УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФОРМАН Продактс»

_____ В.В. Новиков

15.09.2022.

СТЕЛЛАЖ МЕДИЦИНСКИЙ «ФОРМАН» (FOREMAN)

по ТУ 32.50.30-003-79722512-2017

Инструкция по применению

ФРМН.942819.003 ИП

г. Санкт-Петербург

2022

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 4
1.1 Назначение и условия применения 4
1.2 Показания 4
1.3 Противопоказания 4
1.4 Побочные эффекты 4
1.5 Меры предосторожности 5
1.6 Общий вид стеллажа 5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 17
2.1 Основные параметры и характеристики 17
2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям 19
2.3 Требования к надежности 23
2.4 Комплектность 23
2.5 Маркировка 23
2.6 Упаковка 24
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 25
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 25
4.1 Эксплуатационные ограничения 25
4.2 Подготовка к эксплуатации 25
5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ 26
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 27
7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 27
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 28
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 29
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 30
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 31
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 32

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Настоящая инструкция распространяется на Стеллаж медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (в дальнейшем – стеллаж) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках стеллажа, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

⚠ Информация, важная для безопасного применения стеллажа отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

⚠ К эксплуатации допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

⚠ ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования стеллажа, необходимо обращаться к изготовителю:

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАН Продактс»
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12
Тел: +7 (812) 332-58-43
E-mail: nzaharov@foremanfitness.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Стеллаж медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (в дальнейшем – стеллаж), предназначен для оснащения кабинетов и палат, а также иных специальных медицинских помещений лечебно-профилактических учреждений широкого профиля, с целью хранения медицинских изделий.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения.

В зависимости от потенциального риска применения стеллаж относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской федерации №4н от 06.06.2012).

Вид стеллажа в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 260470 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям стеллаж относится к виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации стеллаж относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации стеллаж относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

1.2 Показания

- организация хранения медицинских изделий

1.3 Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.5 Меры предосторожности

⚠ **Внимание!**

- Используйте стеллаж только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за стеллажом осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за стеллажом.
- Не следует ставить на поверхность стеллажа горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

1.6 Общий вид стеллажа

Стеллаж представляет собой изделие, состоящее из полок (настилов), укрепленных в несколько ярусов на стойках каркасов, для хранения предметов и штучных материалов.

Рисунок 1 - Артикул FP-1-03-01. Стеллаж двухсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 1 - Размеры стеллажа двухсекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-01)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 1 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	530	300	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 2 - Артикул FP-1-03-02. Стеллаж двухсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 2 - Размеры стеллажа двухсекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-02)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 1 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	530	400	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

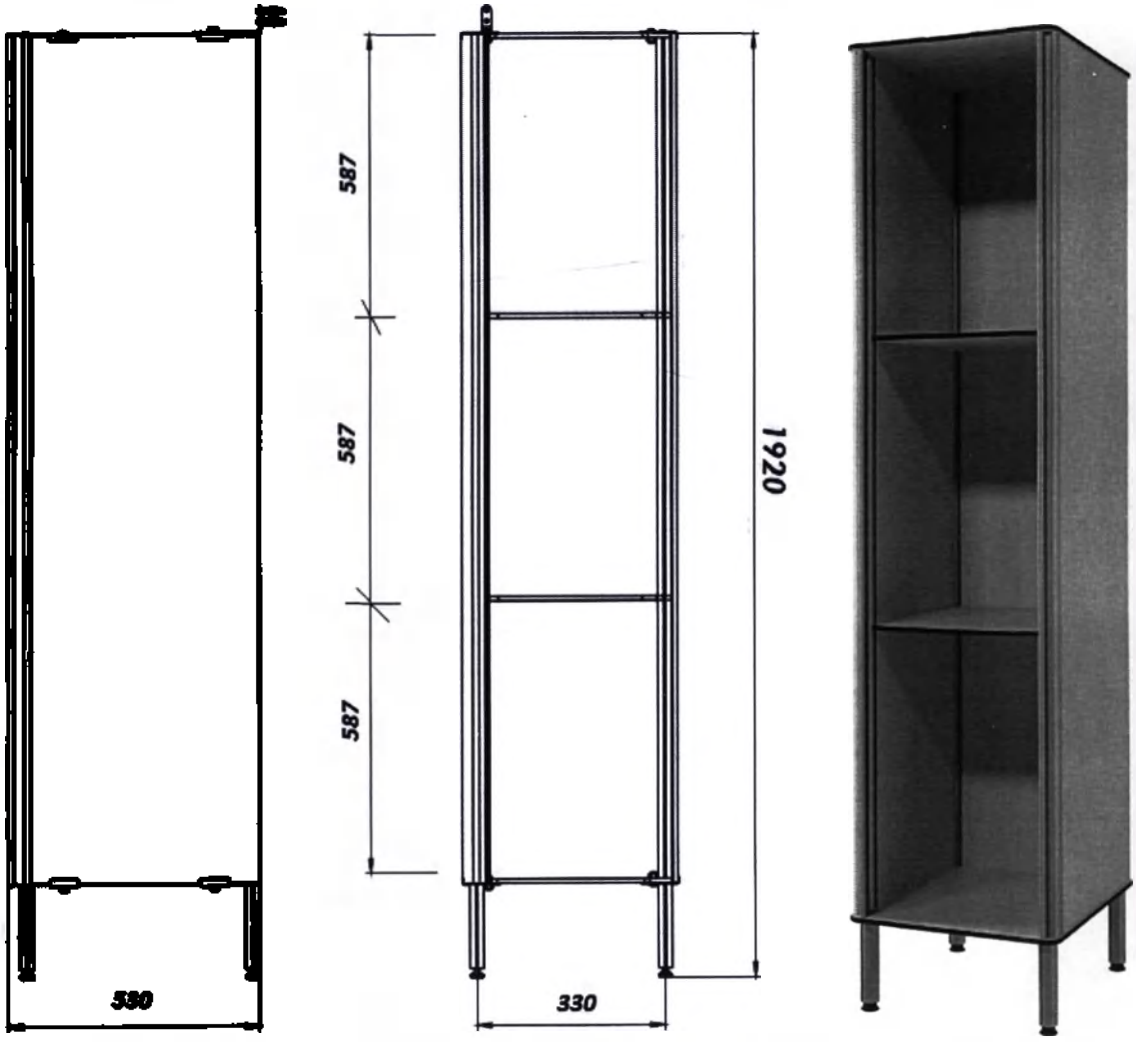

Рисунок 3 - Артикул FP-1-03-03. Стеллаж трехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 3 - Размеры стеллажа трехсекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-03)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 2 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	530	300	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 4 - Артикул FP-1-03-04. Стеллаж трехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 4 - Размеры стеллажа трехсекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-04)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 2 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	530	400	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 5 - Артикул FP-1-03-05. Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 5 - Размеры стеллажа четырехсекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-05)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 3 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	530	300	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 6 - Артикул FP-1-03-06. Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 6 - Размеры стеллажа четырехсекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-06)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 3 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	530	400	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

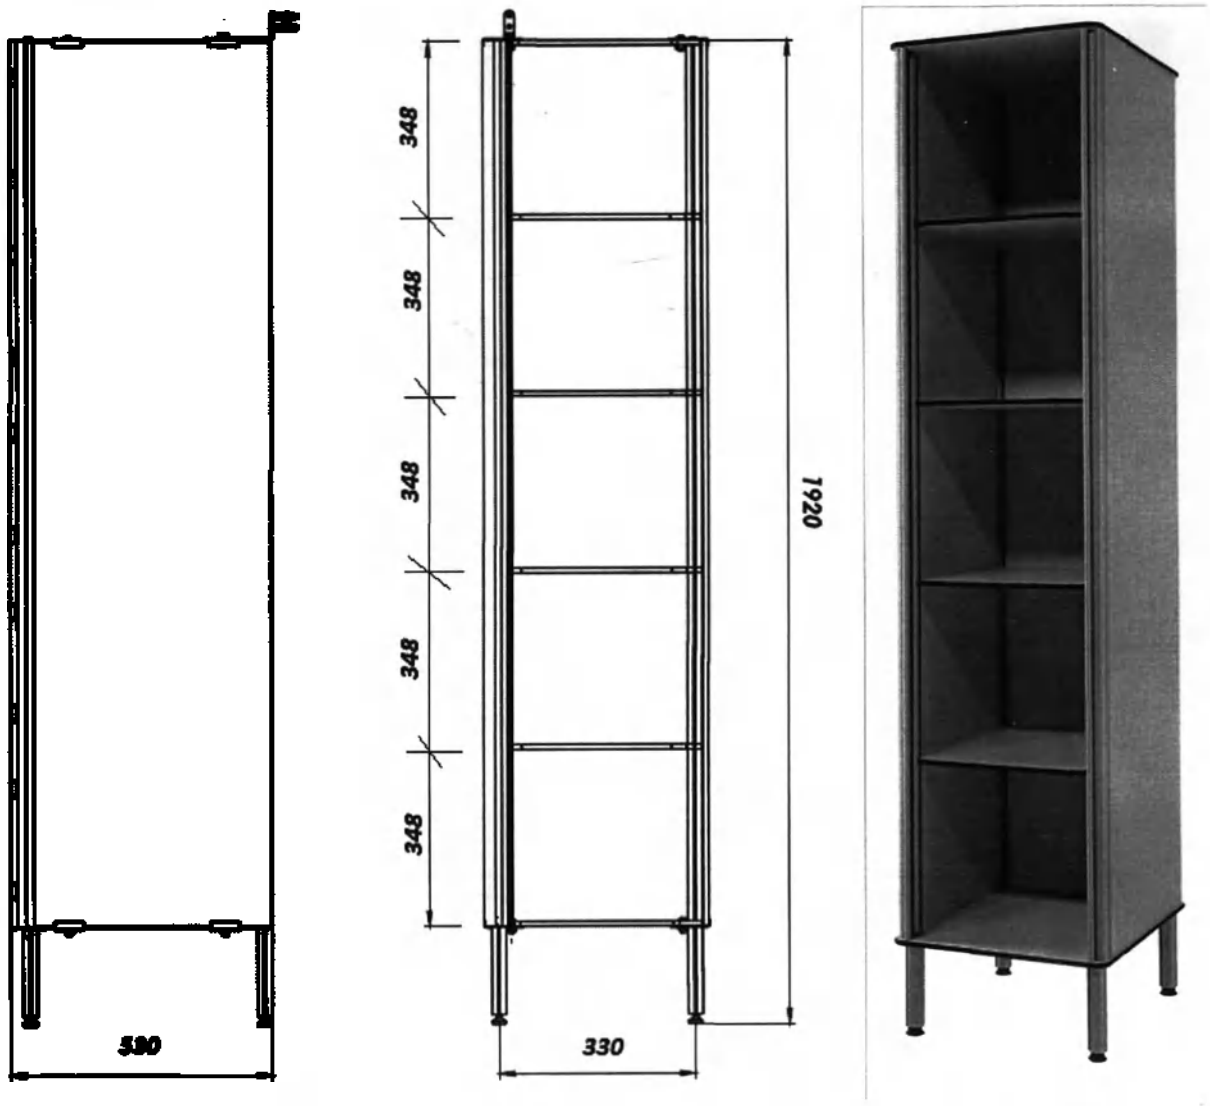

Рисунок 7 - Артикул FP-1-03-07. Стеллаж пятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 7 - Размеры стеллажа пятисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-07)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 4 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	530	300	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 8 - Артикул FP-1-03-08. Стеллаж пятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 8 - Размеры стеллажа пятисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-08)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 4 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	530	400	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

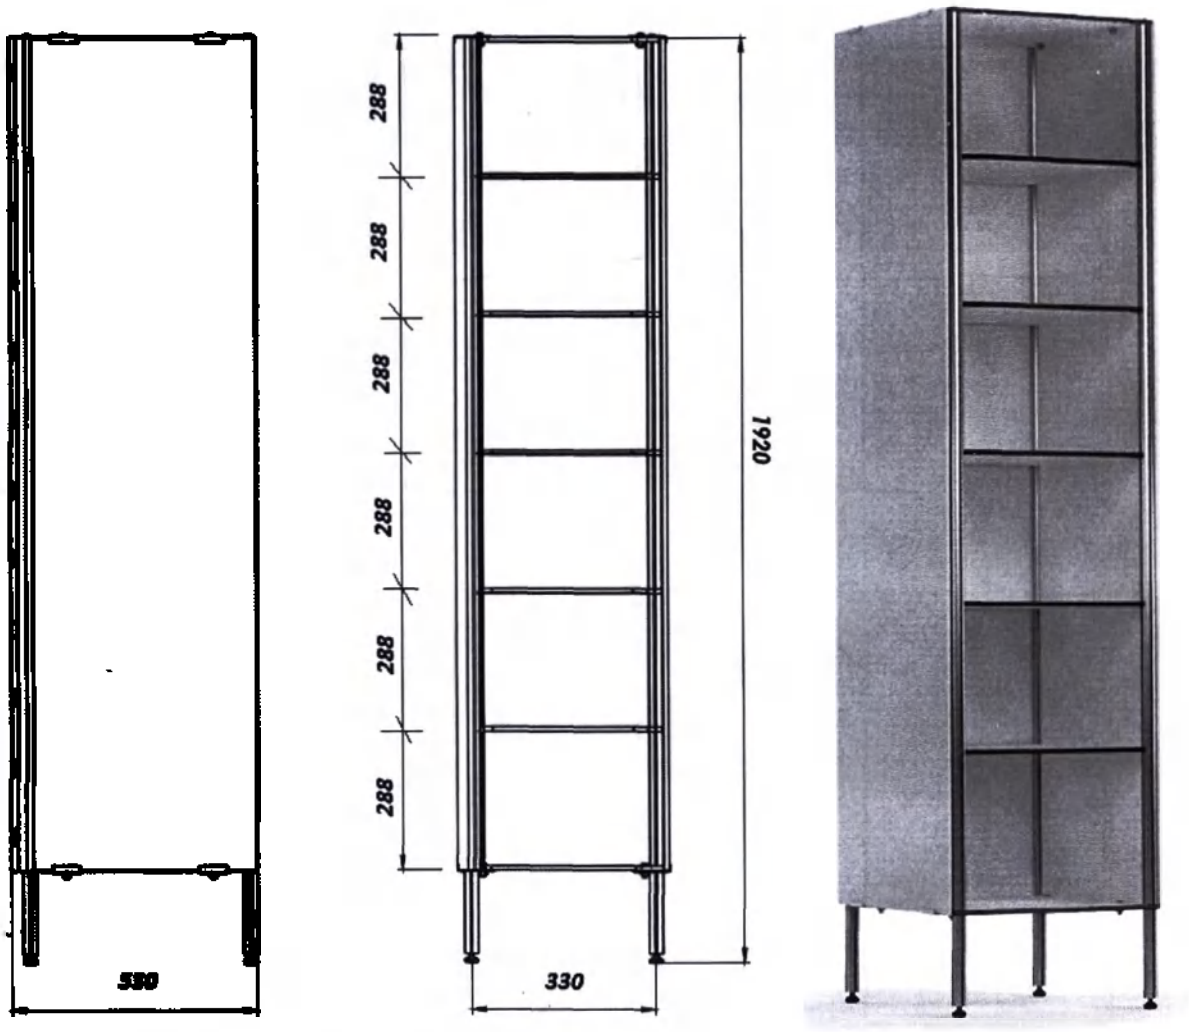

Рисунок 9 - Артикул FP-1-03-09. Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 9 - Размеры стеллажа шестисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-09

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 5 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	530	300	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

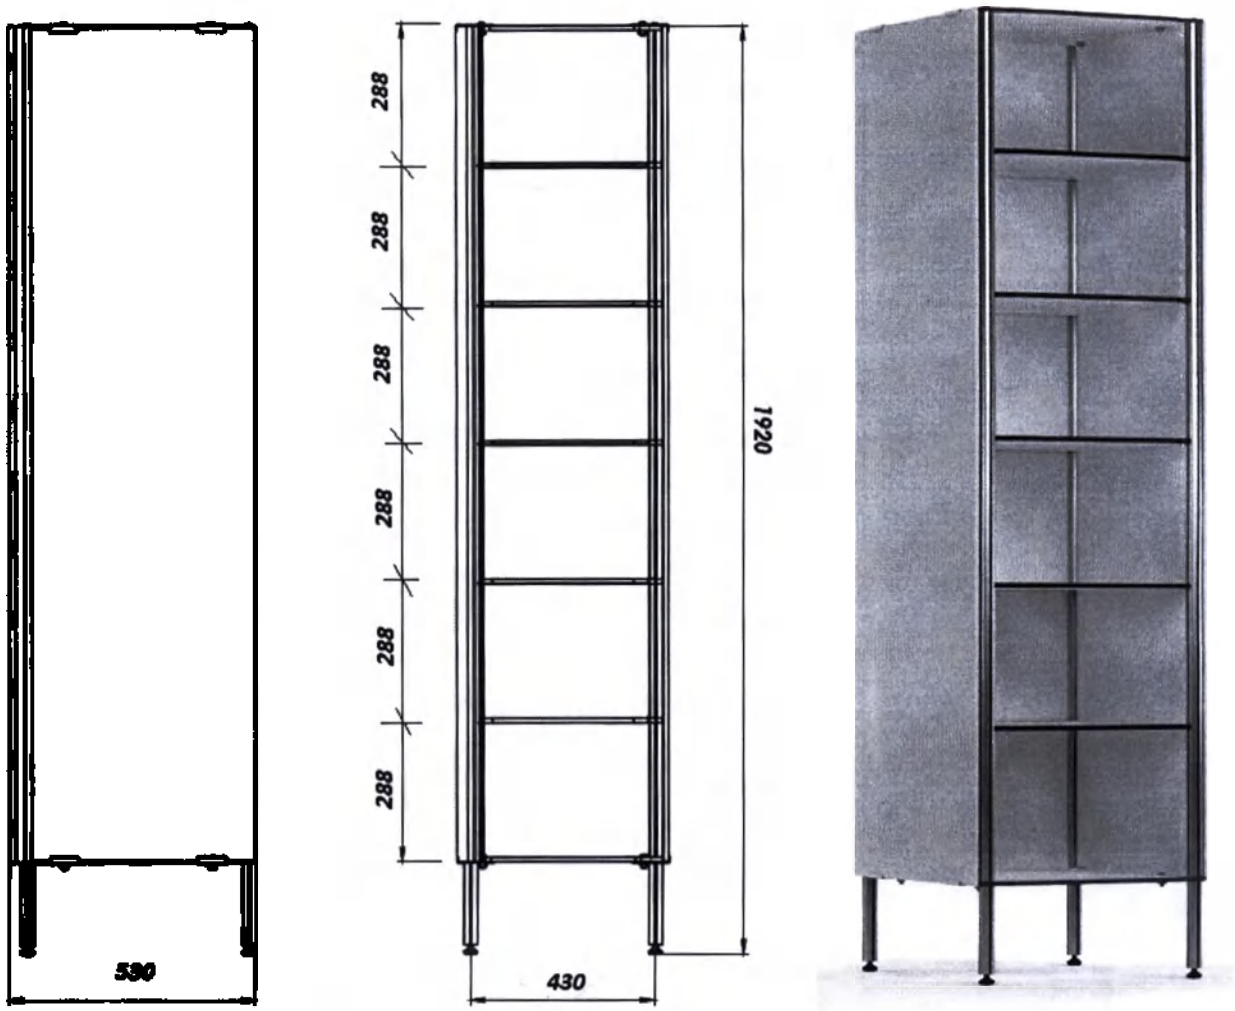

Рисунок 10 - Артикул FP-1-03-10. Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 10 - Размеры стеллажа шестисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-10)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки 5 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	530	400	520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

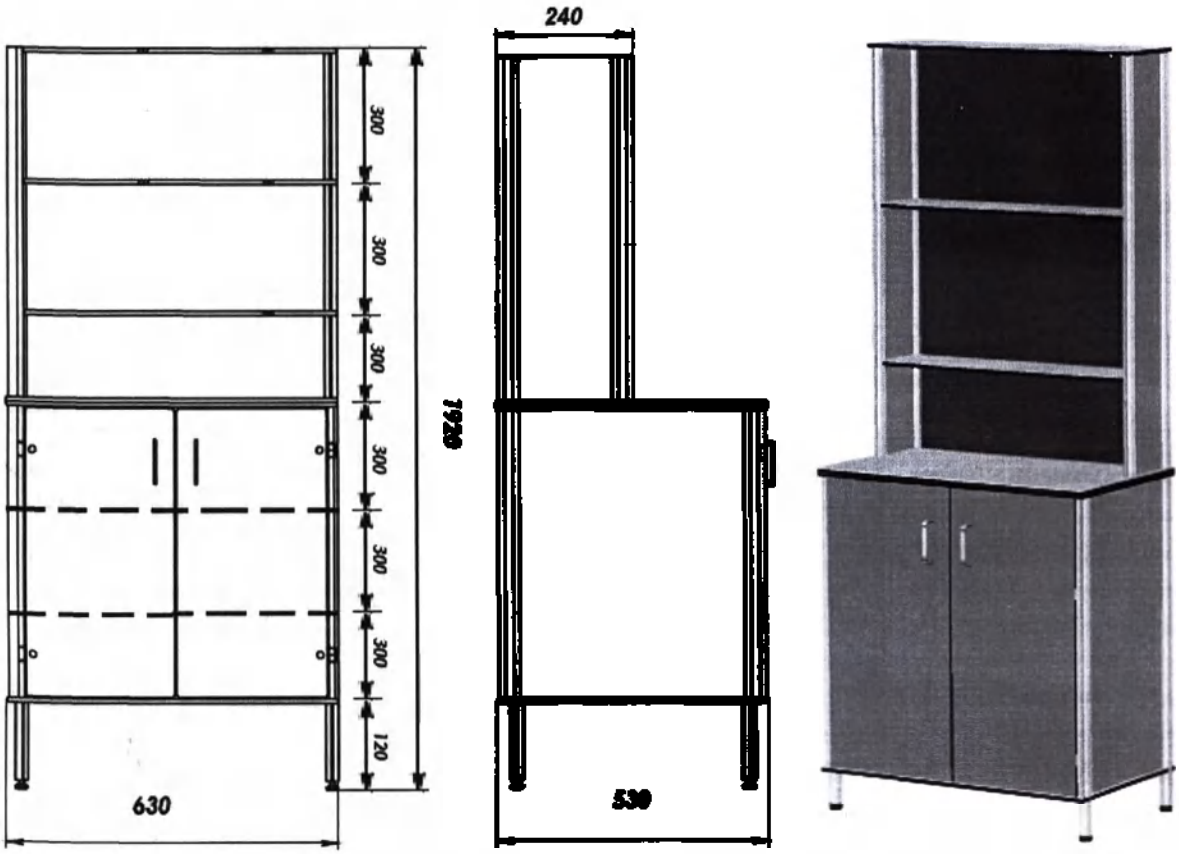

Рисунок В.11 - Артикул FP-1-03-11. Стеллаж с закрываемым отсеком «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица В.11 - Размеры стеллажа с закрываемым отсеком «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-11)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки в закрываемом отсеке 2 шт.		Полки в открытом отсеке 2 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	630	1920	530	600	520	600	230

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

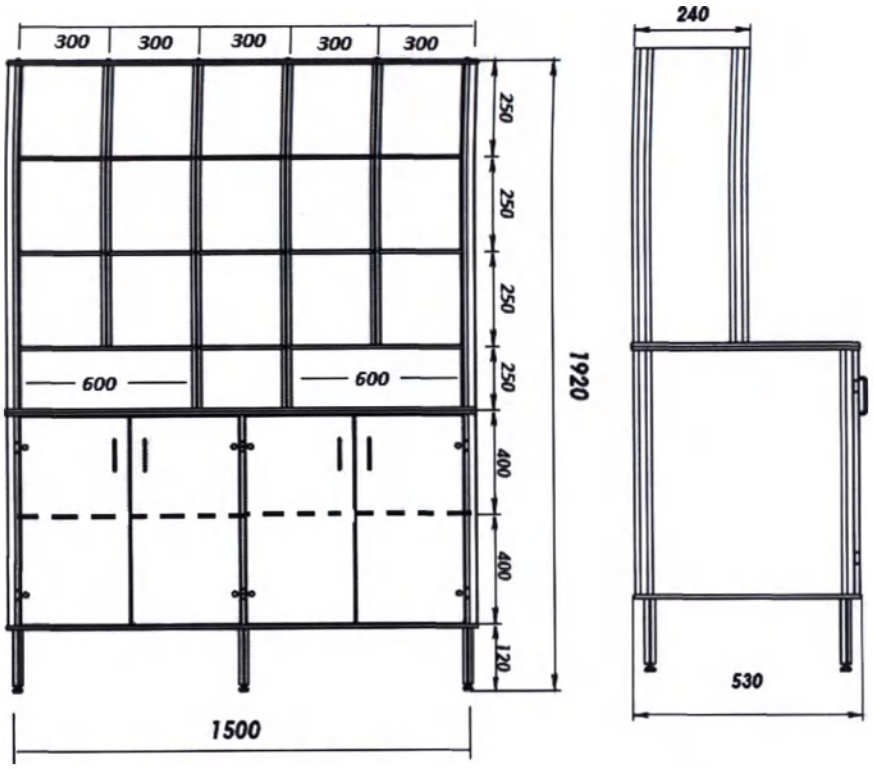

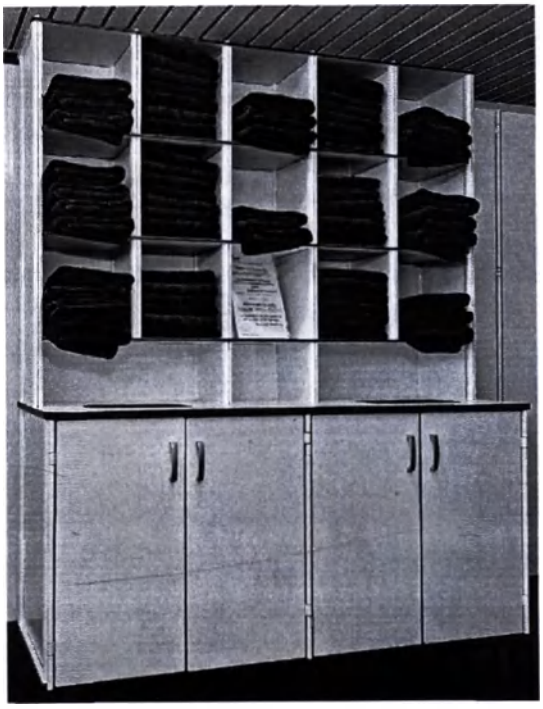

Рисунок В.12 - Артикул FP-1-03-12. Стеллаж с тумбой «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица В.12 - Размеры стеллажа с тумбой «ФОРМАН» (FOREMAN) «ФОРМАН» (FOREMAN) (Артикул FP-1-03-12)

	Ширина стеллажа	Высота стеллажа	Глубина стеллажа	Полки в тумбах 2 шт.		Полки в открытом отсеке 15 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	1920	530	720	520	296	230

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Стеллаж соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 16371-2014, настоящих технических условий и комплектов конструкторской документации согласно таблице 13.

Таблица 13 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

Артикул	Наименование	Обозначение документа	№ Рисунка
FP-1-03-01	Стеллаж двухсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-01	Рис.1.
FP-1-03-02	Стеллаж двухсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-02	Рис.2.
FP-1-03-03	Стеллаж трехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-03	Рис.3.
FP-1-03-04	Стеллаж трехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-04	Рис.4.
FP-1-03-05	Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-05	Рис.5.
FP-1-03-06	Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-06	Рис.6.
FP-1-03-07	Стеллаж пятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-07	Рис.7.
FP-1-03-08	Стеллаж пятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-08	Рис.8.
FP-1-03-09	Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-09	Рис.9.
FP-1-03-10	Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-10	Рис.10.
FP-1-03-11	Стеллаж с закрываемым отсеком «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-11	Рис.11.
FP-1-03-12	Стеллаж с тумбой «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-12	Рис.12.

2.1.2 Конструкция и внешний вид стеллажа соответствуют рисункам 1-12 раздела 1.6.

2.1.3 Габаритные размеры и масса стеллажа соответствуют значениям, указанным в таблице 14. Предельные отклонения размеров стеллажа не превышают ± 4 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 14 – Массогабаритные характеристики

Артикул	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Масса, не более, кг
FP-1-03-01	Стеллаж двухсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	28
FP-1-03-02	Стеллаж двухсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	29
FP-1-03-03	Стеллаж трехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	30
FP-1-03-04	Стеллаж трехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	31
FP-1-03-05	Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	32
FP-1-03-06	Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	33
FP-1-03-07	Стеллаж пятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	34
FP-1-03-08	Стеллаж пятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	35
FP-1-03-09	Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	36
FP-1-03-10	Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	37
FP-1-03-11	Стеллаж с закрываемым отсеком «ФОРМАН» (FOREMAN)	630x1920x530	38
FP-1-03-12	Стеллаж с тумбой «ФОРМАН» (FOREMAN)	1500x1920x530	120

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371-2014.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей стеллажа по ГОСТ 16371-2014.

2.1.6 На видимой поверхности стеллажа отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400-2013: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.7 Столешницы и полки стеллажей выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на столешницу 30± 1 кг;
- на полку 3± 0,5 кг.

2.1.8 Количество и размеры полок, а также их расположение соответствуют рисункам 1-12 раздела 1.6. Предельные отклонения размеров не превышают ± 2 мм.

2.1.8.1 Толщина стенок стеллажа 4 мм. Толщина дверей и полок стеллажа: 10 мм. Допускаемое отклонение: ± 0,5 мм.

2.1.9 Дверцы стеллажа открываются и закрываются плавно, без перекосов, с усилием не более 20 Н.

2.1.10 Петли дверей интегрированы в алюминиевый профиль, обеспечивая открывание дверей на 175± 2 градусов.

2.1.11 Двери стеллажа без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

2.1.12 Стеллаж устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.13 Стеллаж устойчив при приложении нагрузки на открытую дверцу 45 Н.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.1.14 Опоры стеллажа допускают регулировку не менее, чем на 10 мм. Минимальная высота опоры стеллажа 110 мм.

2.1.15 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей фурнитуры и деталей из металла по ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 для изделий группы условий 1.

2.1.16 Наружные поверхности стеллажа устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2.1.17 Стеллаж при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.18 Стеллаж в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при транспортировании в условиях 5 по ГОСТ 15150-69. Стеллаж в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при хранении в условиях 2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.19 Стеллаж в транспортной упаковке обладает прочностью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении стеллажа, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве стеллажа, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

2.2.3 Для изготовления стеллажа используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 15.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 15 - Сырье, материалы и покупные изделия

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
FP-1-03-01	Стеллаж двух-секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-02	Стеллаж двух-секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-03	Стеллаж трех-секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-04	Стеллаж трех-секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-05	Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-06	Стеллаж четырехсекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-07	Стеллаж пятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-08	Стеллаж пятисекционный	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
	«ФОРМАН» (FOREMAN))		Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-09	Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-10	Стеллаж шестисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-11	Стеллаж с закрываемым отсеком «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Дверцы	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
			металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-03-12	Стеллаж с тумбой «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Дверцы	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (То) не менее 5000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п.п. 2.1.5 - 2.1.11.

2.3.2 Средний срок службы стеллажа не менее 4 лет. Критерием предельного состояния стеллажа считается невозможность или нецелесообразность его восстановления (или использования).

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

- Стеллаж одного из исполнений, в сборе
- Эксплуатационная документация:

Инструкция по применению ФРМН.942819.003 ИП

Примечание: количество и исполнение стеллажа определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка стеллажа соответствует ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

2.5.2 На каждом изделии этикетка, на которой указано:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- дата изготовления: месяц и год;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер;
- обозначение настоящих технических условий, ГОСТ 16371-2014.

2.5.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации.

2.6.2 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту стеллажа от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям стеллаж соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

⚠ Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния изделия, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:
Температура от плюс 10 до плюс 35°С.
Относительная влажность воздуха: до 80%.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.3 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

4.3 Порядок работы с изделием

- Освободите стеллаж от упаковки, выбросите упаковочный материал.

⚠ Все изделия поставляются готовыми к применению, однако рекомендуется перед первым использованием осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями Раздела 5.

- Используйте изделие в соответствии с его функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п. 2.1.7).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию изделия согласно разделу 5.1 настоящей инструкции.

5.1 Внешние и внутренние доступные поверхности стеллажа протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644-96 или иные средства согласно МУ 287-113.

⚠ Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за стеллажом.

⚠ Не следует ставить на поверхность стеллажа горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение стеллажа должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

Транспортирование стеллажа может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

6.2 Условия транспортирования стеллажа должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 100%).

6.3 Условия хранения стеллажа в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98%).

7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790-10.

7.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 стеллаж относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

7.3 Перед утилизацией стеллаж должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

7.4 Стеллаж должен подлежать утилизации в случае:

– окончания срока эксплуатации;

– подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

7.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование стеллажа должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2 К эксплуатации стеллажа допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стеллаж медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) производства ООО «ФОРМАН Продактс»

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

Петров _____ Петров А. С. _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллаж медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ФОРМАН Продактс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовить принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

– Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

– Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

– Несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном

– Наличия механических повреждений

– Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

на замену в течение гарантийного срока

Стеллаж медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ **Артикул** _____ **Заводской номер** _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____

(подпись, печать)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В настоящем документе
прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (семнадцать) лист (ов)
Генеральный директор
ООО " ФОРМАН Продактс"
Новиков В.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU