



ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюнь Вэй

Сюнь Вэй.

по доверенности от 30.11.22г

Сысоева Н.В.

2023 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Макет маркировки медицинского изделия

Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) имунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro

Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro, в составе

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;

Код партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057, Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель в РФ:

129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел. +7 (499) 553-60-36

Информацию на стикере считать приоритетной.



Сысоева

по доверенности от 30.11.22г
СЫСОЕВА Н.В.
руководитель отдела
регистрации

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»



Сюн Вэй.

2023 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro

FDP Cal

FDP Cal 1: 2×1.0 mL; FDP Cal 2: 2×1.0 mL; FDP Cal 3: 2×1.0 mL; FDP Cal 4: 2×1.0 mL; FDP Cal 5: 2×1.0 mL

Fibrin(ogen) Degradation Products (FDP) Calibrators

Fibrin(ogen) Yıkım Ürünleri (FDP) Kalibratörleri

Calibratori per prodotti di degradazione della fibrina/del fibrinogeno (FDP)

Calibradores de produtos de degradação de fibrin(ogênio) (FDP)

Calibradores de productos de degradación de la fibrina (fibrinógeno) (PDF)

Калибраторы для теста на продукты распада фибрина (фибриногена) (ПРФ)

Calibrateurs produits de dégradation de fibrine (fibrinogène) (FDP)


Fibrin(ogen)-Abbauprodukt-Kalibratoren (FDP)



19Z712209011700011

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680 www.mindray.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany 047-042394-00(1.0)

mindray

Рисунок 1 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 1)

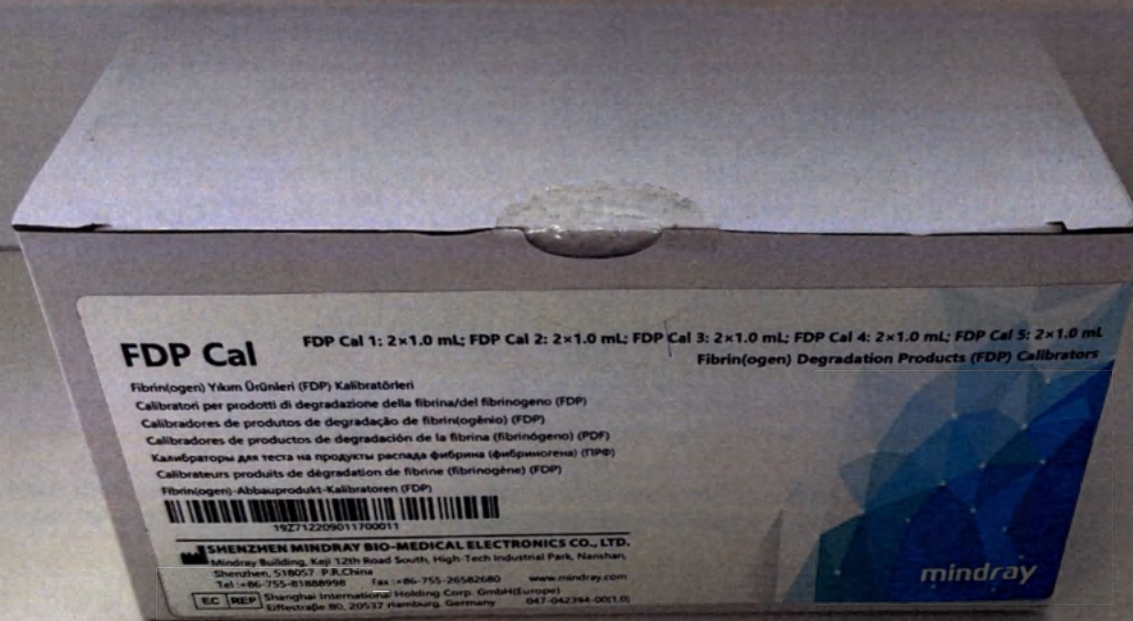


Рисунок 2 Внешняя Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим методом в

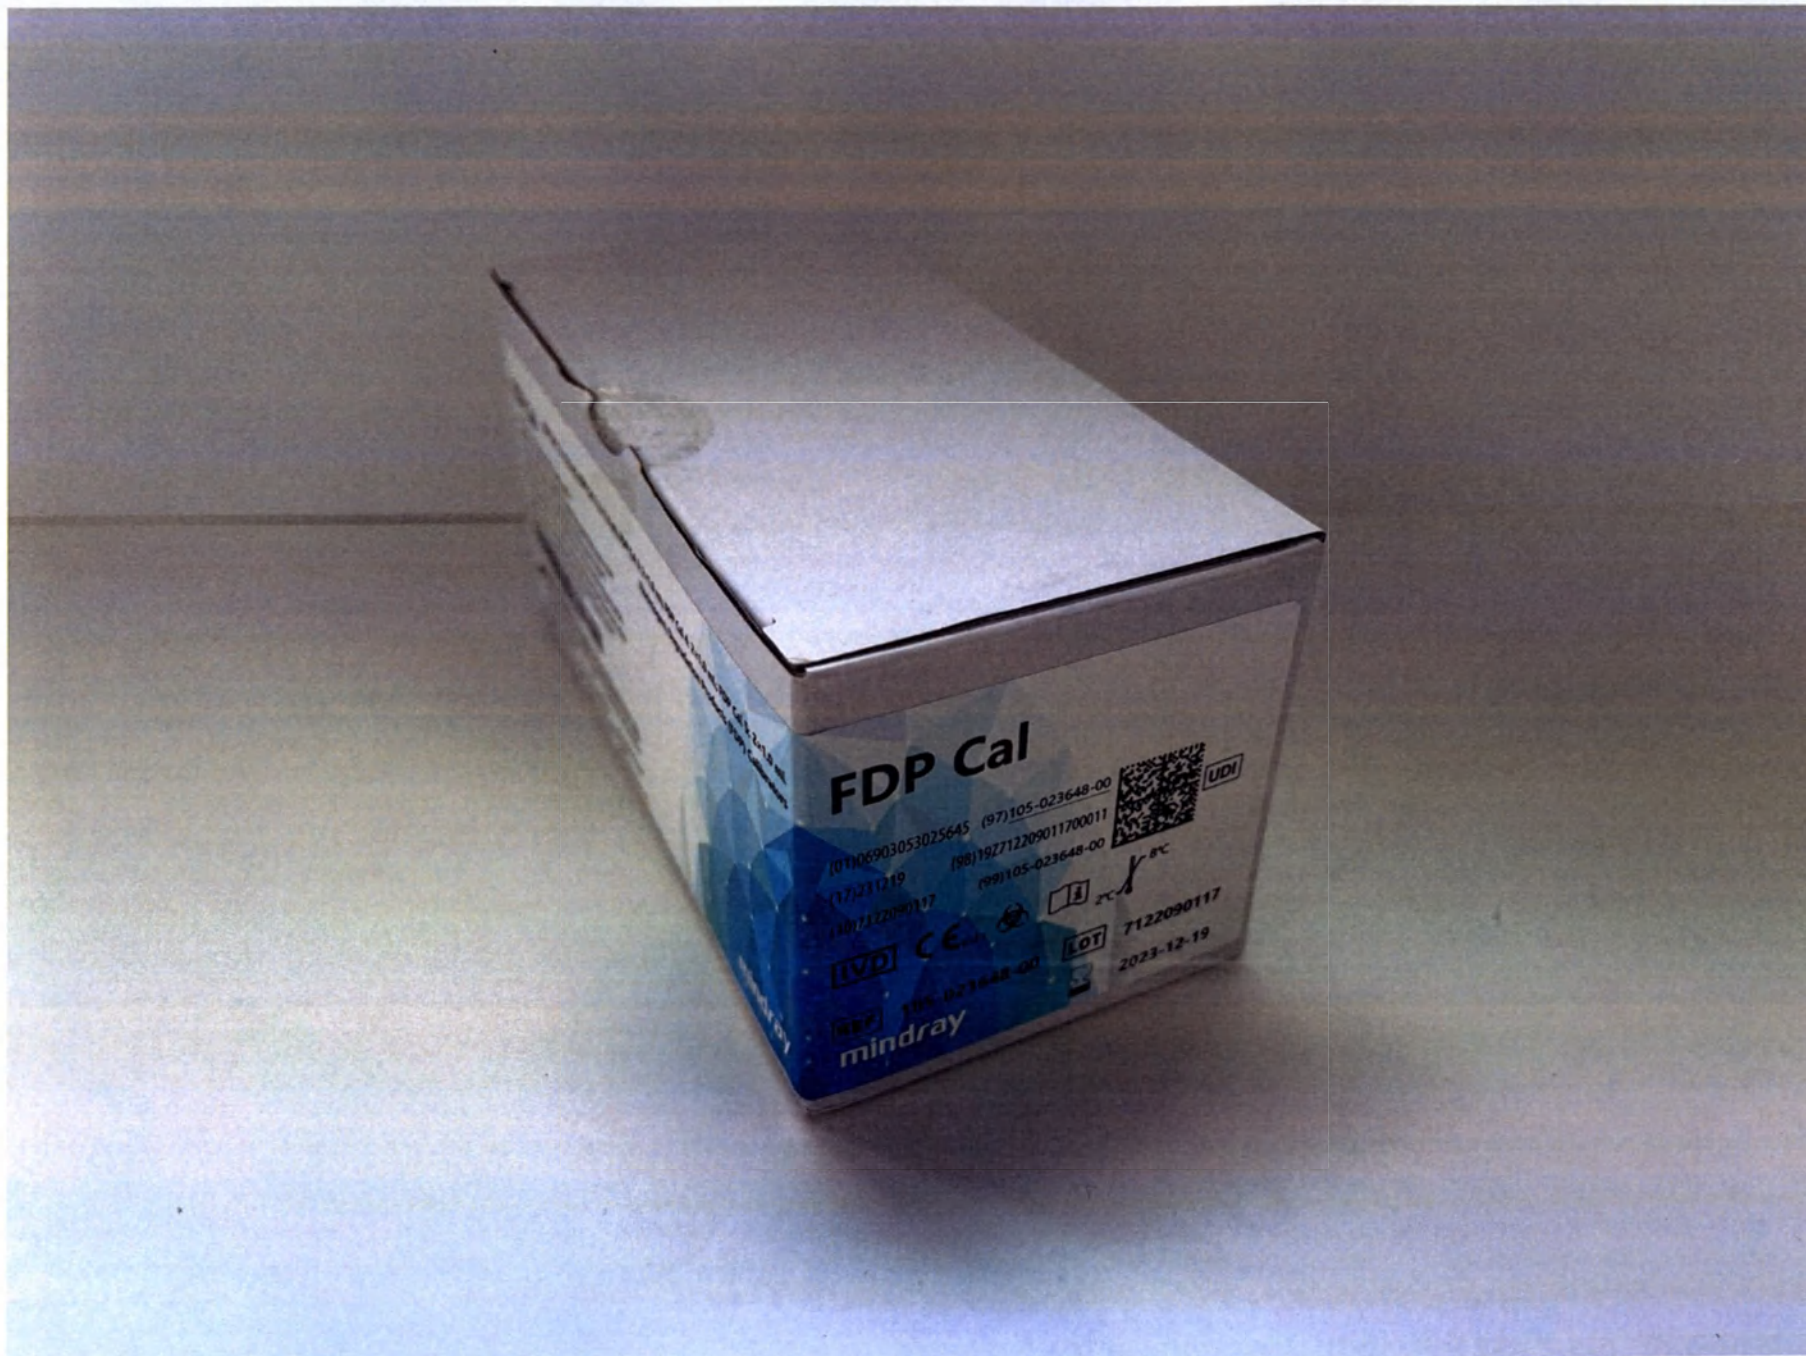


Рисунок 3 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим

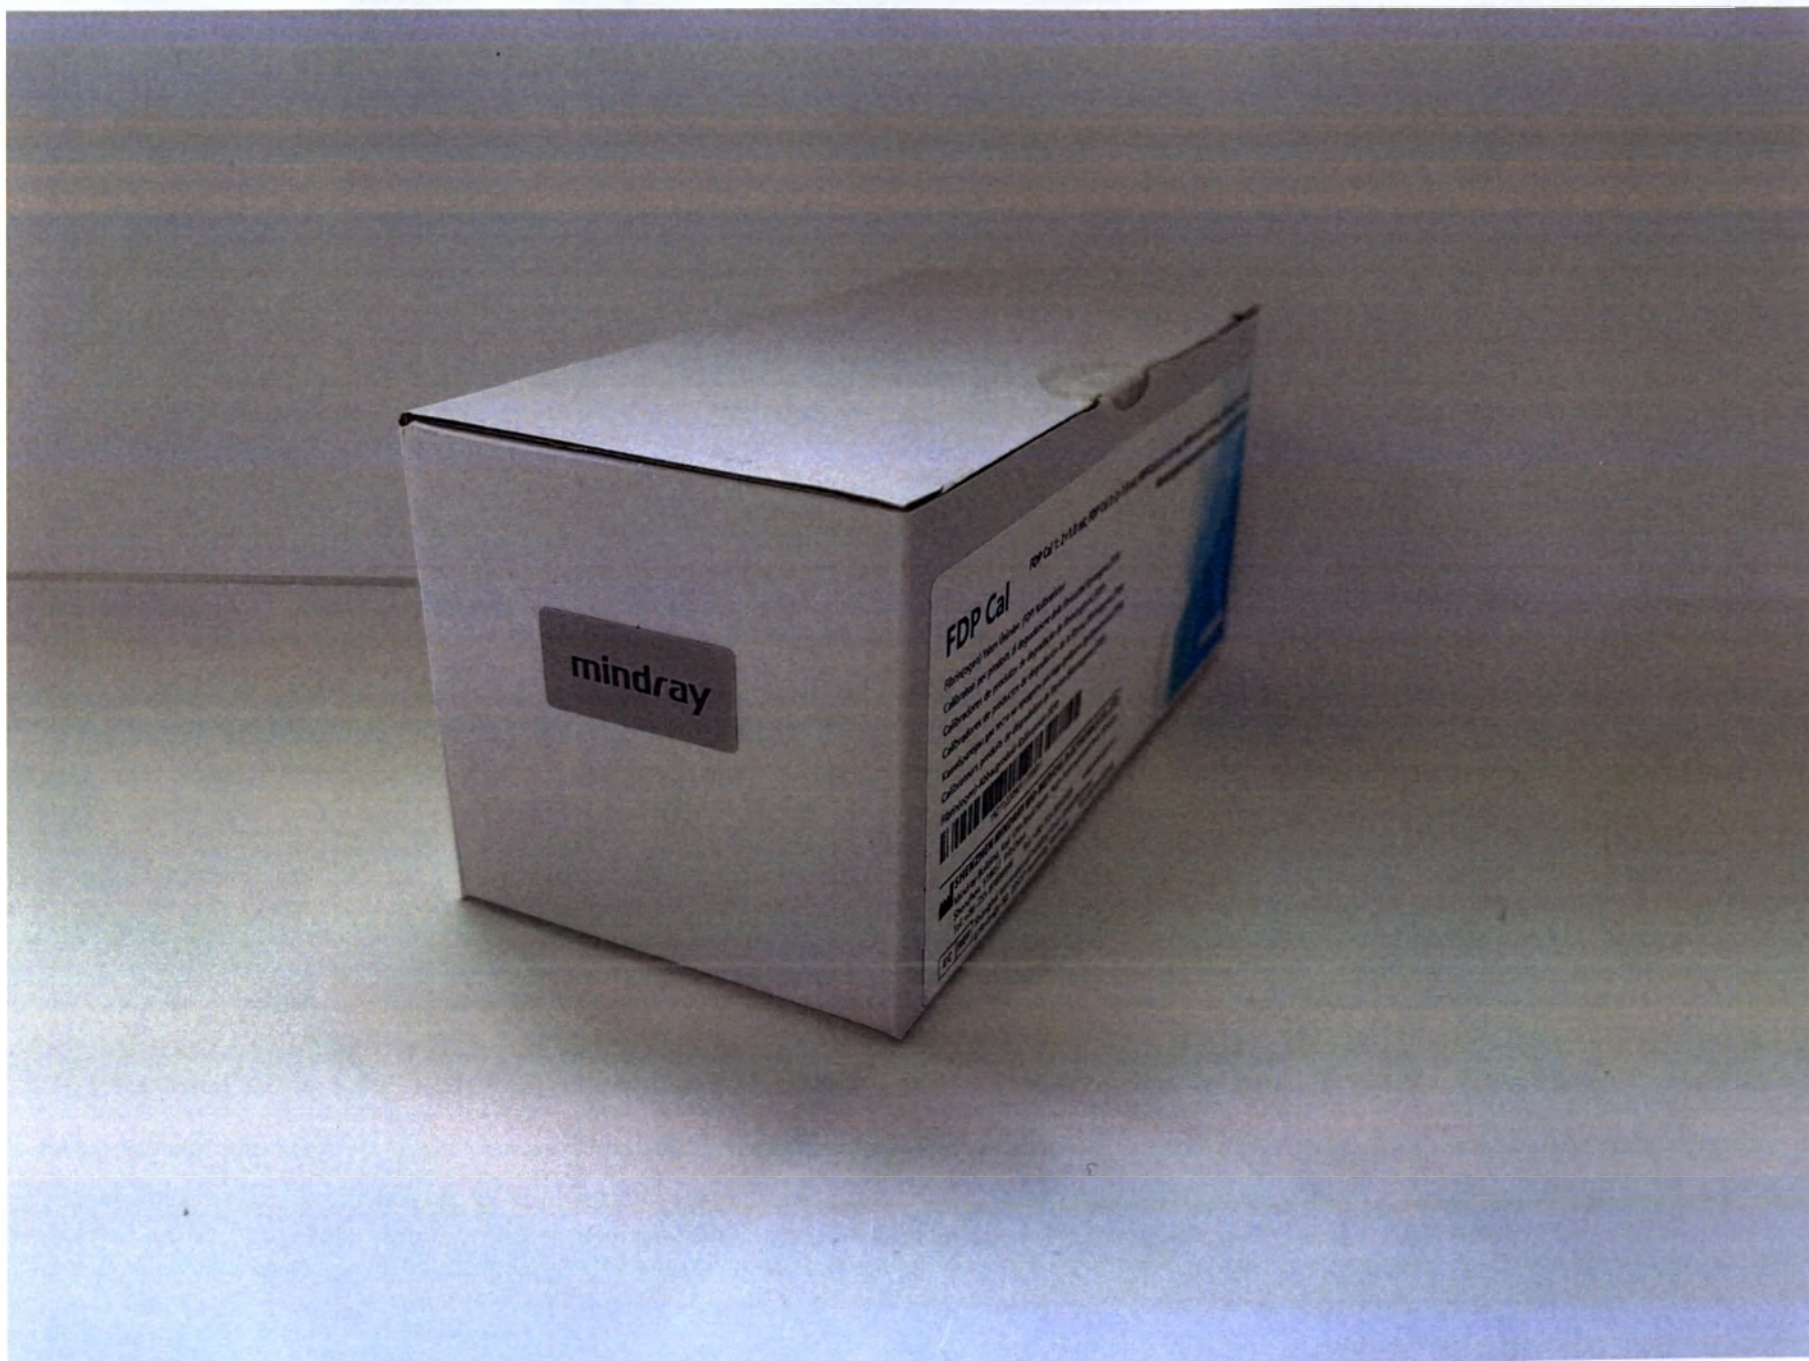


Рисунок 4 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим

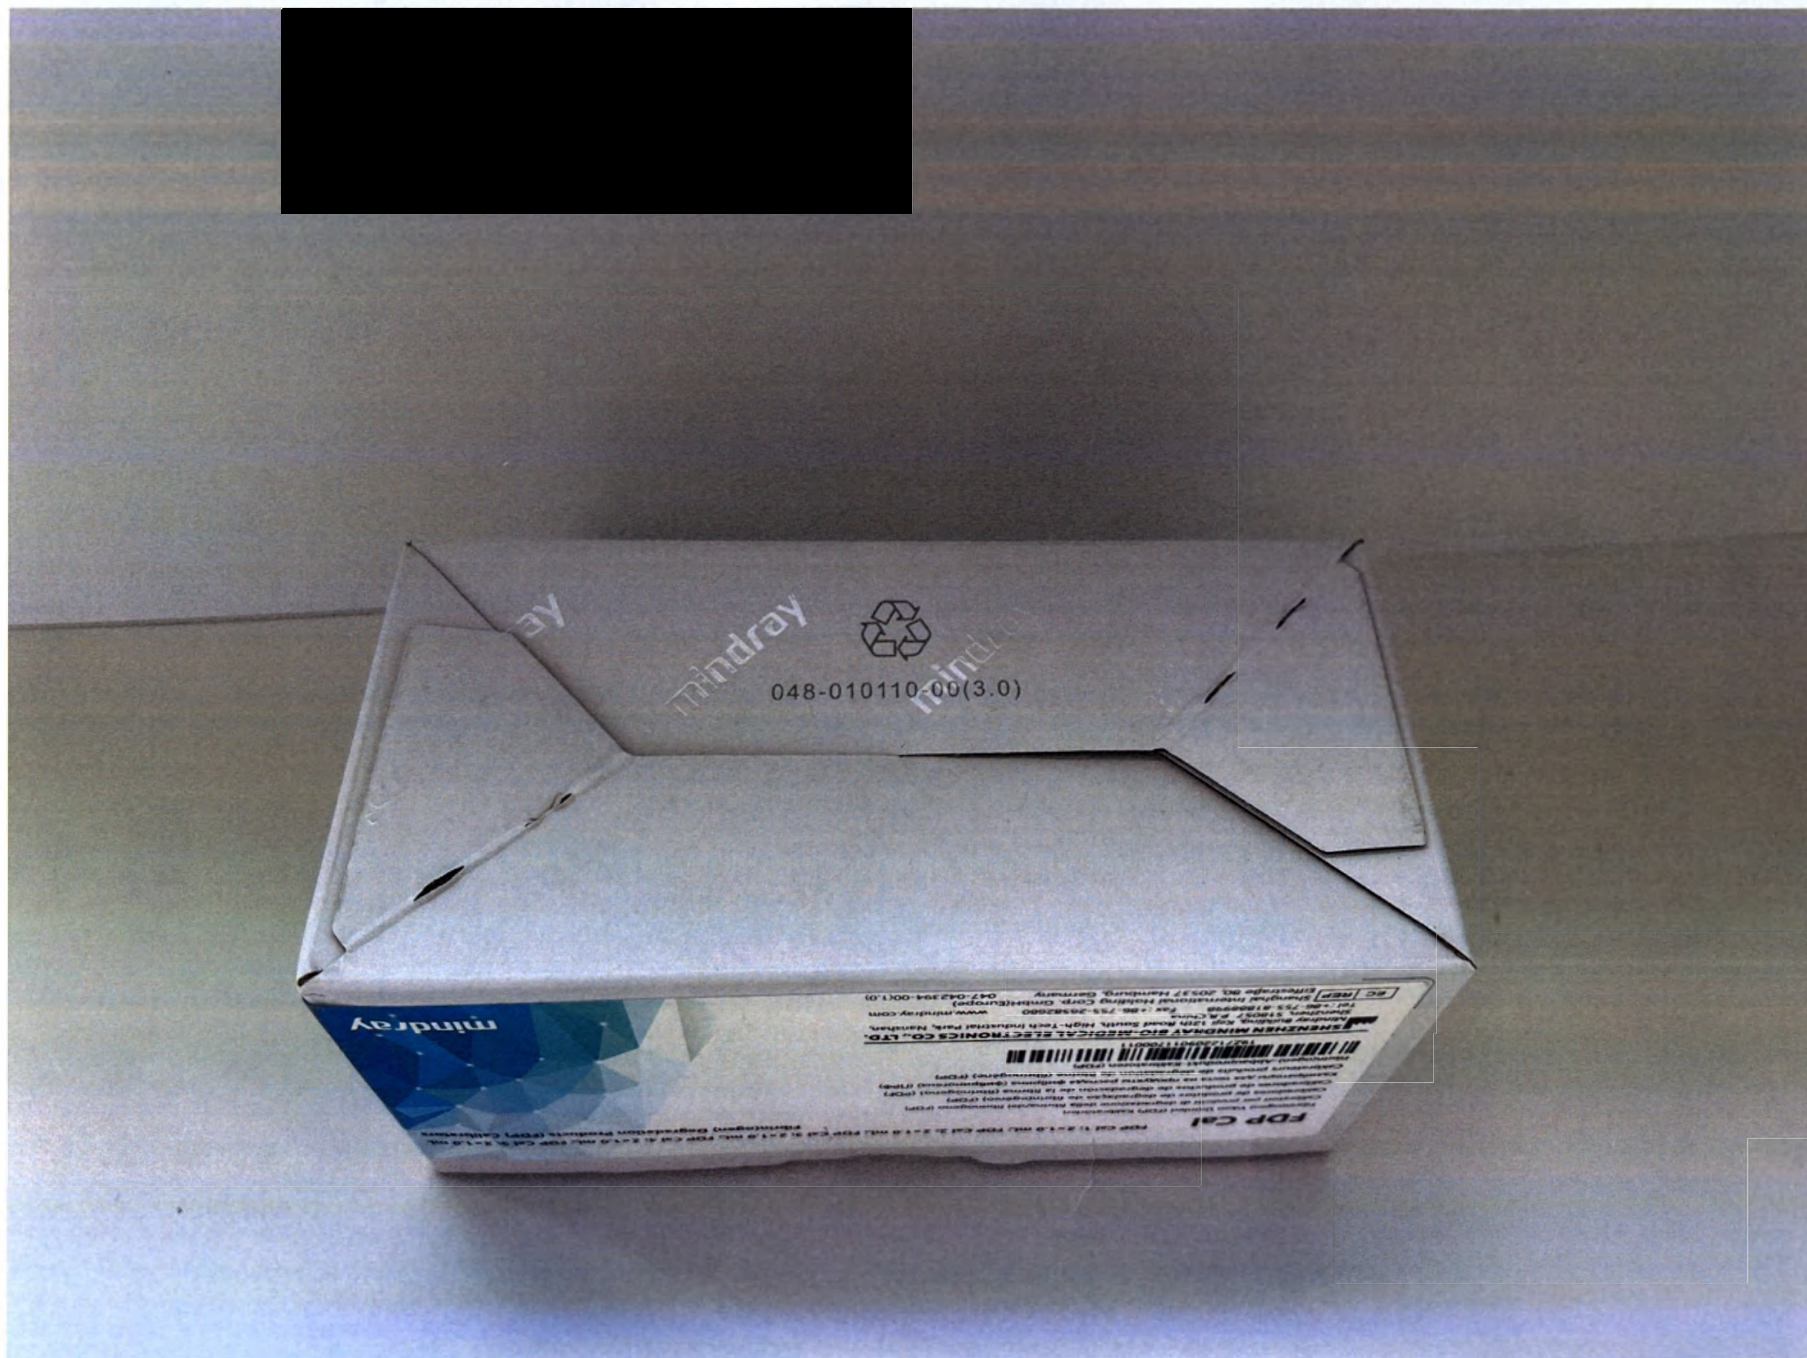


Рисунок 5 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим



Рисунок 6. Общий

вид Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal)



Рисунок 7.

Общий вид Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal)



вид Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal)

Рисунок 8. Общий



Рисунок 9. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 1) (вид 1)



Рисунок 10. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 1) (вид 2)

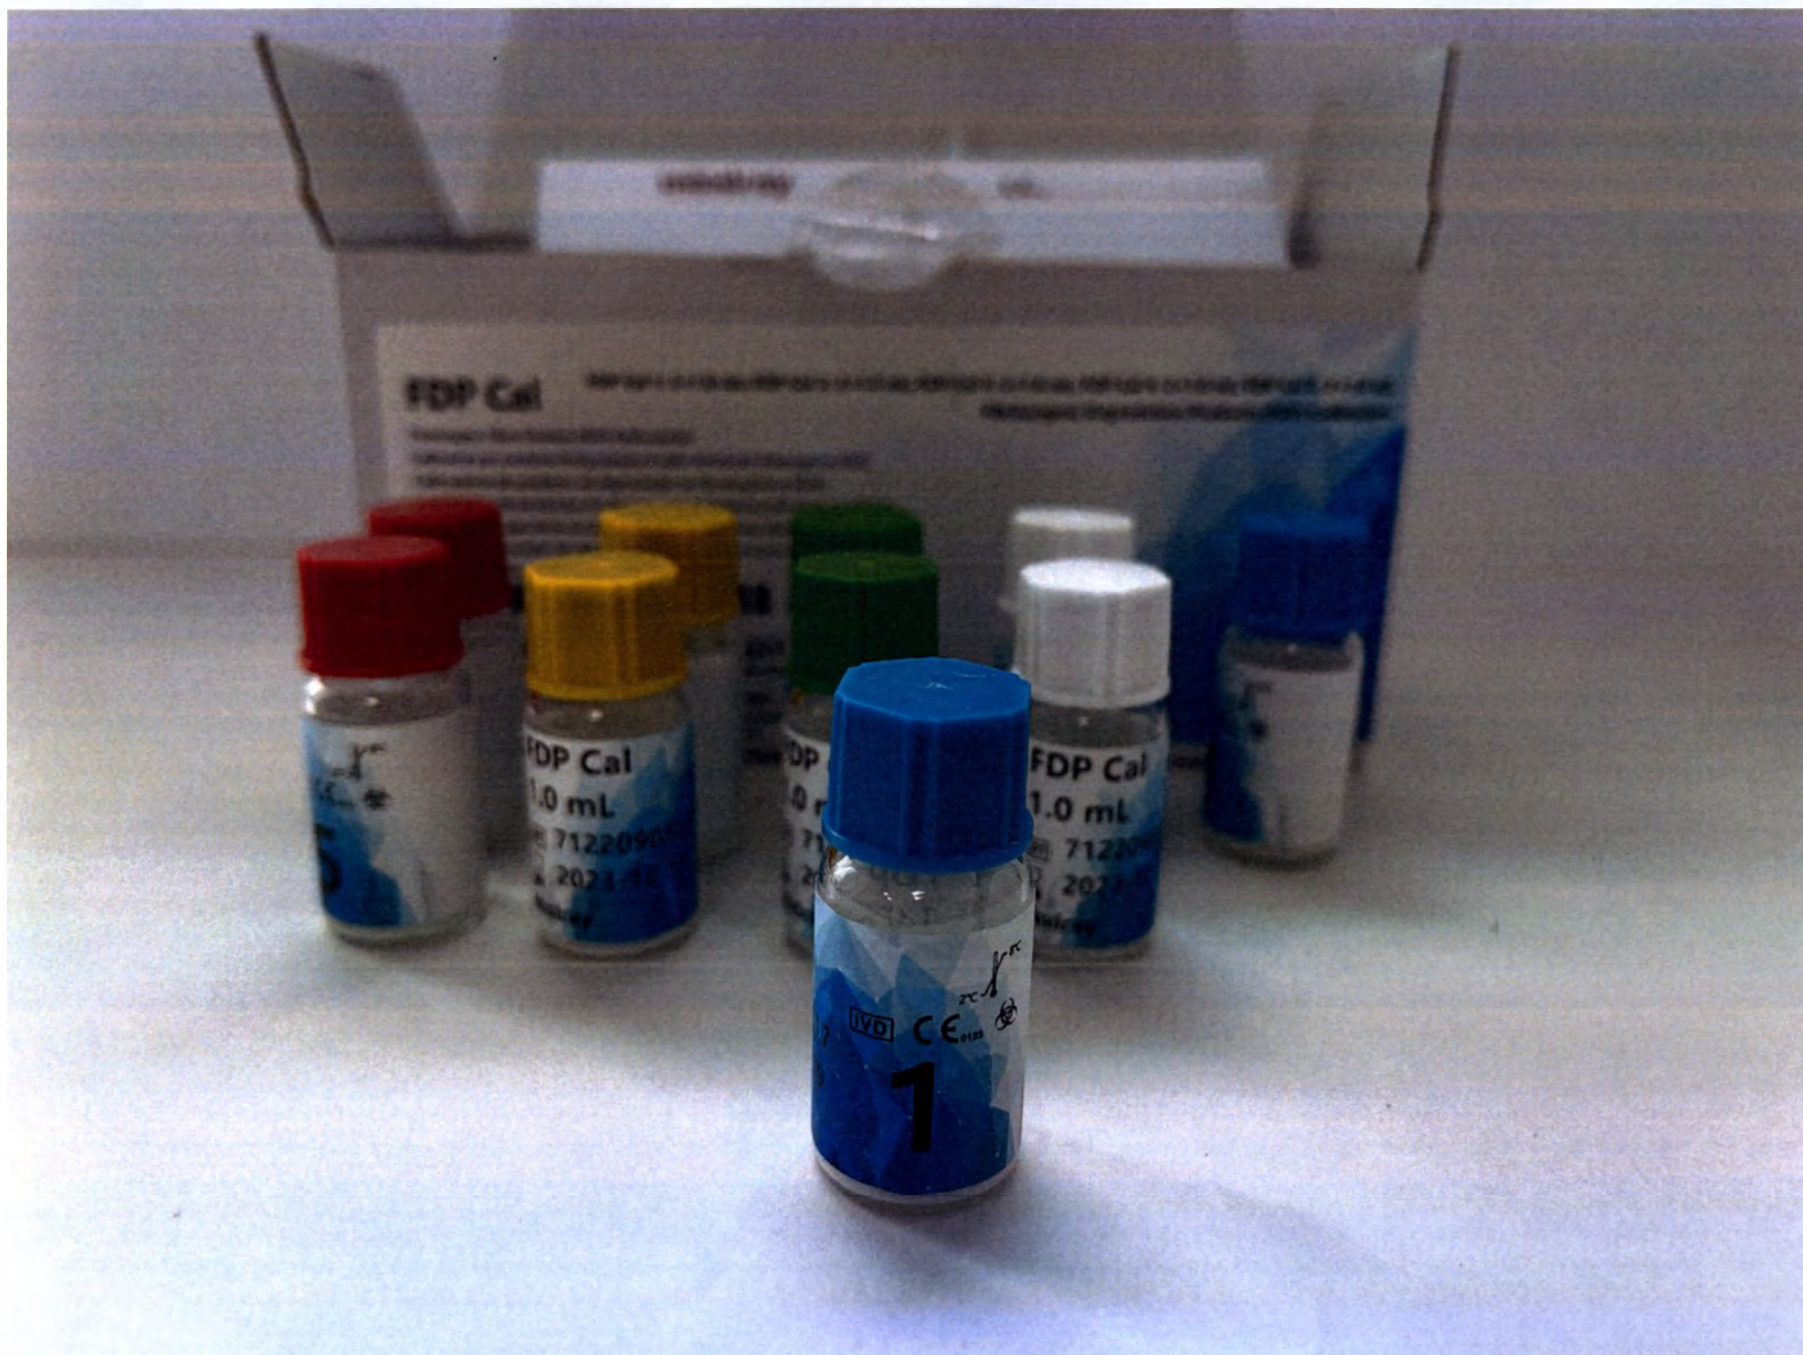


Рисунок 11. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 1) (вид 3)

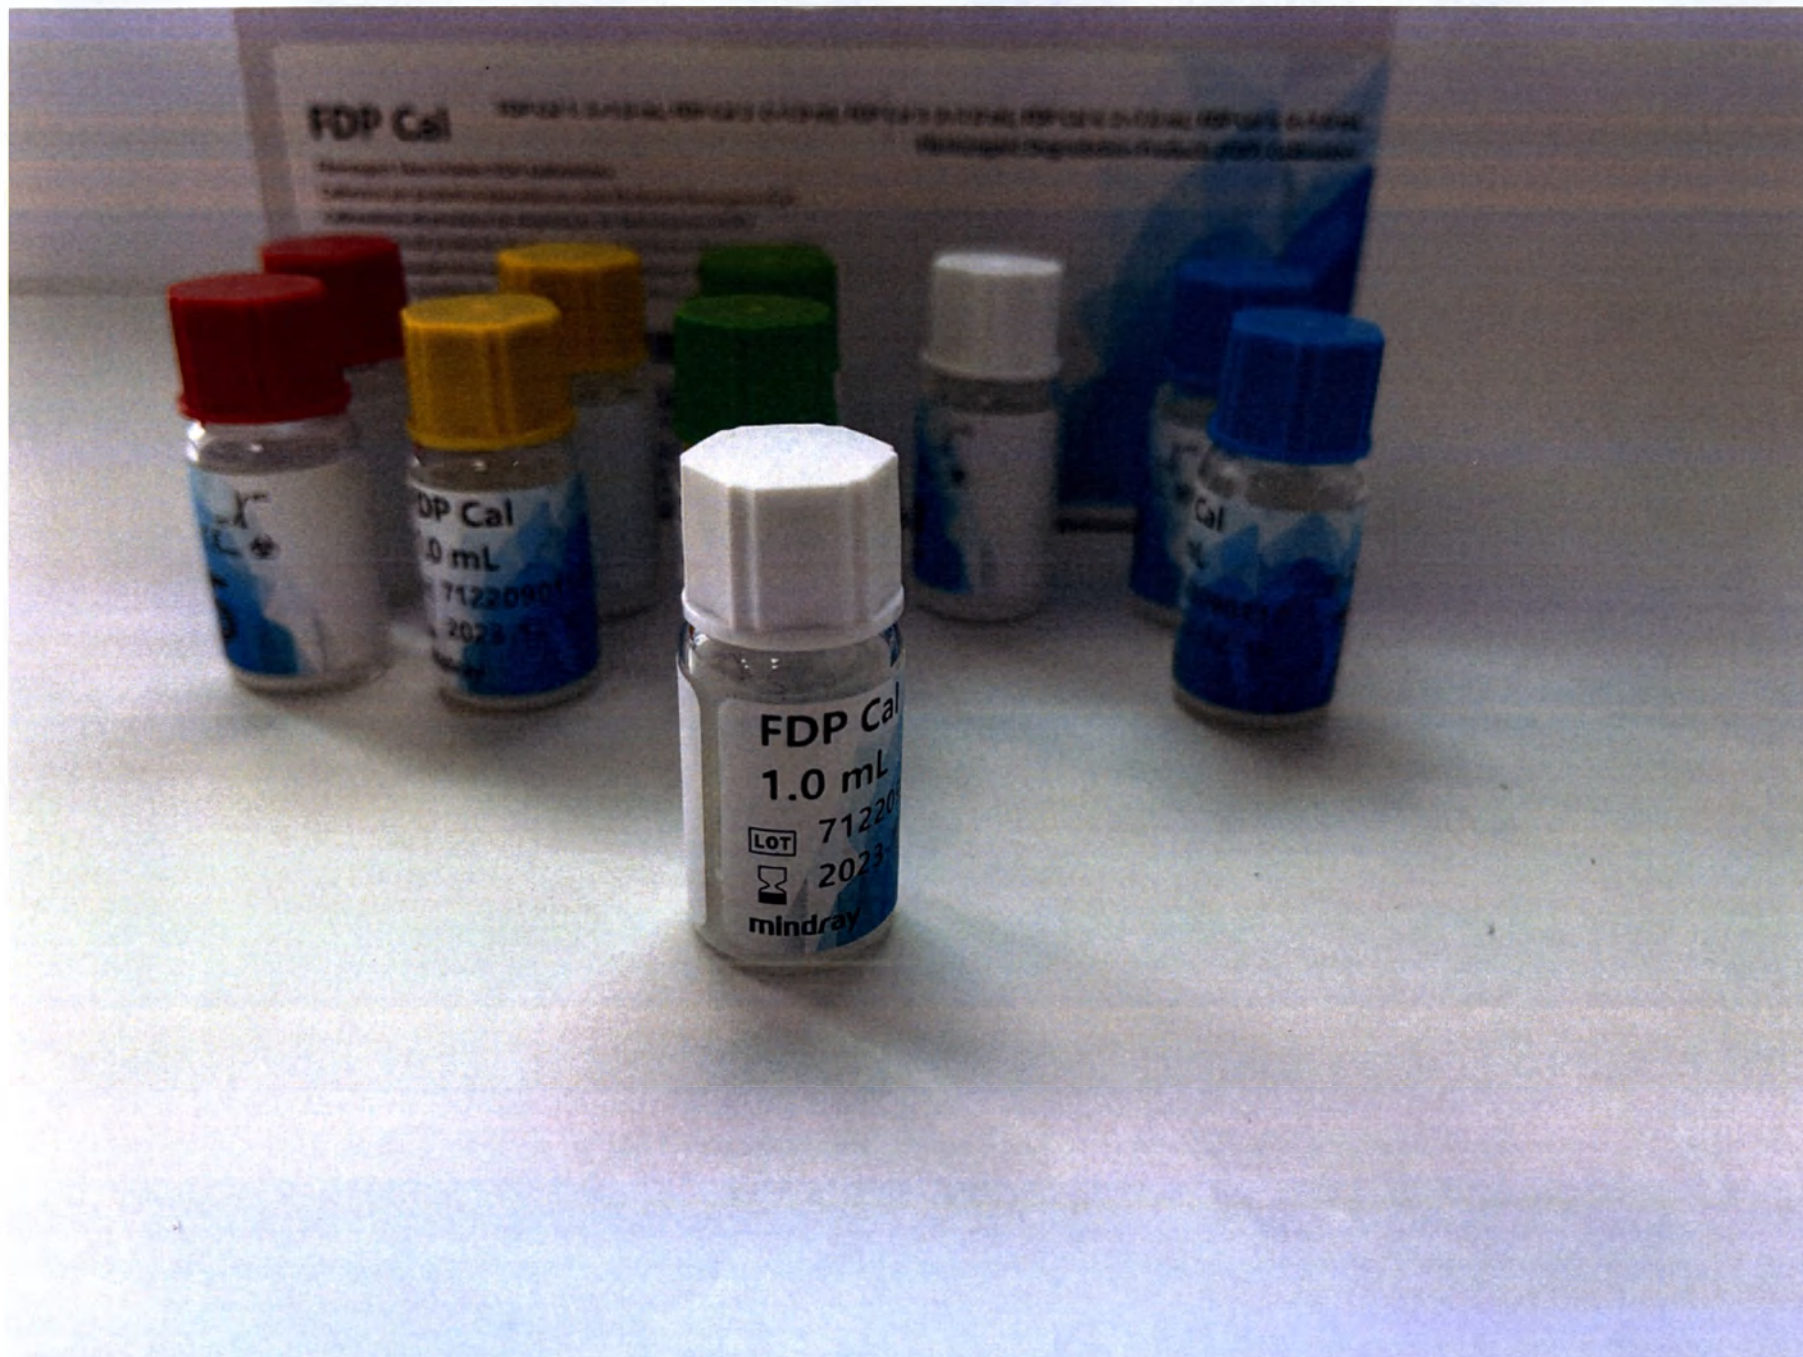


Рисунок 12. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 2) (вид 1)

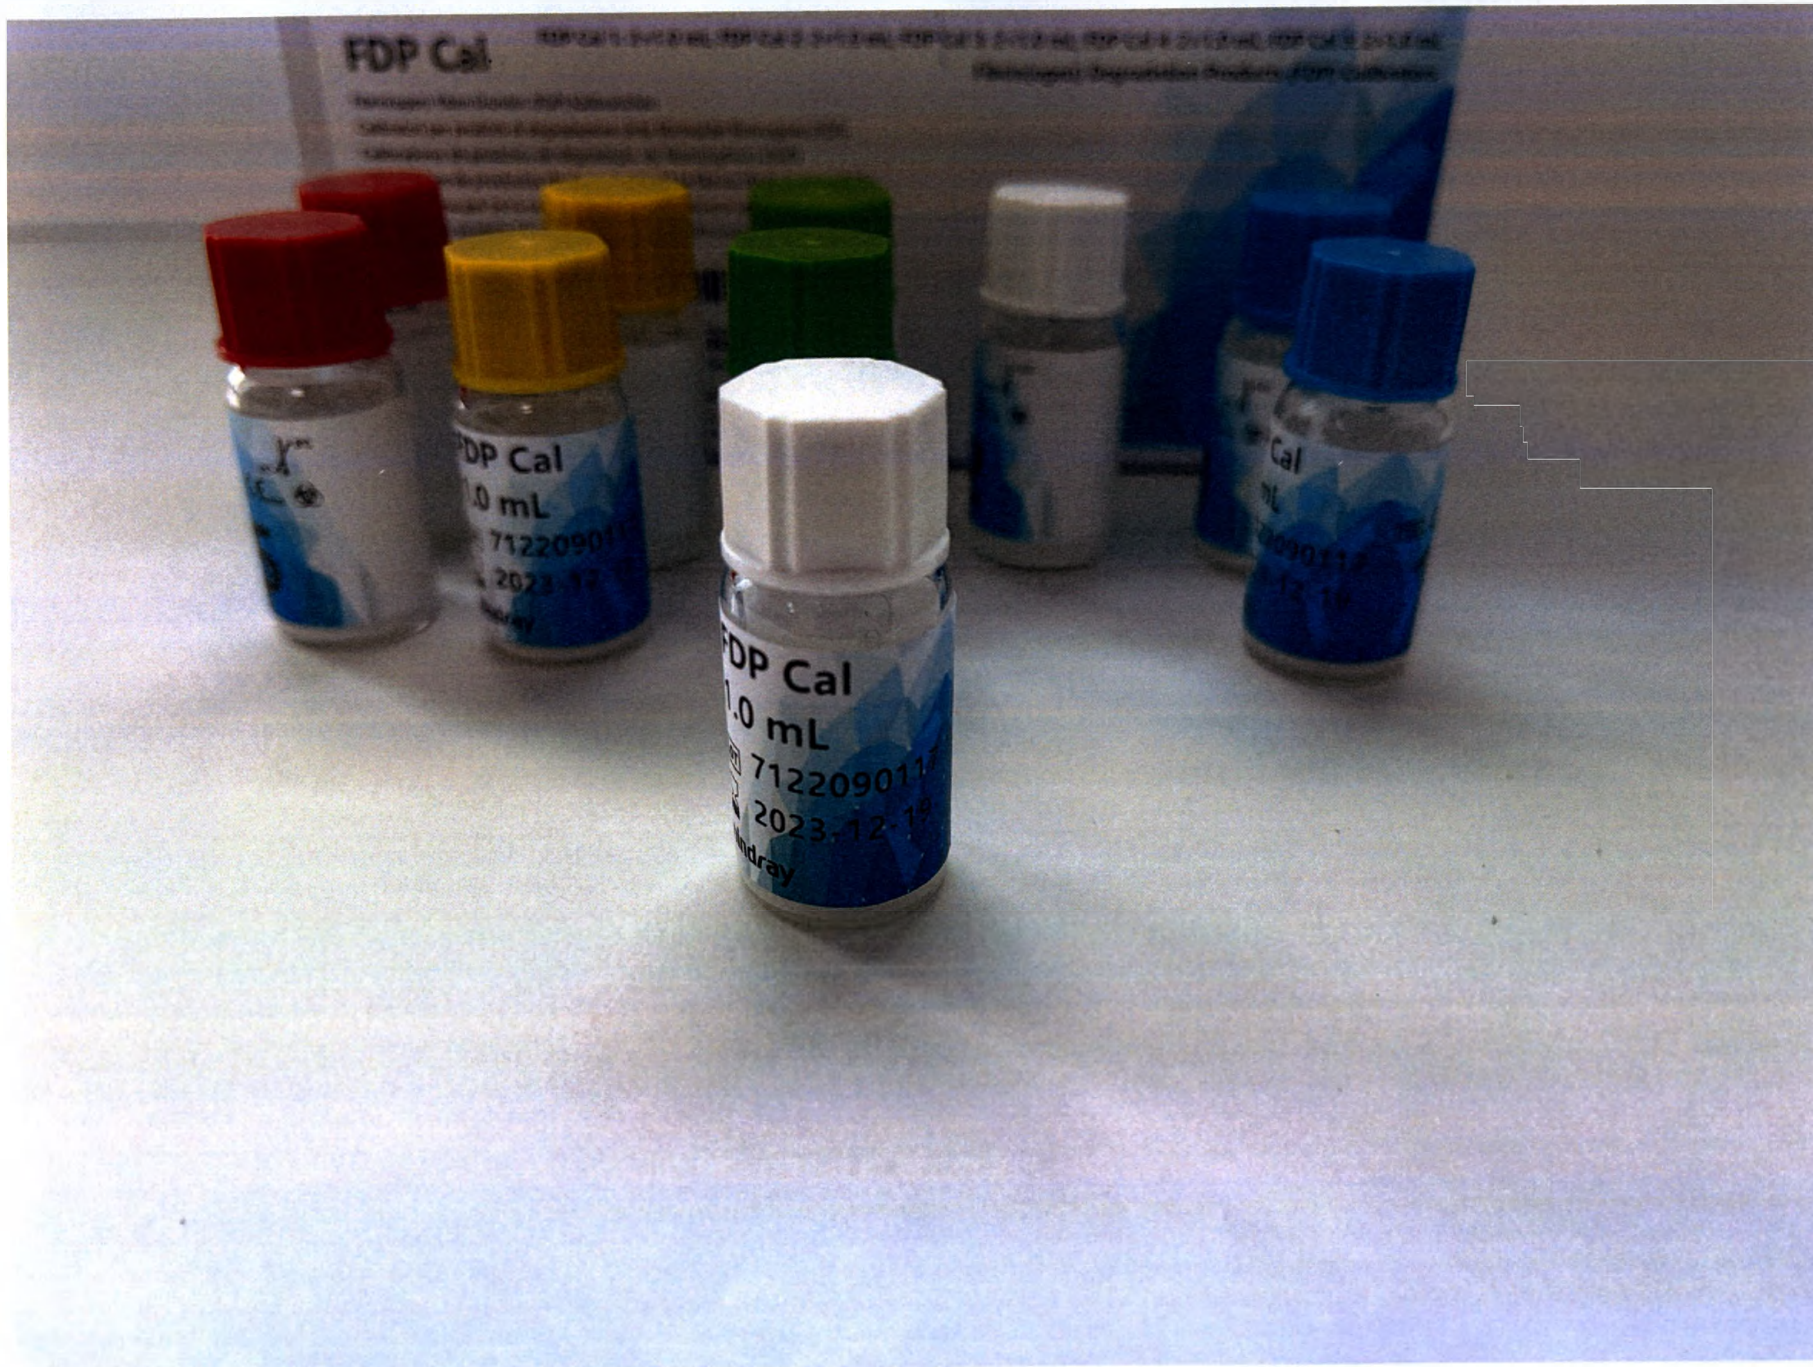


Рисунок 13. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 2) (вид 2)

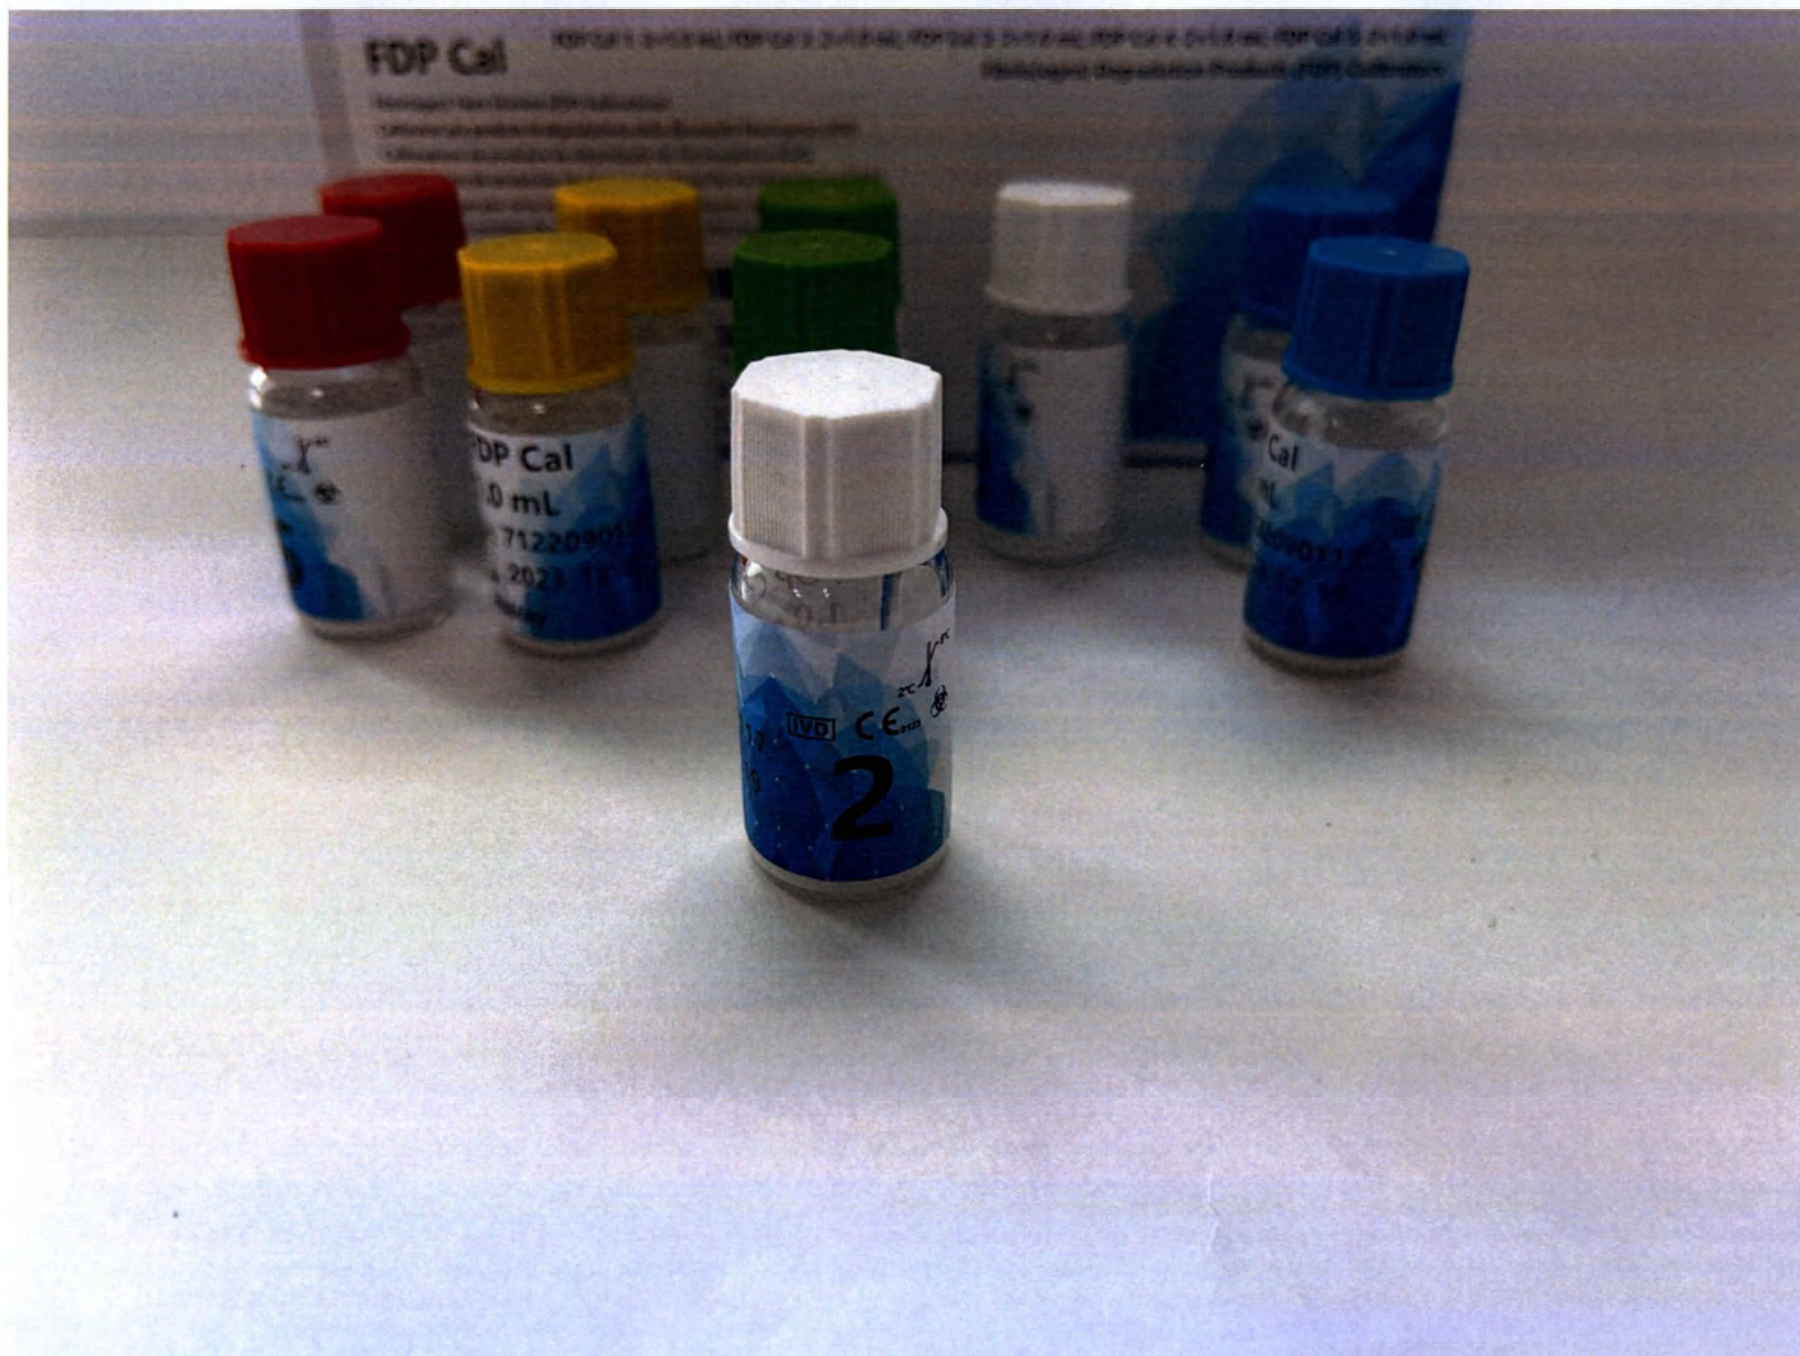


Рисунок 14. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 2) (вид 3)

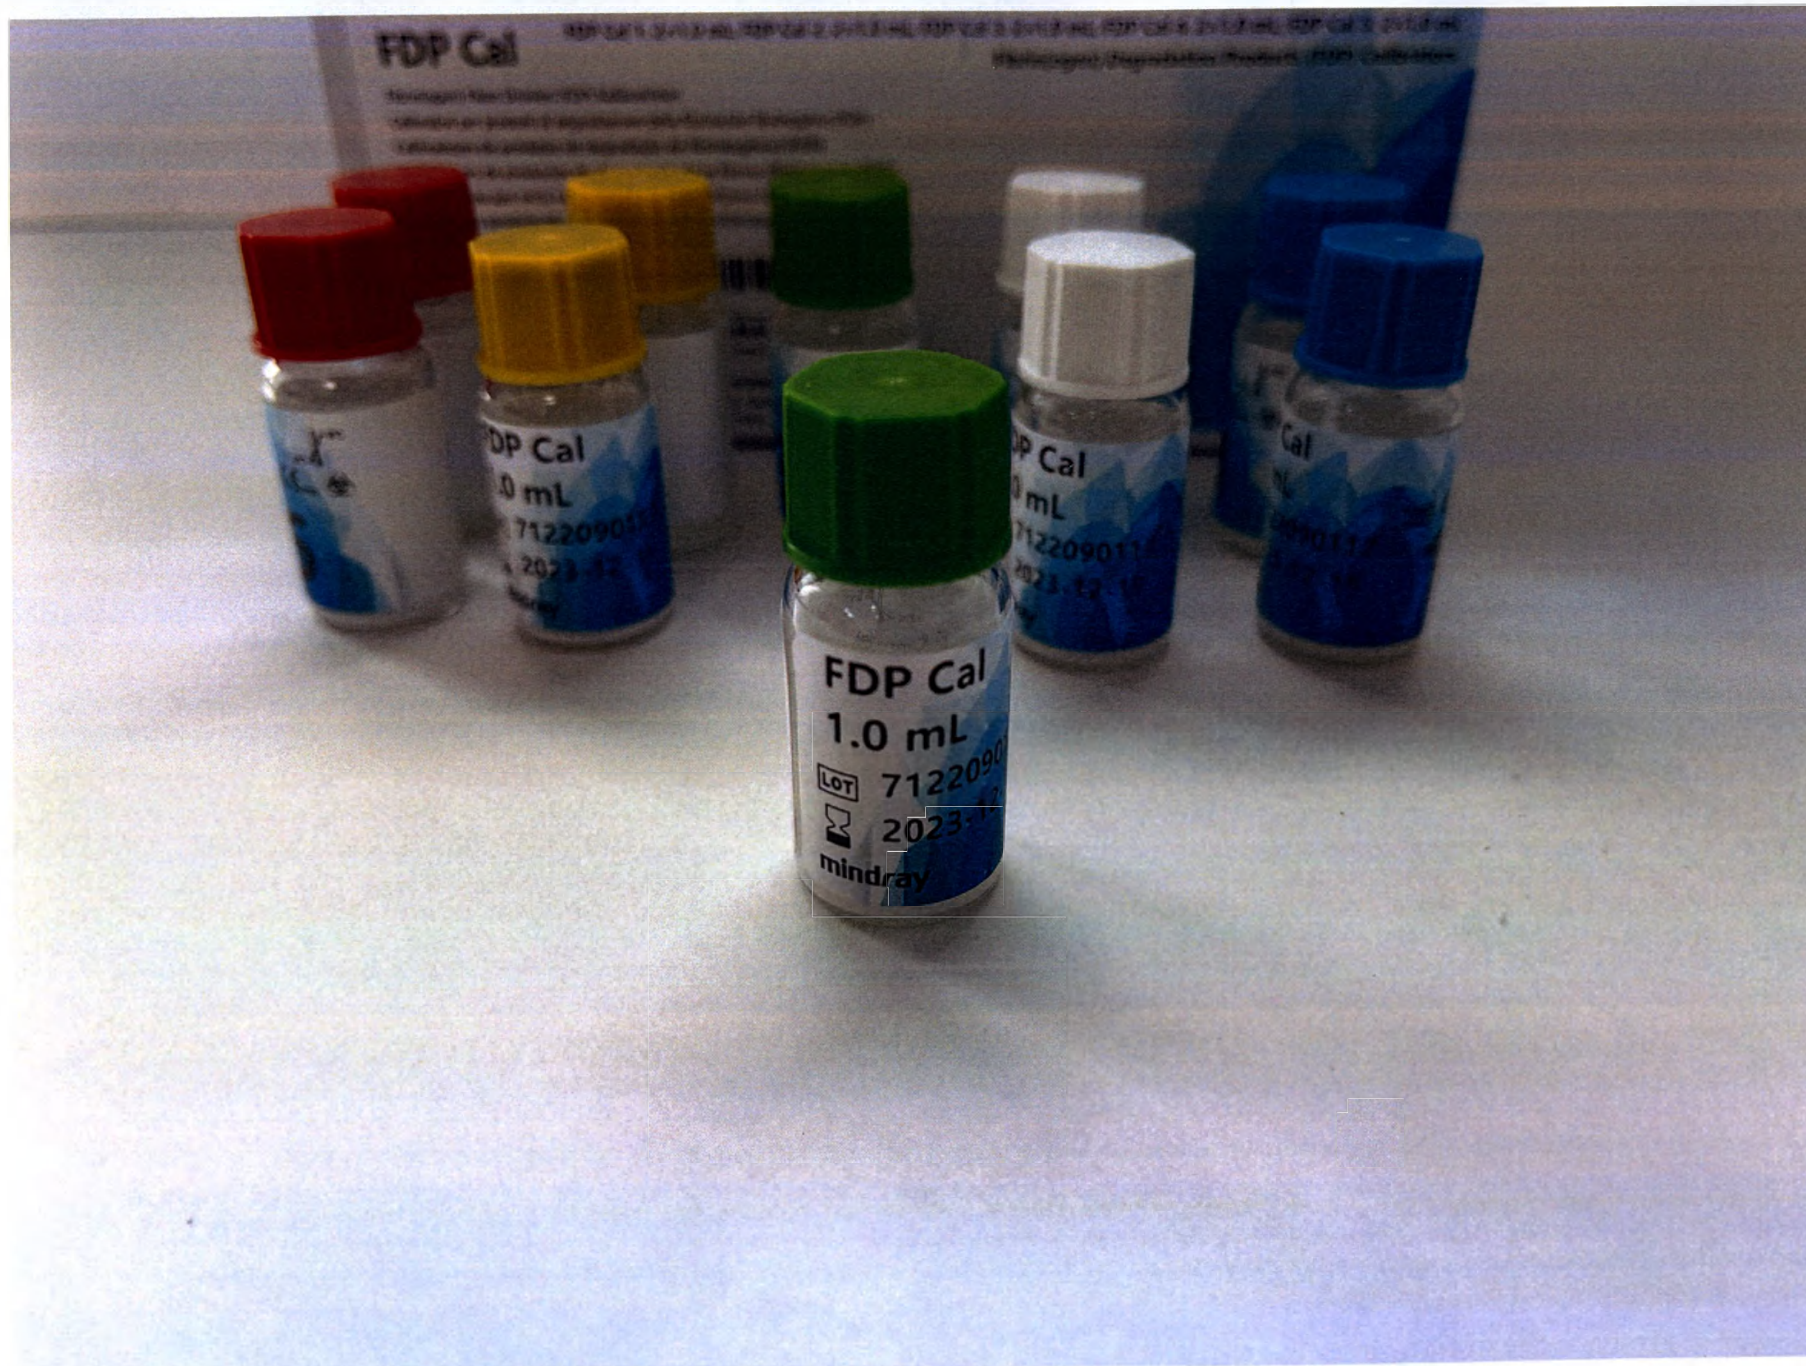


Рисунок 15. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 3) (вид 1)

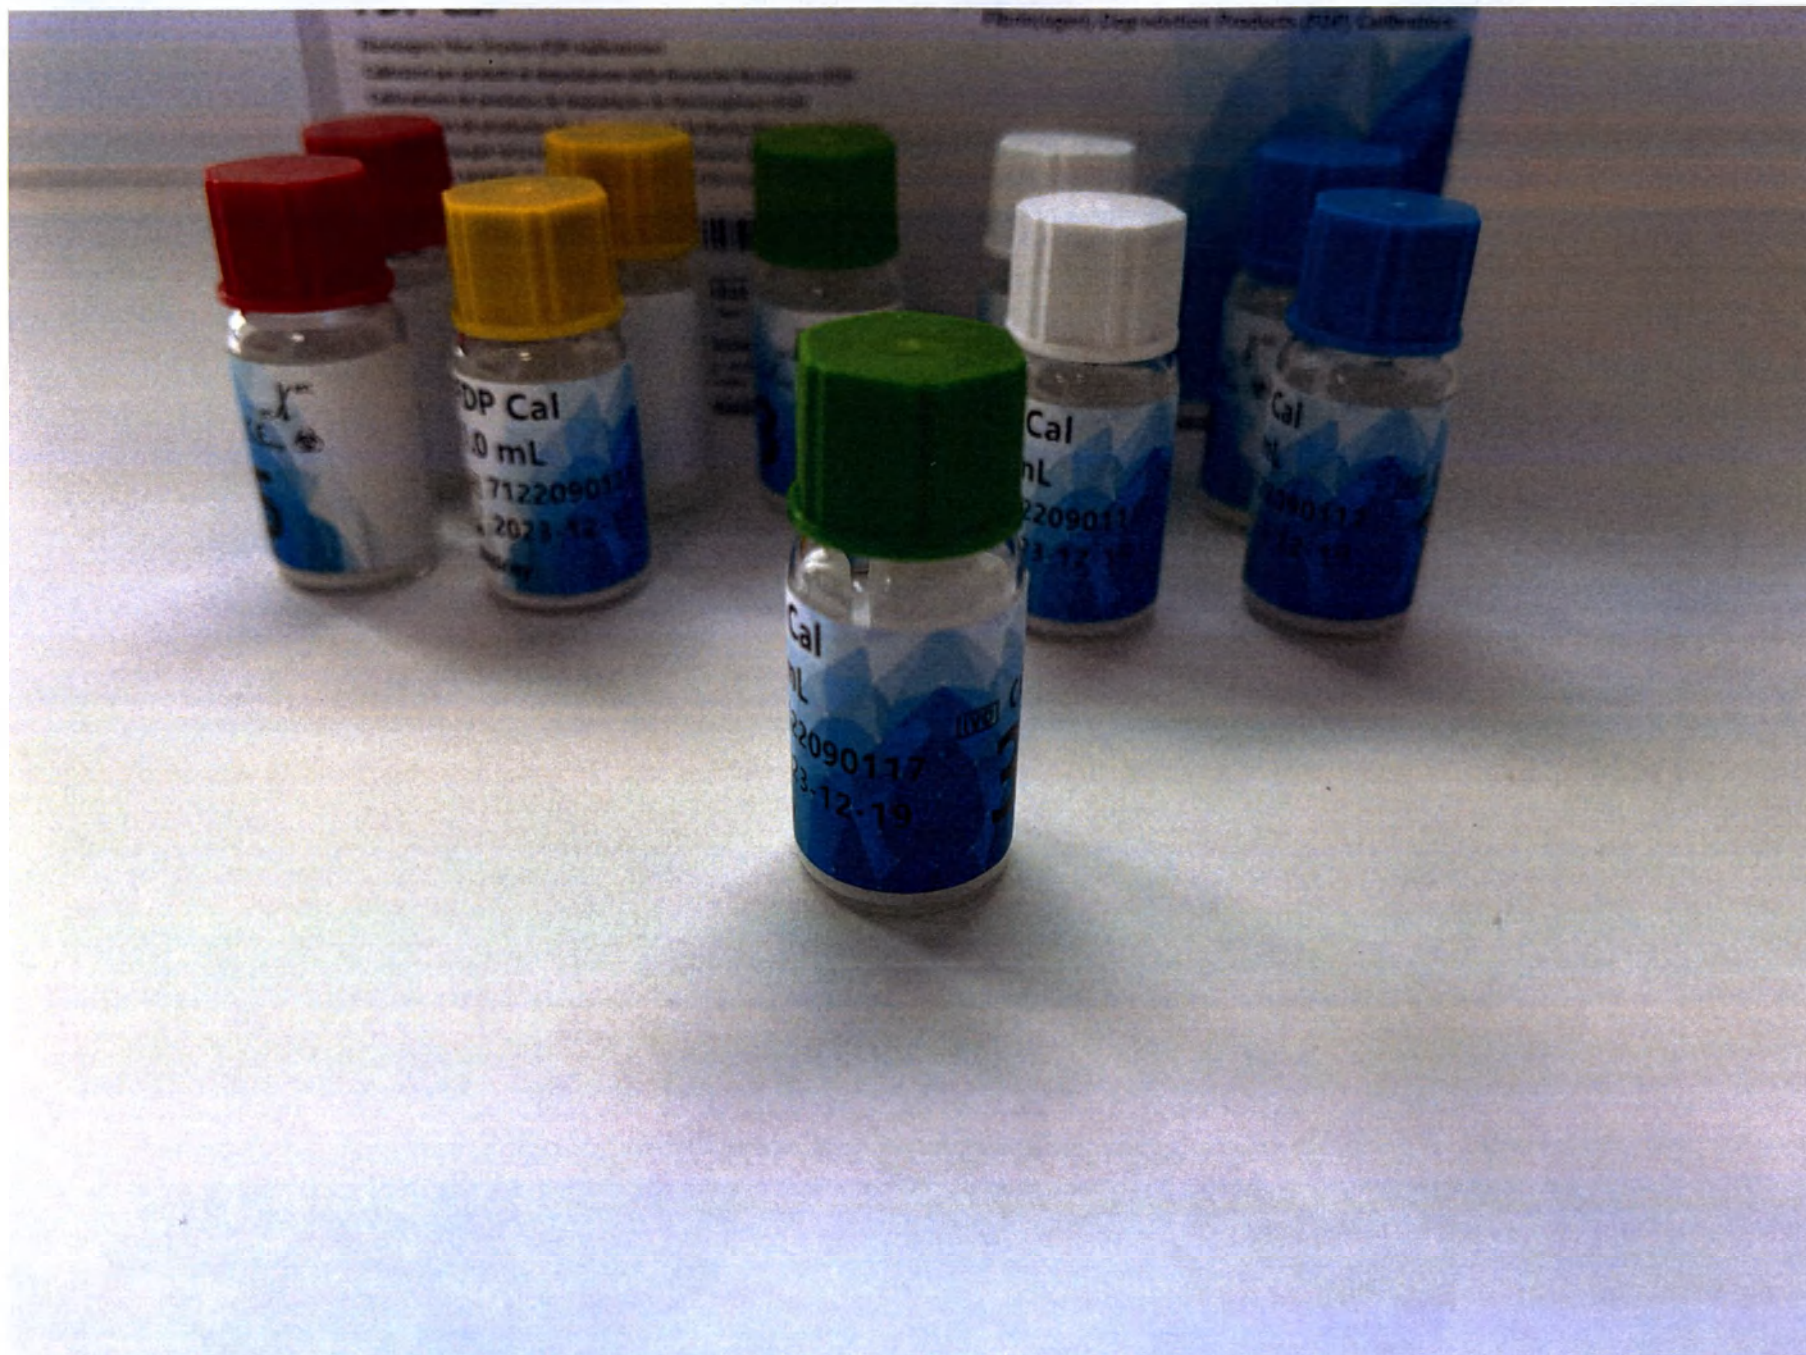


Рисунок 16. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 3) (вид 2)



Рисунок 16. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 3) (вид 3)



Рисунок 17. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 4) (вид 1)

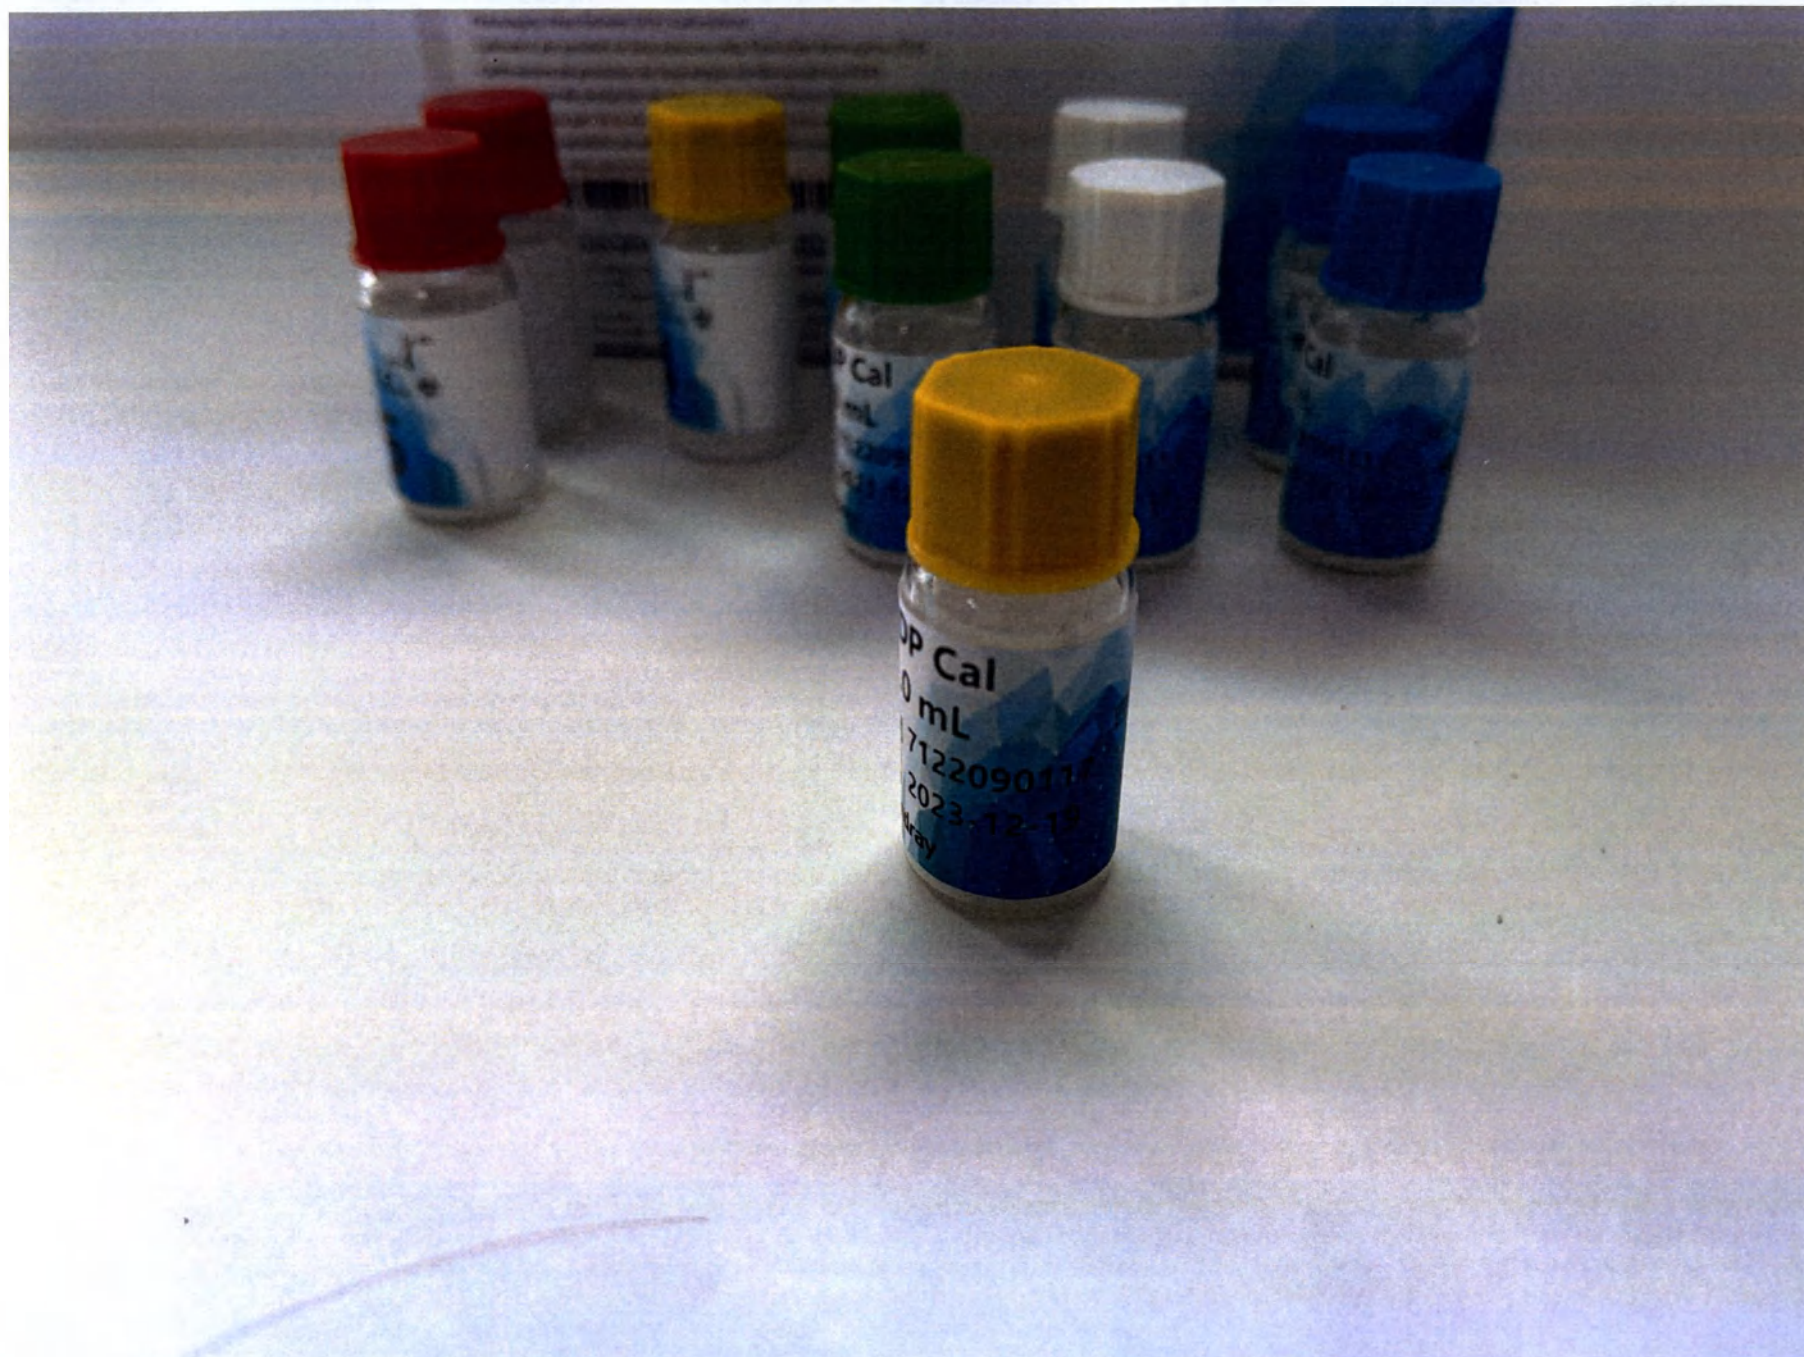


Рисунок 18. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 4) (вид 2)

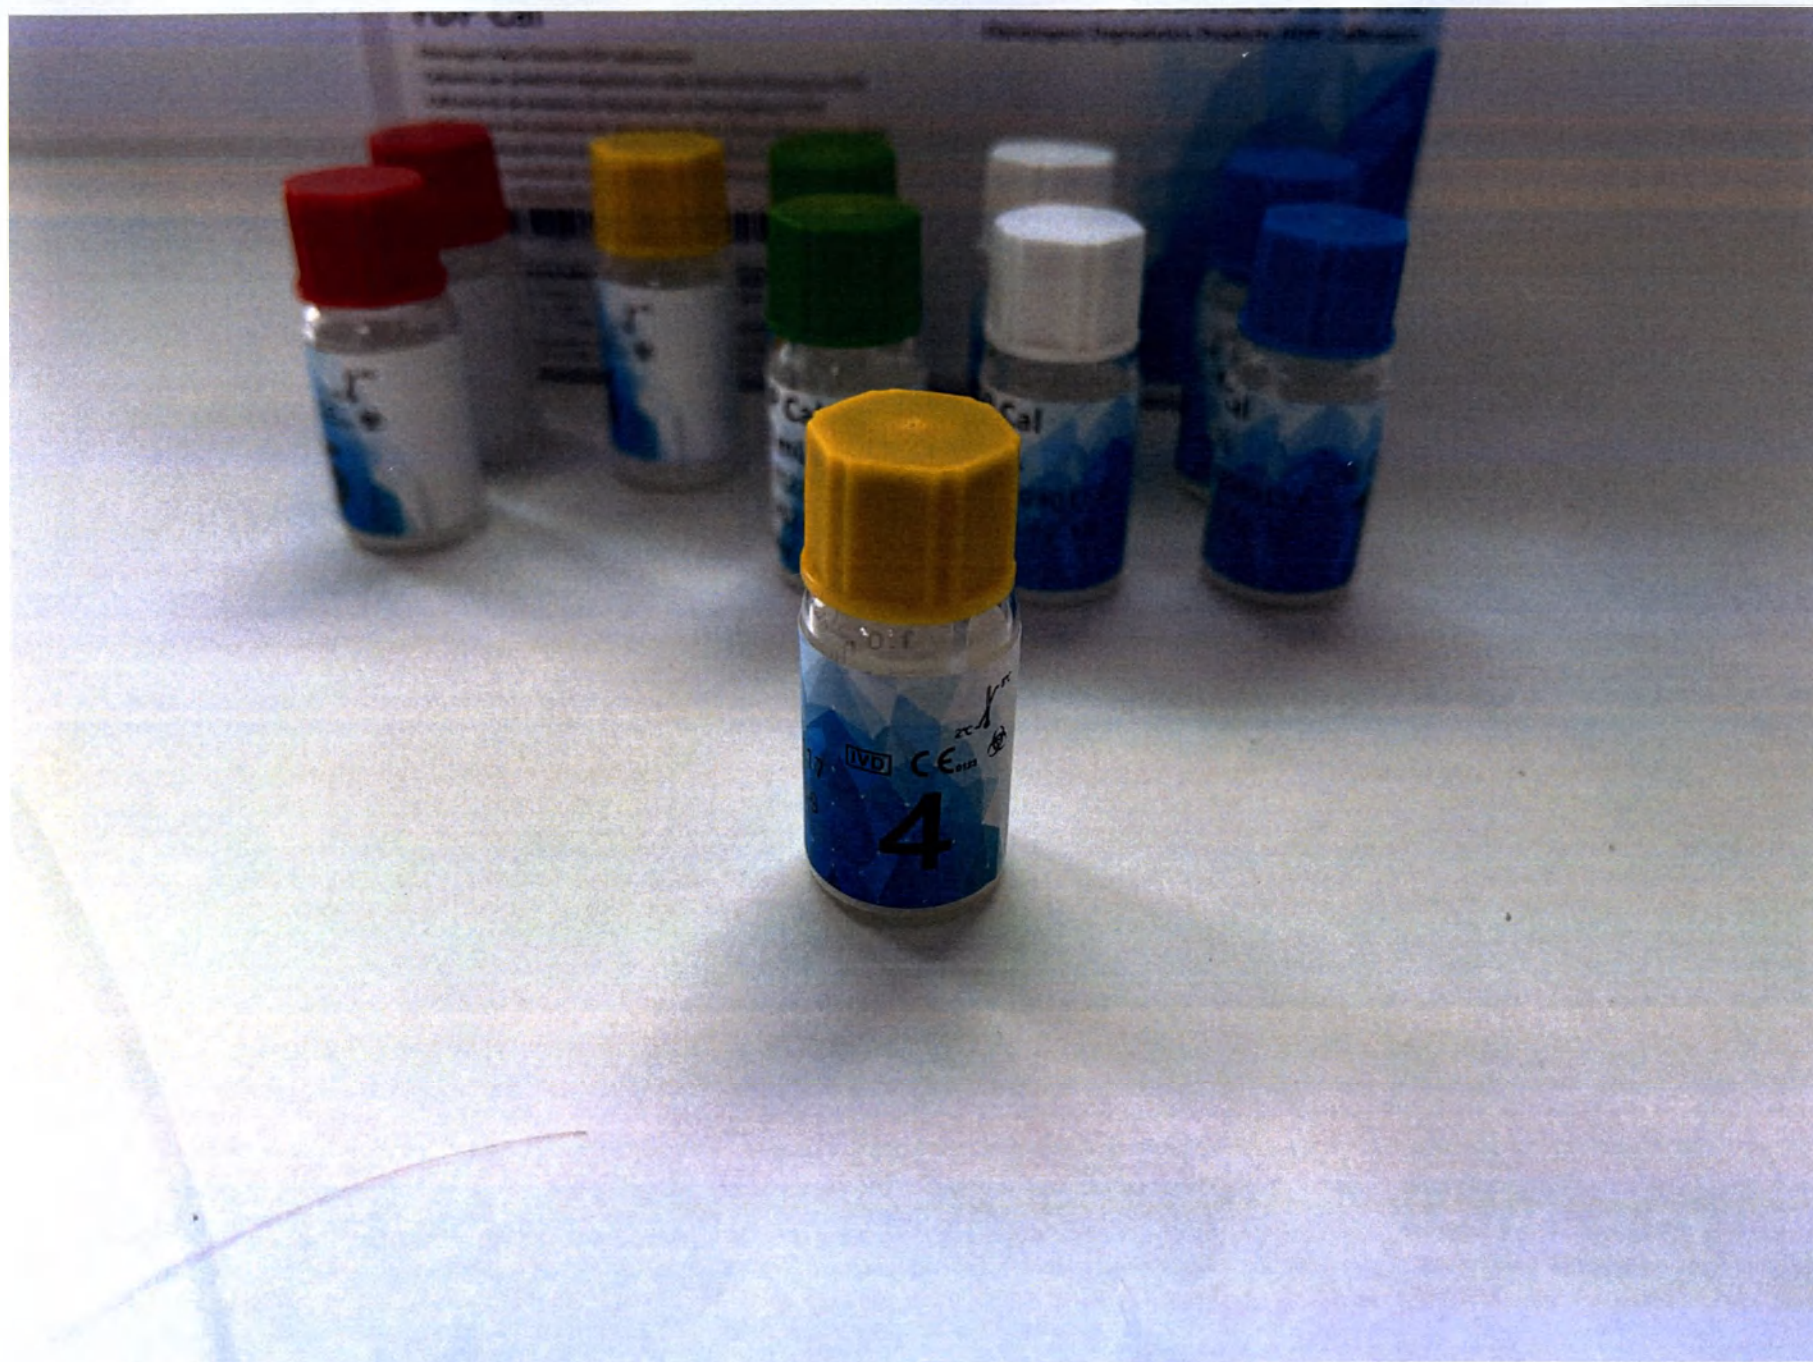


Рисунок 19. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 4) (вид 3)

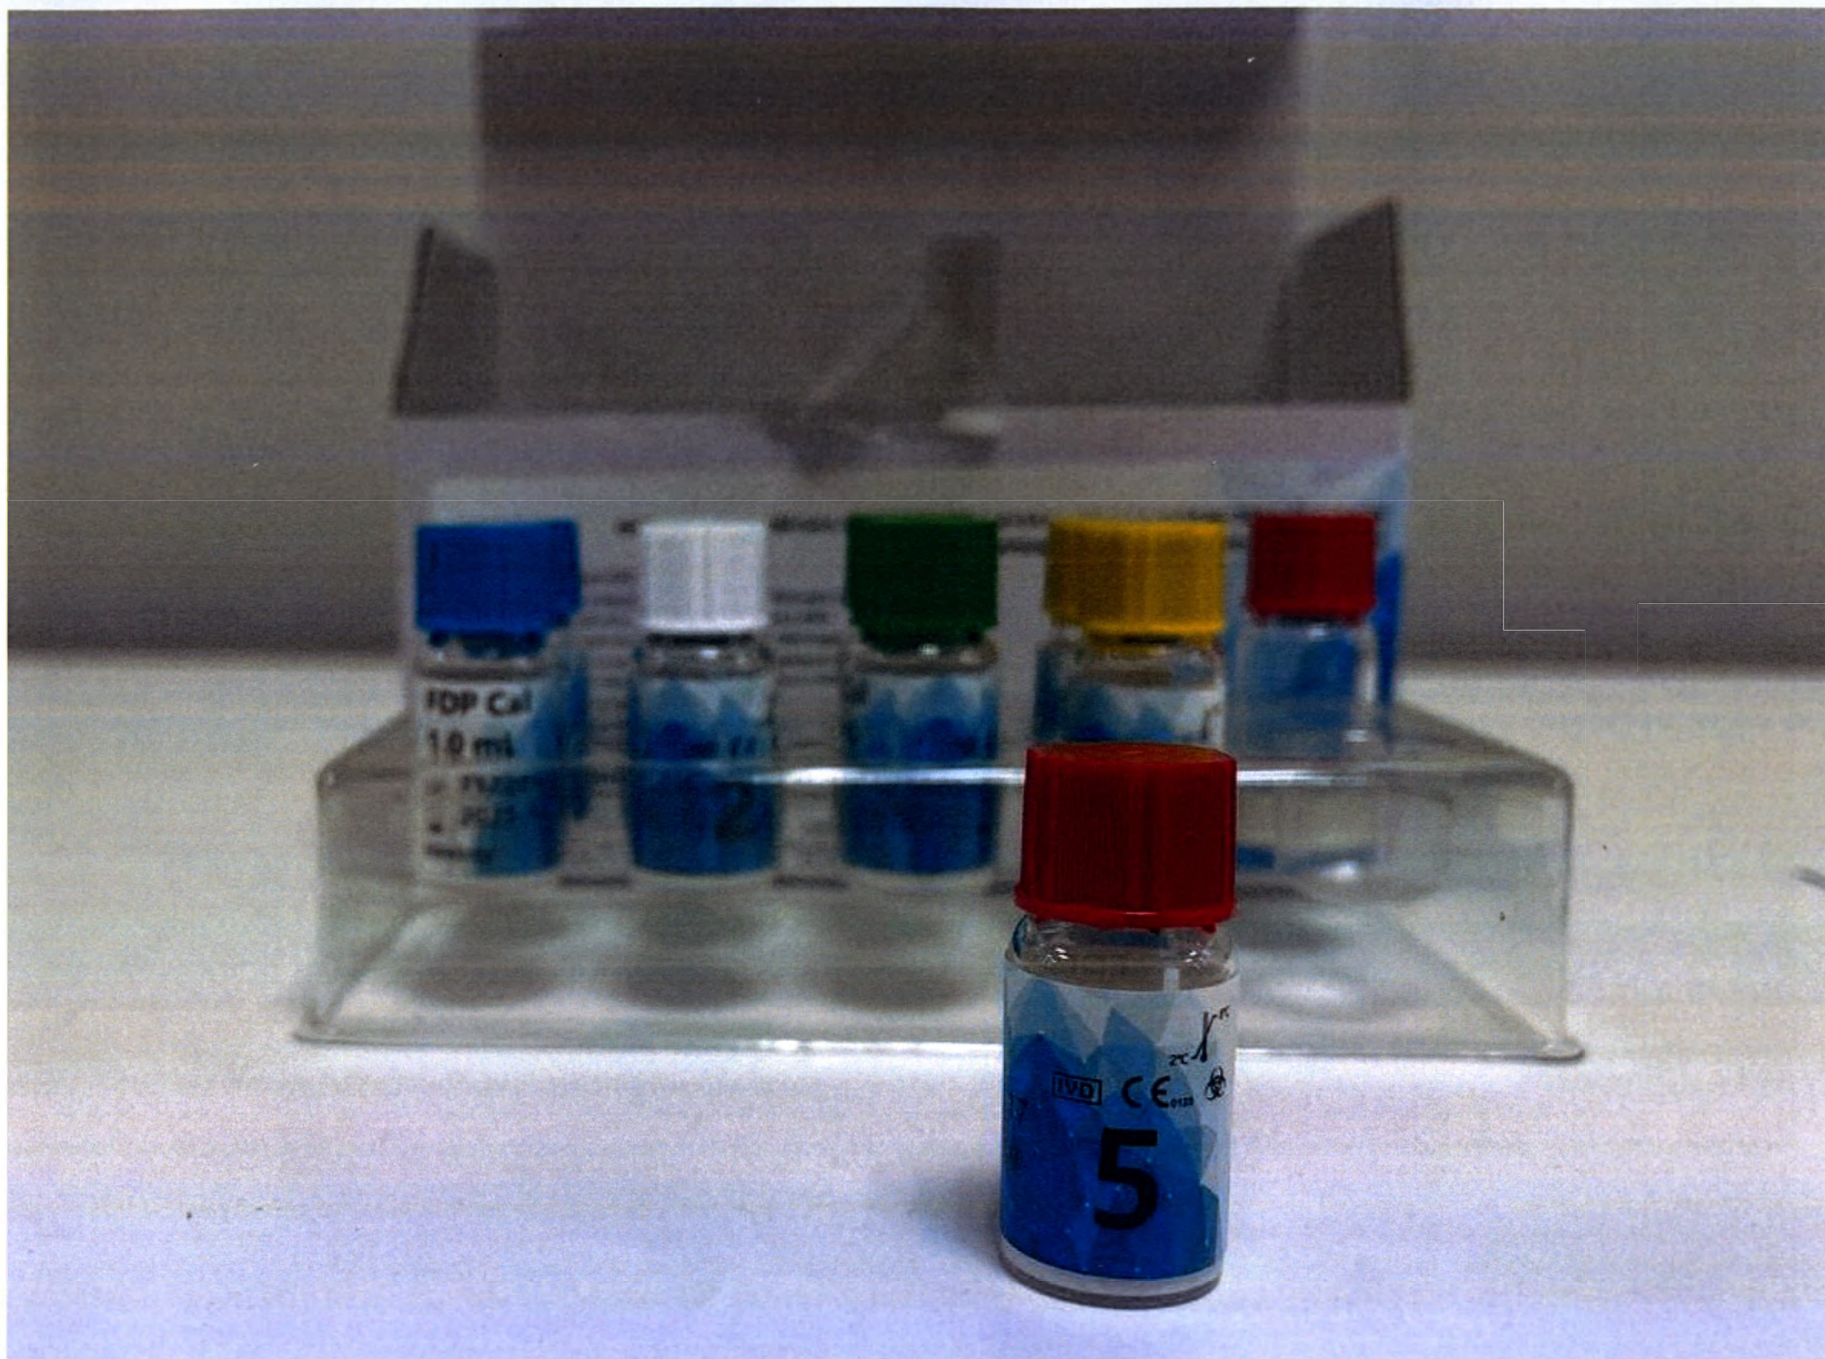


Рисунок 20. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 5) (вид 1)

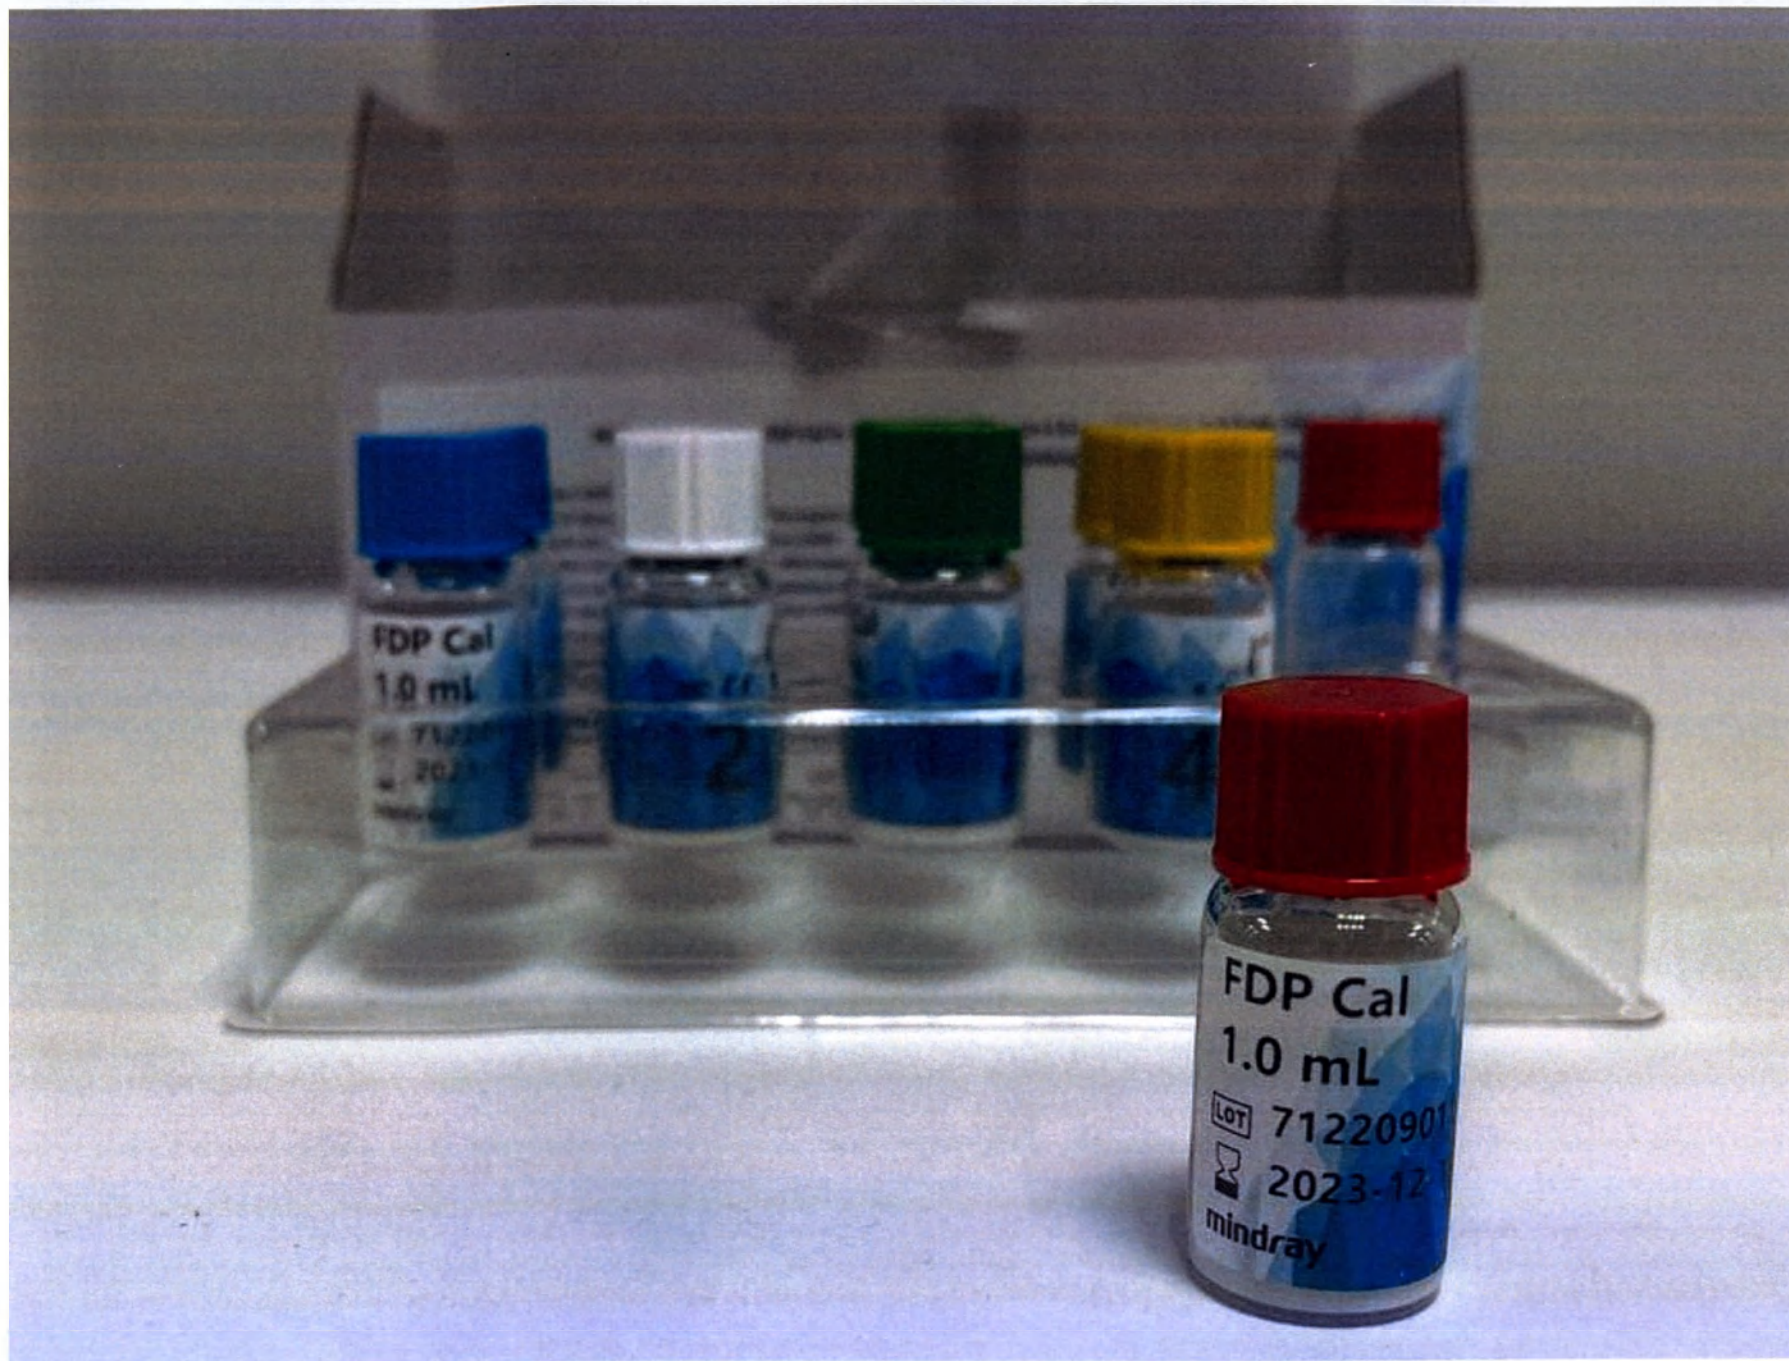


Рисунок 21. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 5) (вид 2)

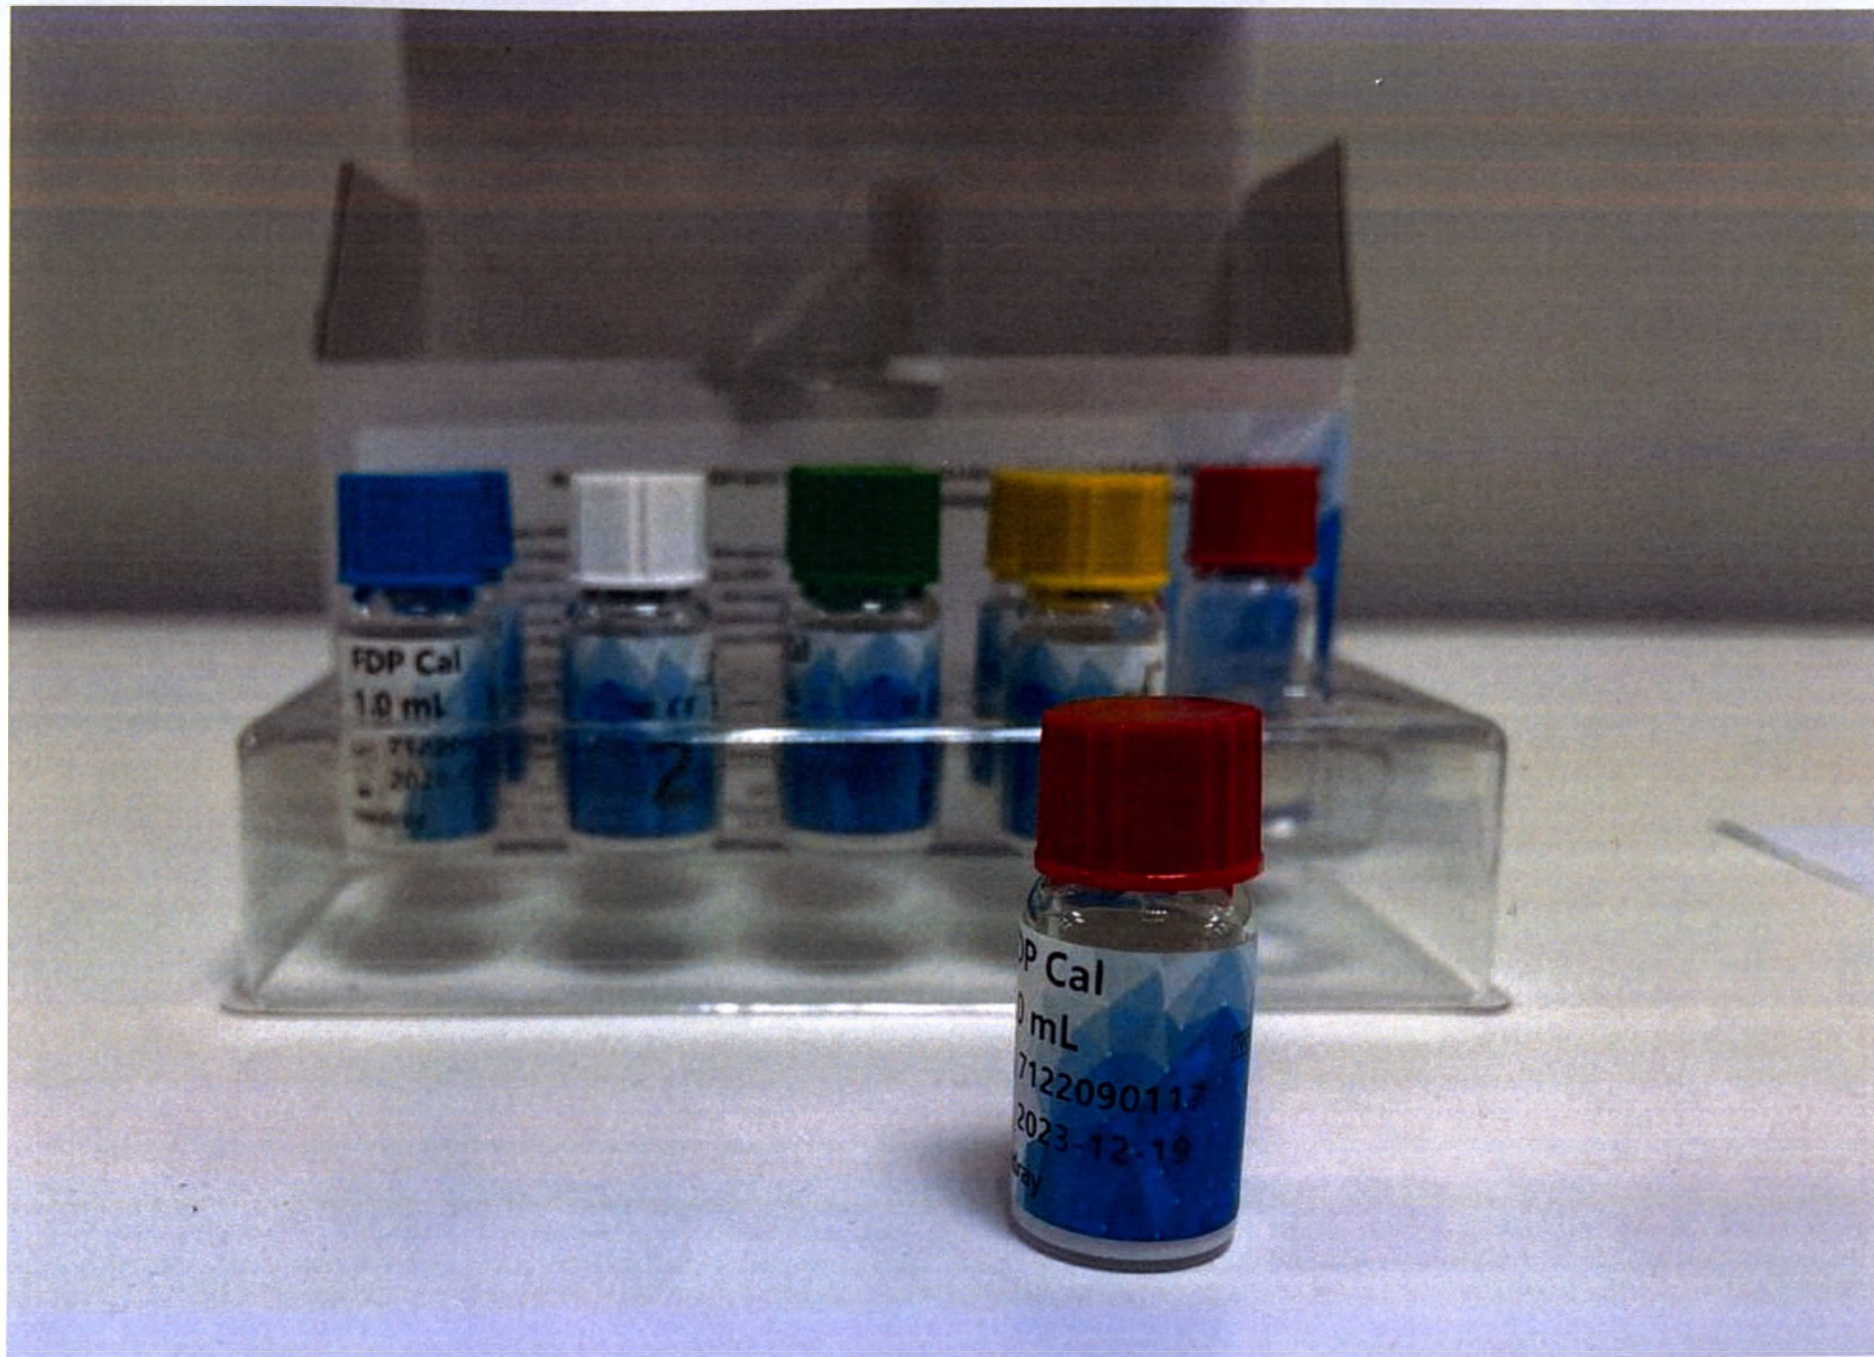


Рисунок 22. Калибратор для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) (уровень 5) (вид 3)

