

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

по доверенности от 20.11.2023

Сюнь Вэй.

2023 г.



Макет маркировки медицинского изделия

Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal)
иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на
анализаторах серии CX для диагностики in vitro

...инбраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим
...ом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in
...го

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;

*Код партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы
указаны на оригинальной упаковке*

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road
South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057, Shenzhen, People's Republic of China**

Уполномоченный представитель в РФ:

**129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский
пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11А.**

Тел. +7 (499) 553-60-36

Информацию на стикере считать приоритетной

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИЯ

Сысова



ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миидрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
« 10 » _____ 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal)
иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на
анализаторах серии CX для диагностики in vitro

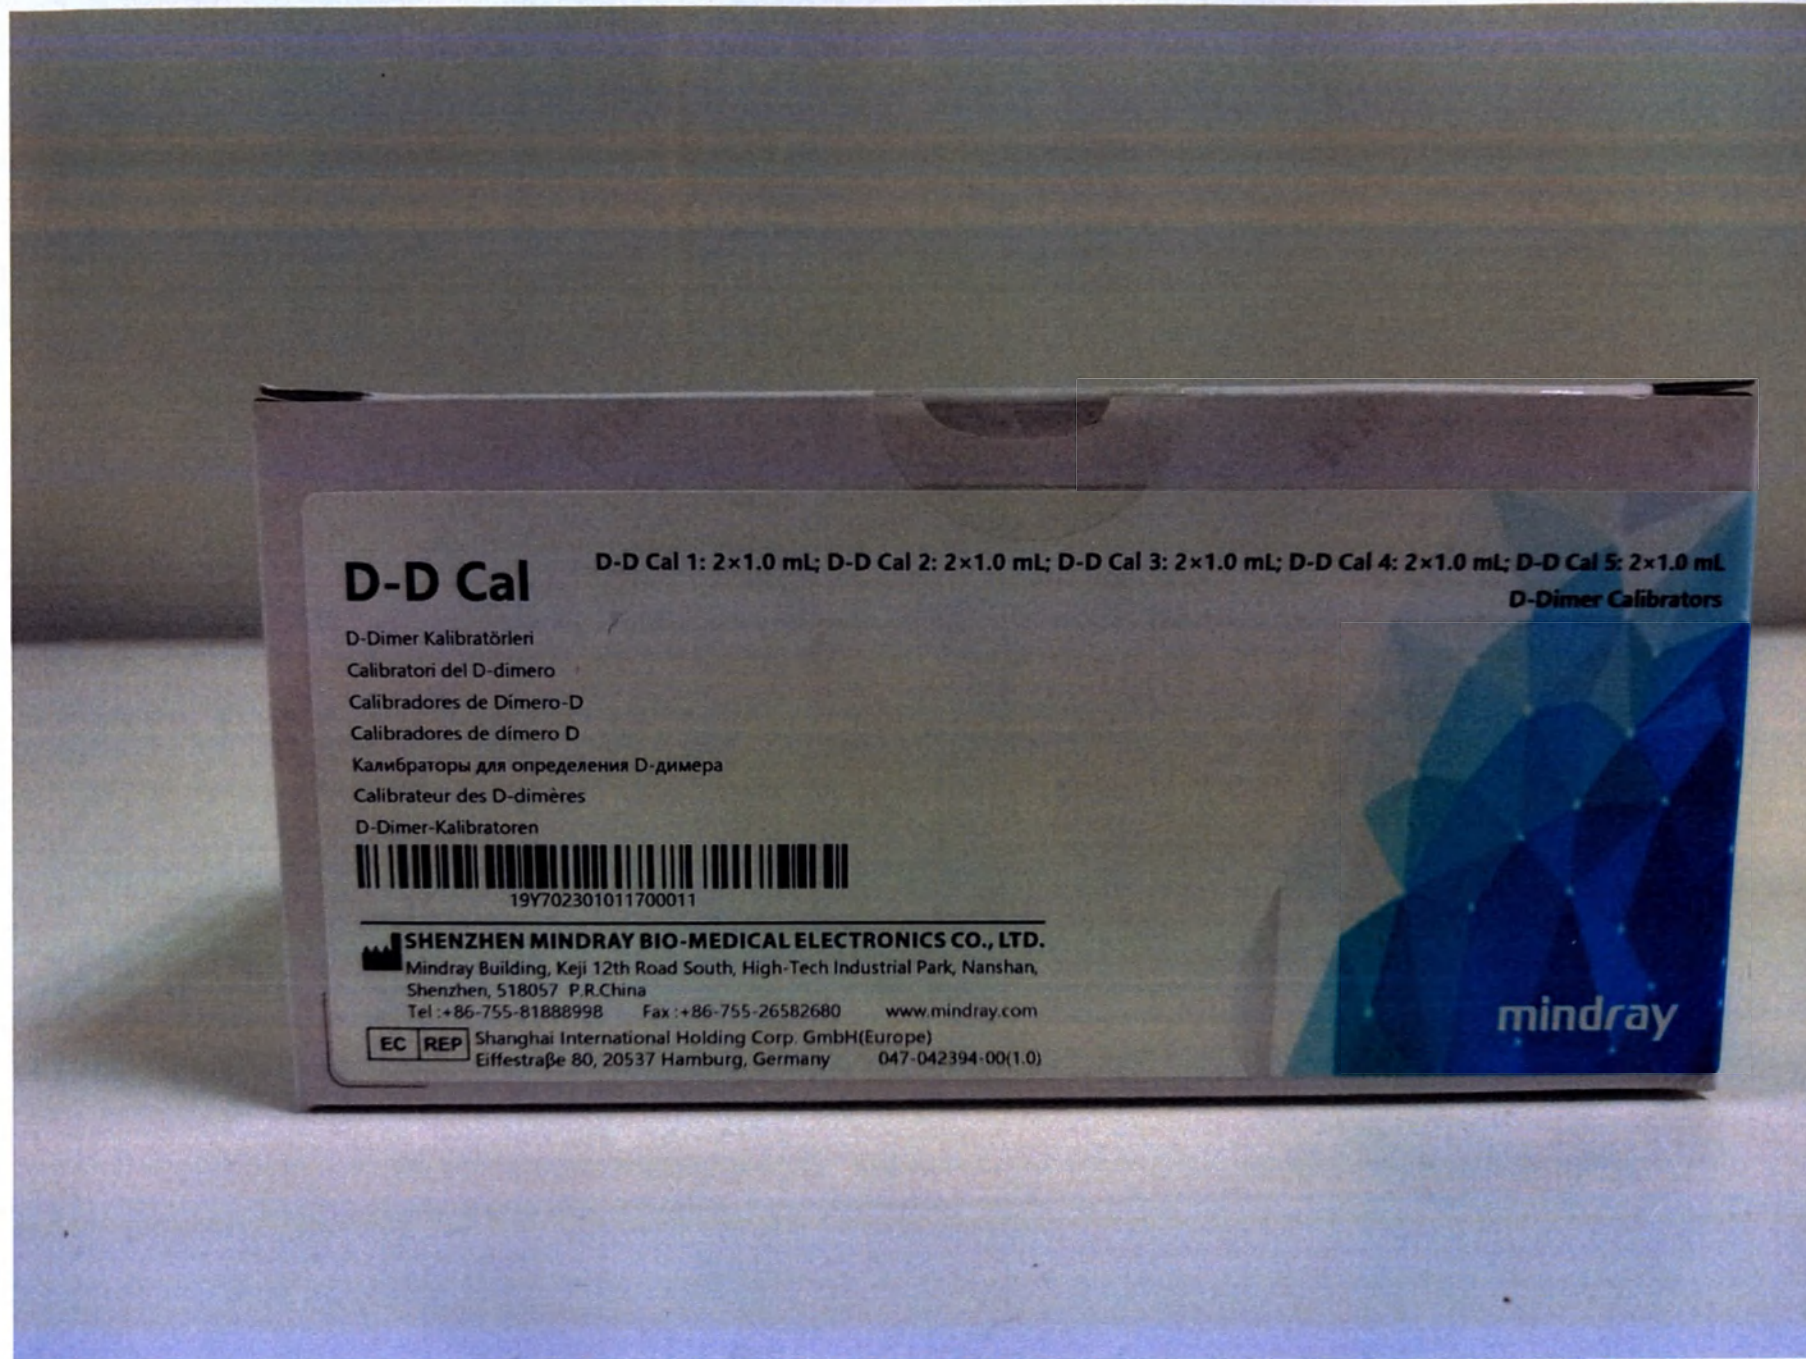


Рисунок 1 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 1)

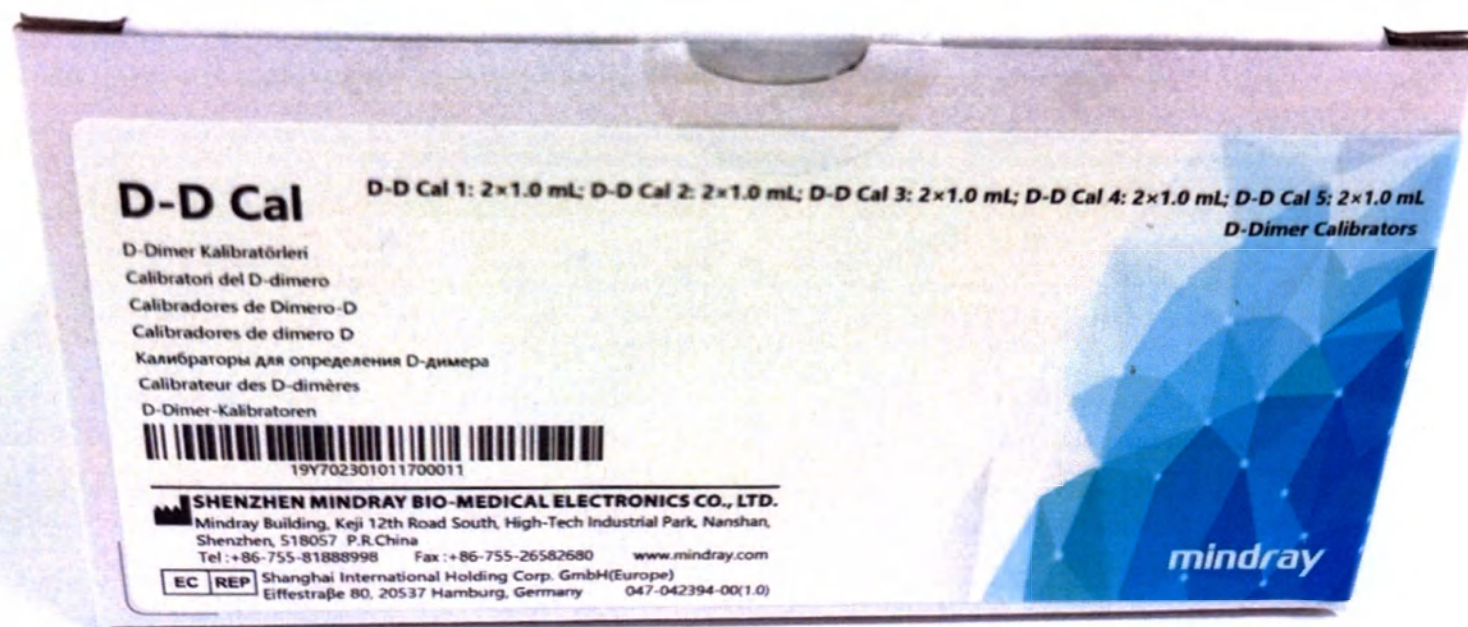


Рисунок 2 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 2)

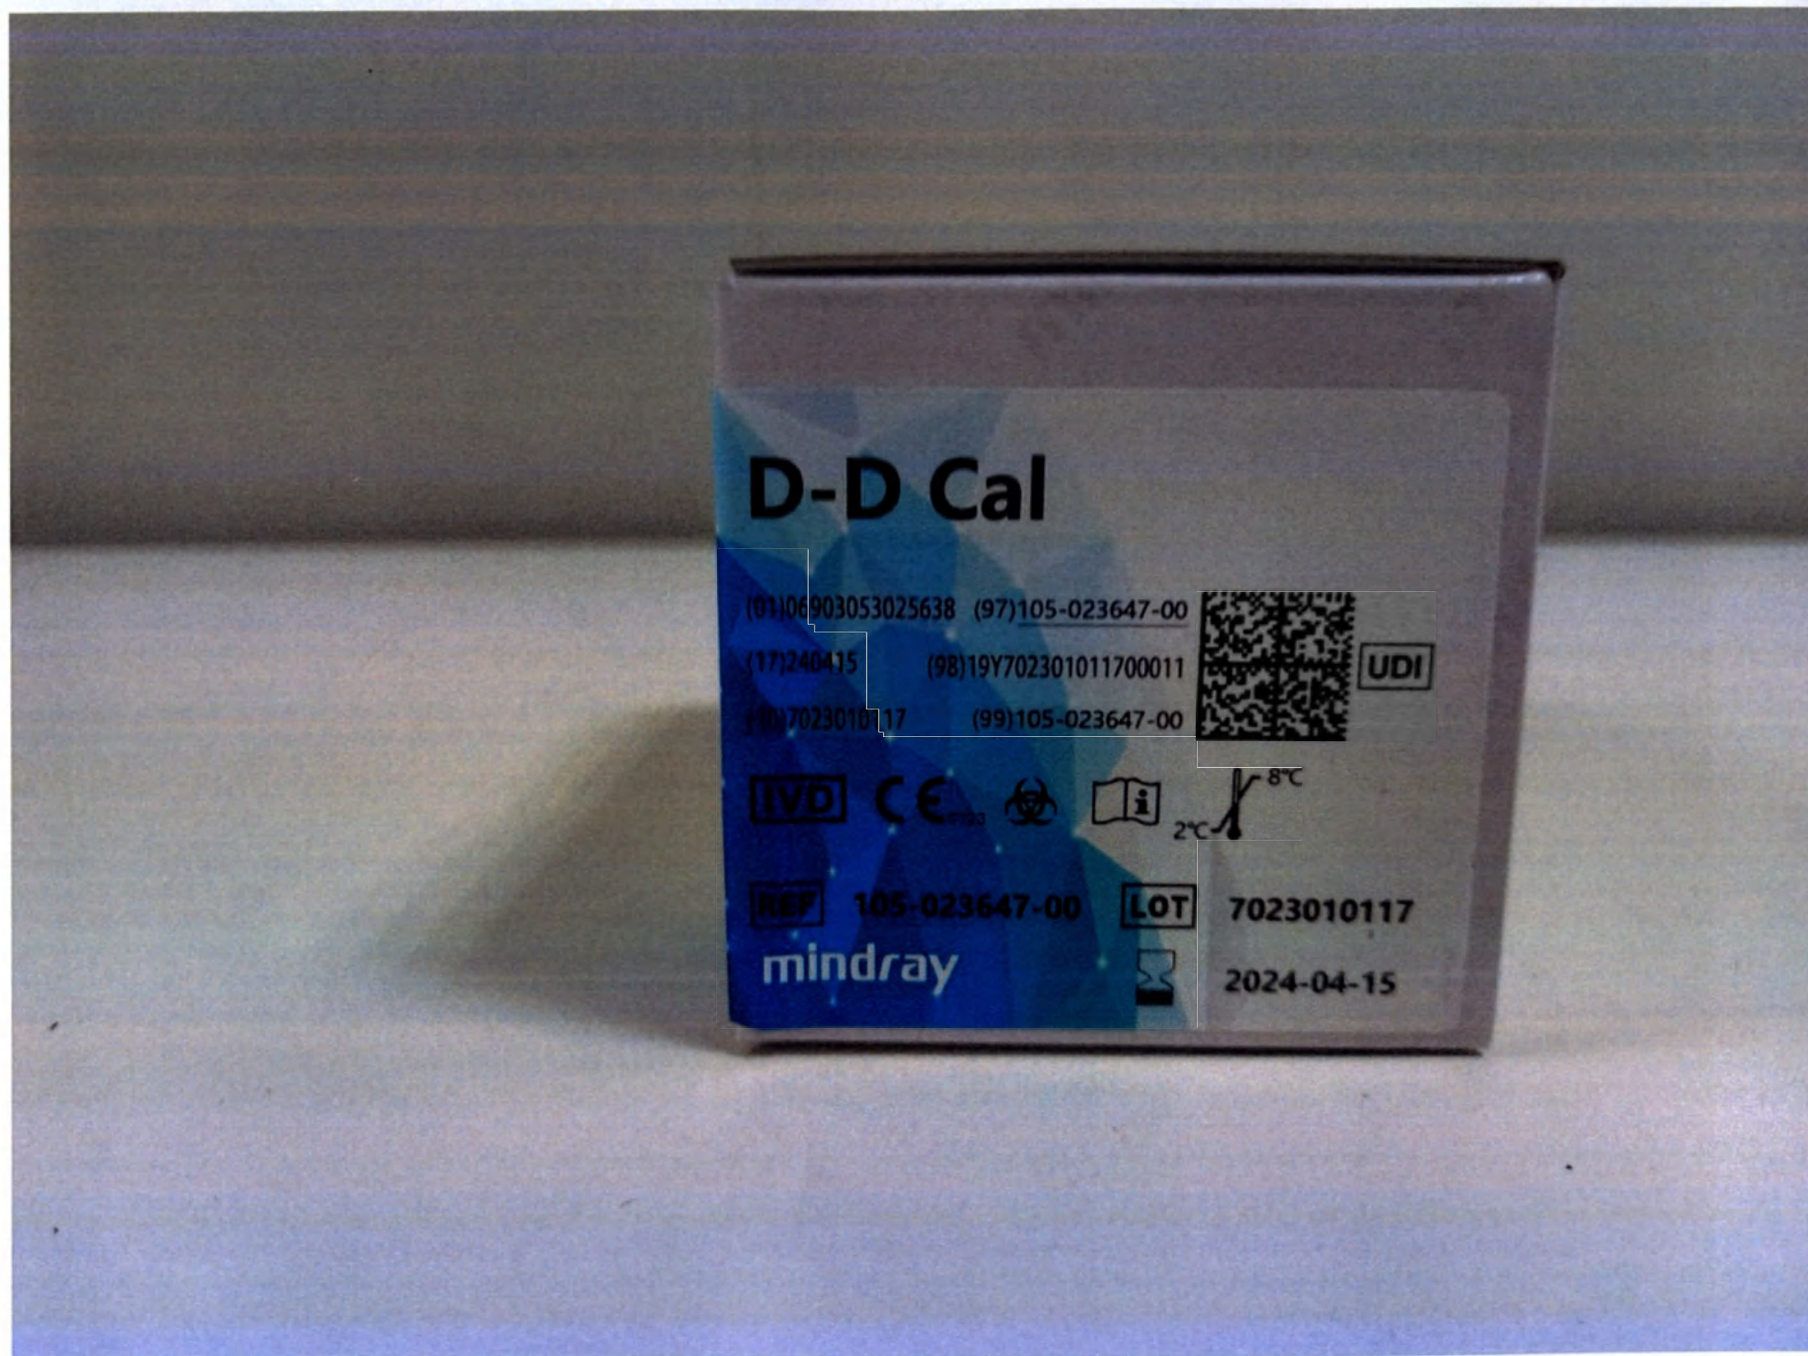


Рисунок 3 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 3)

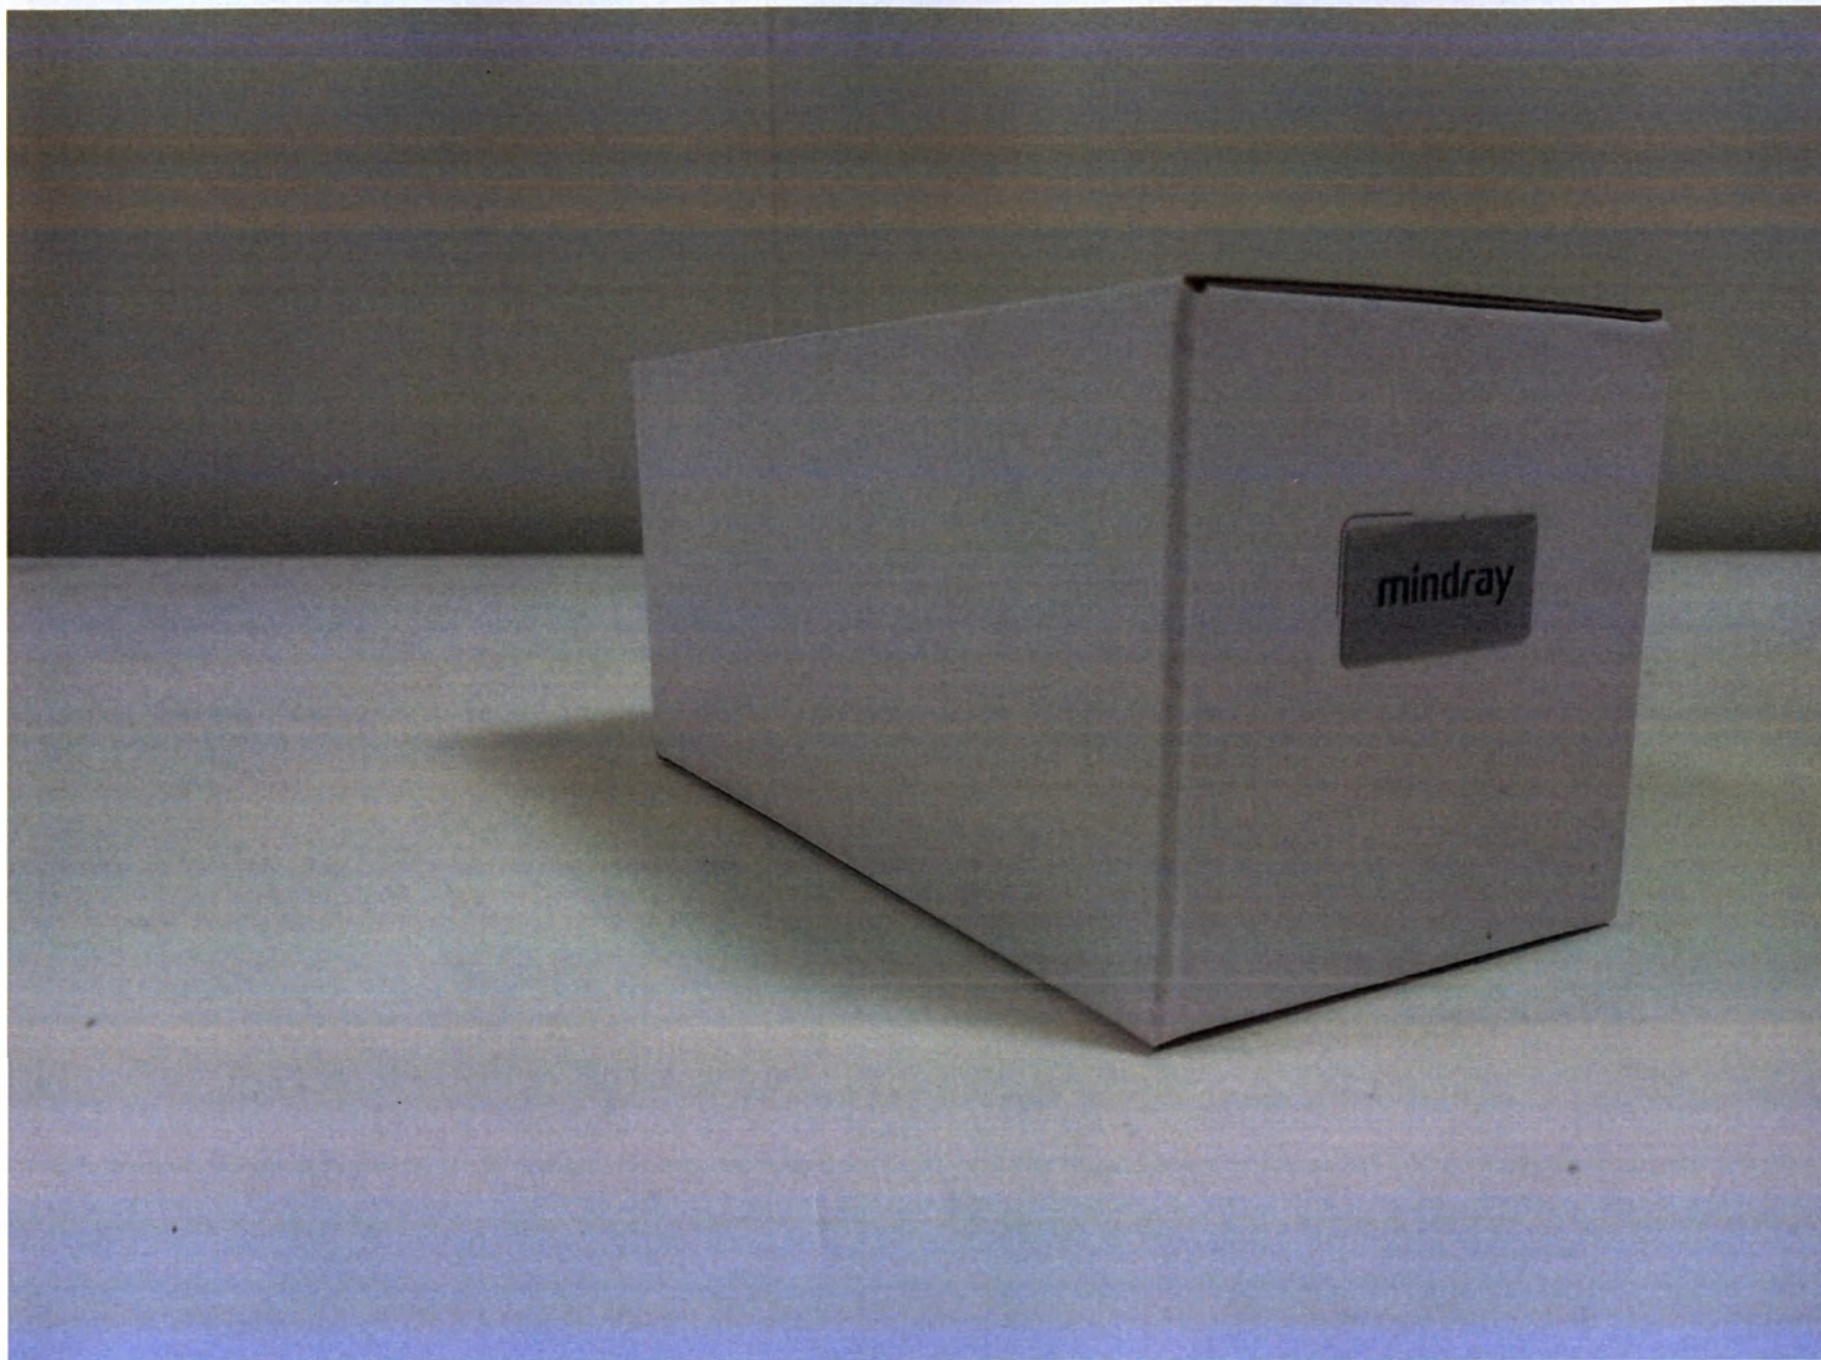


Рисунок 4 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 4)



Рисунок 5 Внешняя упаковка Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 5)

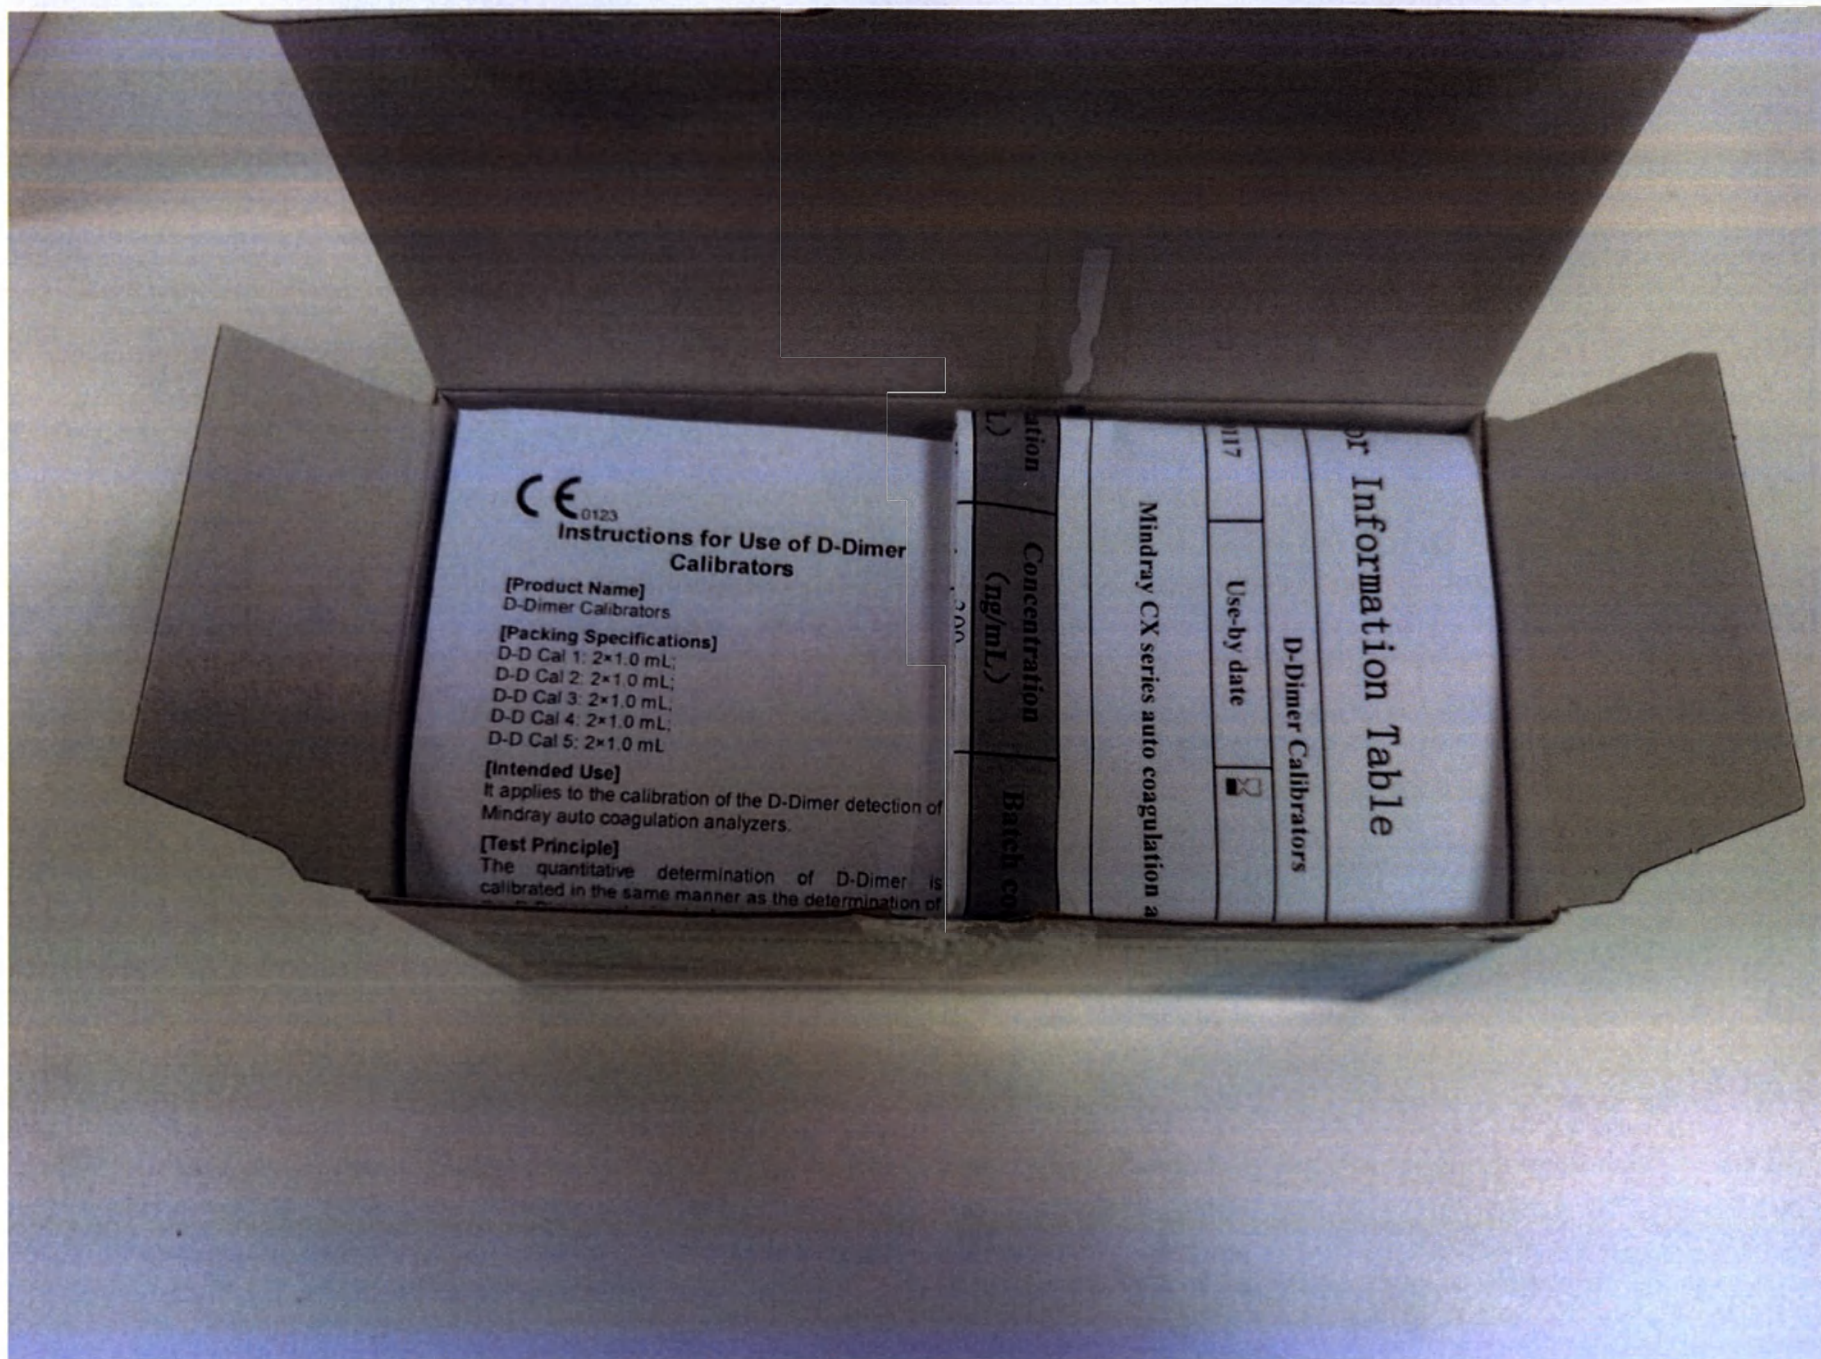


Рисунок 6 Вскрытая упаковка Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 1)



Рисунок 7 Вскрытая упаковка Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 2)

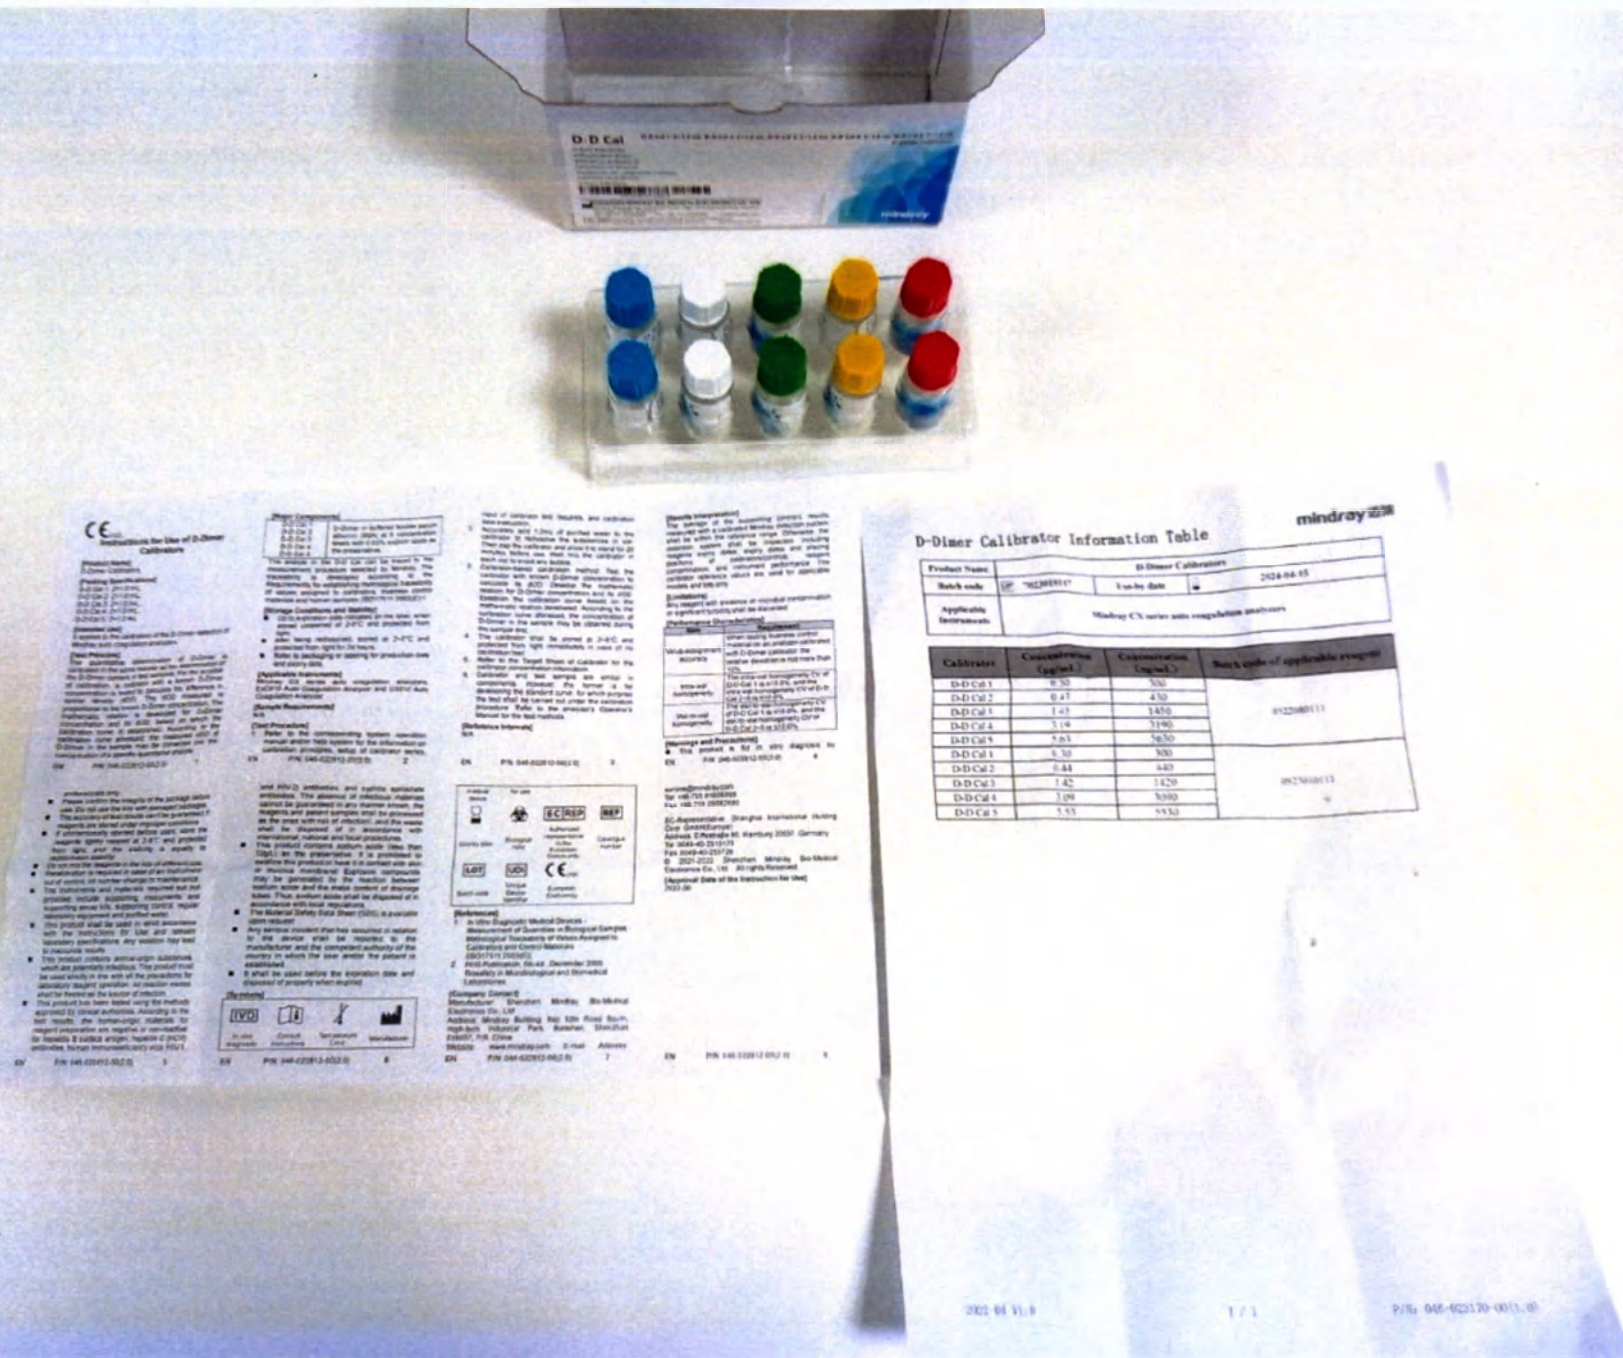


Рисунок 8 Общий вид Набор калибраторов для определения D-Димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro

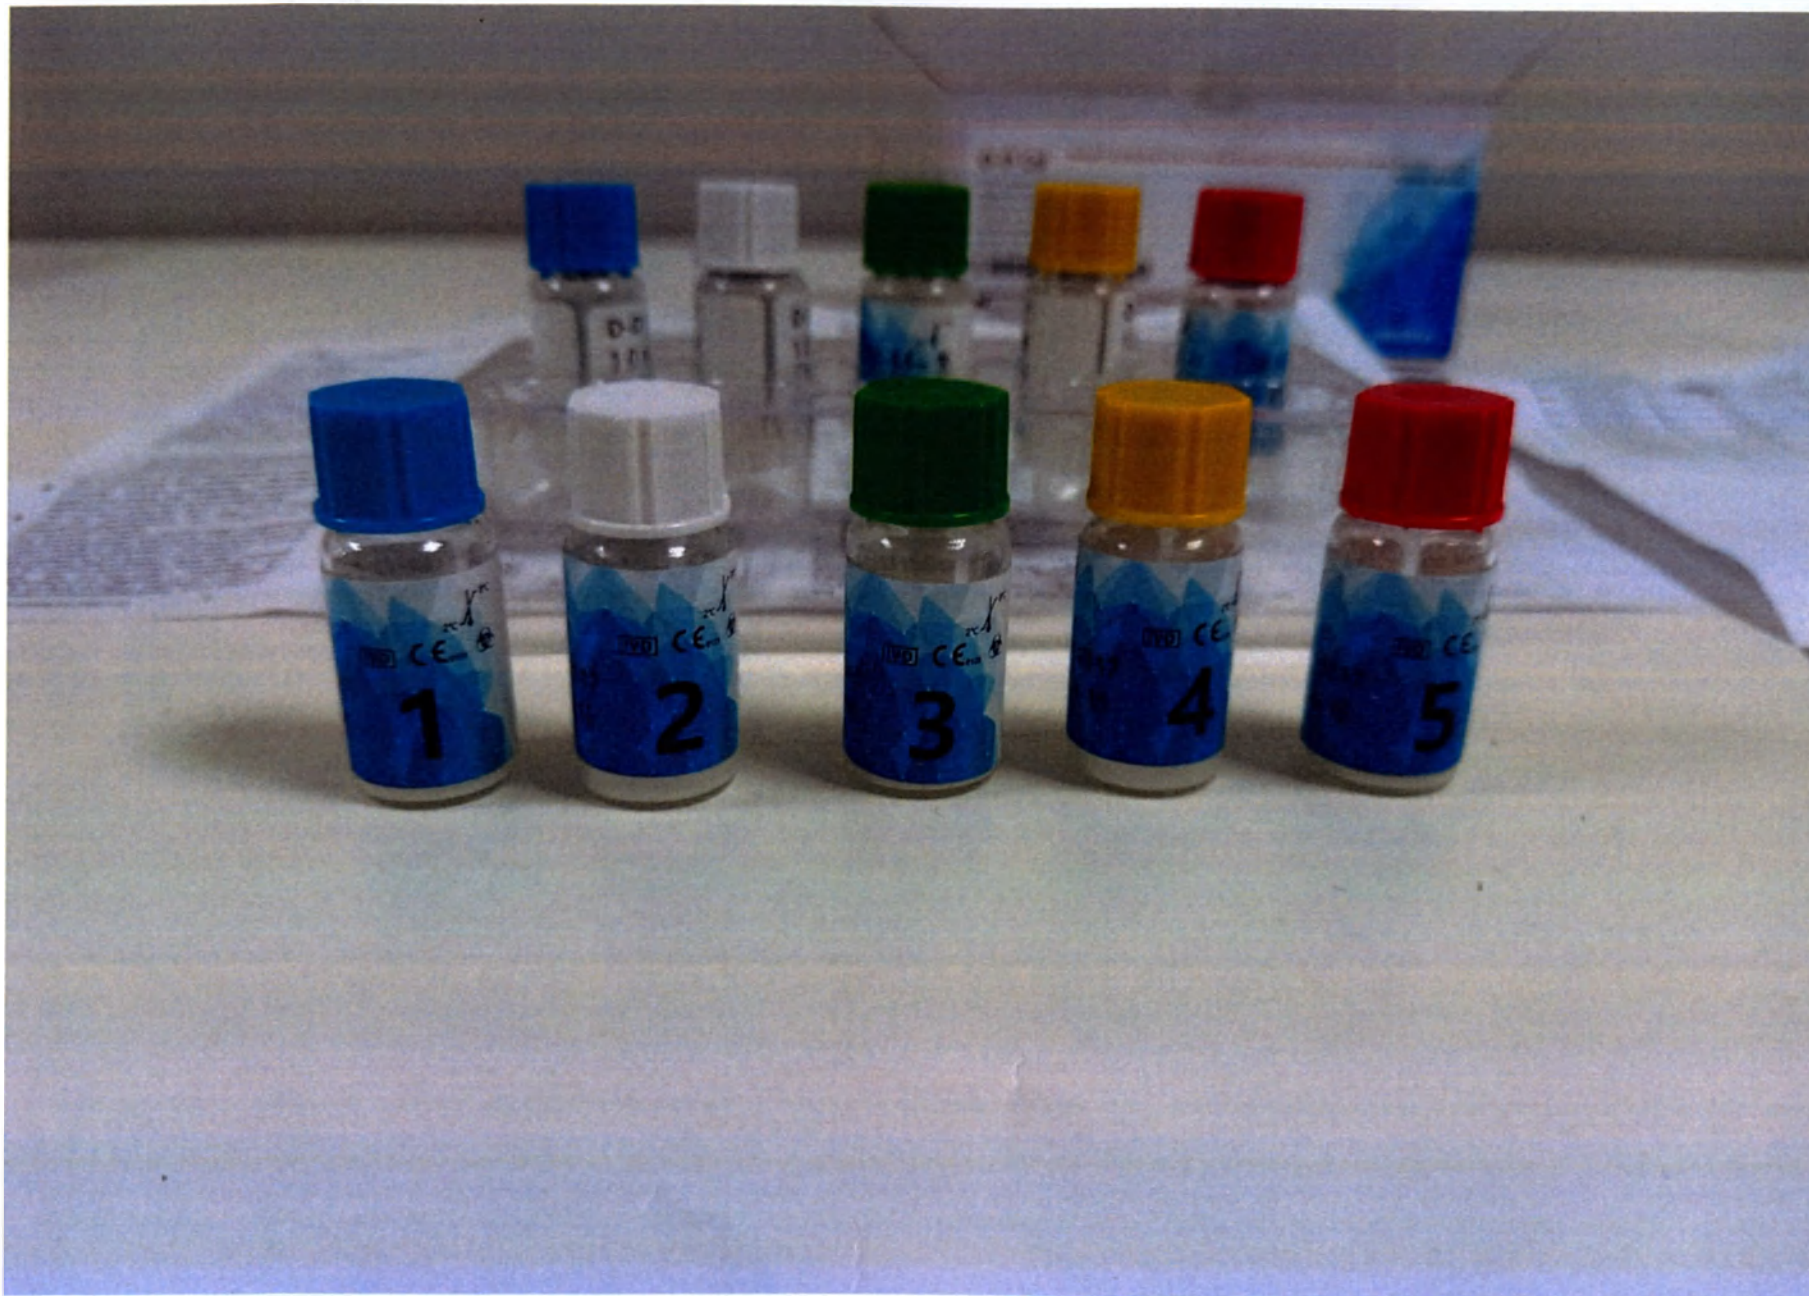


Рисунок 9 Внешний вид флаконов калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики *in vitro*

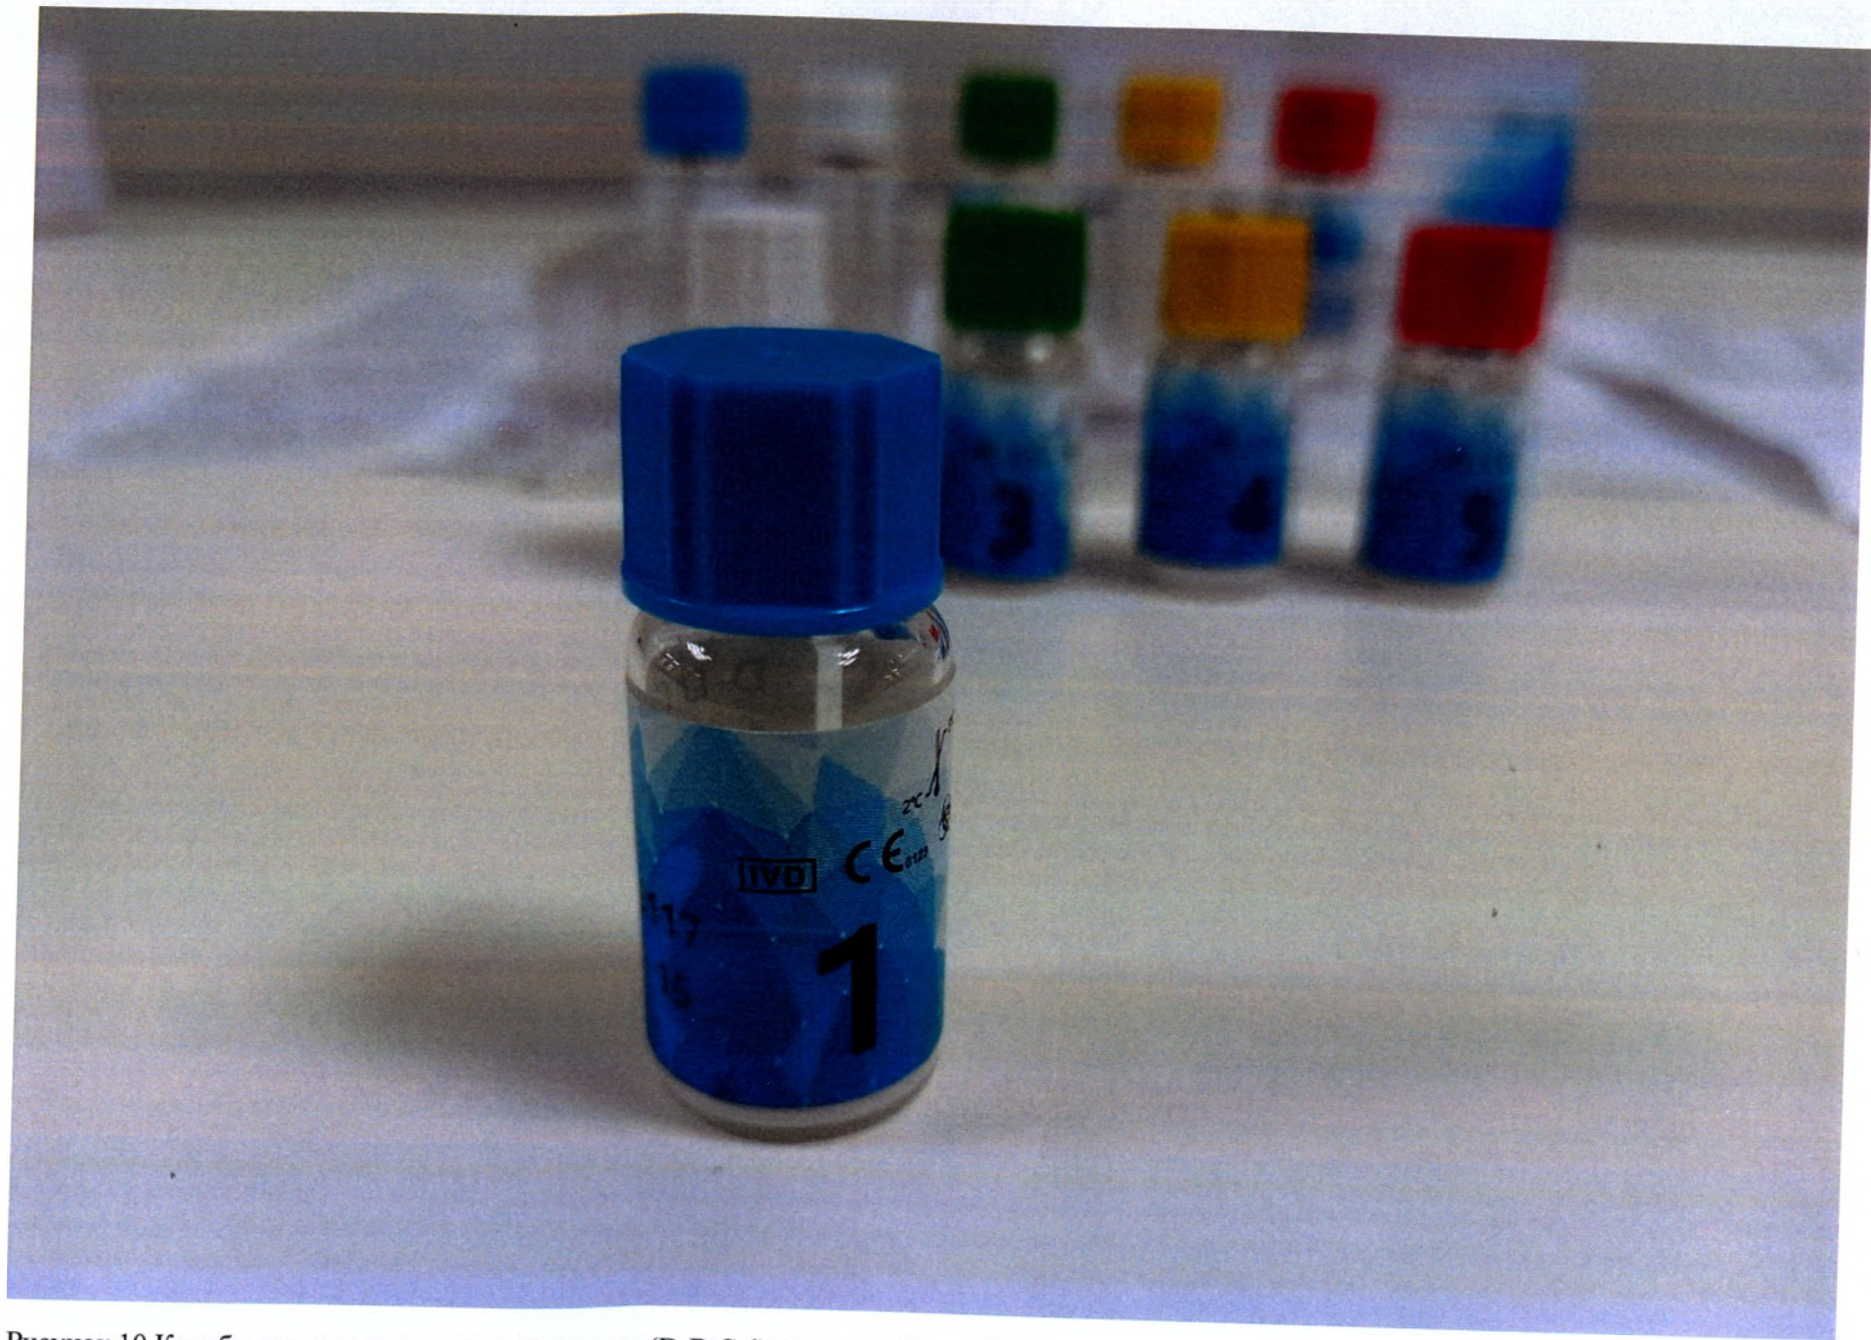


Рисунок 10 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 1) (вид 1)

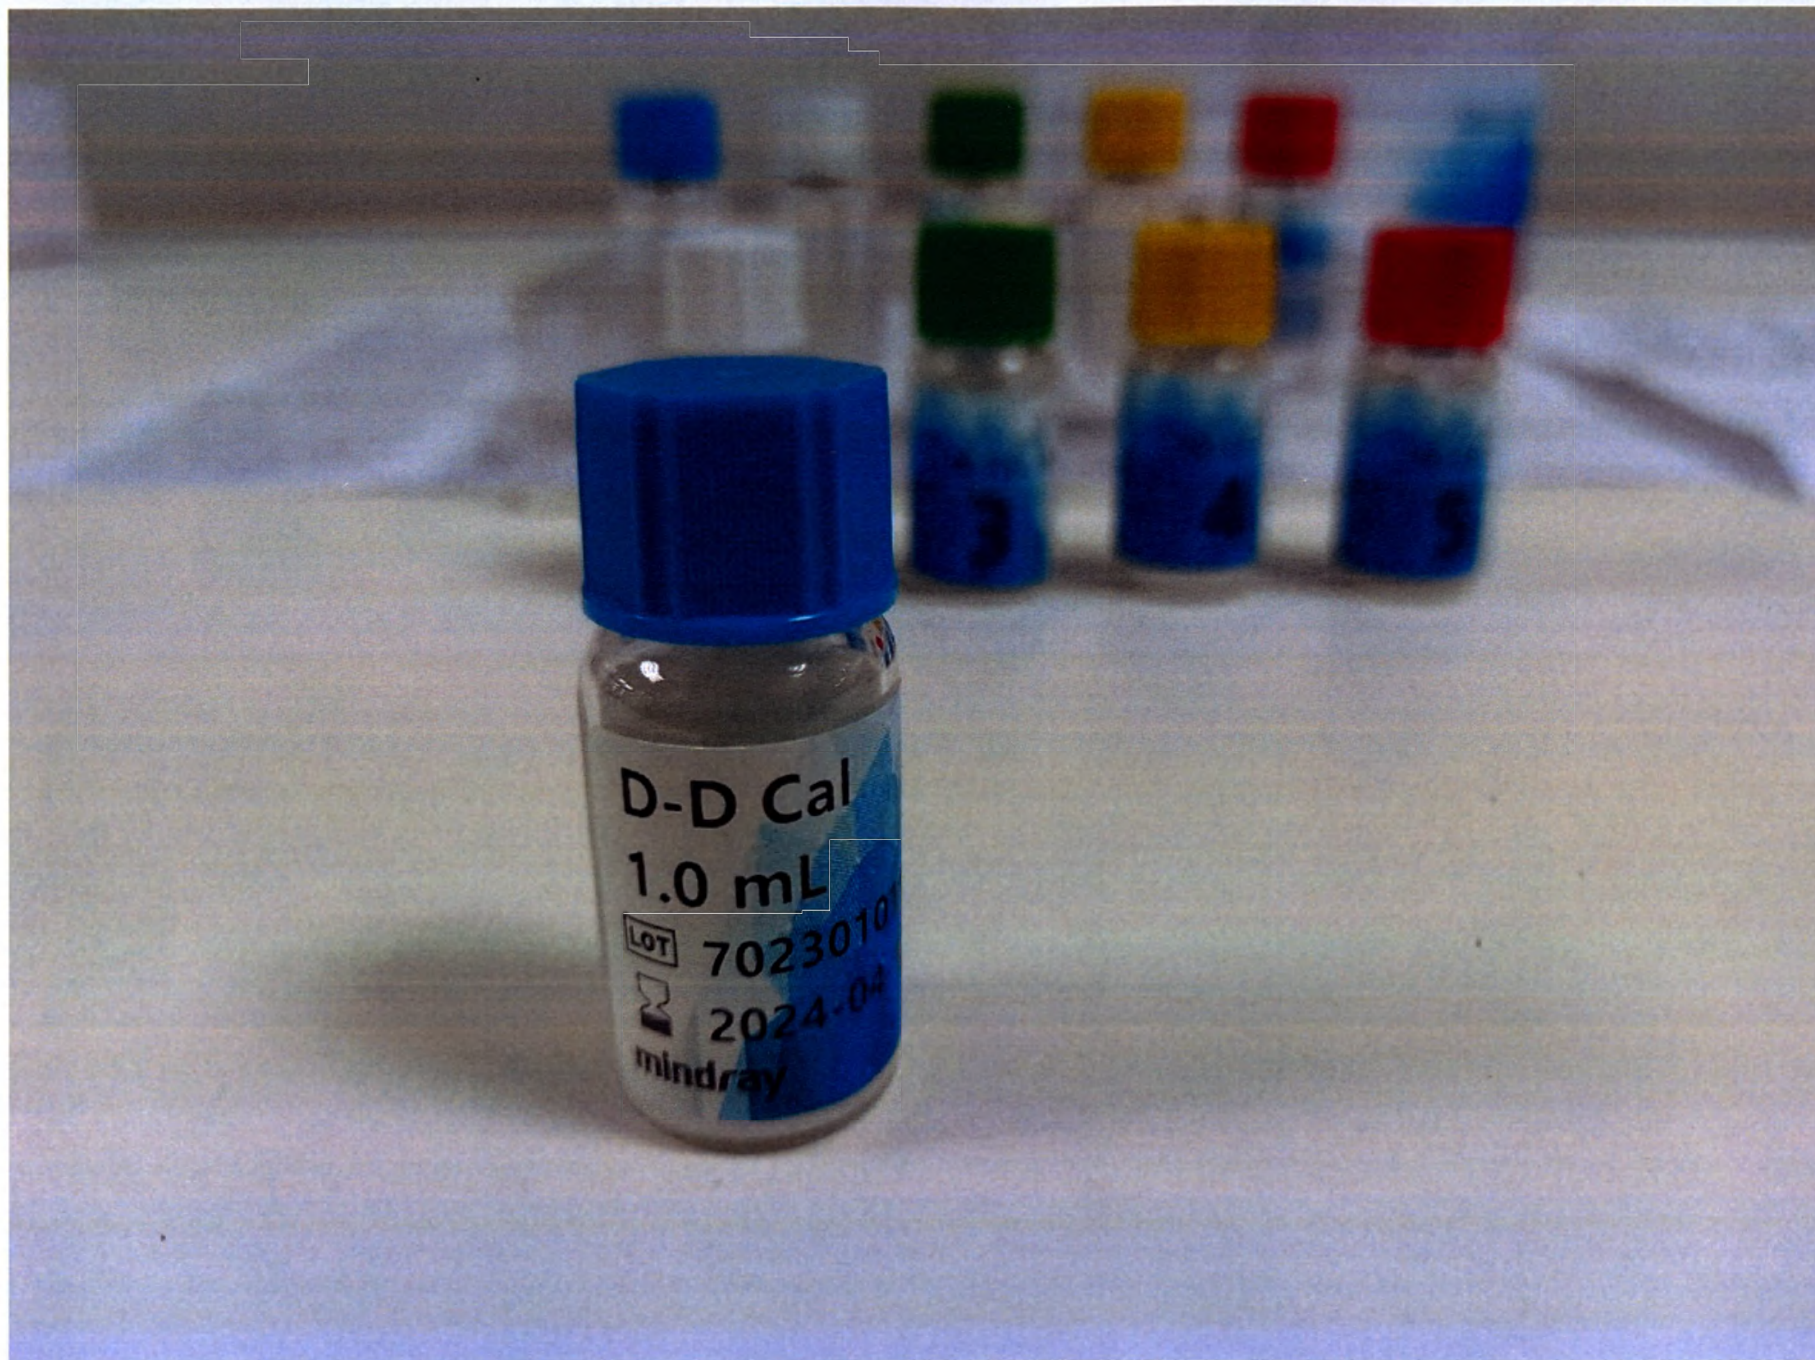


Рисунок 11 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 1) (вид 2)

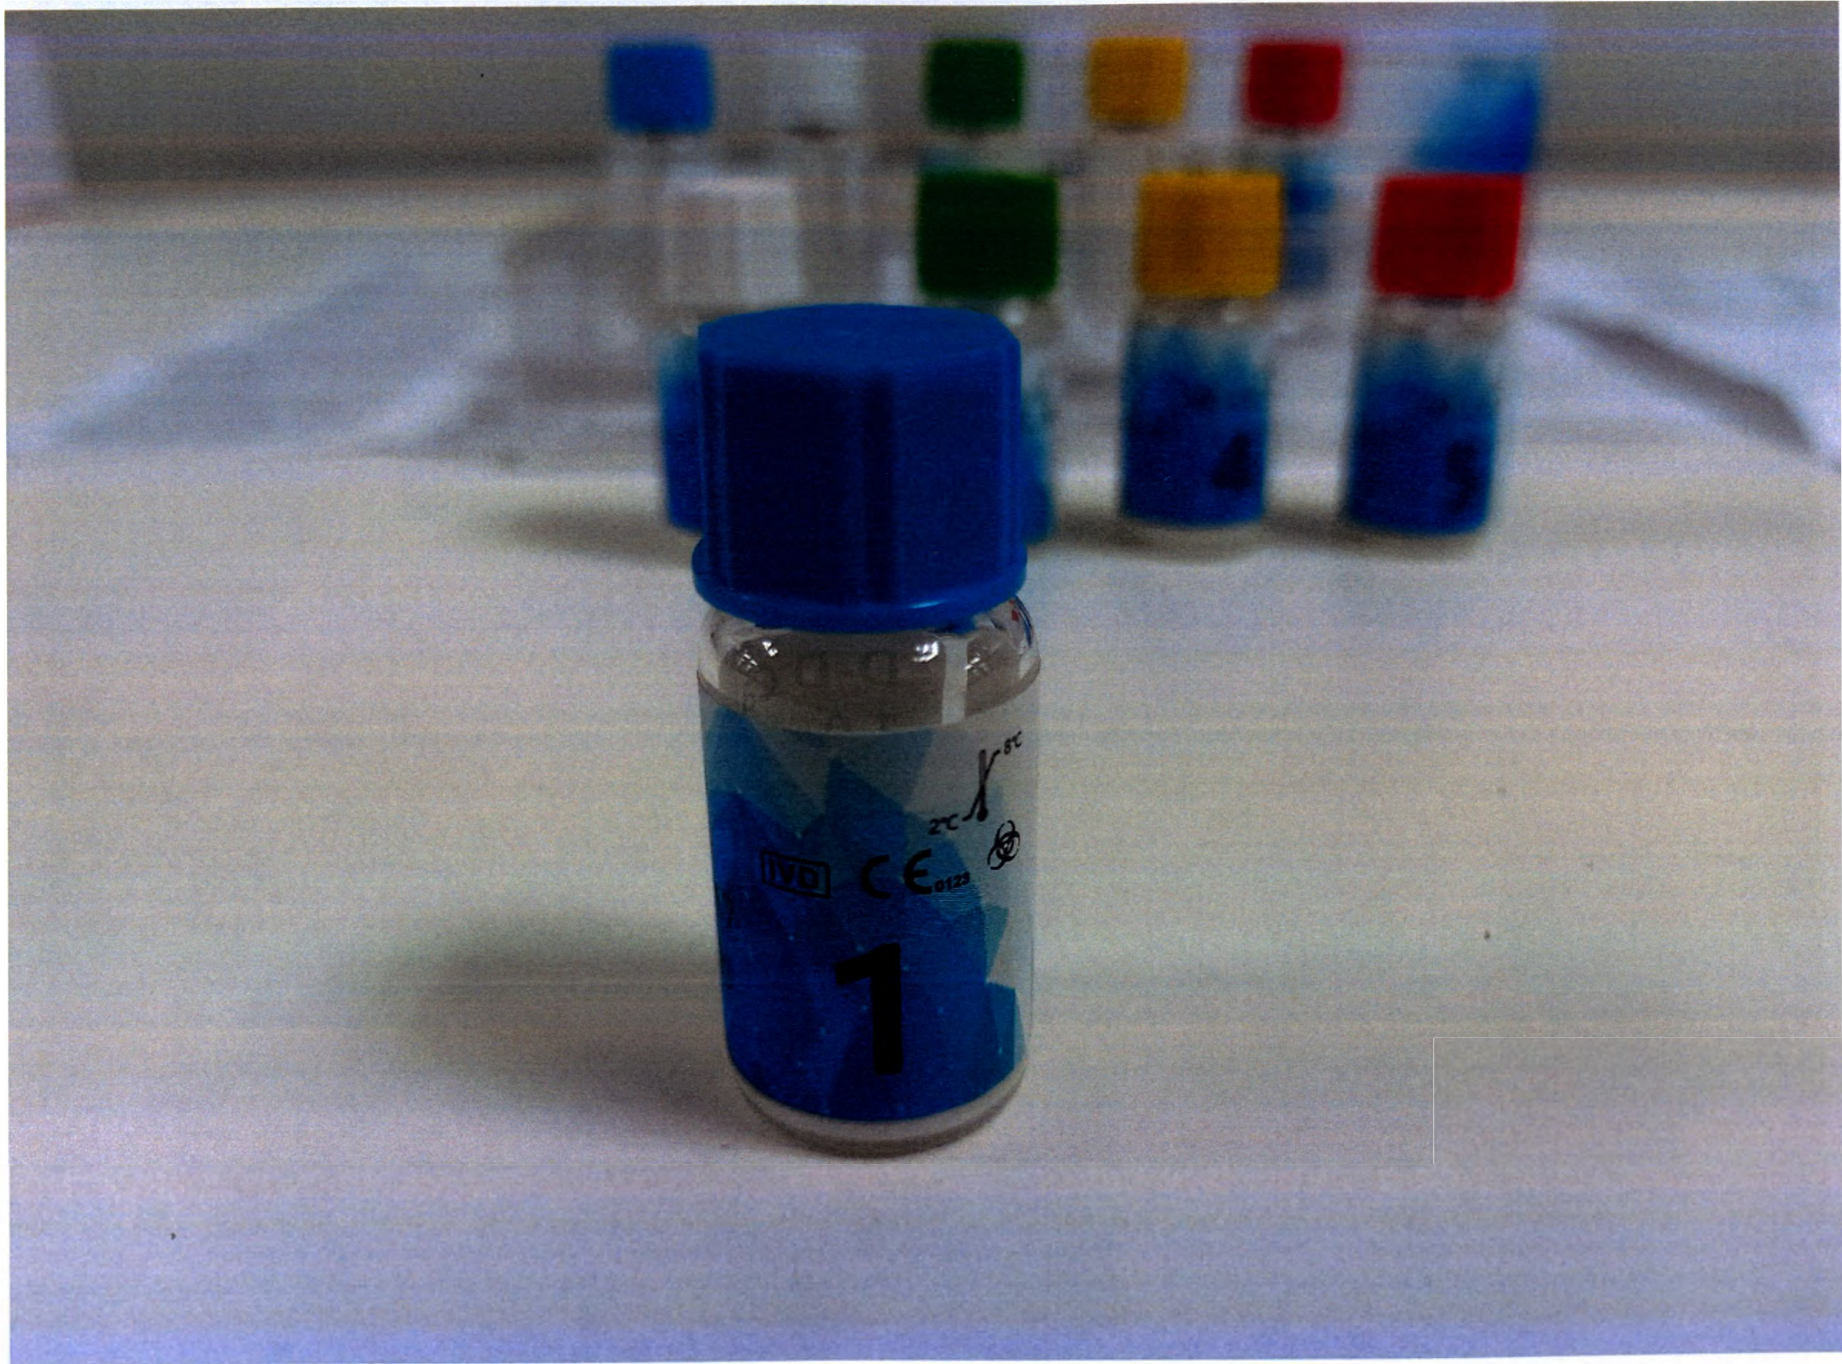


Рисунок 12 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 1) (вид 3)

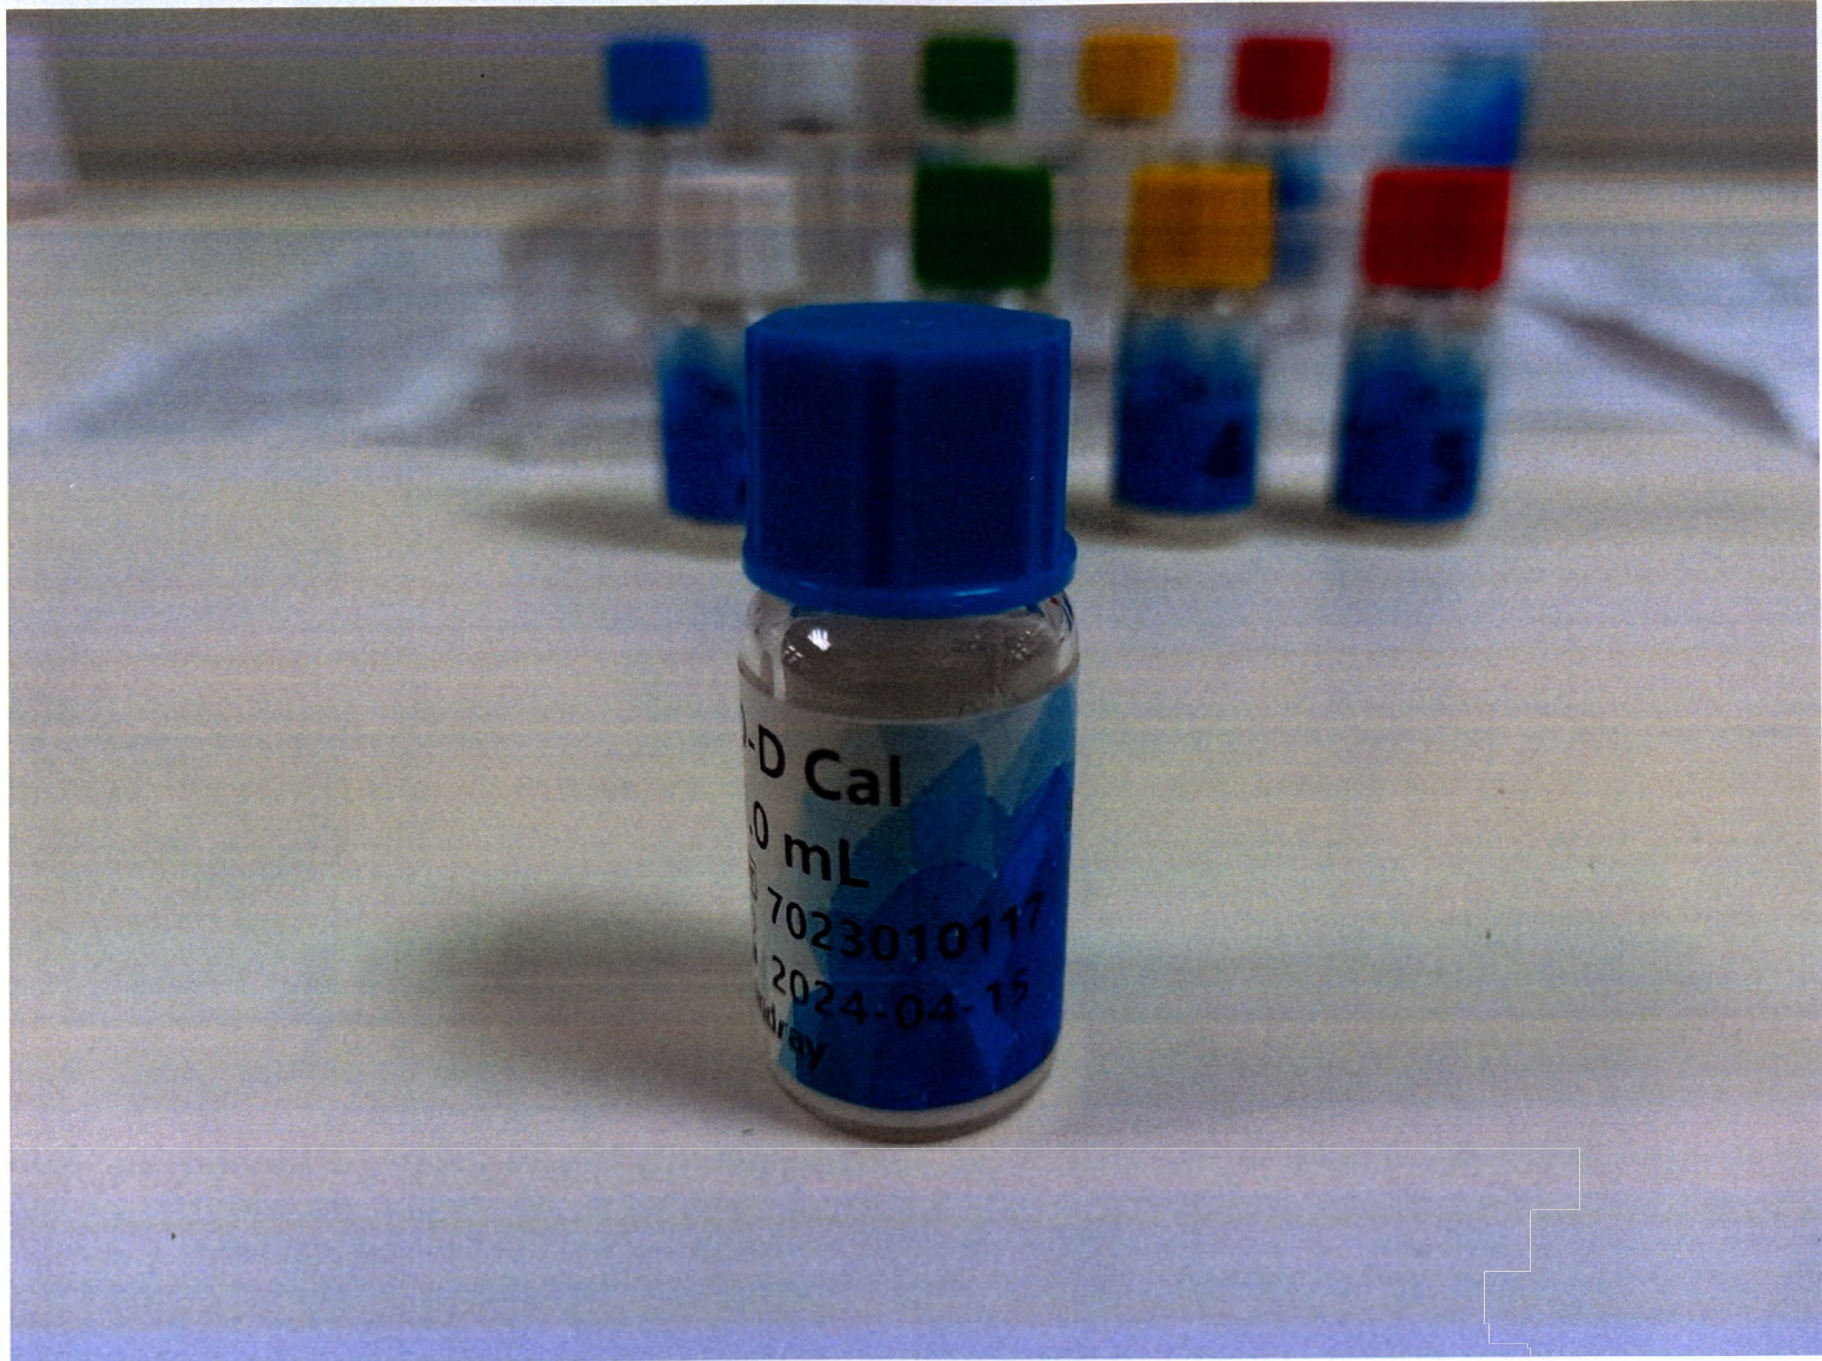


Рисунок 13 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 1) (вид 4)

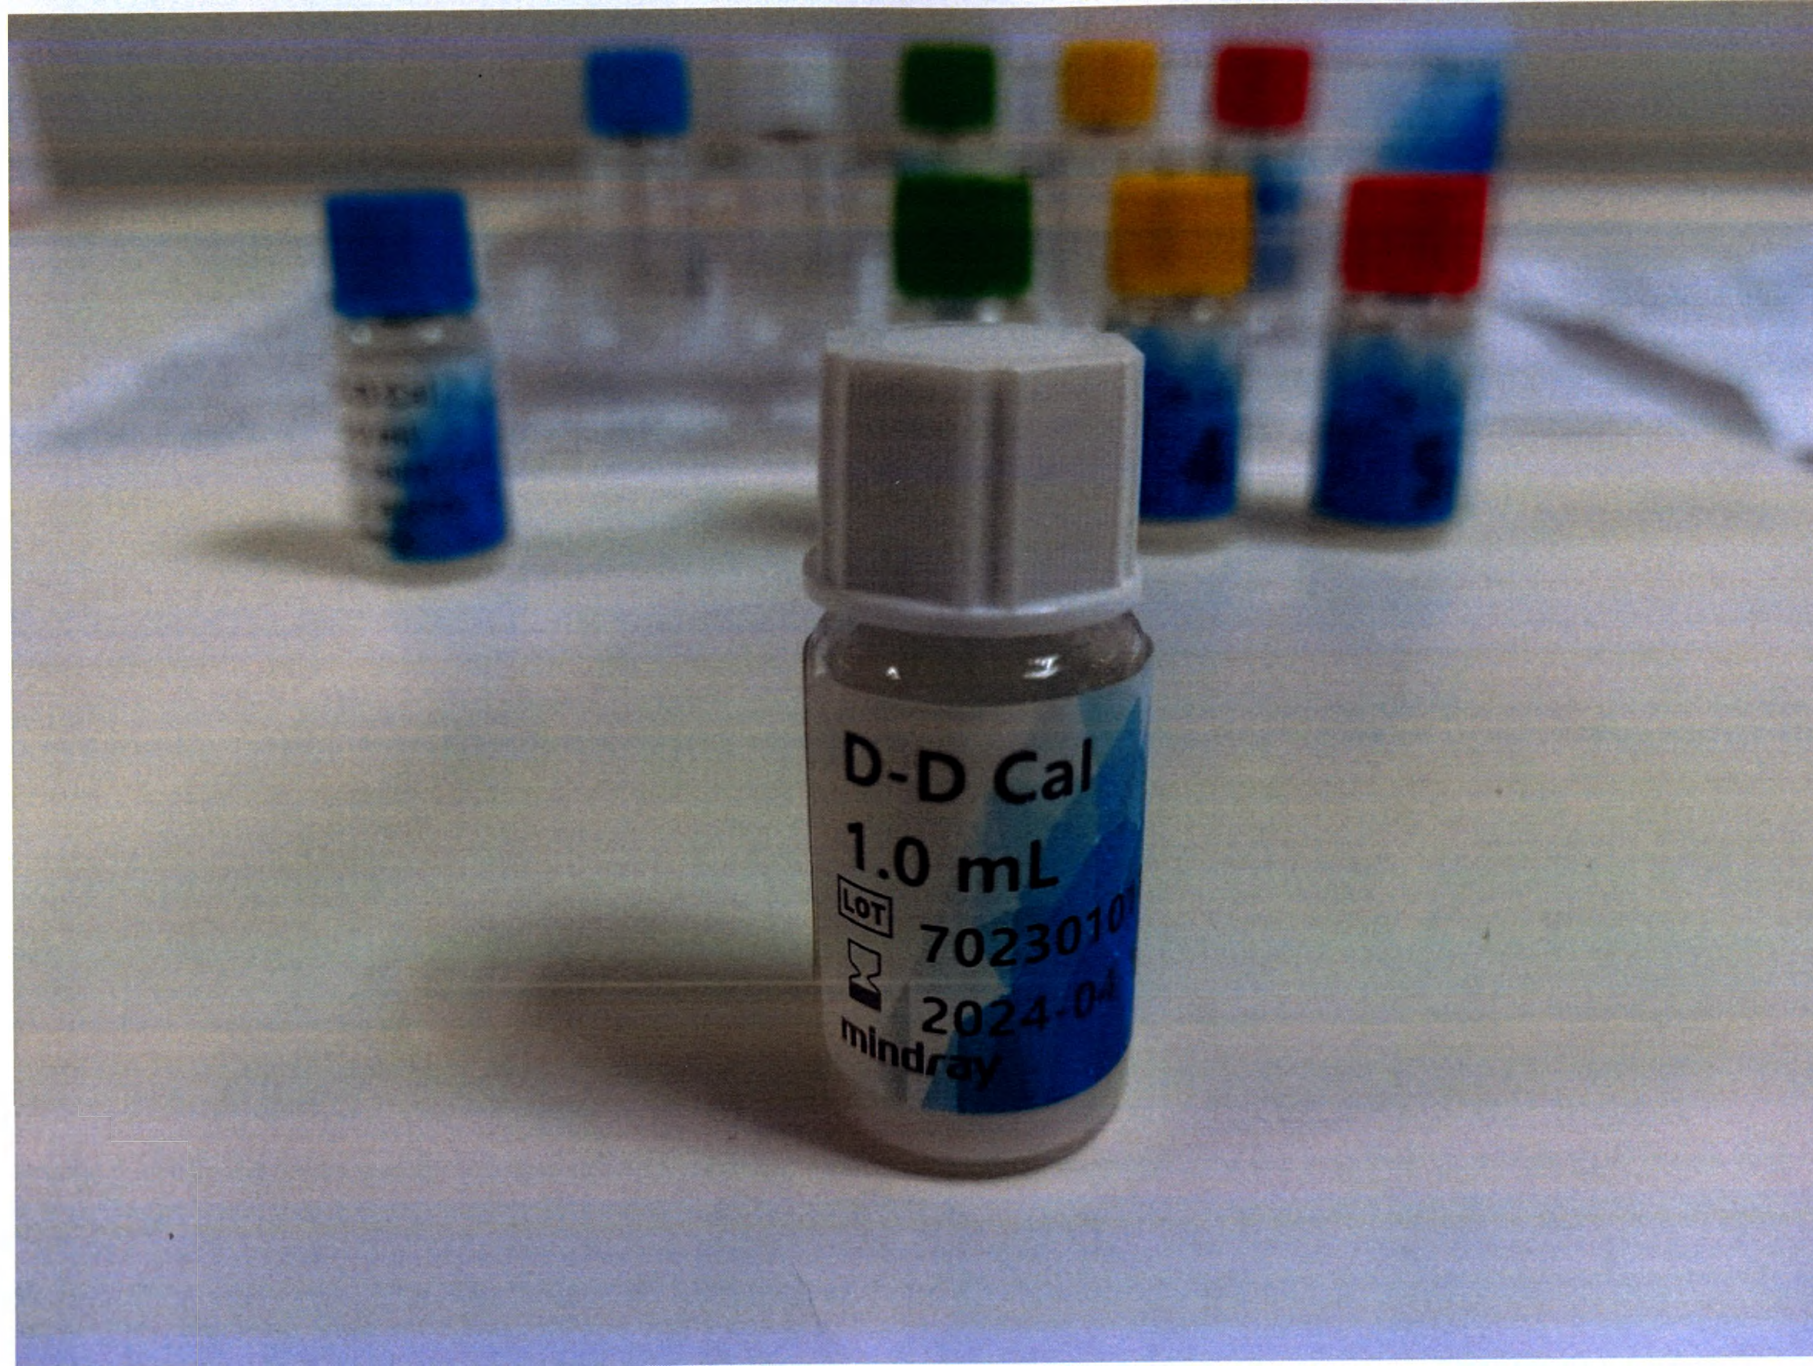


Рисунок 14 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 2) (вид 1)

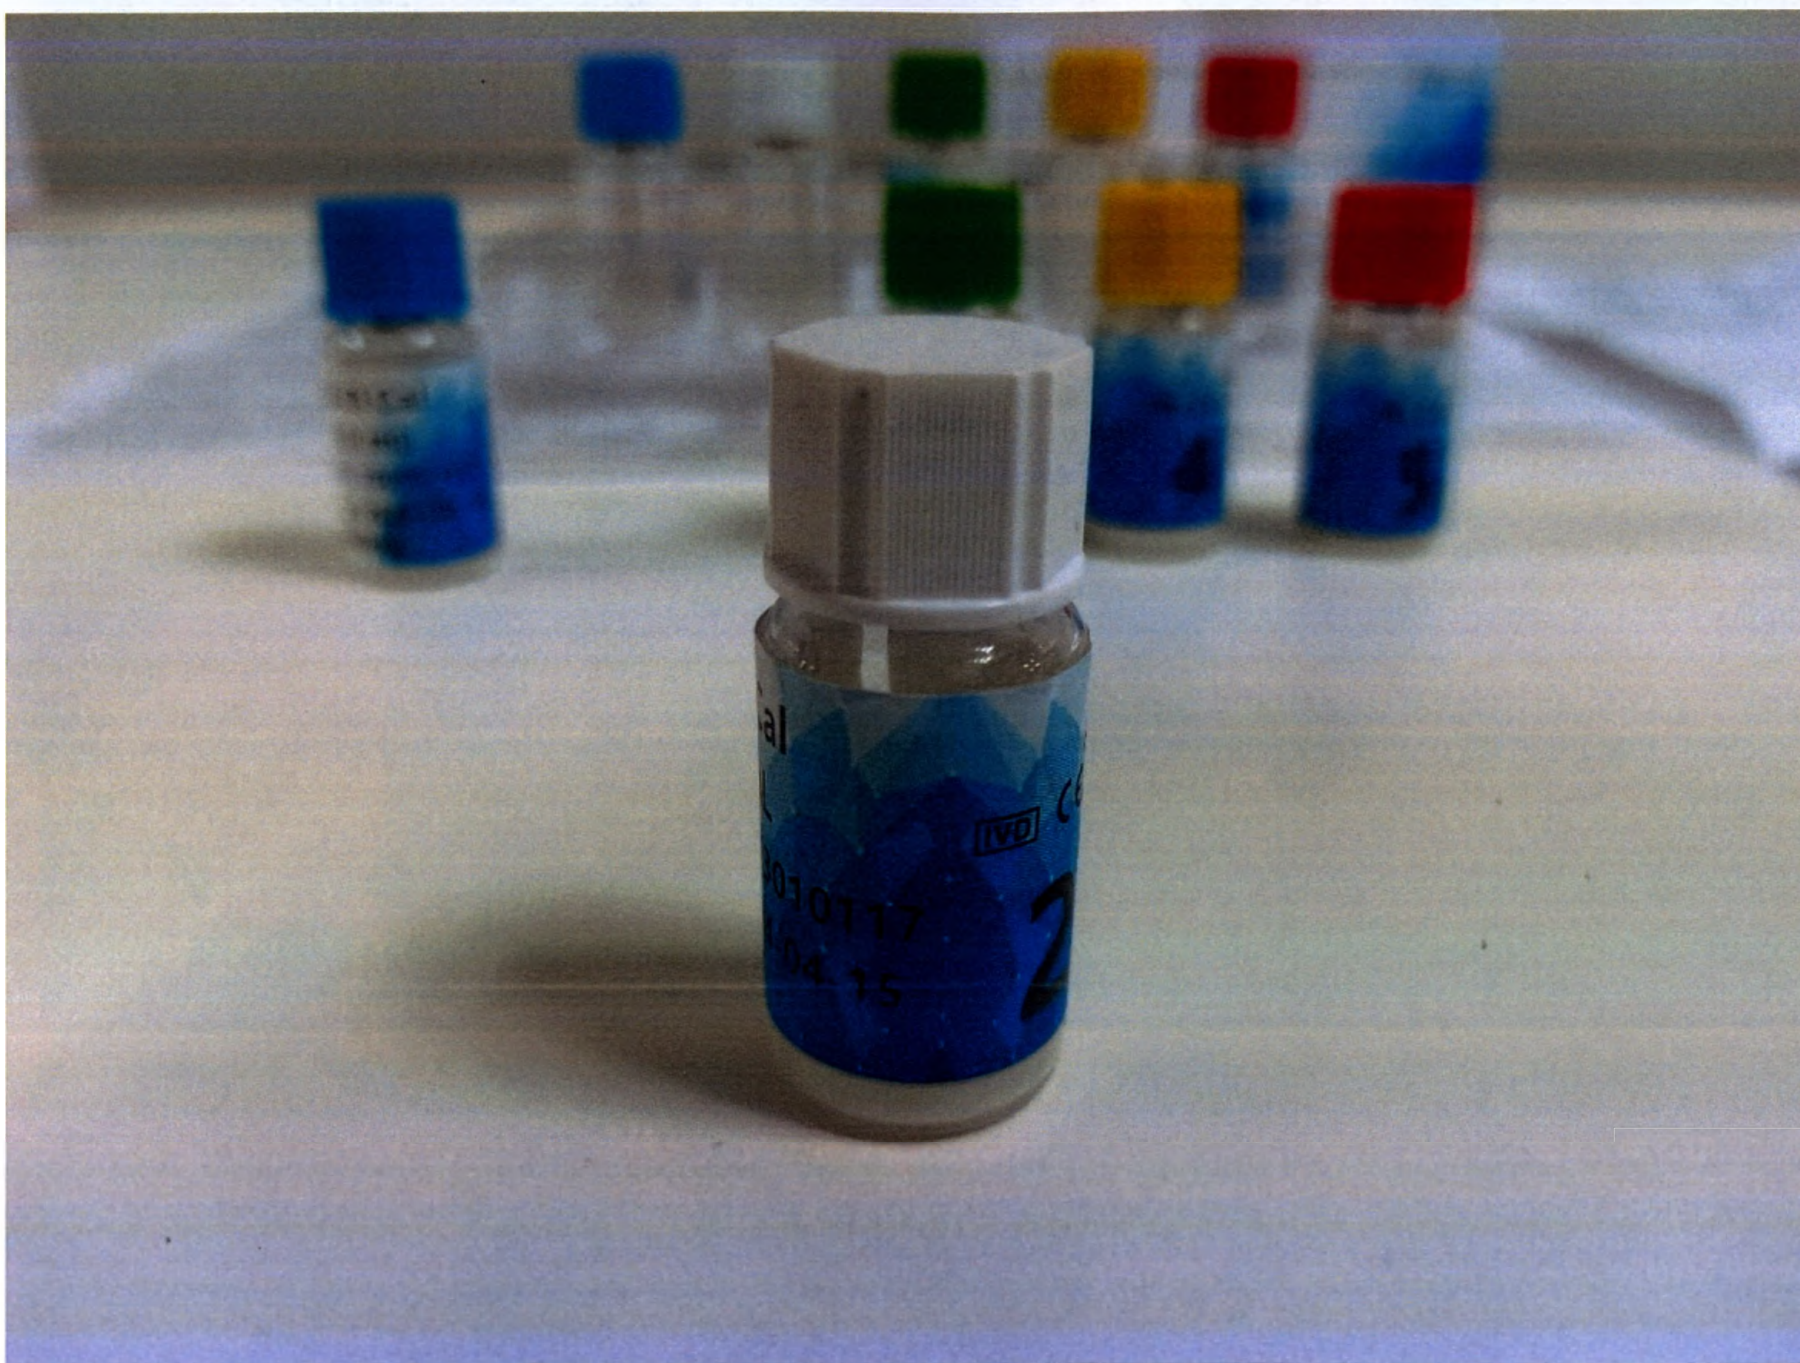


Рисунок 15 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 2) (вид 2)



Рисунок 15 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 2) (вид 3)

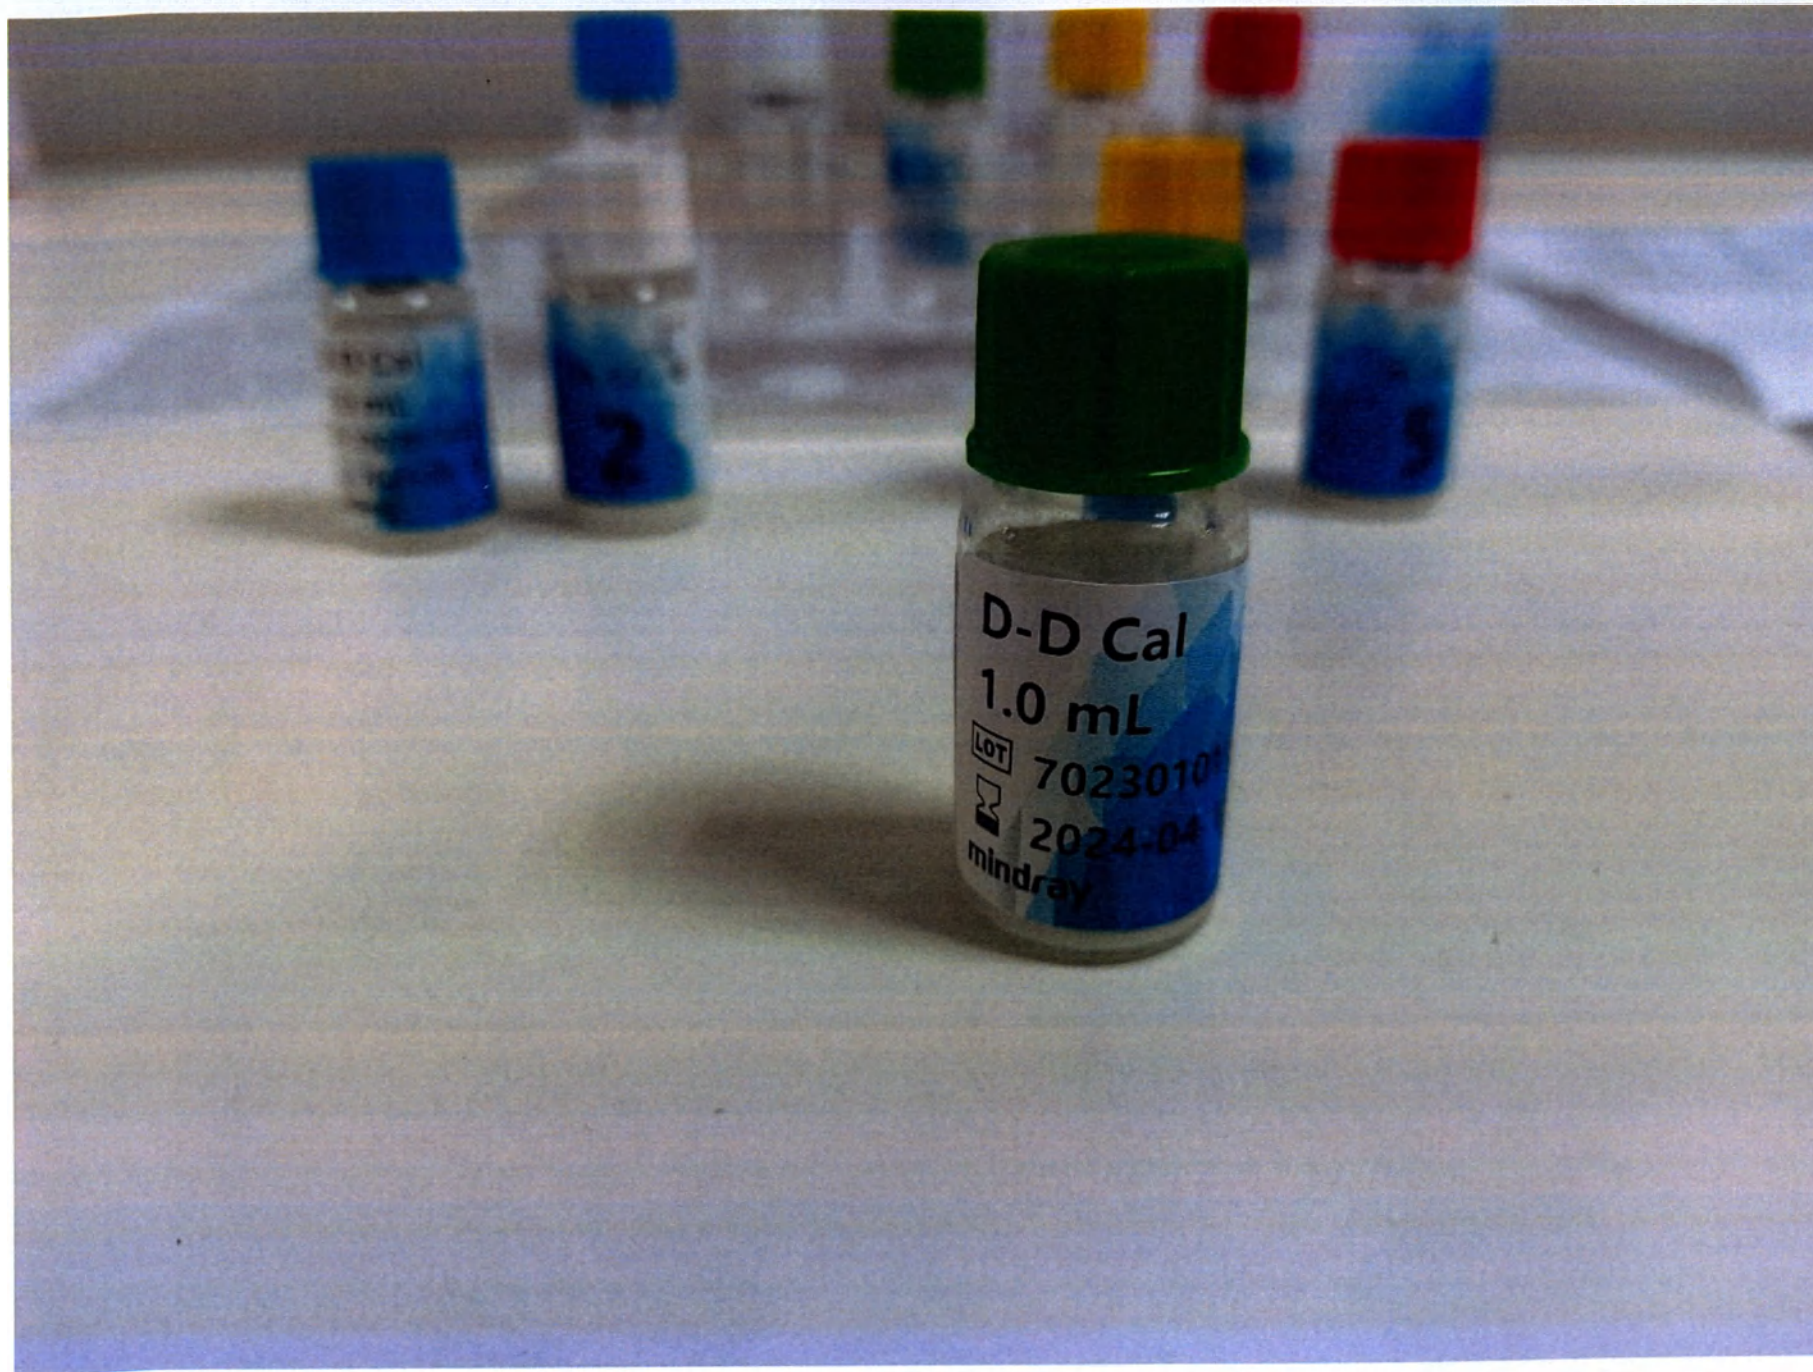


Рисунок 16 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 3) (вид 1)

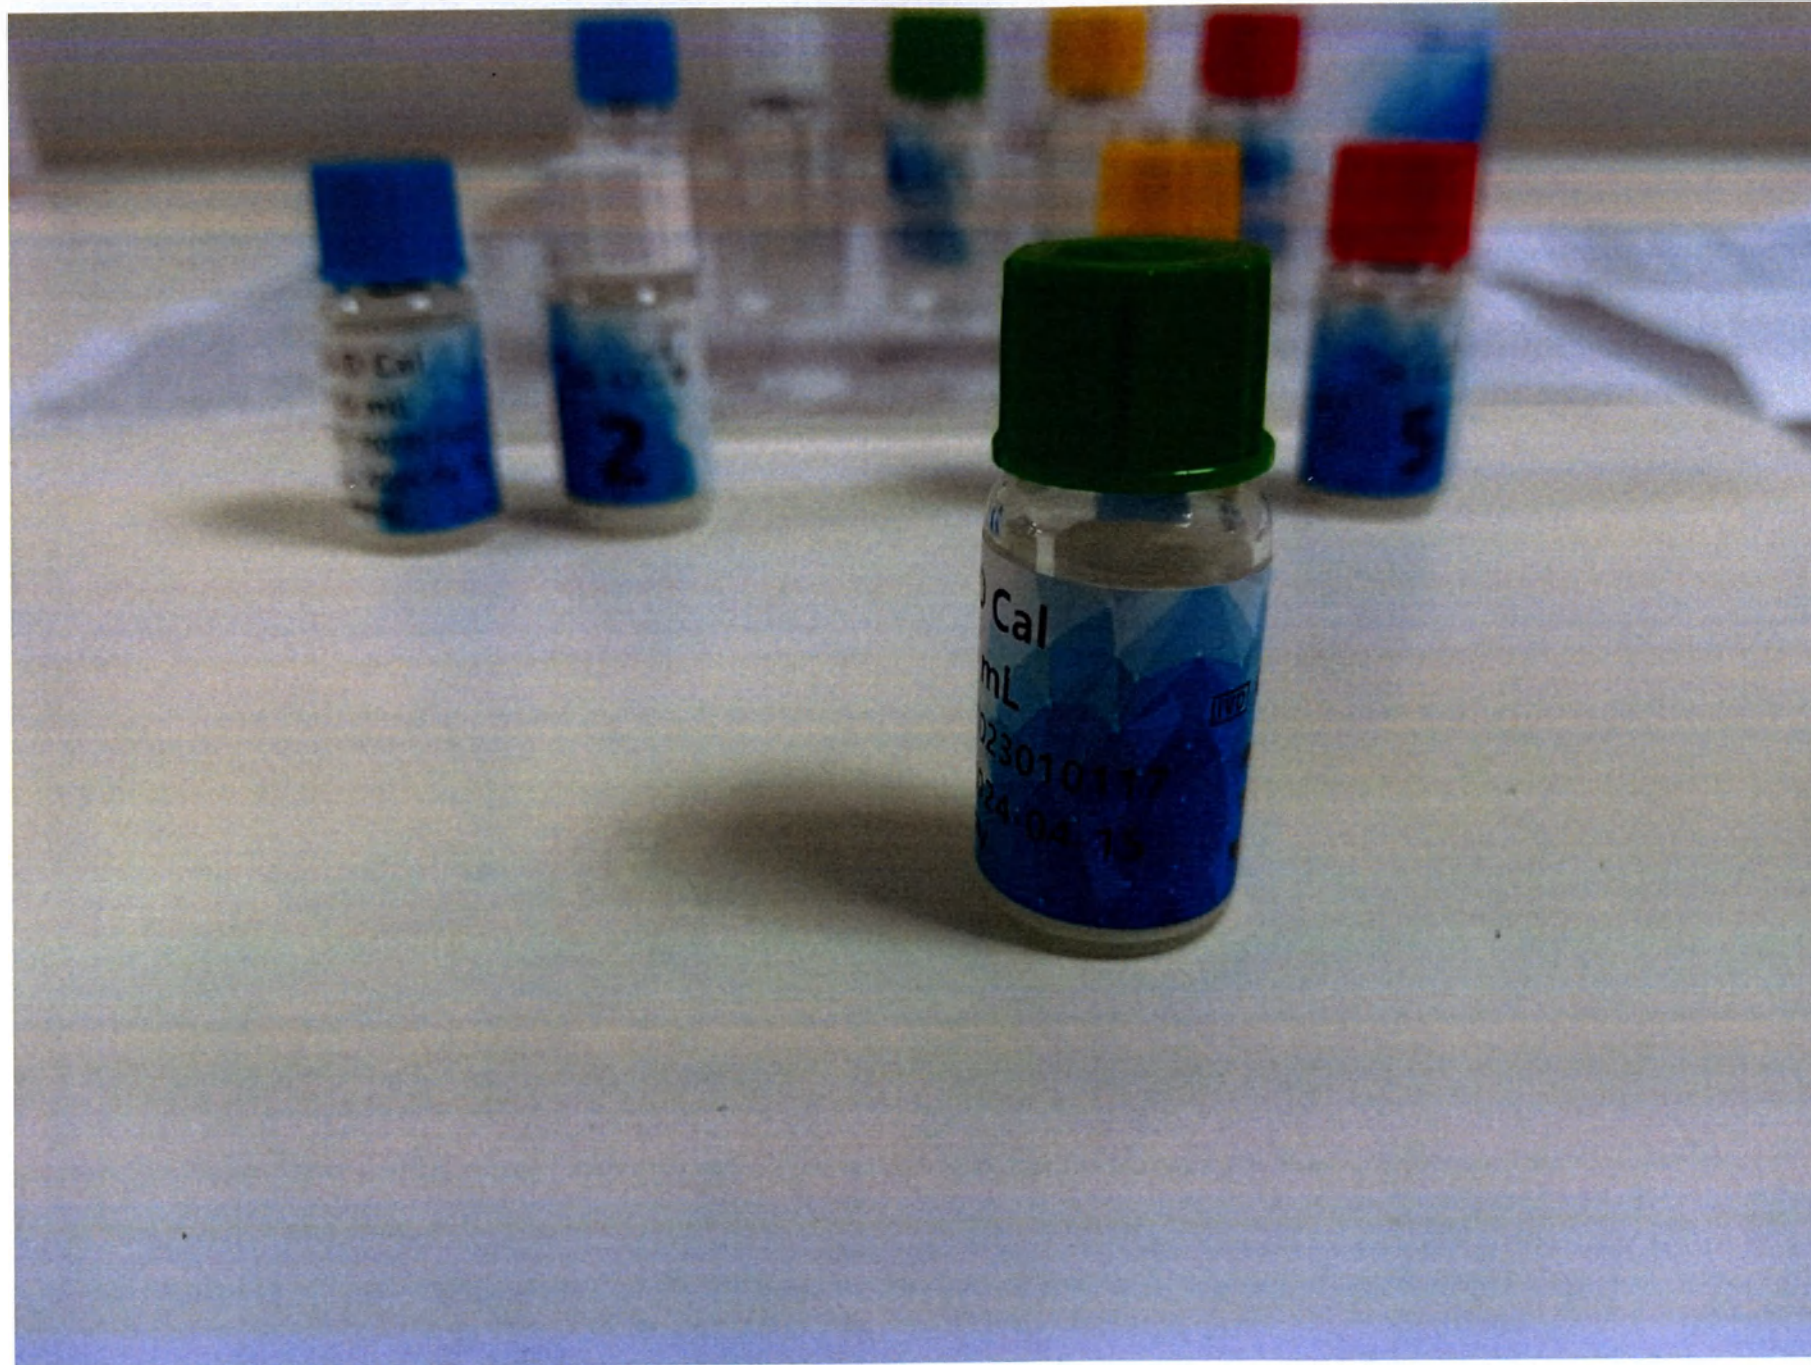


Рисунок 17 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 3) (вид 2)

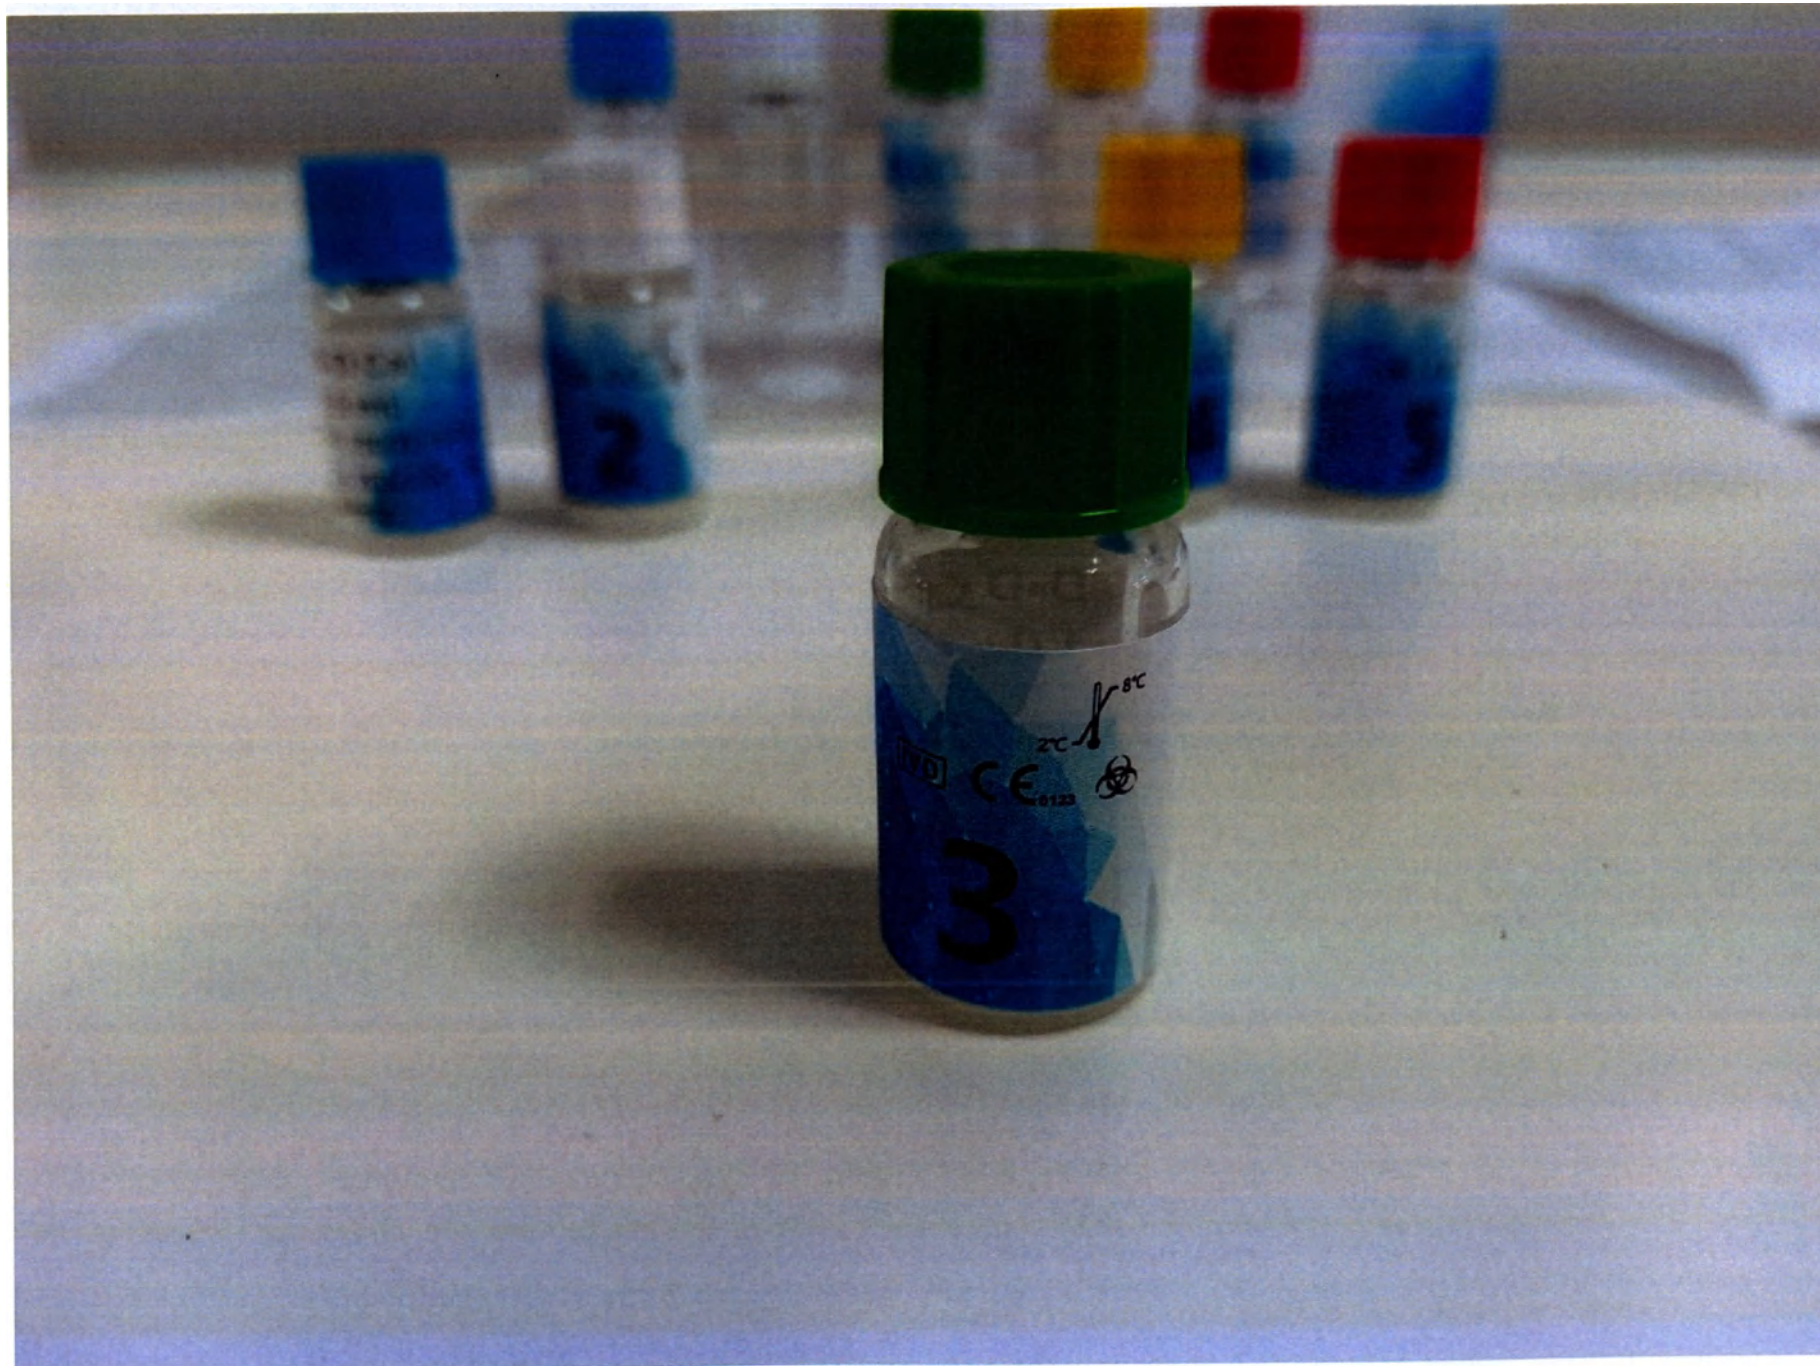


Рисунок 18 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 3) (вид 3)



Рисунок 19 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 4) (вид 1)

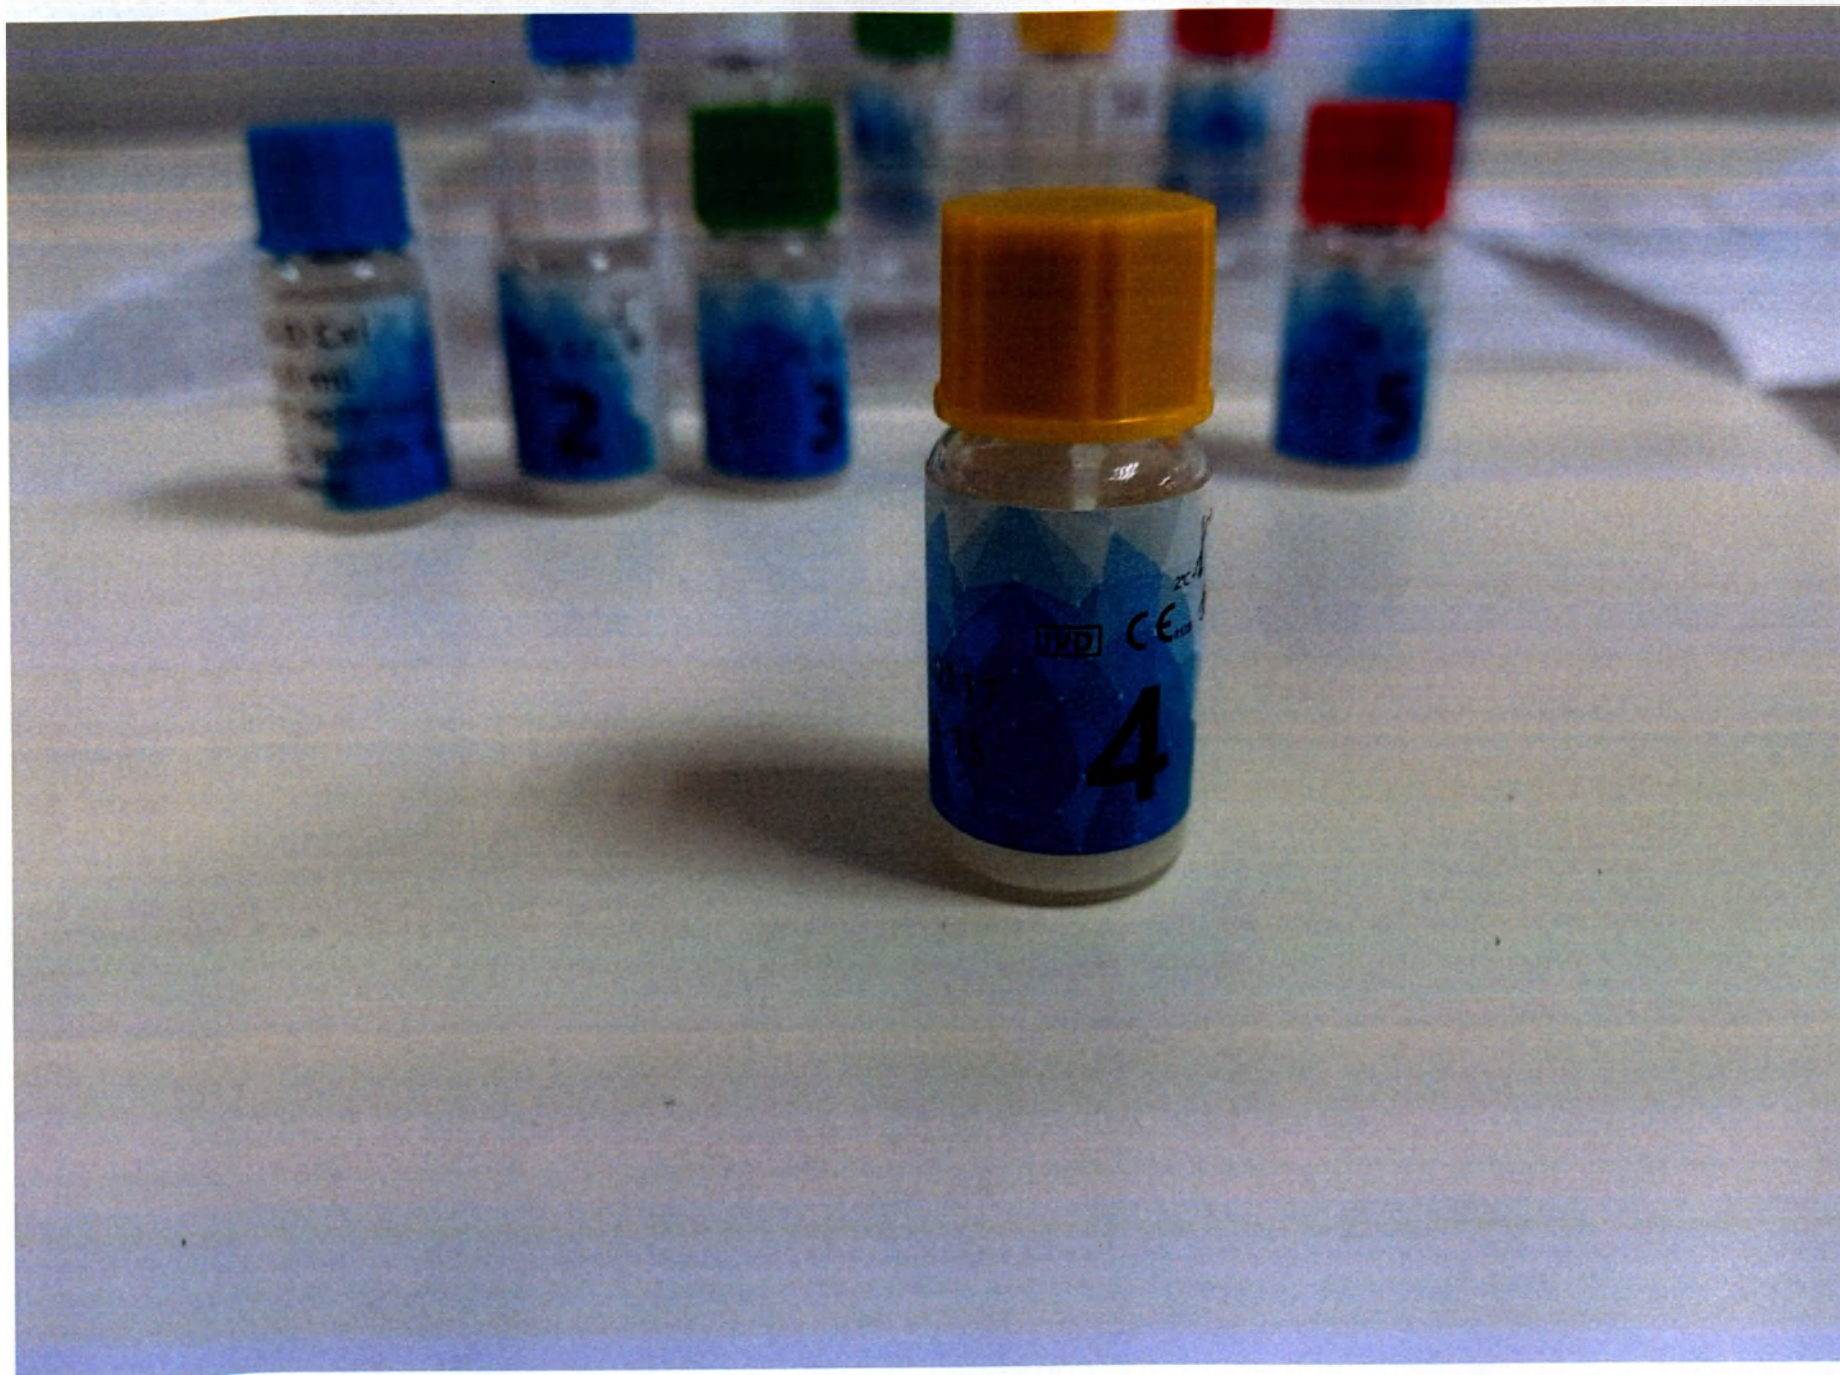



Рисунок 20 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 4) (вид 2)



Рисунок 21 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 4) (вид 3)



Рисунок 22 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 5) (вид 1)

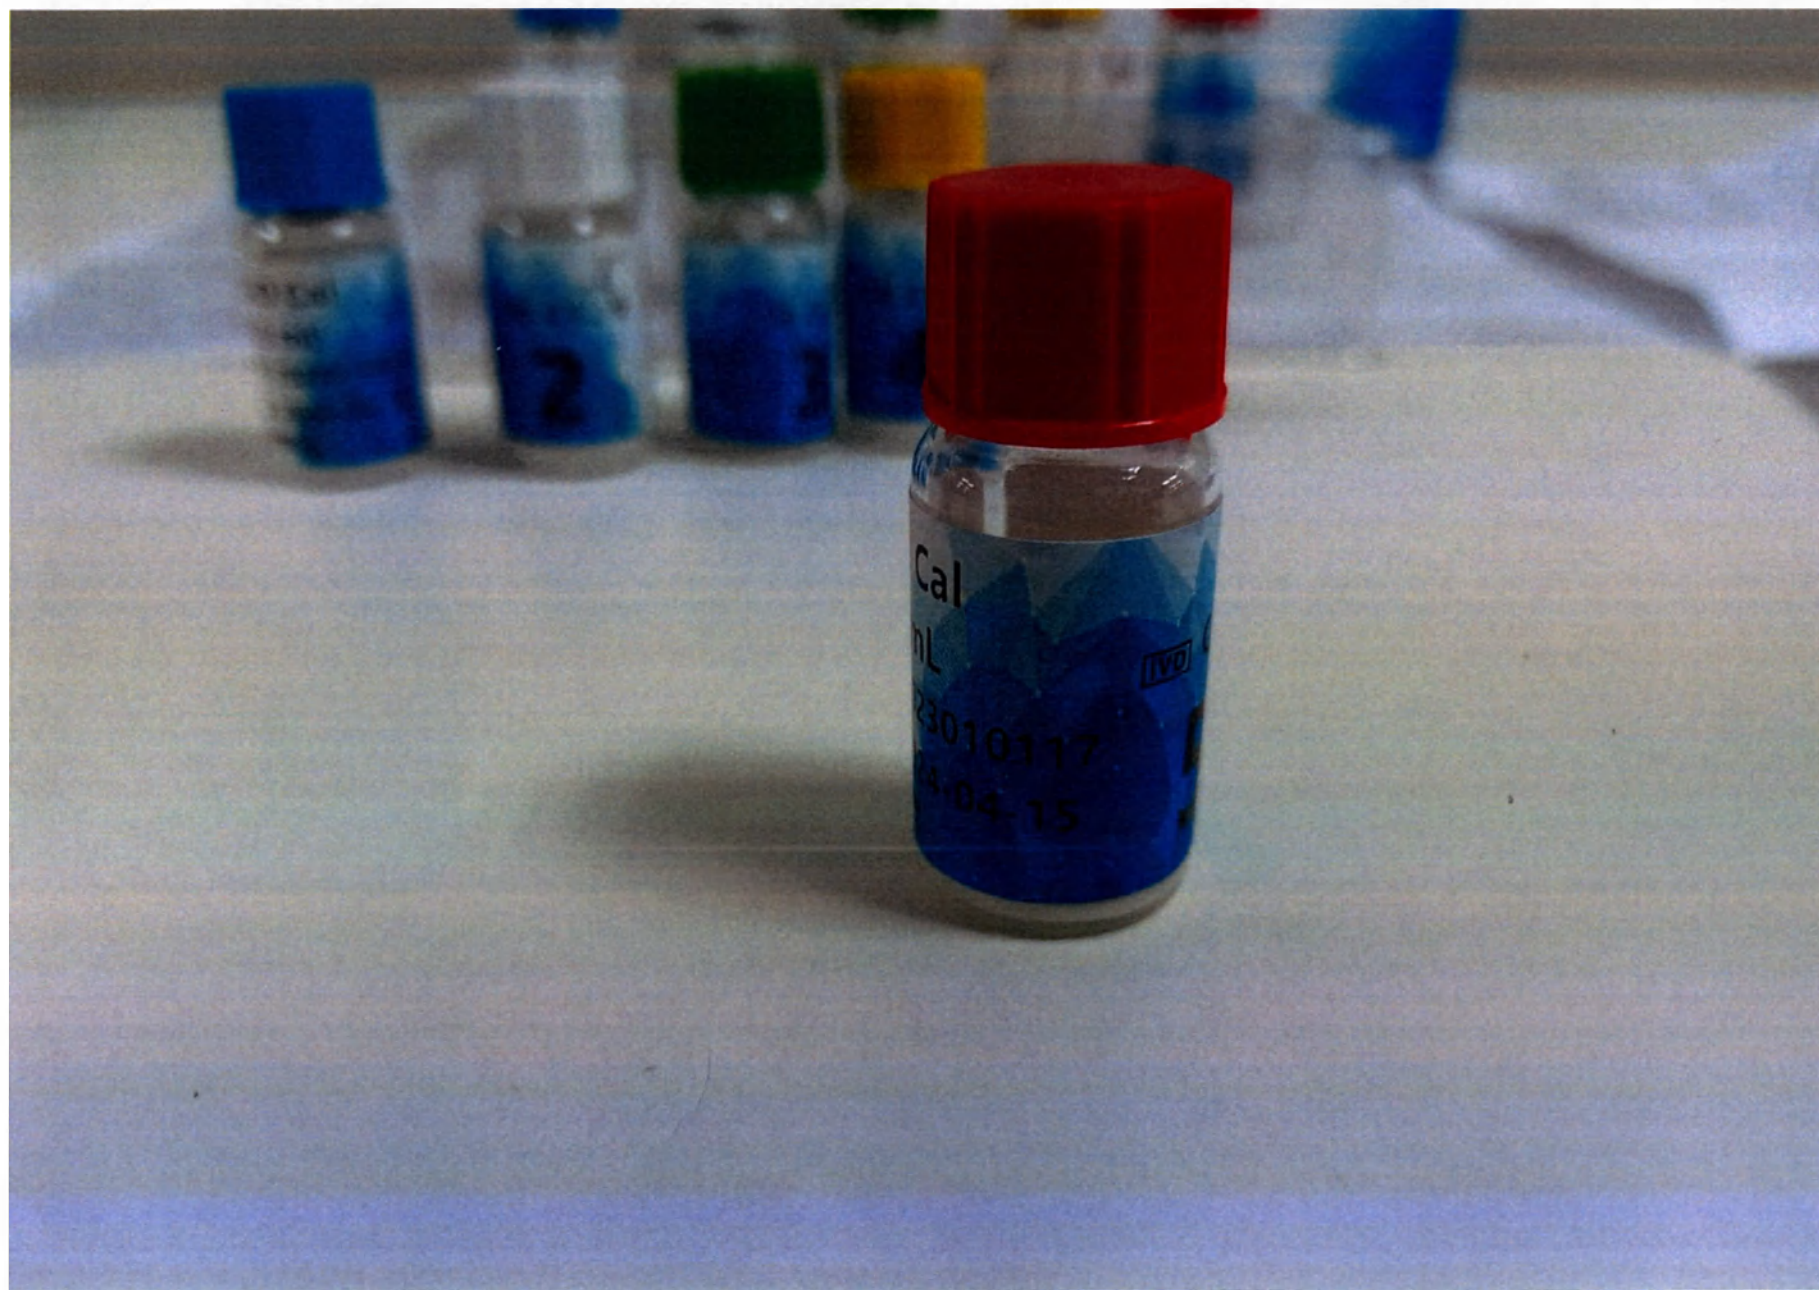

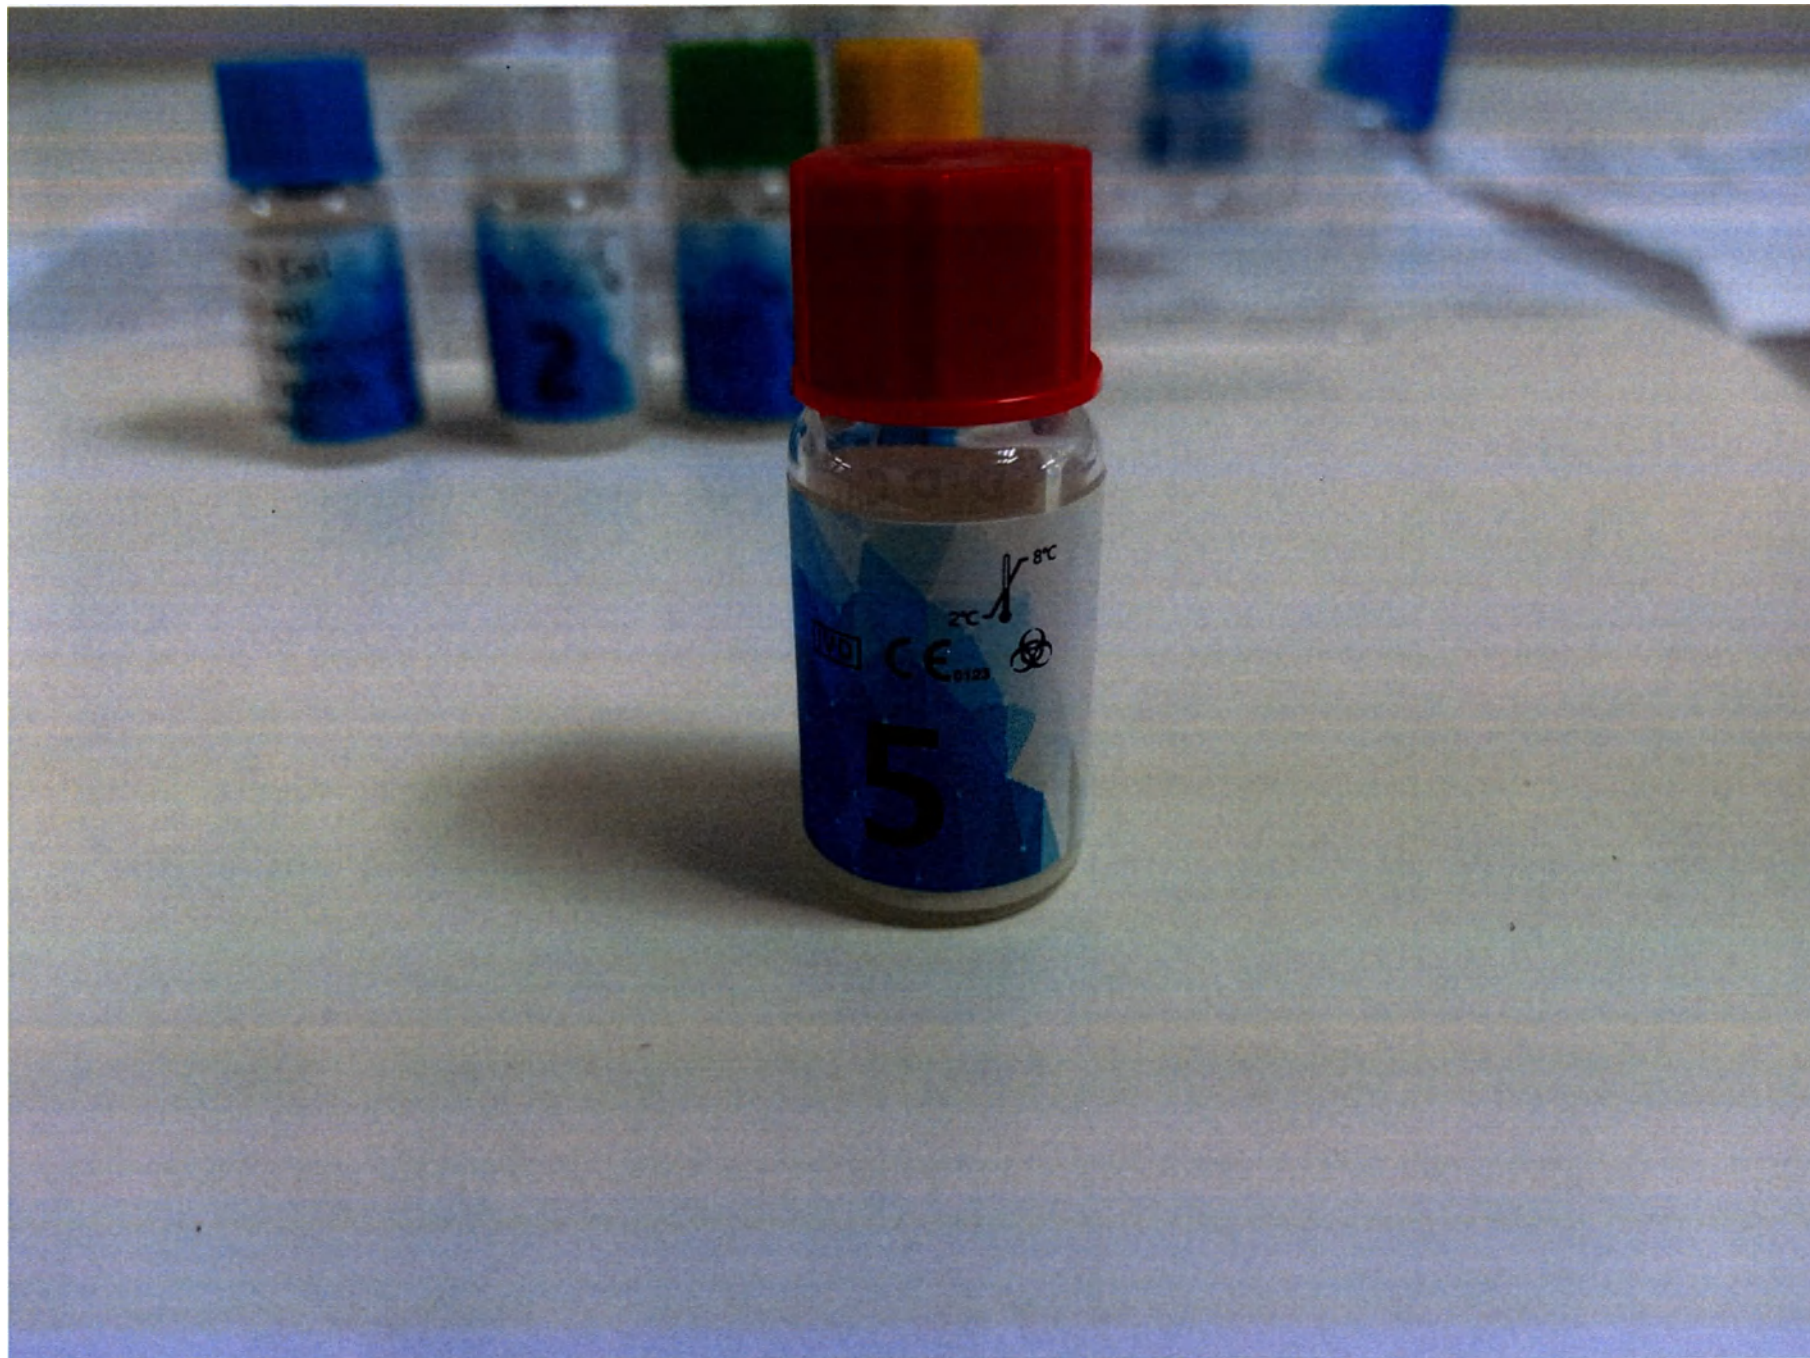


Рисунок 24 Калибратор для определения D-димера (D-D Cal) (уровень 5) (вид 3)



26