



ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сысоев Сюн Вэй.
« » 2023 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСоев Н.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Макет маркировки медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII)
методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии СХ
для диагностики in vitro

Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии СХ для диагностики *in vitro*, вариант исполнения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

*Только для диагностики *in vitro*, для профессионального применения;*

Код партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057, Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель в РФ:

129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел. +7 (499) 553-60-36

информацию на стикере считать приоритетной

Сисоев

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22г
СЫСОЕВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ



ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
« 30 » 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII)
методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии СХ
для диагностики in vitro

AT III

4x50 Tests; AT III calibrator: 1x1.0 mL

Antithrombin III (AT III) Assay Kit (Chromogenic Substrate Method)

Antitrombin III (AT III) Tayin Kiti (Kromojenik Substrat Yöntemi)

Kit per il dosaggio dell'antitrombina III (AT III) (metodo del substrato cromogeno)


Kit de ensaio de antitrombina III (AT III) (método de substrato cromogénico)

Kit de análise de antitrombina III (AT III) (método de sustrato cromogénico)

набор для анализа на антитромбин III (AT III) (хромогенный метод)

Kit de dosage de l'antithrombine III (AT III) (méthode du substrat chromogène)

Assay-Set für Antithrombin III (AT III) (chromogene Substratmethode)



19Q072301011100011



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel.: +86-755-81888998

Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Erfestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

047-042394-00(1.0)

mindray

Рисунок 1 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 1)



Рисунок 2 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro (вид 2)



Рисунок 3 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 3)

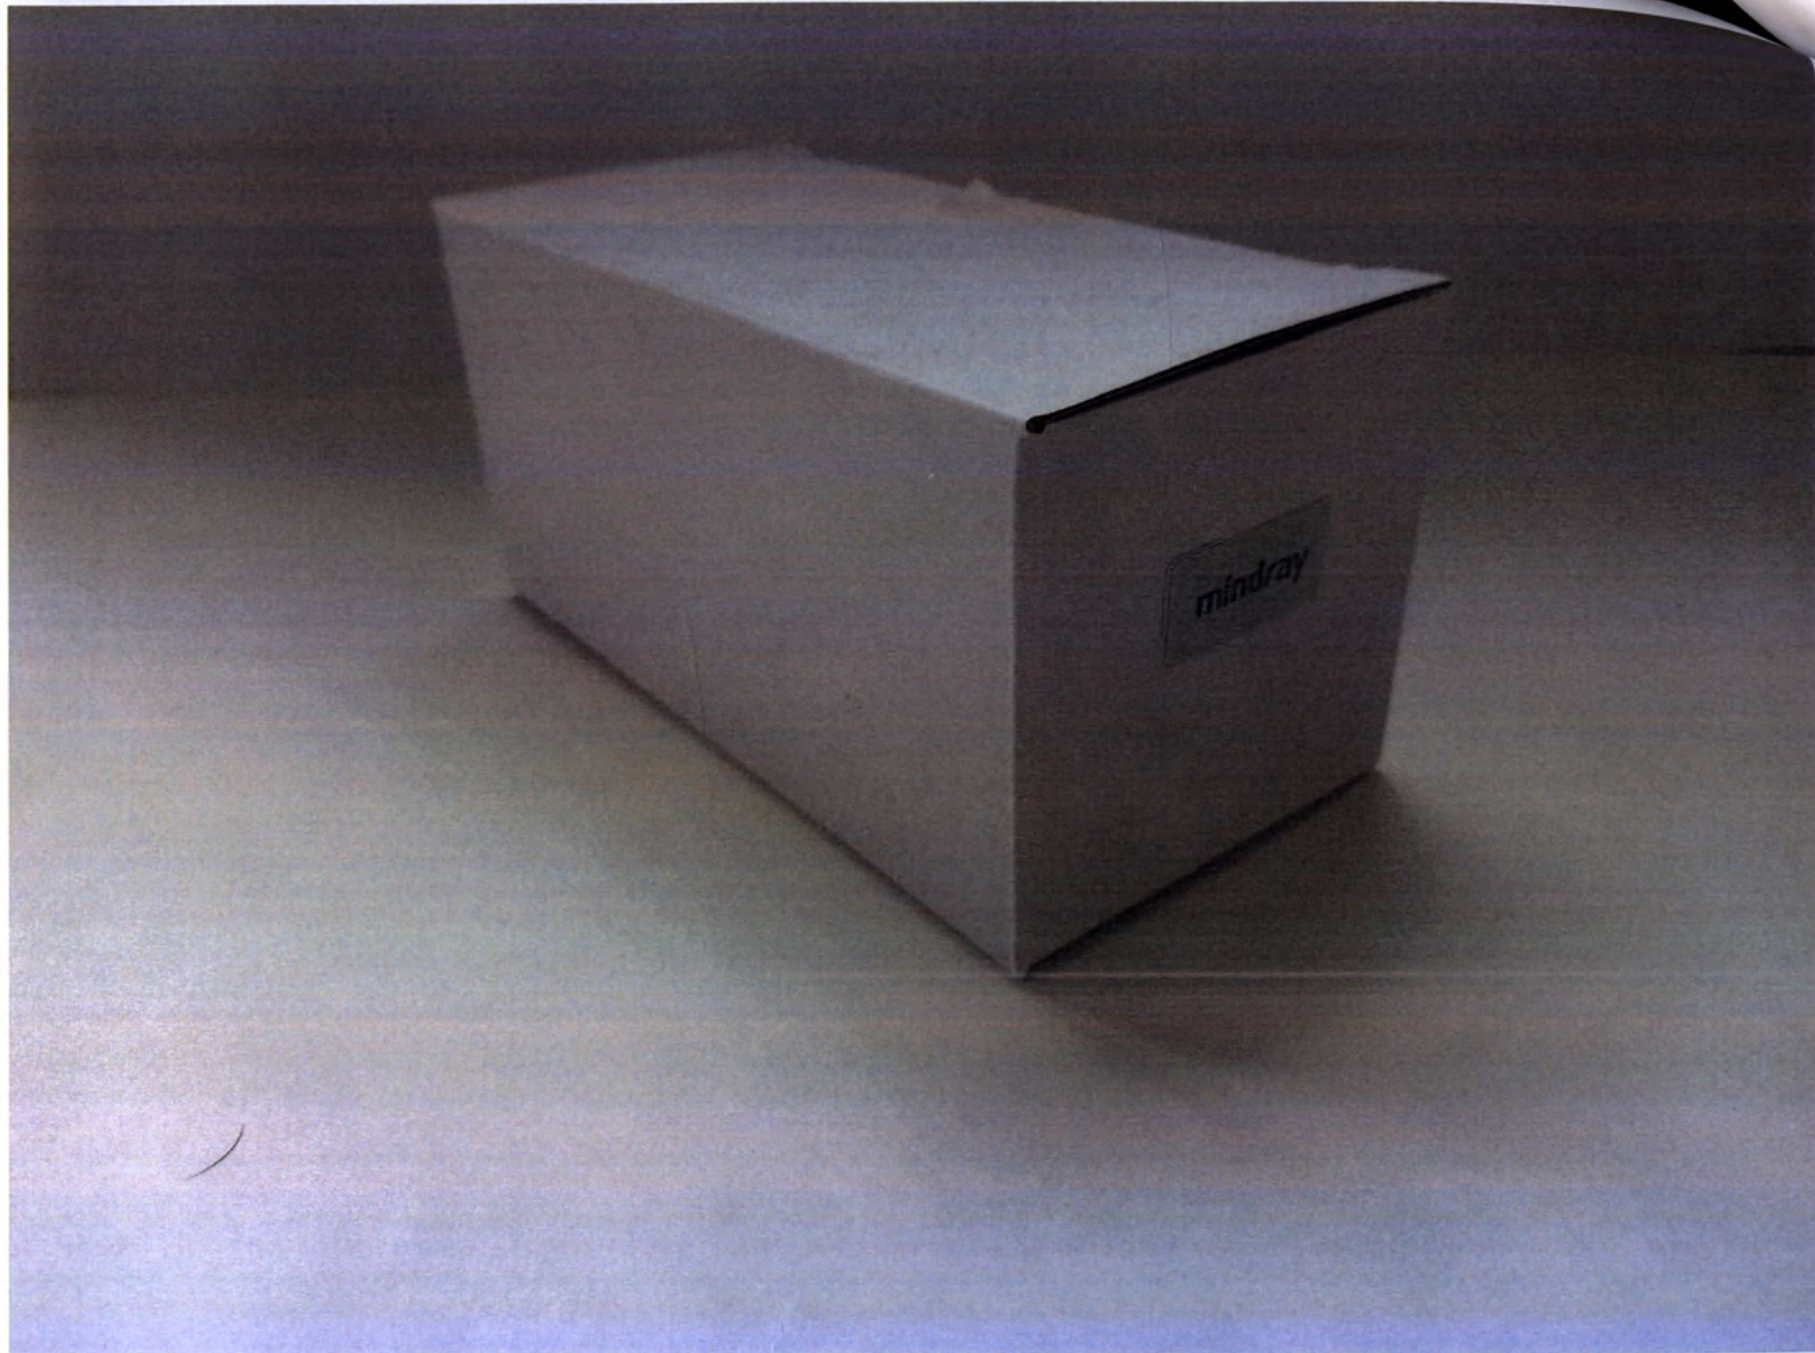


Рисунок 4 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 4)



Рисунок 5 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro (вид 5)

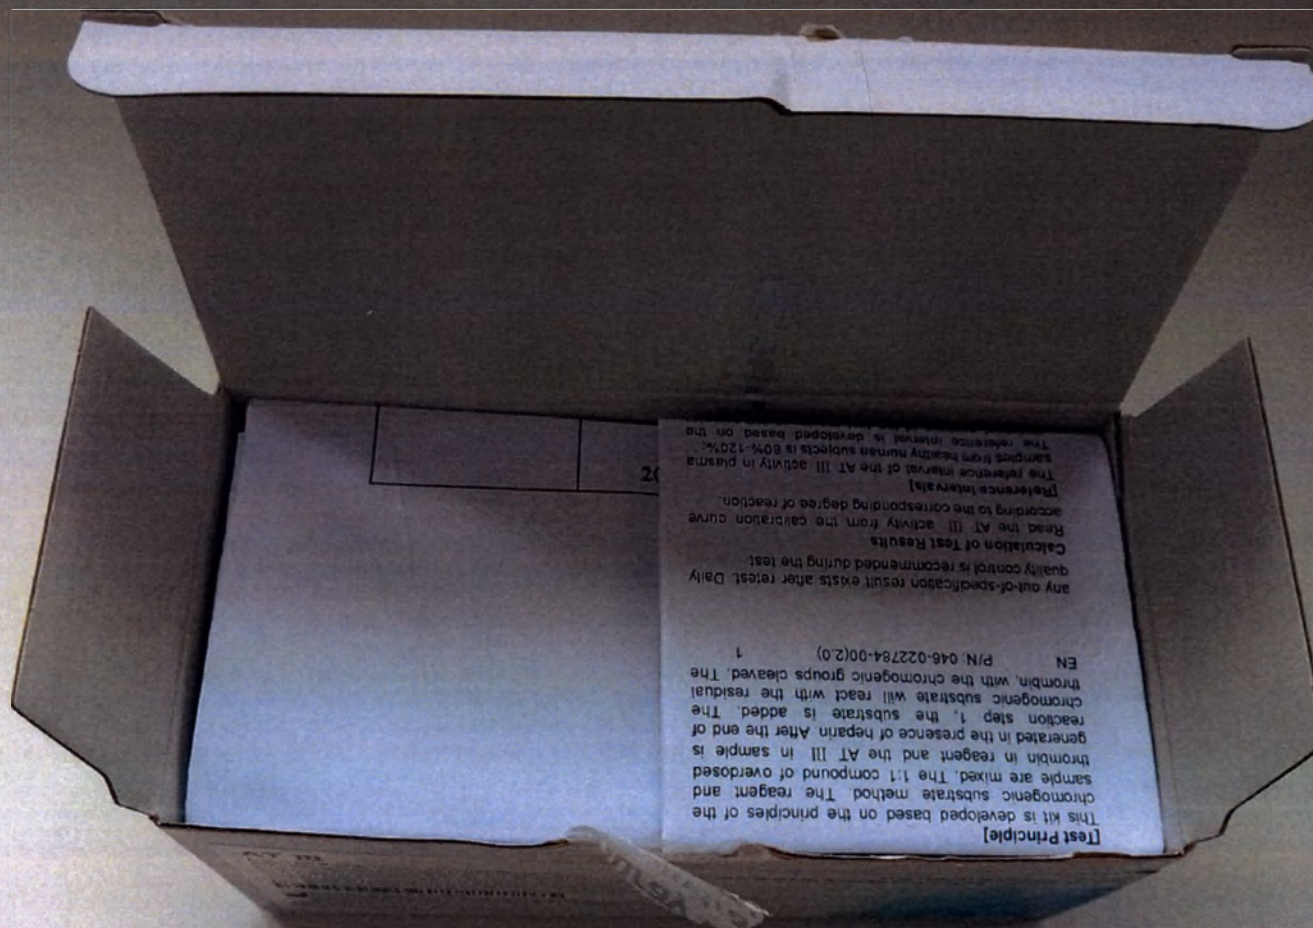


Рисунок 6 Вскрытая упаковка Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека

на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 1)

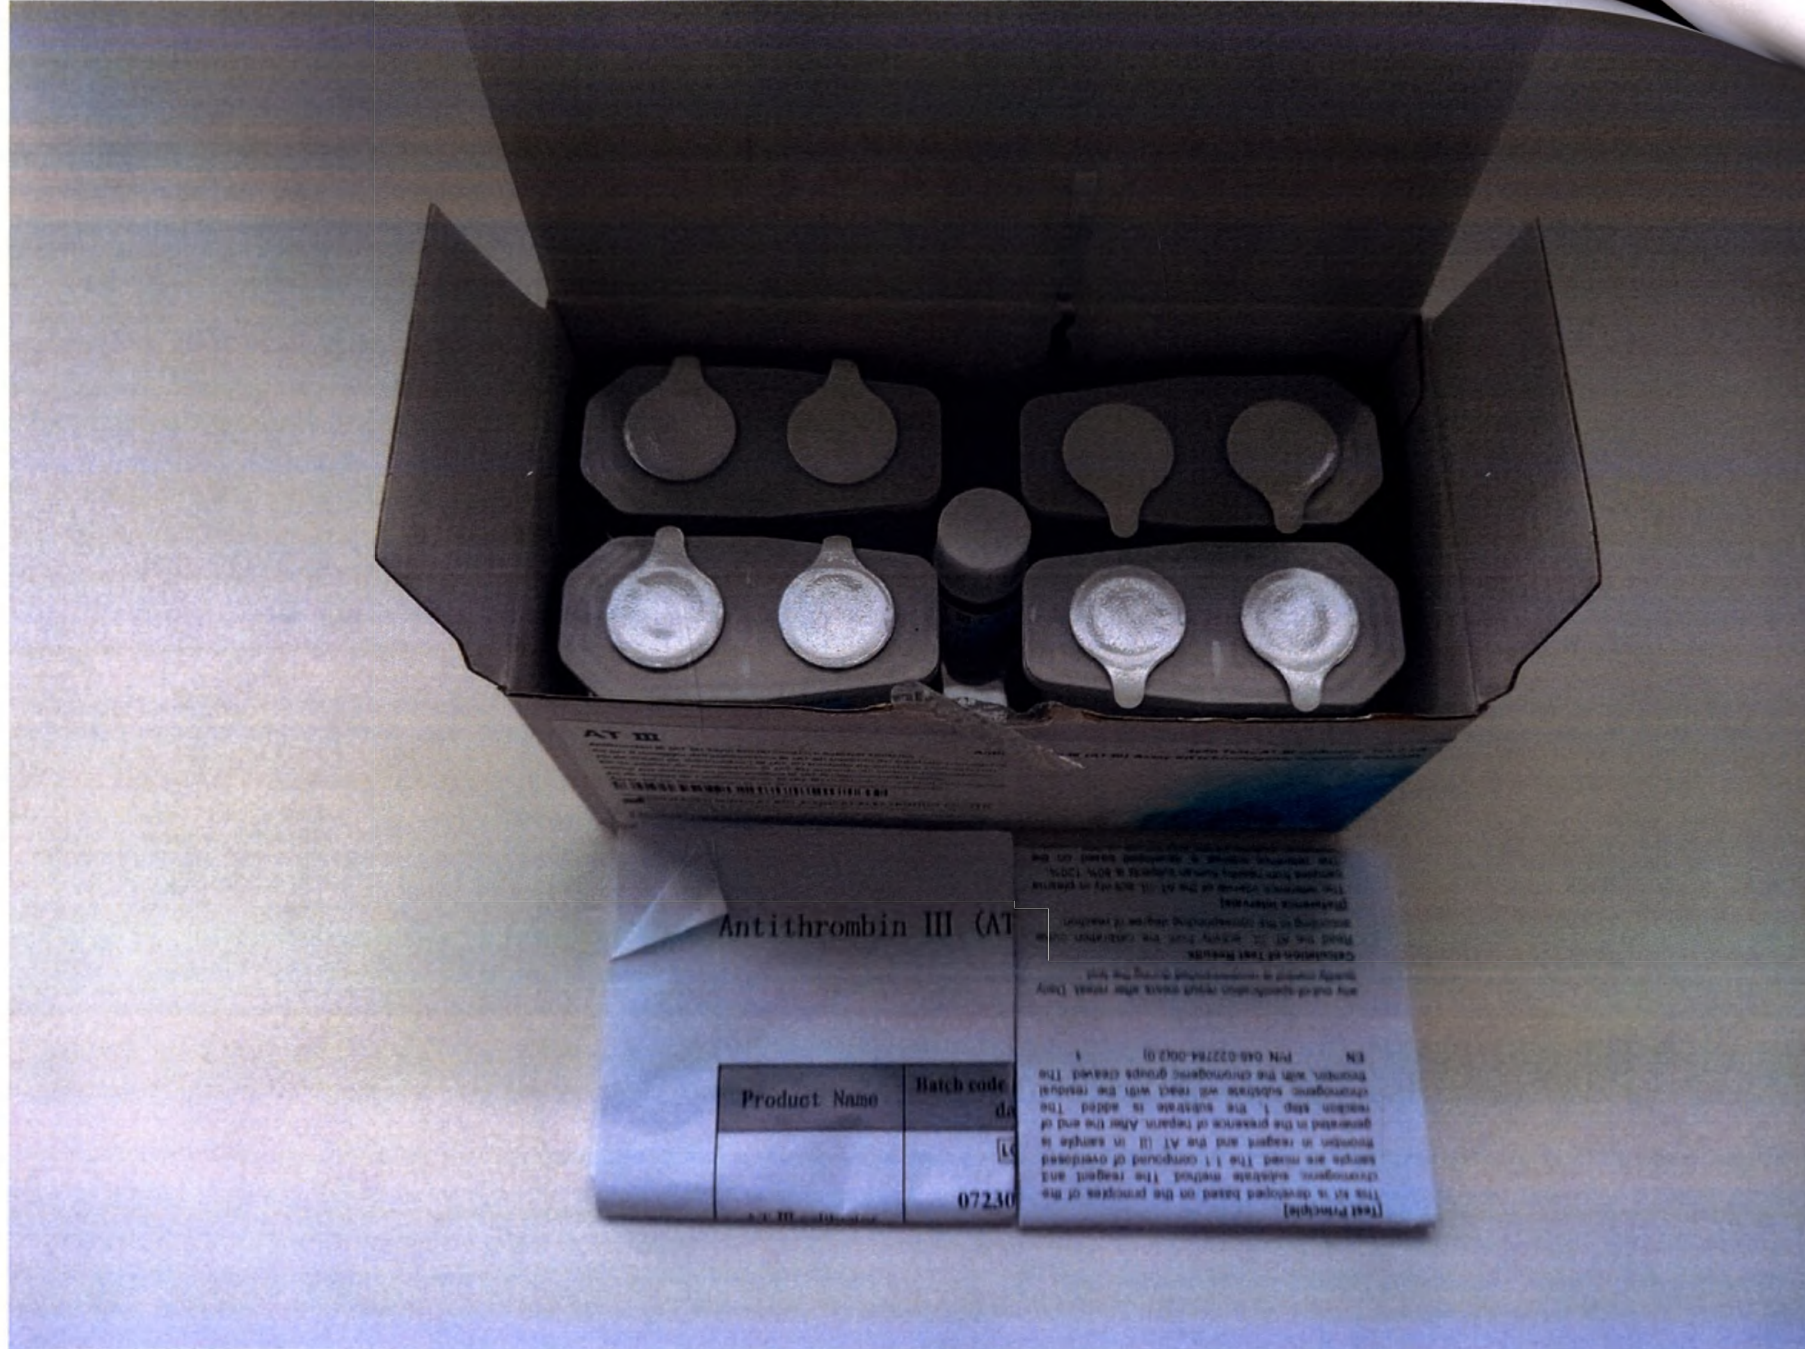


Рисунок 7 Вскрытая упаковка Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 2)

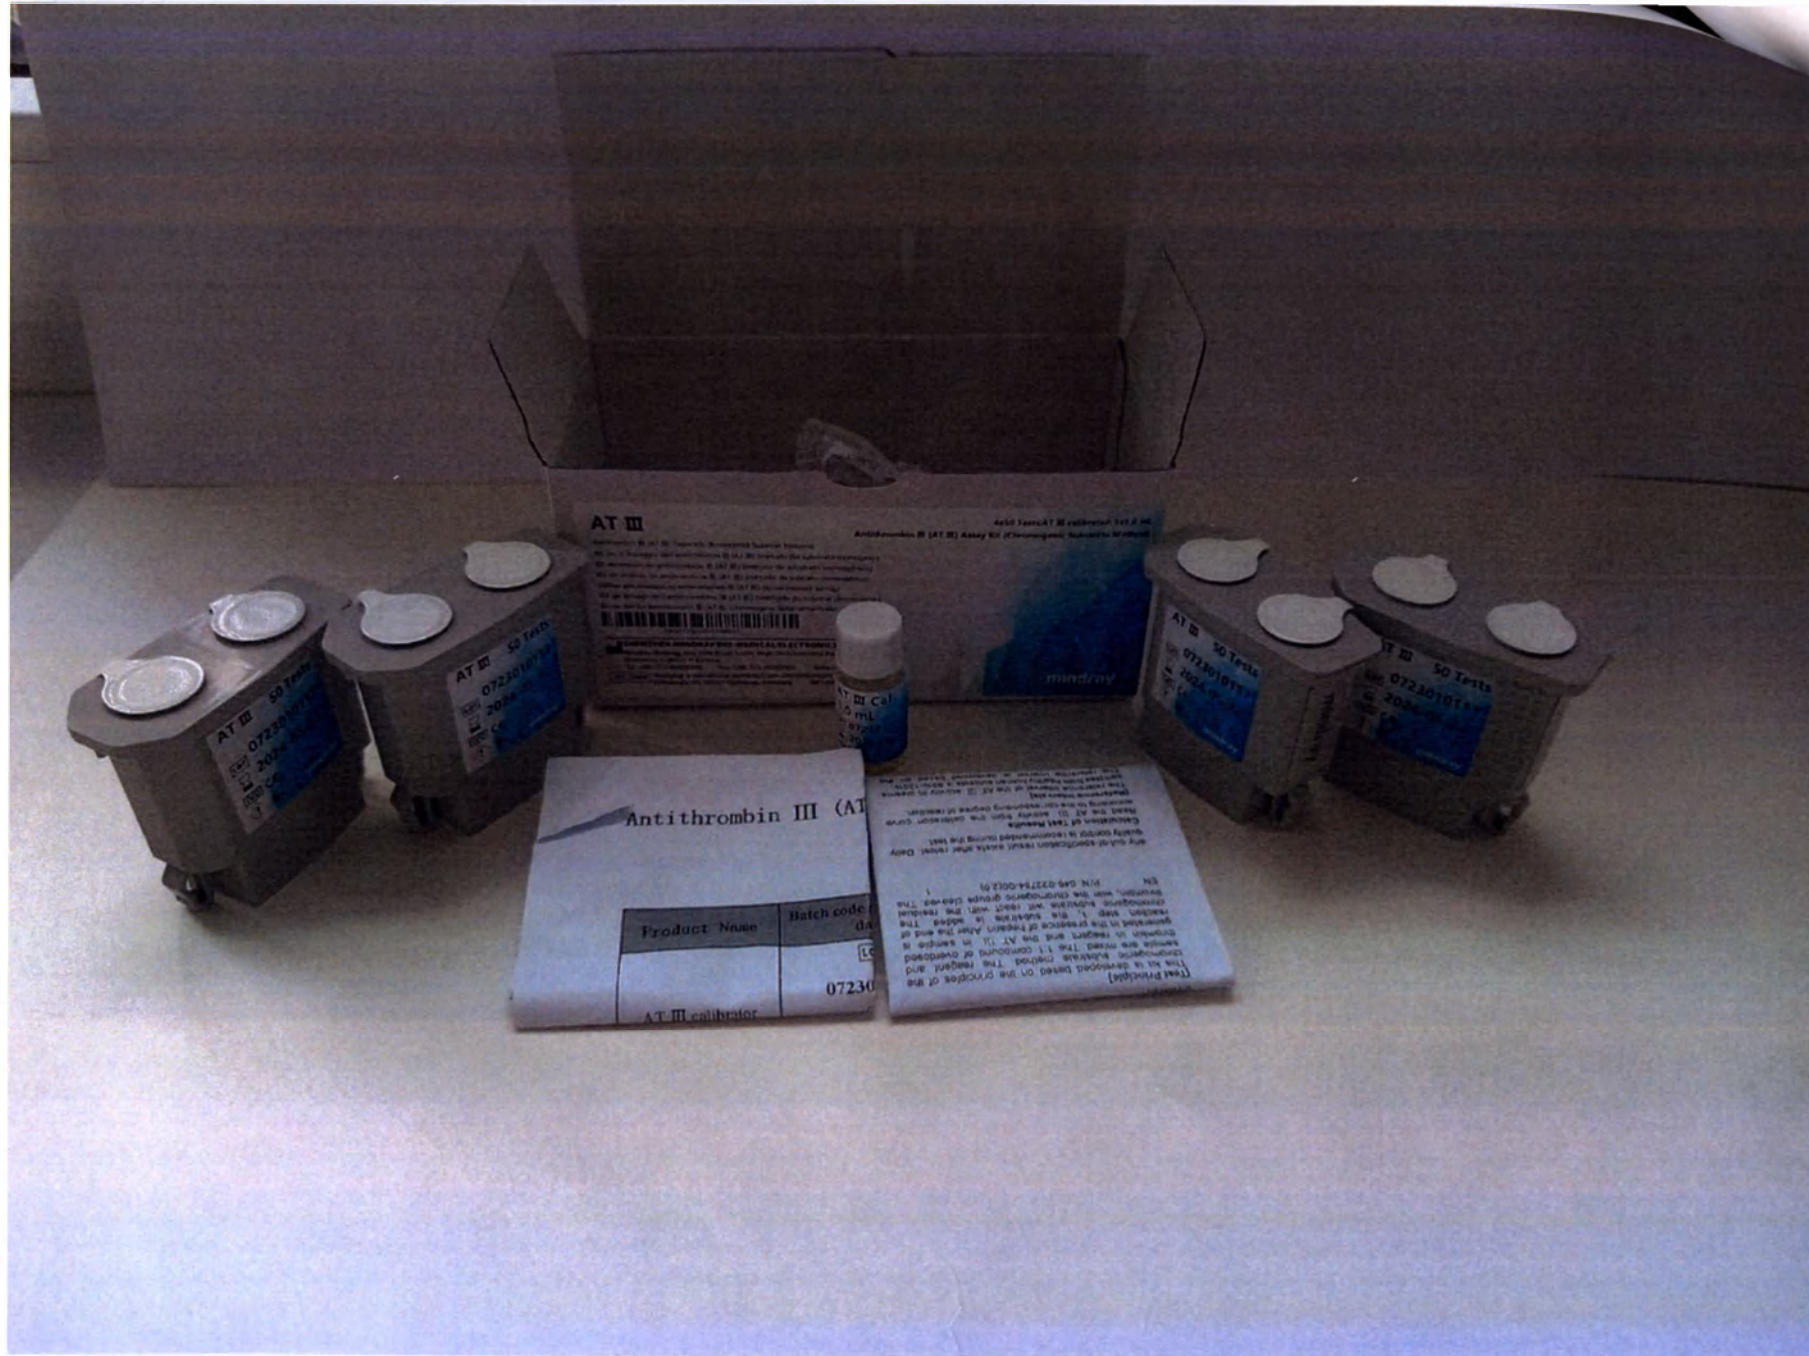


Рисунок 8 Общий вид Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (АТIII) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro



Рисунок 9 Внешний вид Кассета с реагентом для определения антитромбина III (АТIII) на 50 тестов (вид 1)



Рисунок 10 Внешний вид Кассета с реагентом для определения антитромбина III (АТIII) на 50 тестов (вид 2)

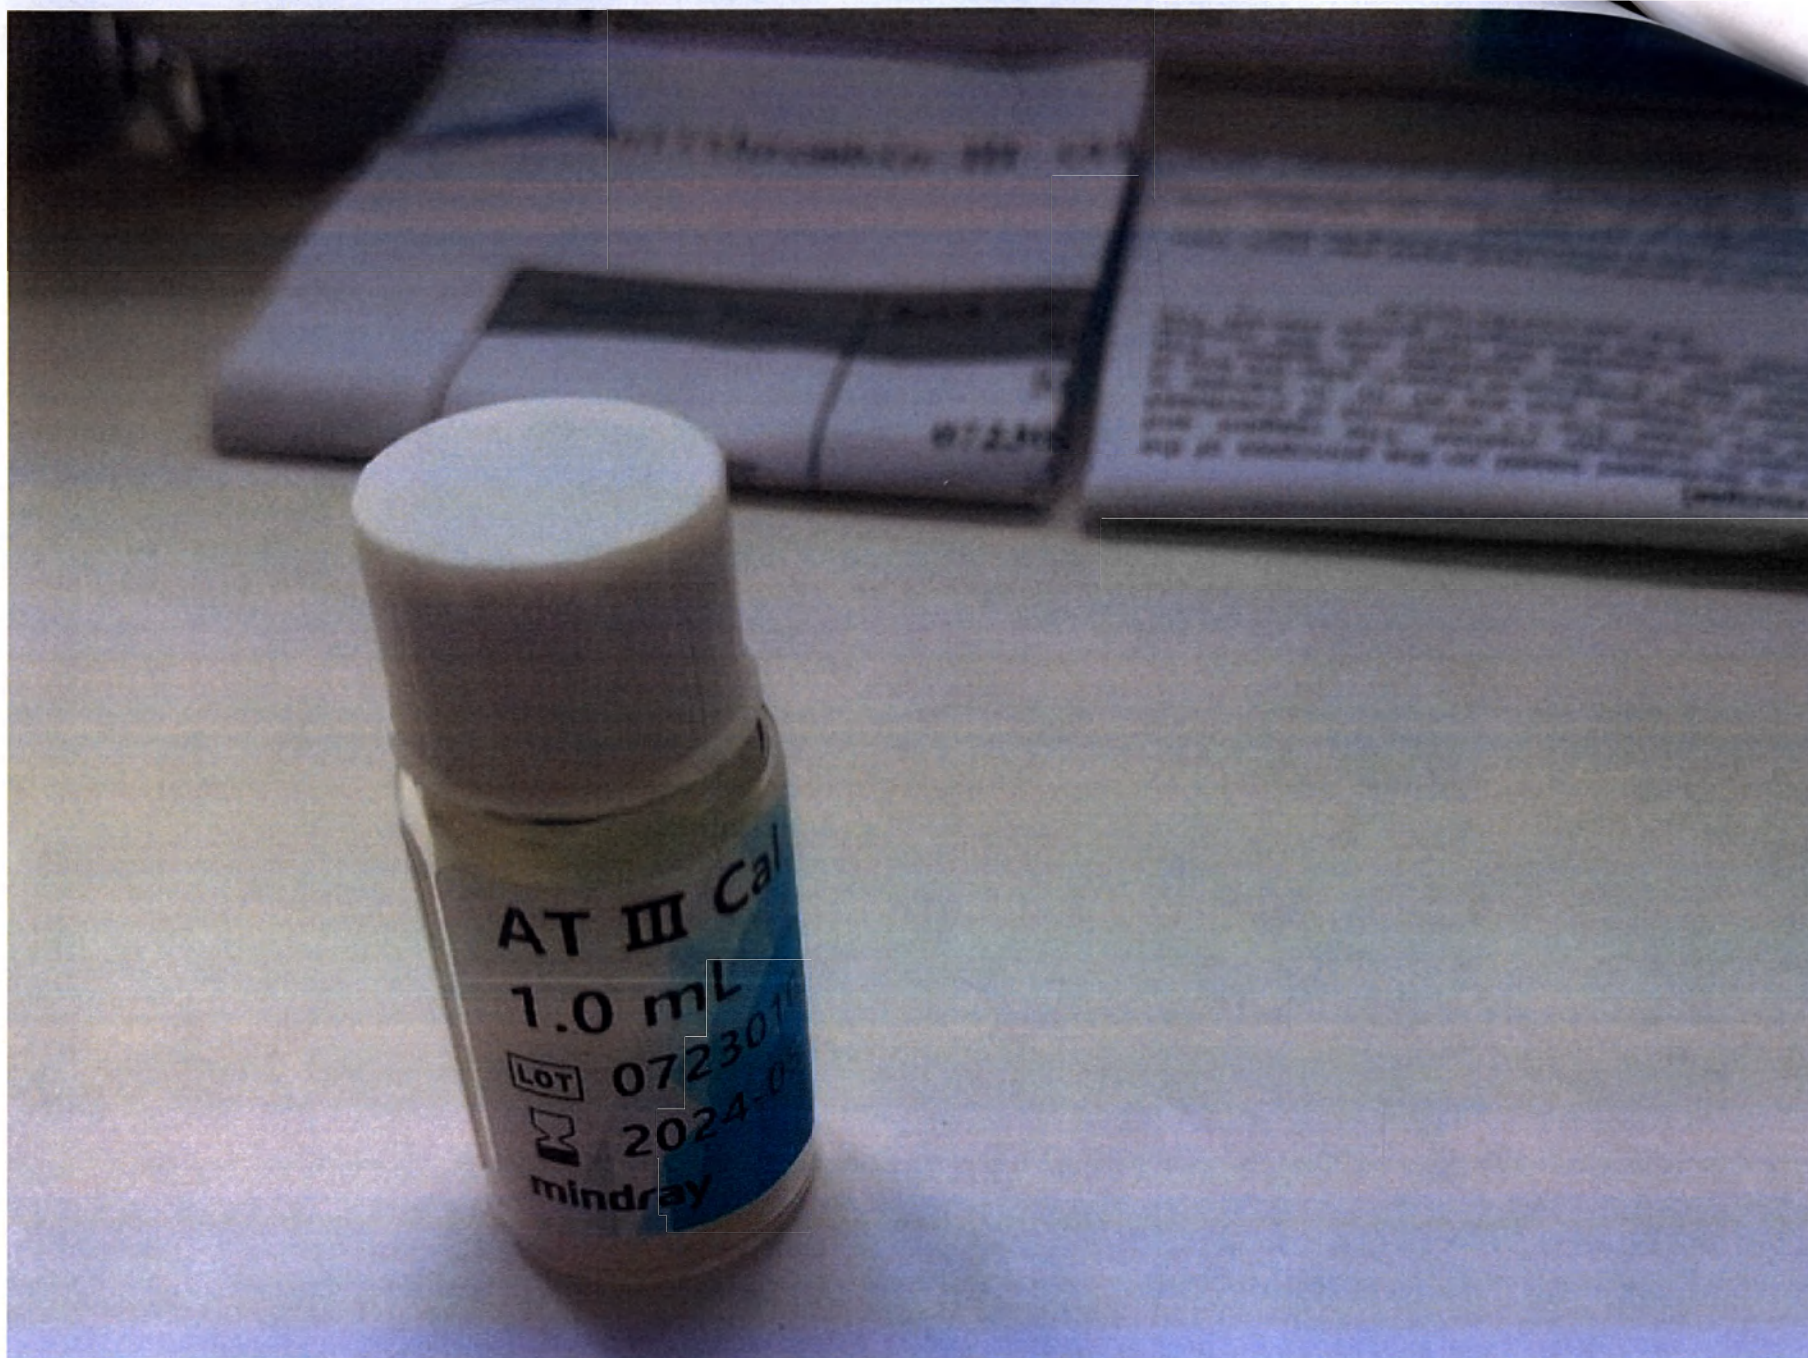


Рисунок 11 Калибратор АТIII – 1 шт x 1,0 мл (вид 1)

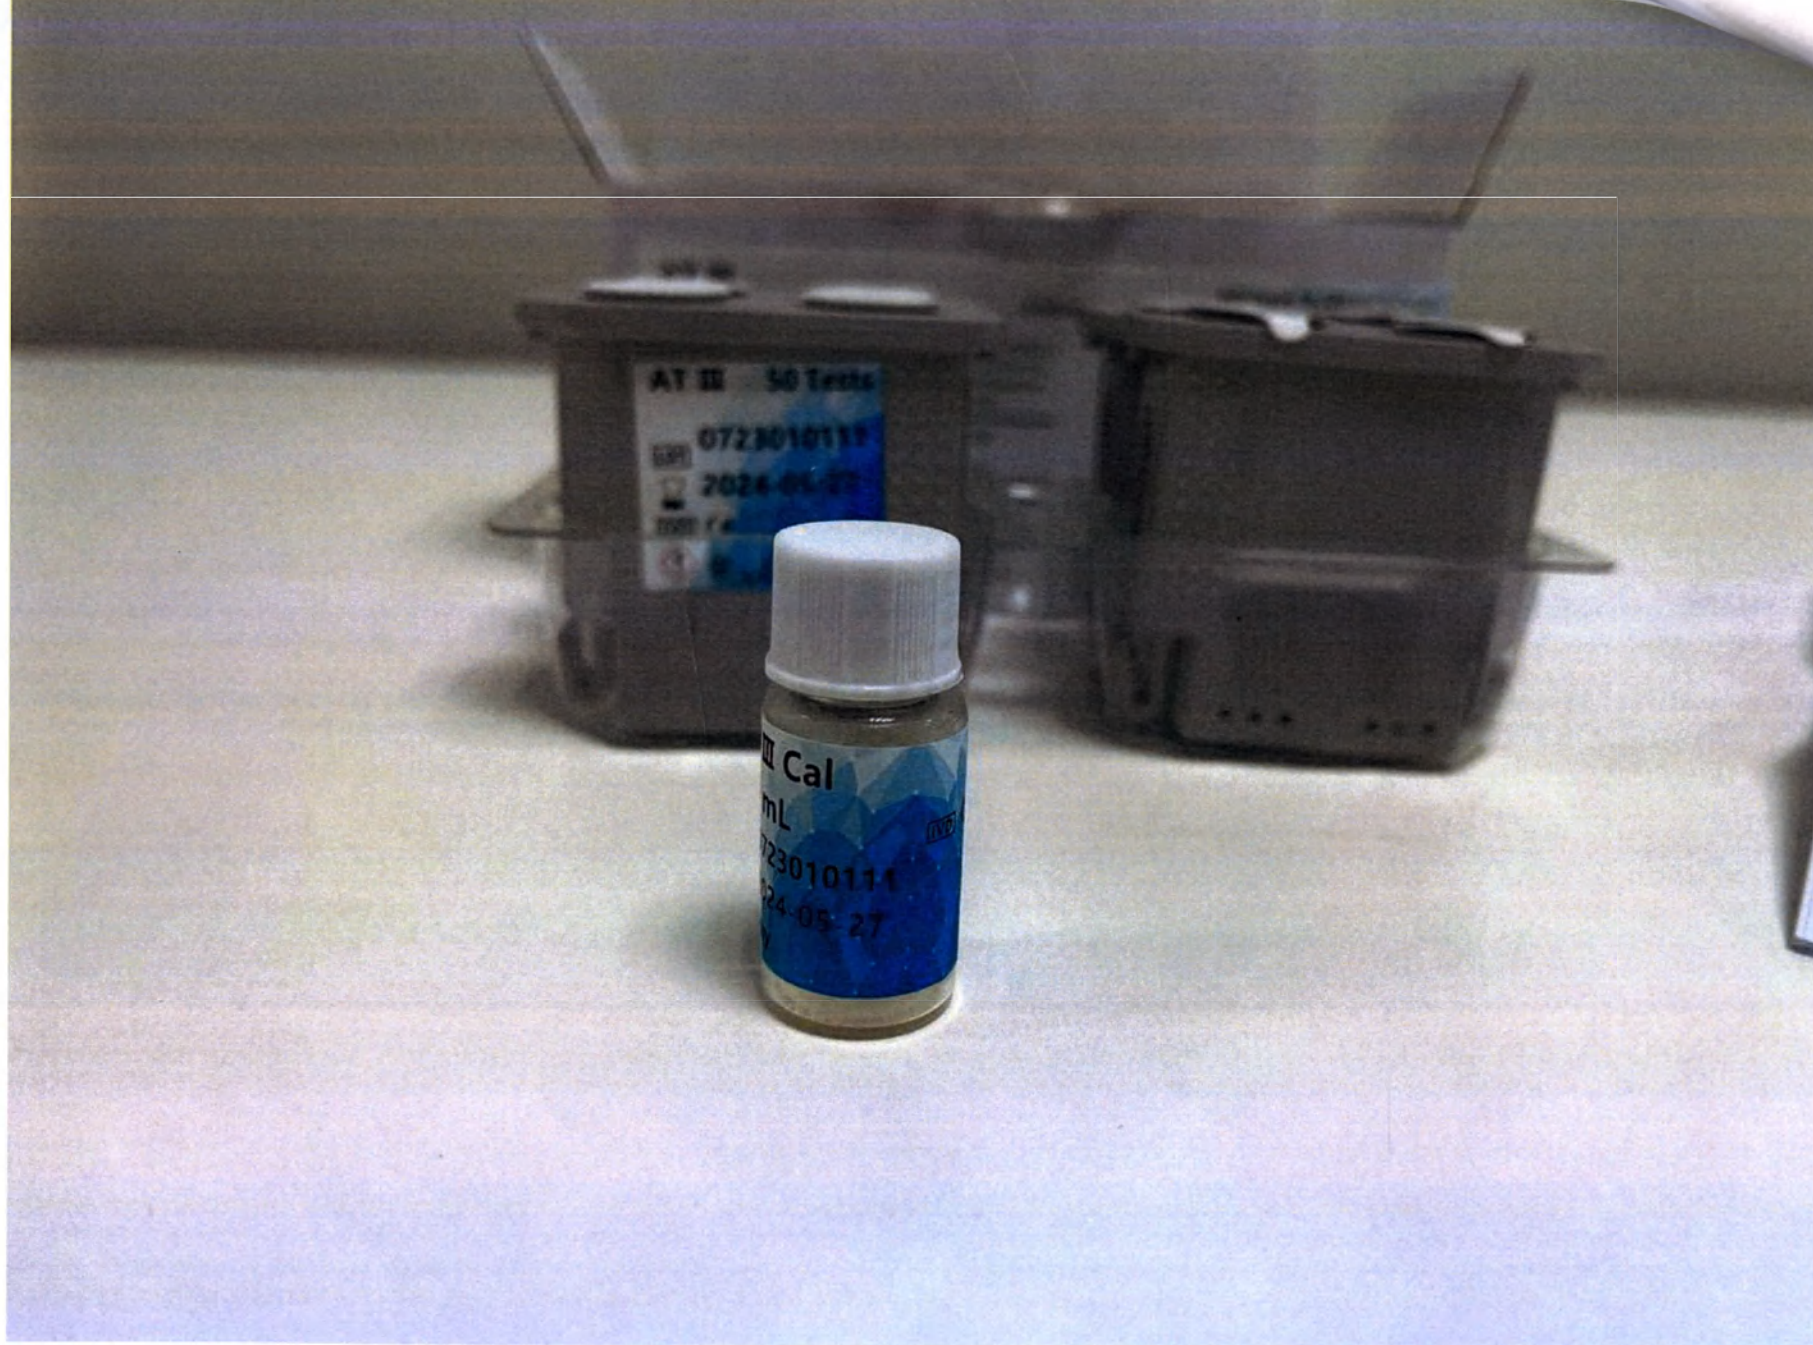


Рисунок 12 Калибратор АТIII – 1 шт x 1,0 мл (вид 2)

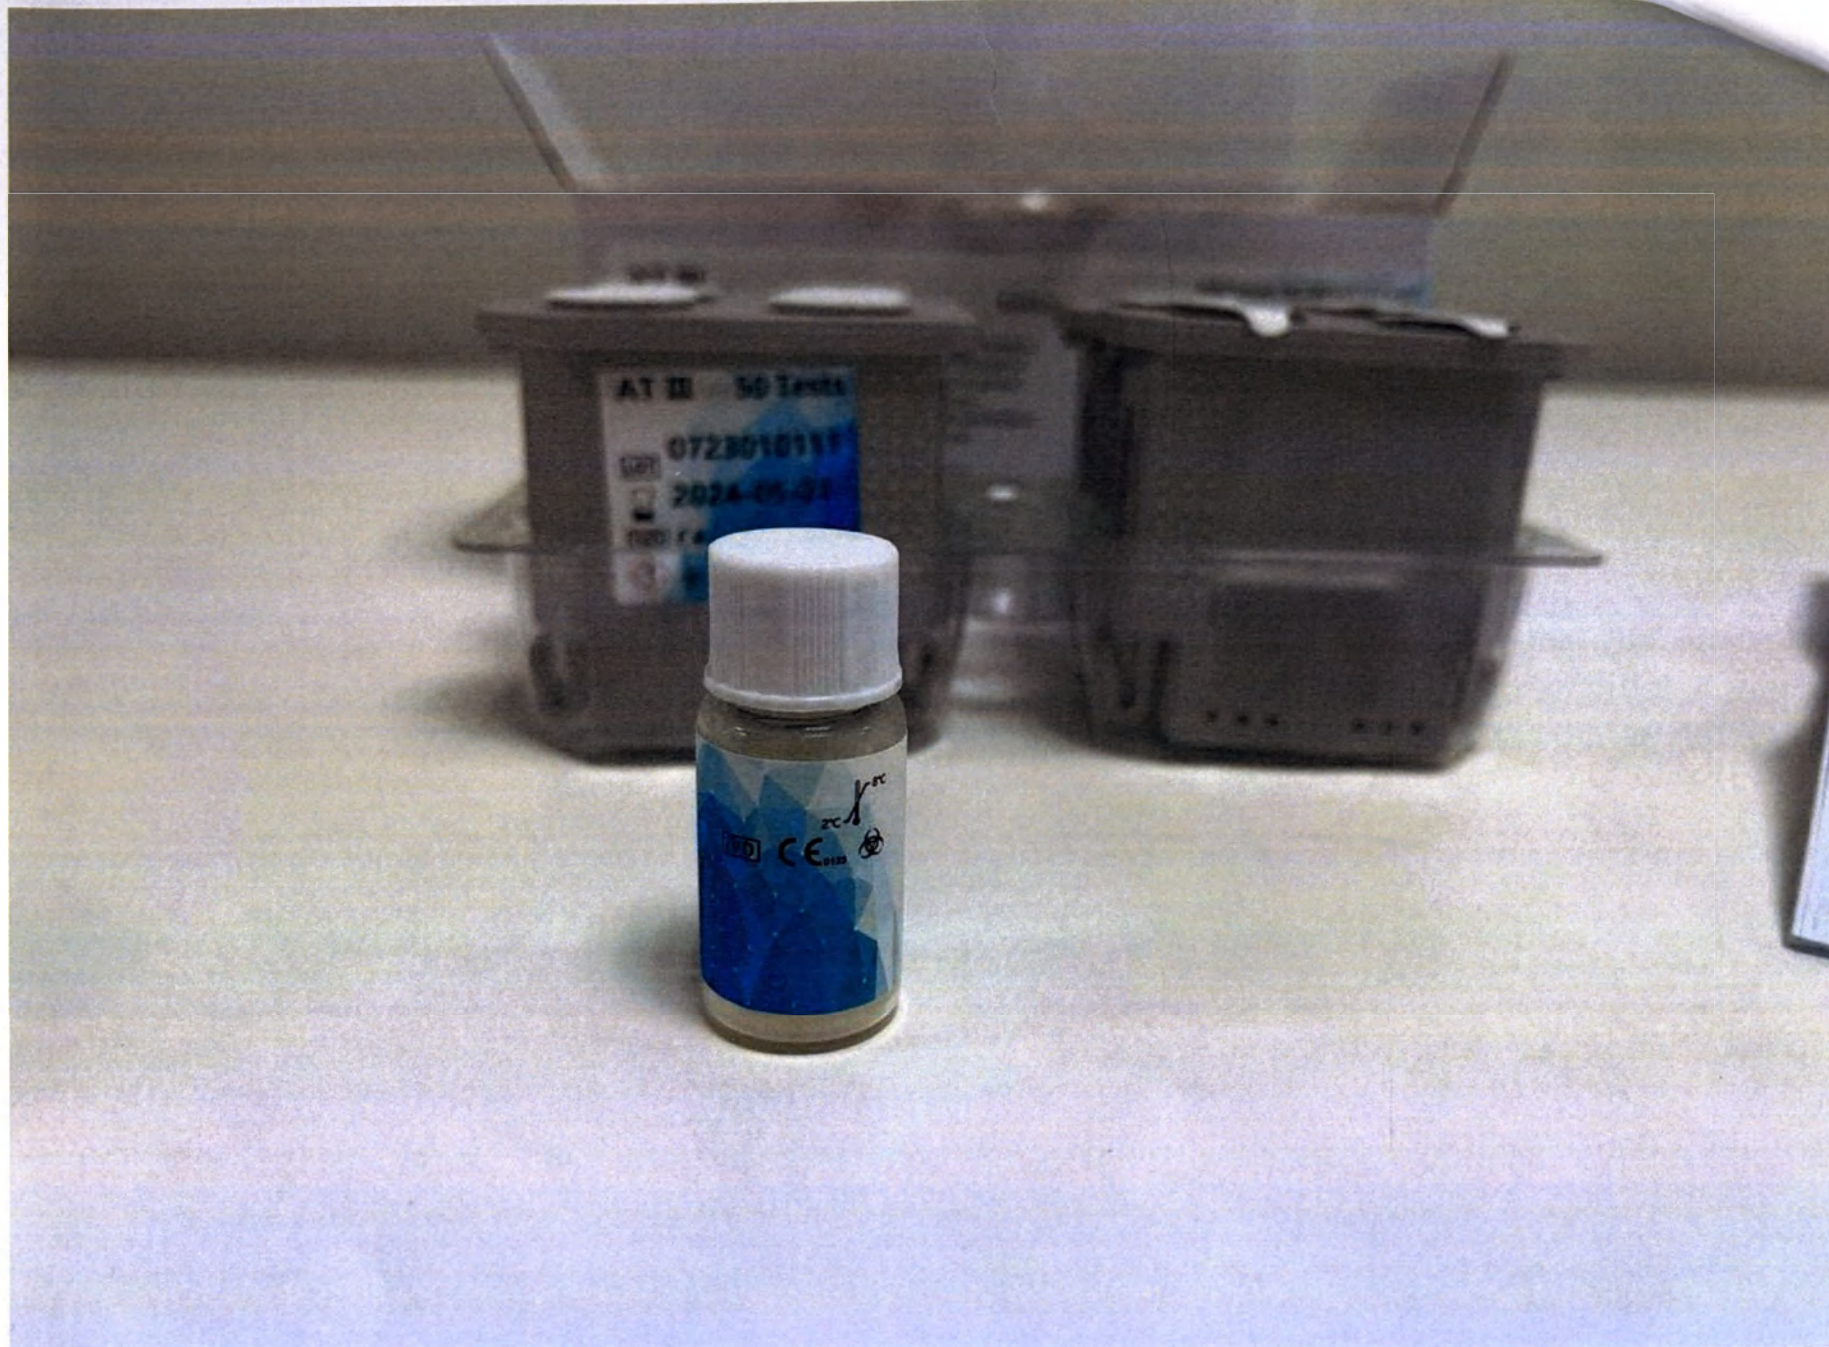


Рисунок 13 Калибратор АТIII – 1 шт x 1,0 мл (вид 3)

