

Фотографические изображения

**Набор калибраторов для количественного определения миокардиального
изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e
(CalSet CK-MB cobas e analyzers)**

Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (CKMB Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (CKMB Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон пустой – 4 шт.;
4. Этикетка для флакона – 12 шт.;
5. Инструкция по применению.



Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (KK-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers)

CalSet CK-MB

cobas e analyzers

REF 07394667190

CONTENT

Cal1 → 2 x 1.0 mL

Cal2 → 2 x 1.0 mL

COBAS, COBAS E
are trademarks of Roche.



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

06444856301(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

03

IVD

CE

0123

 2-8 °C



 dialog.roche.com



cobas[®]

Набор калибраторов для количественного определения миокардиального
изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e
(CalSet CK-MB cobas e analyzers)

CalSet CK-MB

For USA:

CONTENT

Cal1 CK-MB (human) in a human serum matrix
Cal2 CK-MB (human) in a human serum matrix

Rx only

REF

LOT



GTIN

(240)07394667190

(10)70338801

2024-06-30

2023-01-24

(01)04015630939534

UDI

Roche

04



Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers)

Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (СКМВ Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (СКМВ Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон пустой – 4 шт.;
4. Этикетка для флакона – 12 шт.;
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail:

moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 07394667190

Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы МВ (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (CKMB Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

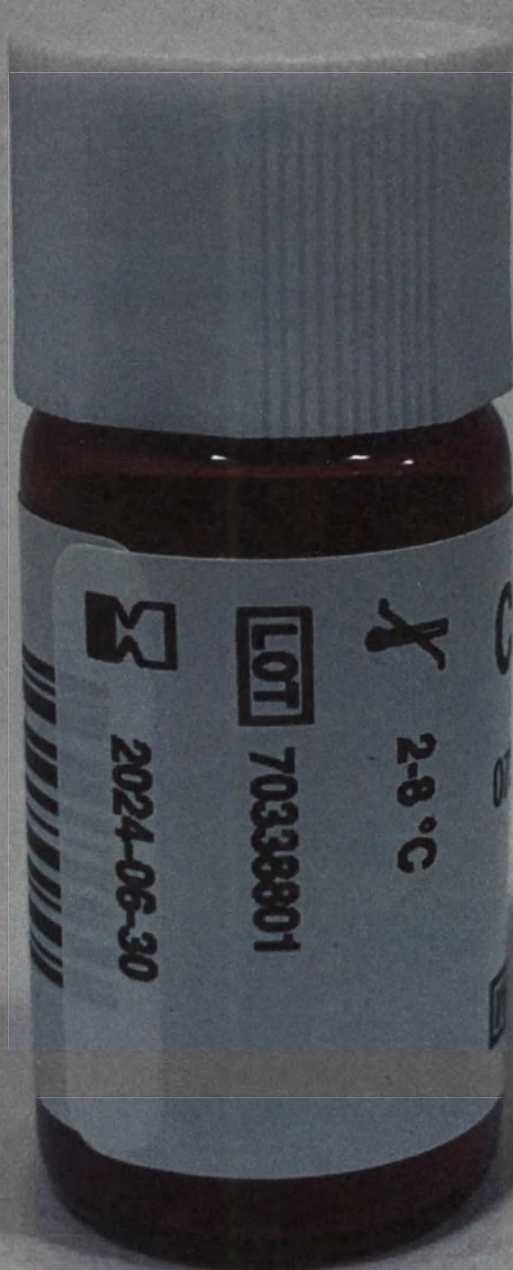


Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы МВ (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:


1. Калибратор 1 (СКМВ Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы МВ (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (СКМВ Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

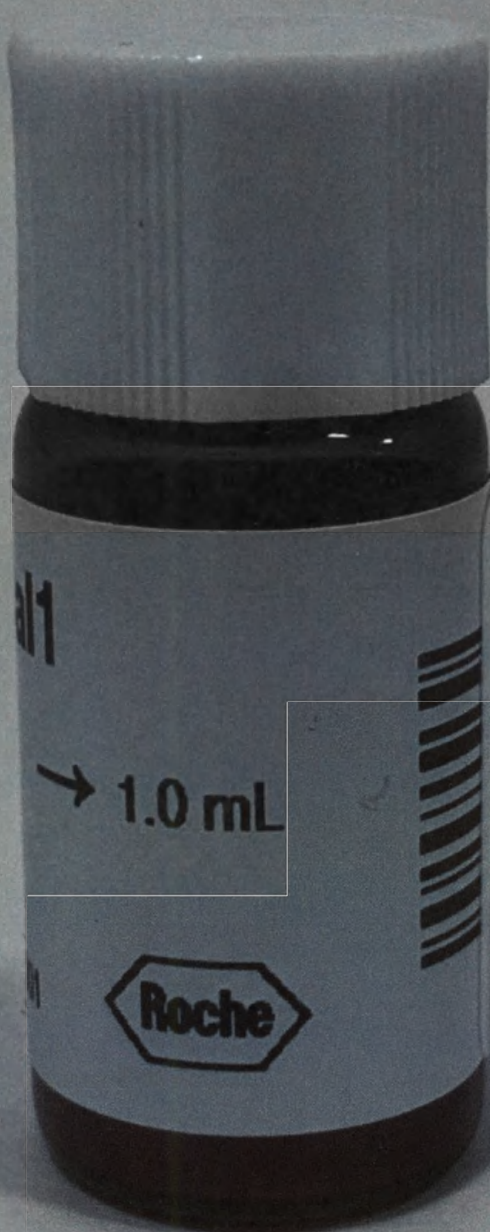

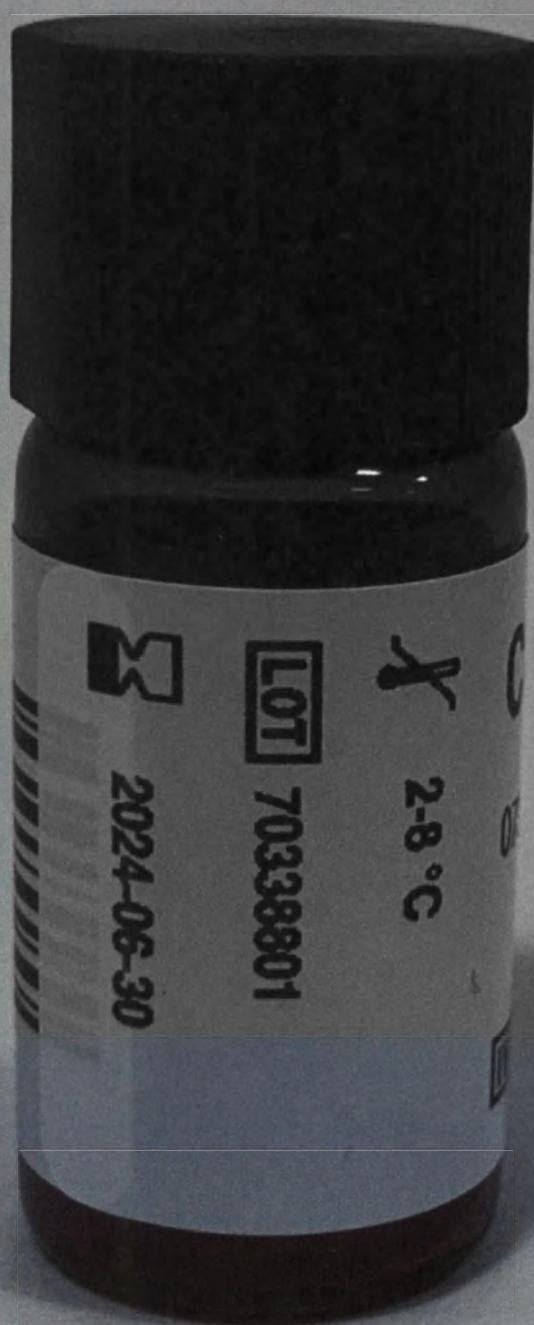

Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

2. Калибратор 2 (СКМВ Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;


Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы МВ (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

2. Калибратор 2 (СКМВ Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы МВ (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

2. Калибратор 2 (СКМВ Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

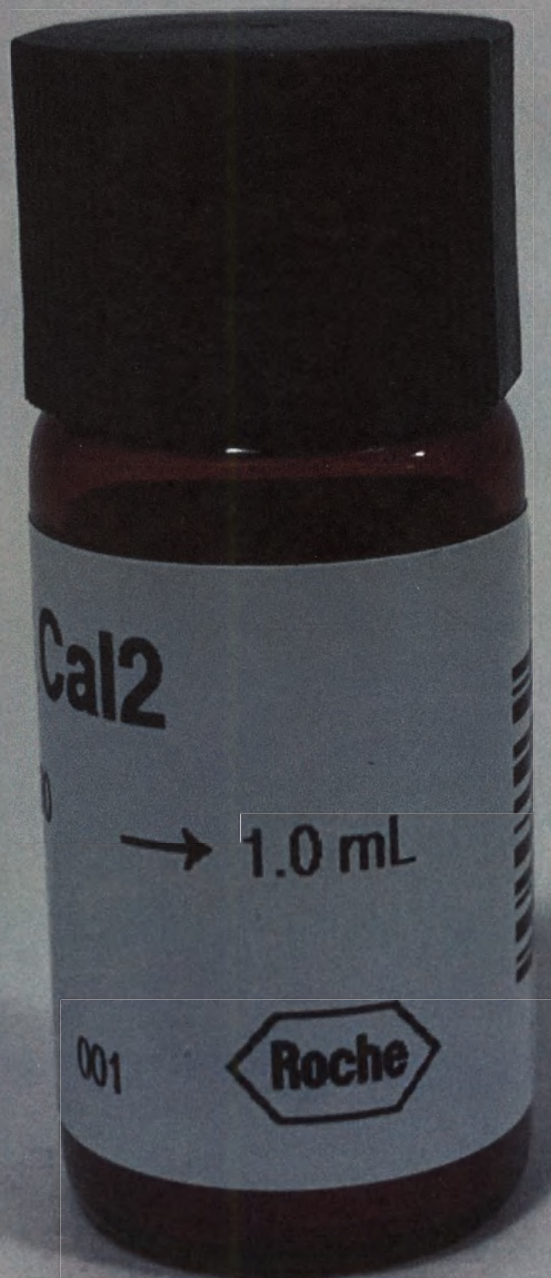


Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы МВ (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

3. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения миокардального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

3. Флакон пустой – 4 шт.;

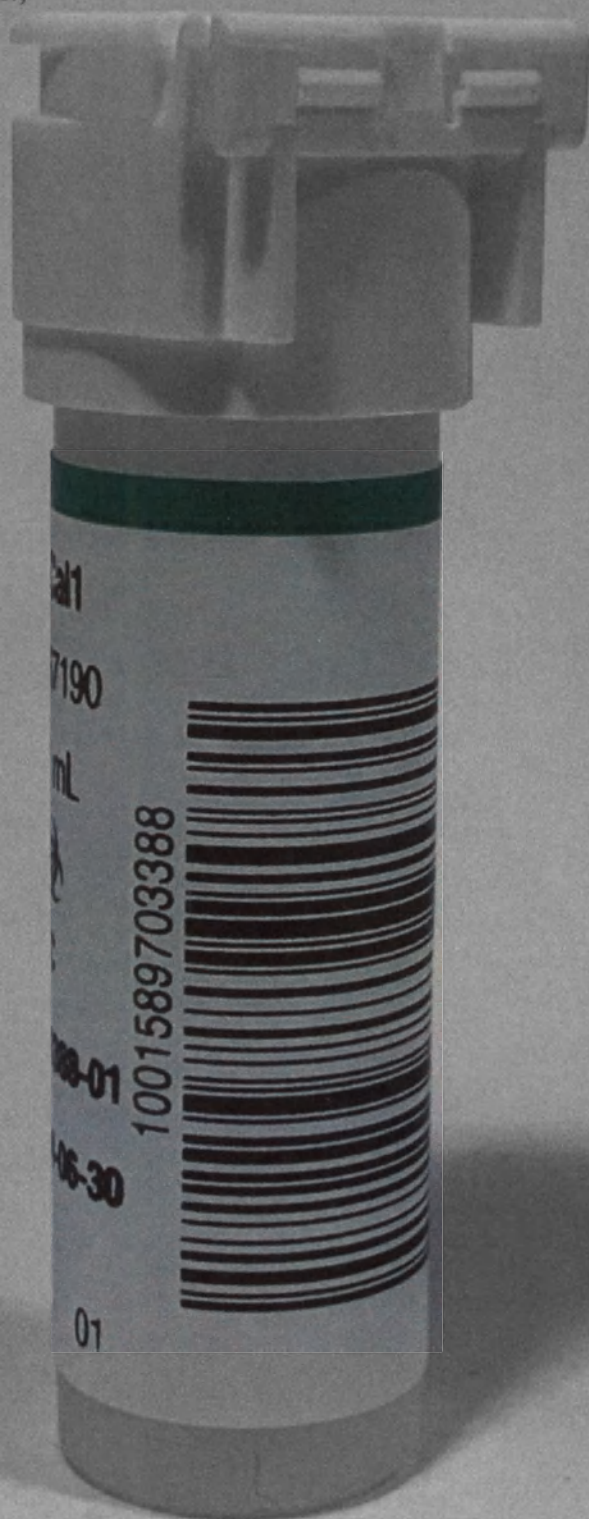




Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

3. Флакон пустой – 4 шт.;


Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

3. Флакон пустой – 4 шт.;

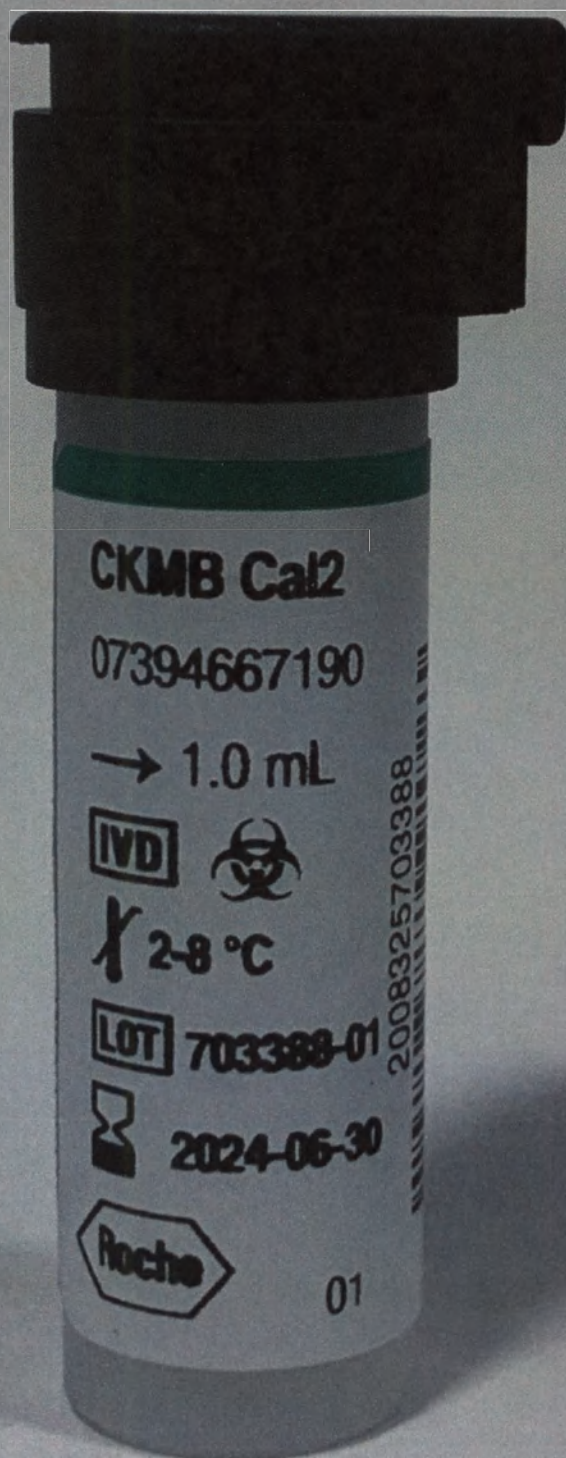


Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

3. Флакон пустой – 4 шт.;

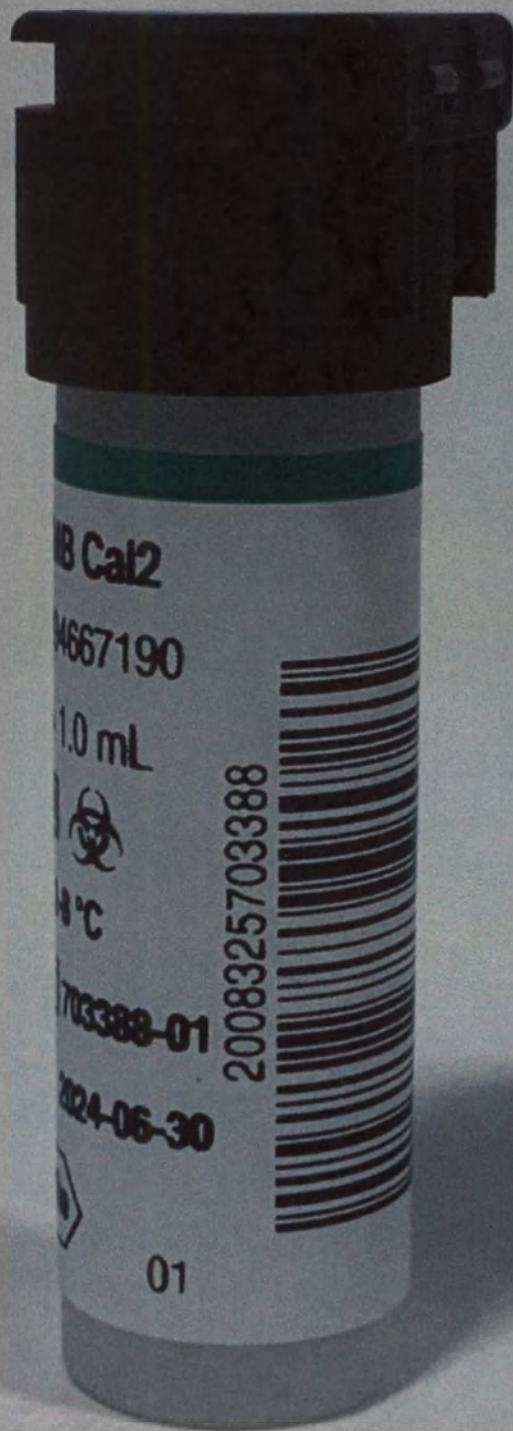

Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы МВ (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

3. Флакон пустой – 4 шт.;

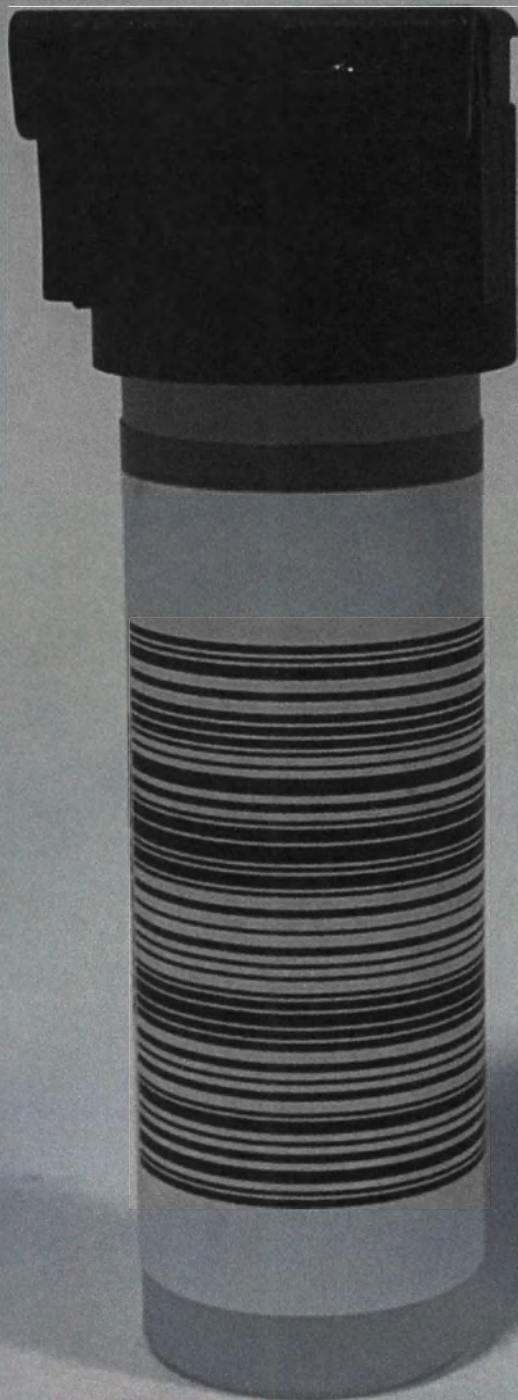



Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet CK-MB cobas e analyzers), в составе:

4. Этикетка для флакона – 12 шт.;

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
18 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.