

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «БиоХимМак»



____ Н.Е. Тамм

____ 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор контролей С-реактивного белка в сыворотке крови человека
Afinion CRP Control»

Производства
Abbott Diagnostics Technologies AS (Эбботт Диагностикс Текнолоджис АС)

Фото 1. Набор контролей С-реактивного белка в сыворотке крови человека Afinion CRP Control. Вторичная упаковка (картонная коробка), маркировка.

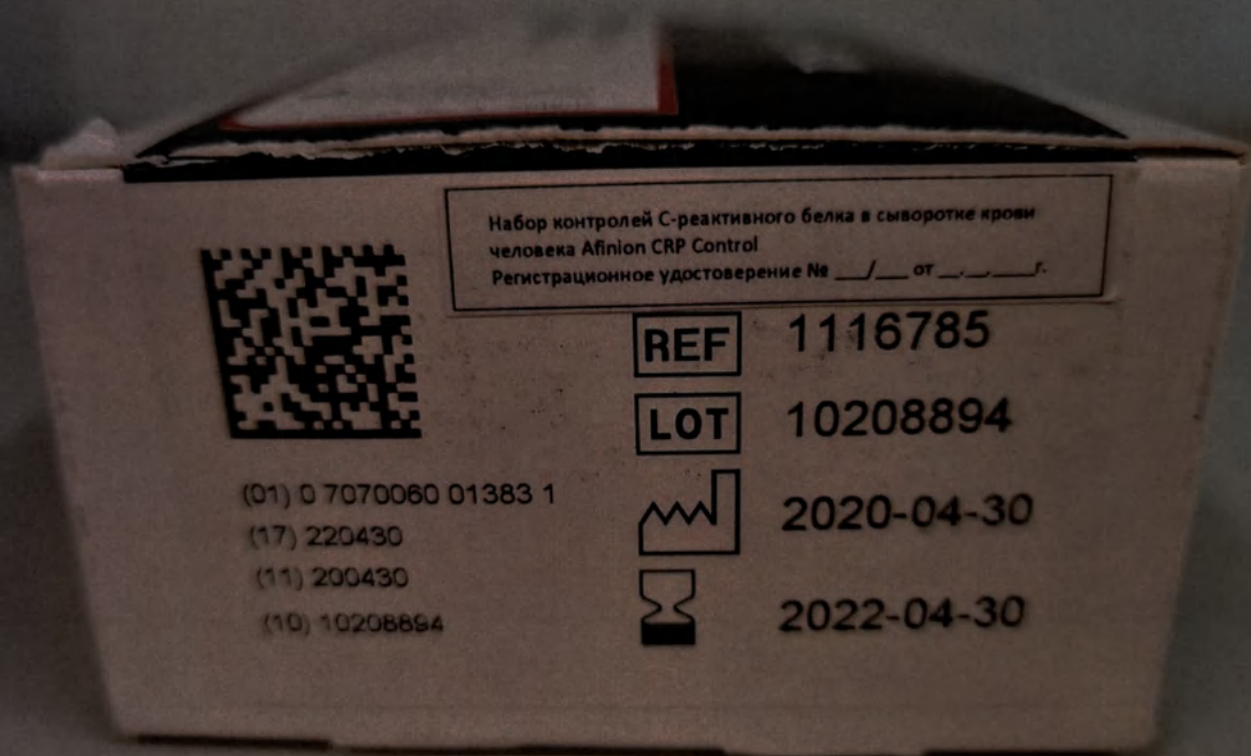
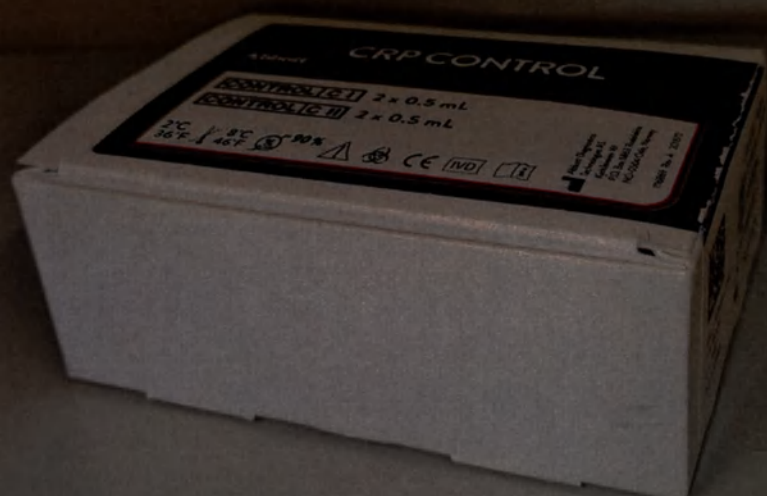


Фото 2. Набор контролей С-реактивного белка в сыворотке крови человека Afinion CRP Control. Состав набора.



Фото 3. Набор контролей С-реактивного белка в сыворотке крови человека Afinion CRP Control. Первичная упаковка (флаконы).




Фото 4. Набор контролей С-реактивного белка в сыворотке крови человека Afinion CRP Control. Макет маркировки вторичной упаковки (картонная коробка).



Фото 5. Afinion CRP Control. Контроль С I. Макет маркировки.



Фото 6. Afinion CRP Control. Контроль С II. Макет маркировки.

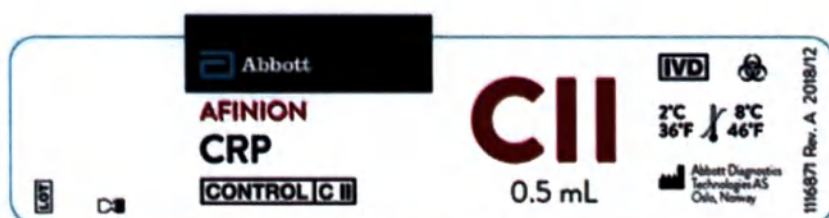



Abbott

Набор контролей С-реактивного белка в сыворотке крови человека

AFINION CRP CONTROL

Инструкция по применению

REF 1116785

LOT 10206765



CONTROL I

CONTROL II

Afinion CRP mg/L 19 (16 - 24)

58 (50 - 70)

Генеральный директор

АО «БиоХимМак»

Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

листа (ов).

