

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «БиоХимМак»



Н.Е. Тамм

2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке, плазме или
цельной крови Afinion CRP»

Производства
Abbott Diagnostics Technologies AS (Эбботт Диагностикс Текнолоджис АС)

Фото 1. Набор для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке, плазме или цельной крови Afinion CRP. Вторичная (групповая) упаковка, маркировка.

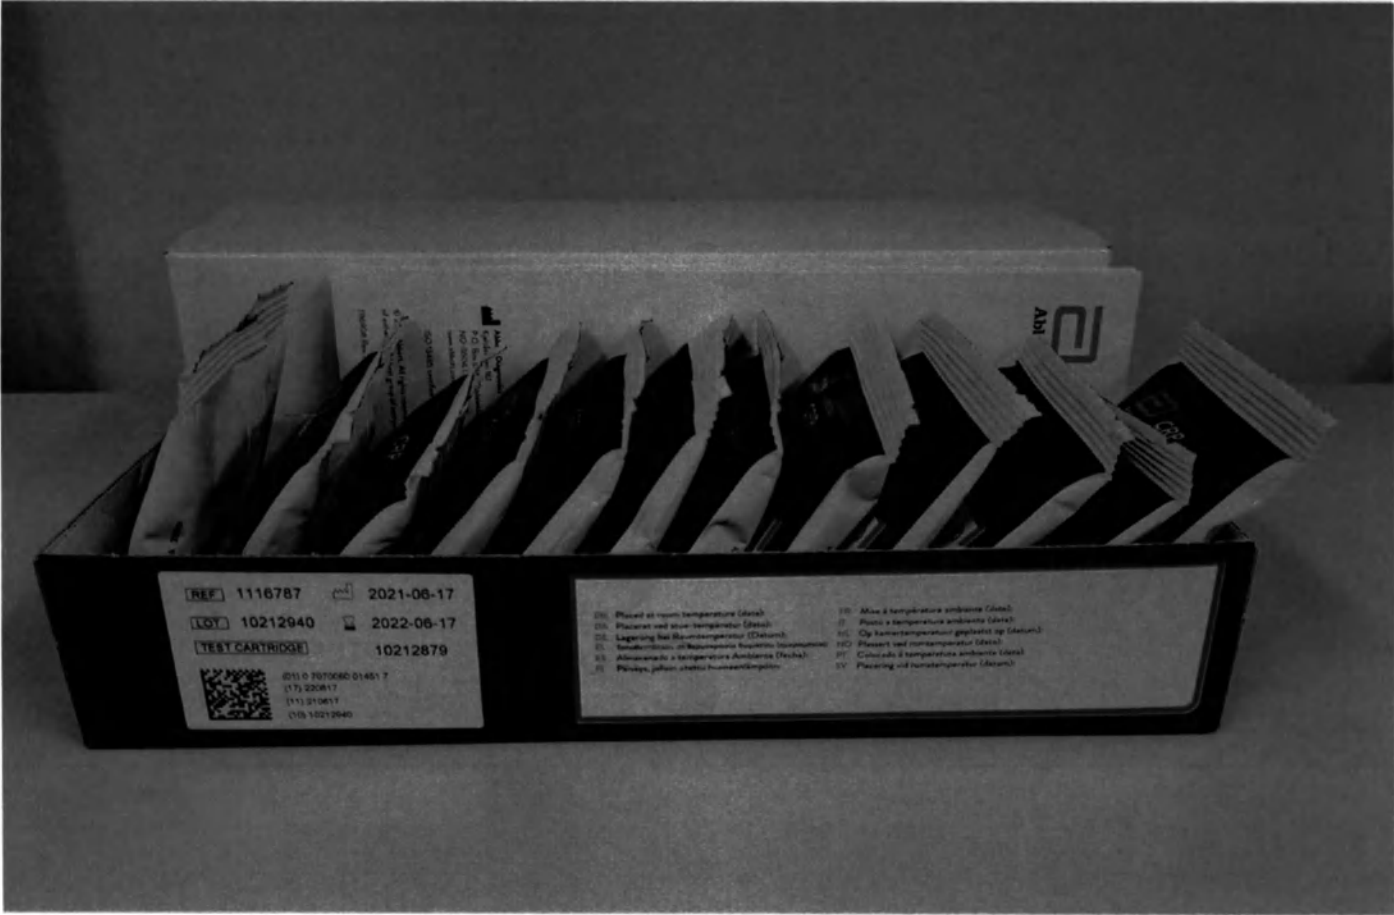


Фото 2. Набор для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке, плазме или цельной крови Afinion CRP. Тестовый картридж, первичная упаковка (пакет из фольги).

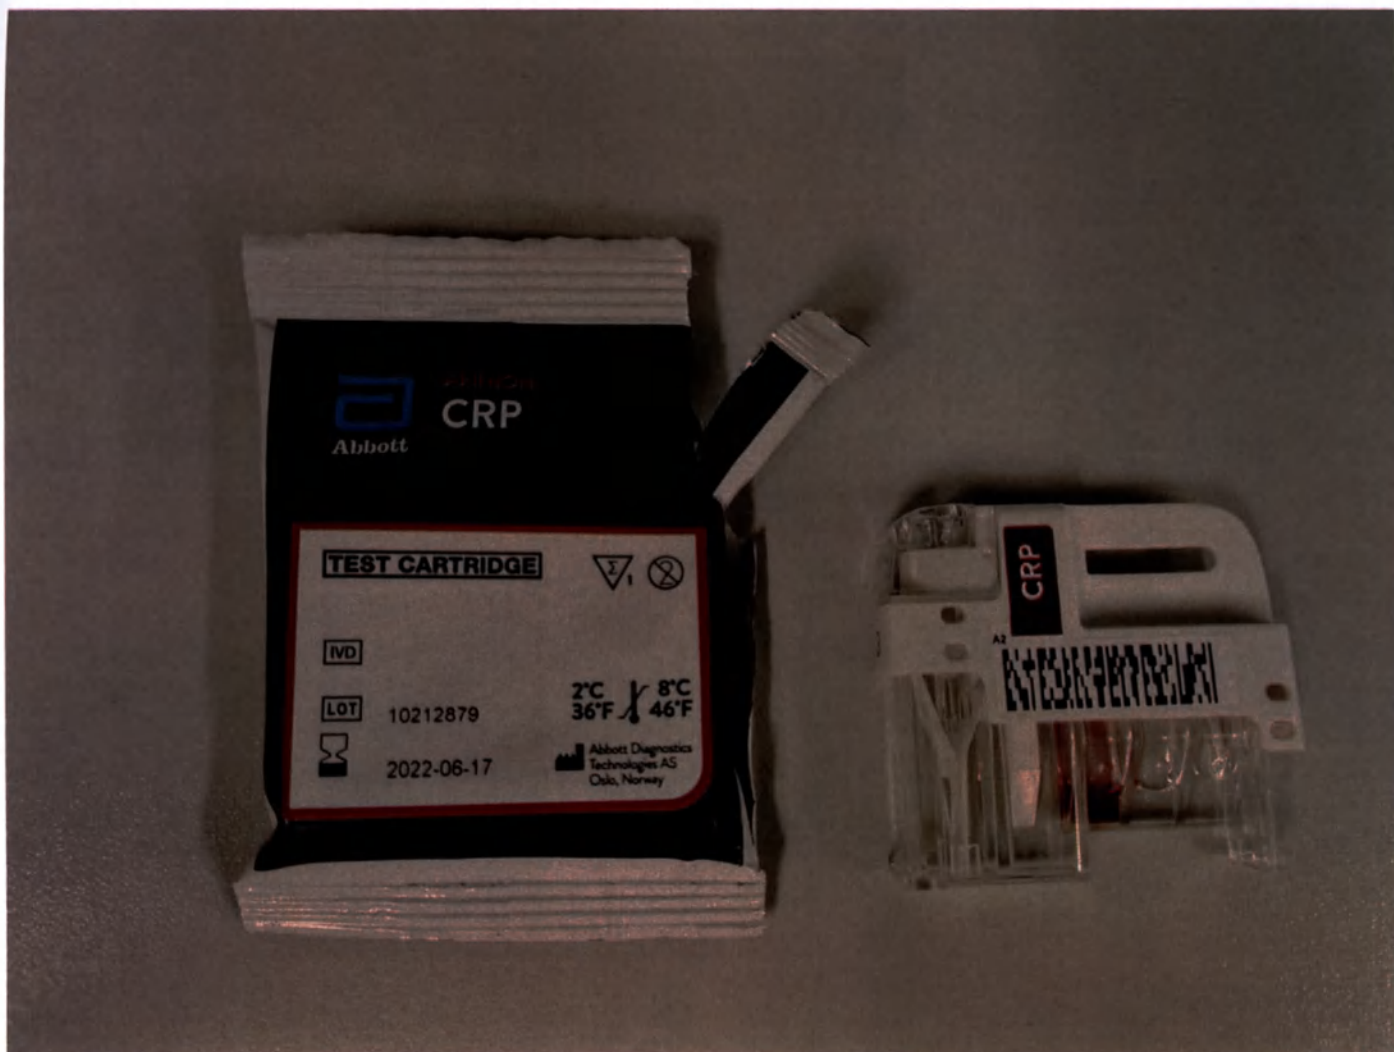


Фото 3. Набор для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке, плазме или цельной крови Afinion CRP. Макет маркировки вторичной (групповой) упаковки.

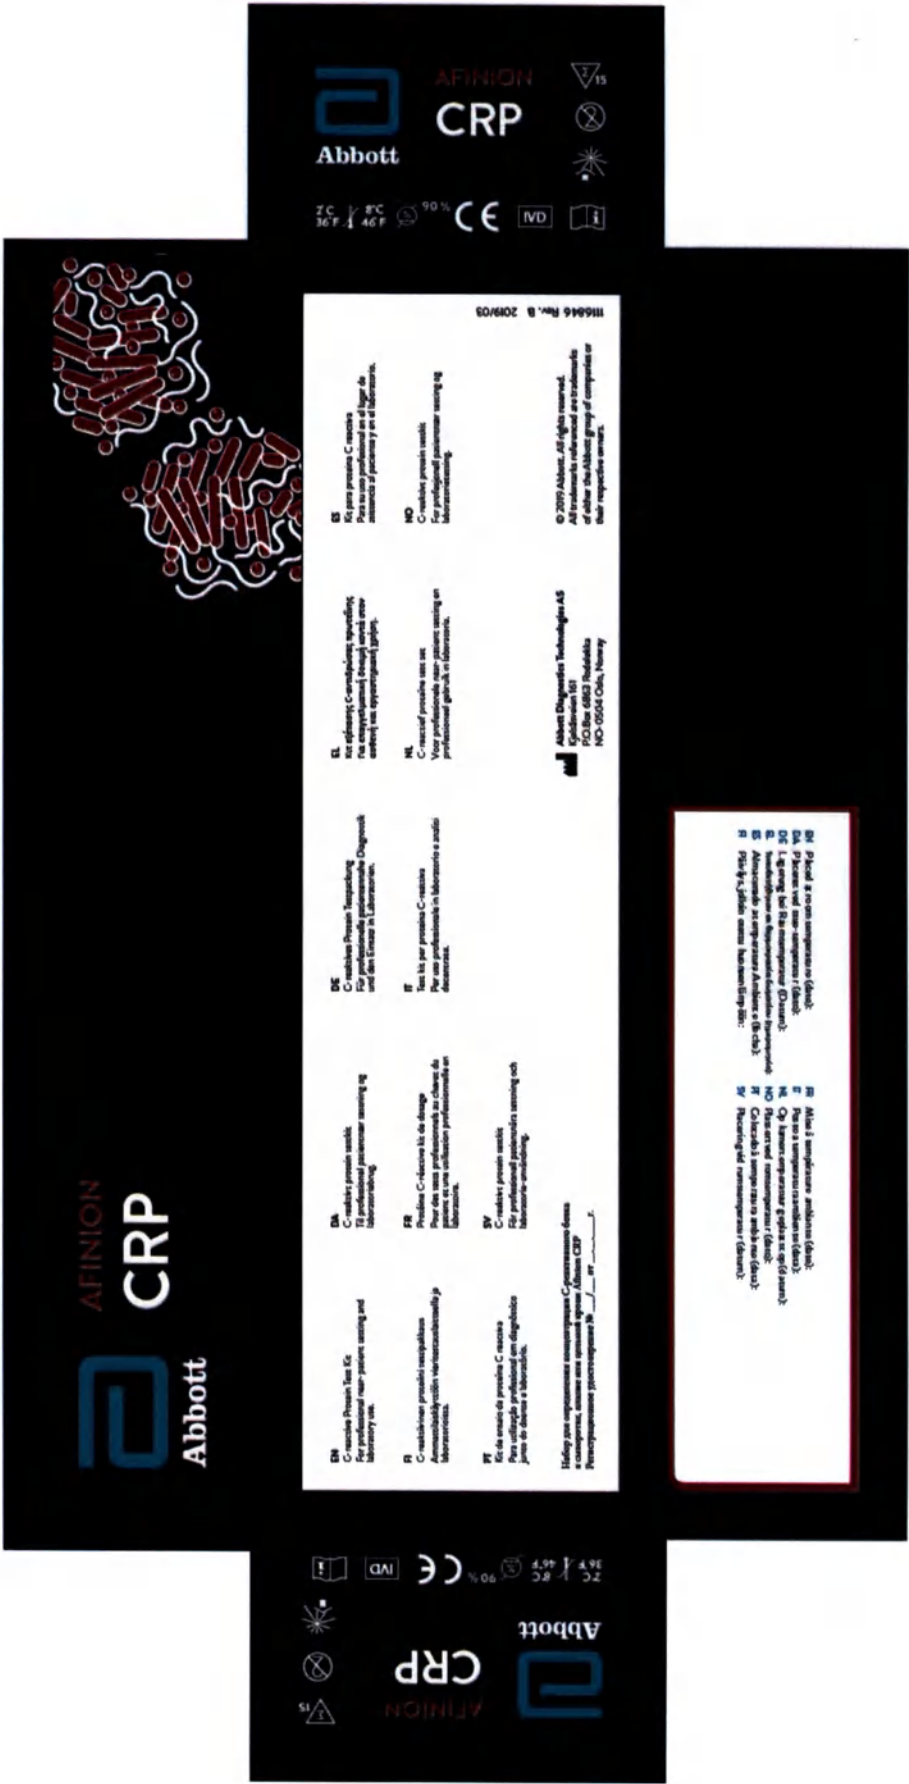


Фото 4. Набор для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке, плазме или цельной крови Afinion CRP. Макет маркировки первичной упаковки (пакет из фольги).


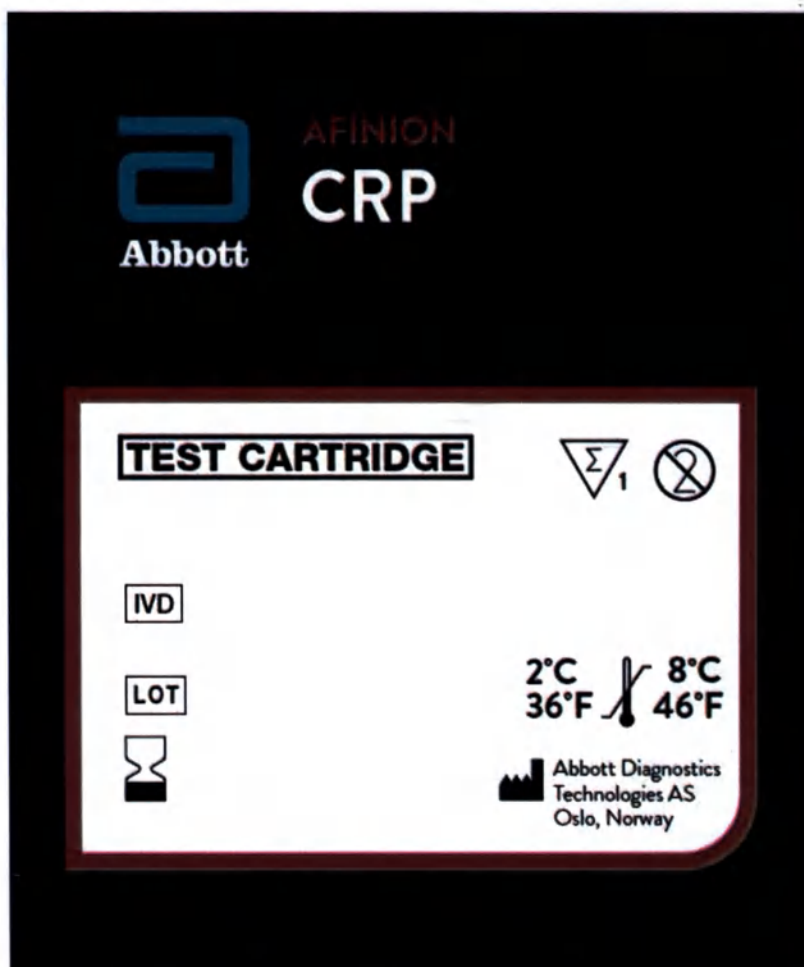


Фото 5. Набор для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке, плазме или цельной крови Afinion CRP. Инструкция по применению

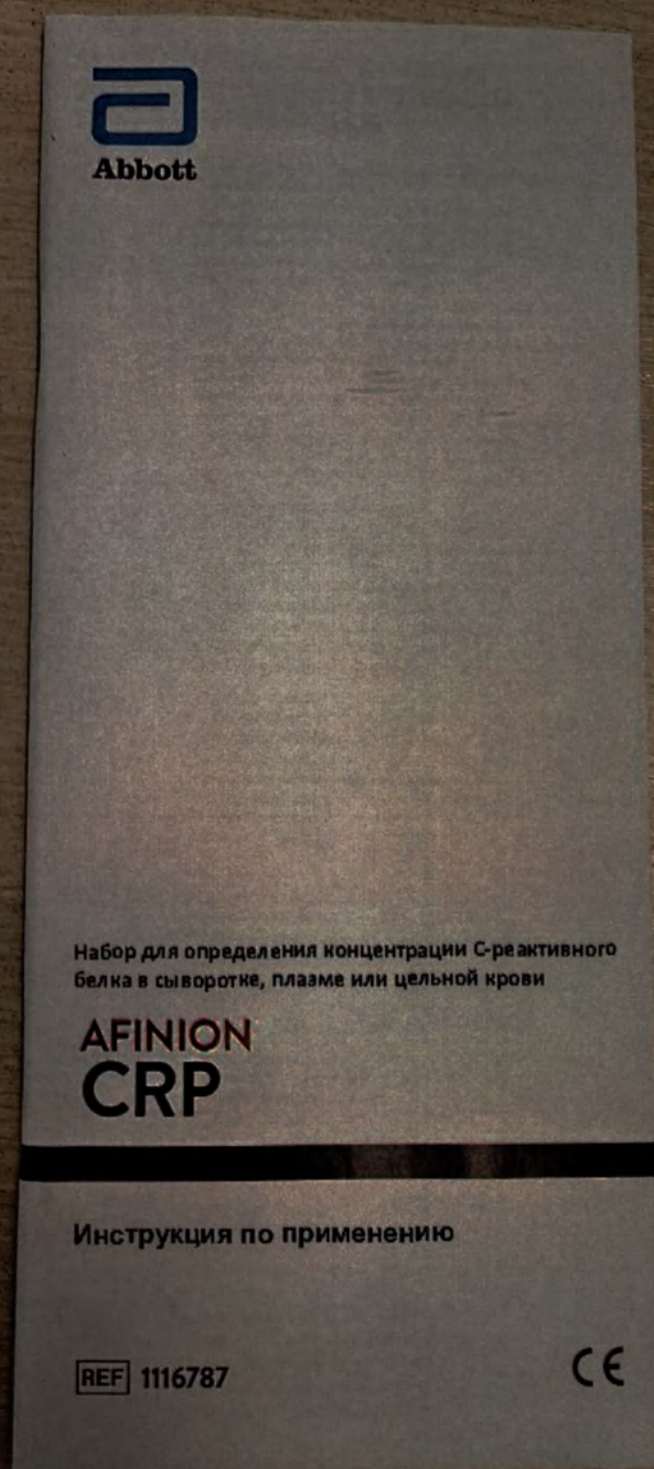

Генеральный директор

АО «БиоХимМак»

Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

6 (шесть)
листа (ов).

