

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «БиоХимМак»



Н.Е. Тамм

2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор контролей гликозилированного гемоглобина в цельной крови
Afinion HbA1c Control»

Производства
Abbott Diagnostics Technologies AS (Эбботт Диагностикас Текнолоджис АС)

Фото 1. Набор контролей гликозилированного гемоглобина в цельной крови Afinion HbA1c Control. Вторичная упаковка (картонная коробка), маркировка.

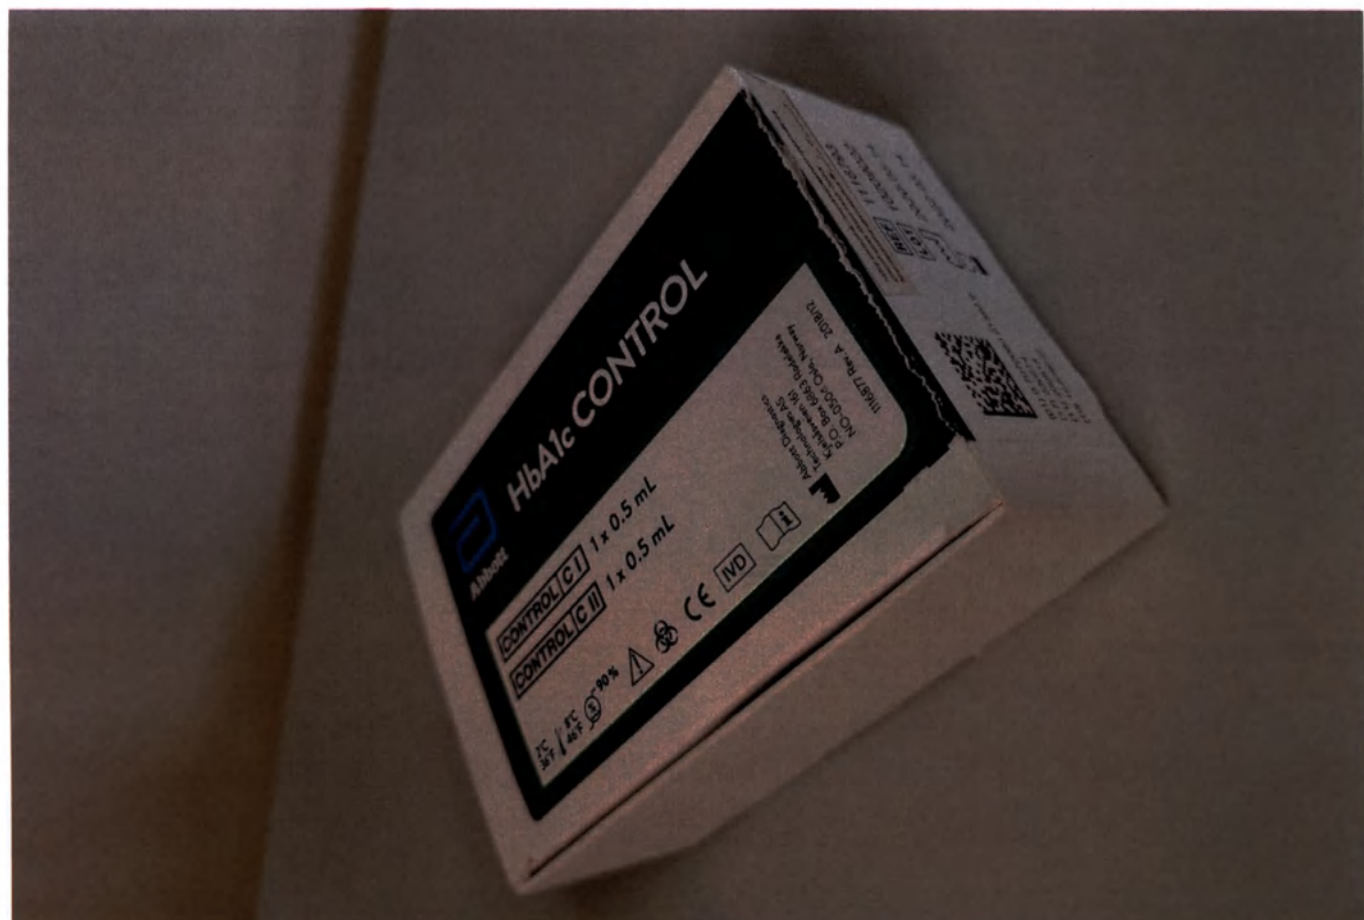


Фото 2. Набор контролей гликозилированного гемоглобина в цельной крови Afinion HbA1c Control. Состав набора.



Фото 3. Набор контролей гликозилированного гемоглобина в цельной крови Afinion HbA1c Control. Первичная упаковка (флаконы).



Фото 4. Набор контролей гликозилированного гемоглобина в цельной крови Afinion HbA1c Control. Макет маркировки вторичной упаковки (картонная коробка).



Фото 5. Afinion HbA1c Control C I – Контроль C I. Макет маркировки.

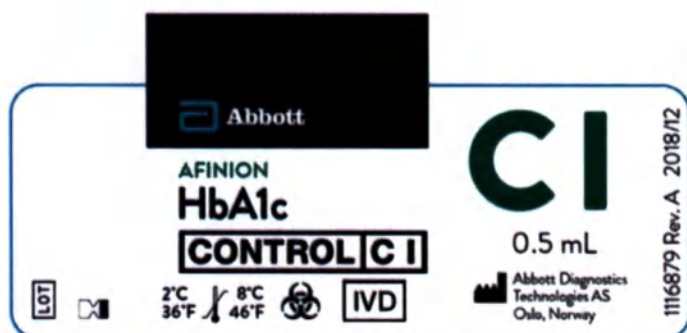


Фото 6. Afinion HbA1c Control C II – Контроль C II. Макет маркировки.

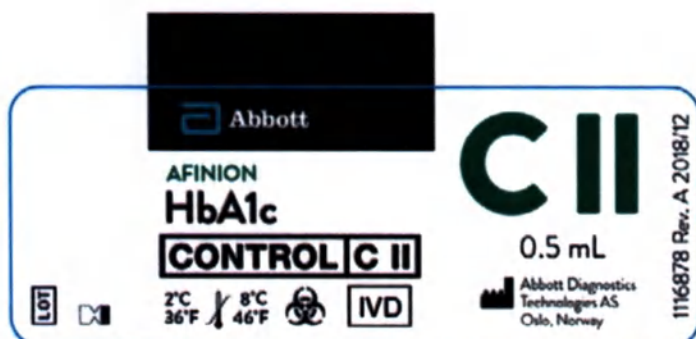


Фото 5. Набор контролей гликозилированного гемоглобина в цельной крови Afinion HbA1c Control. Инструкция по применению



Abbott

Набор контролей гликозилированного гемоглобина в цельной крови

AFINION HbA1c CONTROL

Инструкция по применению

REF 1116793

LOT 10206294



CONTROL | CI

CONTROL | CII

mmol/mol 42 (37 - 50)

65 (56 - 74)

% HbA1c 6.0 (5.6 - 6.7)

8.1 (7.3 - 8.9)

Генеральный директор

АО «БиоХимМак»



Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

листа (ов).