

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НВс

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88048
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., нейтрализующий реагент (R3), 3,25 мл/уп., реагент для разведения образцов (R4), 2,25 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НВс

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88048
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., нейтрализующий реагент (R3), 3,25 мл/уп., реагент для разведения образцов (R4), 2,25 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НВс

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88048
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., нейтрализующий реагент (R3), 3,25 мл/уп., реагент для разведения образцов (R4), 2,25 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НВс

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88048
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., нейтрализующий реагент (R3), 3,25 мл/уп., реагент для разведения образцов (R4), 2,25 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.



лидкор **YHLO**

Лидлаб Амур
Анти-НВс


IVD



3,5 мл	4,0 мл	3,25 мл	2,25 мл
R 1	R 2	R 3	R 4




LOT	20230701	01.07.2024
-----	----------	------------

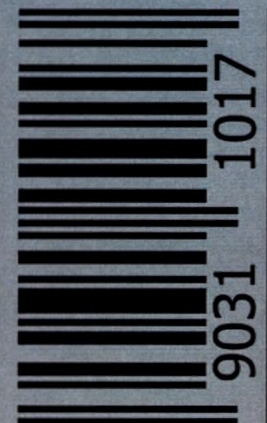

лидкор

Лидлаб Амур Анти-НВс

Калибратор инактивирован



IVD



ProClin 300



1,0 мл

LOT

20230701



01.07.2024

CAL 1


REF

C88048

лидкор

Лидлаб Амур Анти-НВс

Калибратор инактивирован



IVD



ProClin 300



1,0 мл

LOT

20230701



01.07.2024

CAL 2

REF

C88048

лидкор
Лидлаб Амур
Анти-НВс

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

IVD



01.07.2024


REF C88048




Лидлаб Амур Анти-НВс



LOT 20230701 EXP 01.07.2024

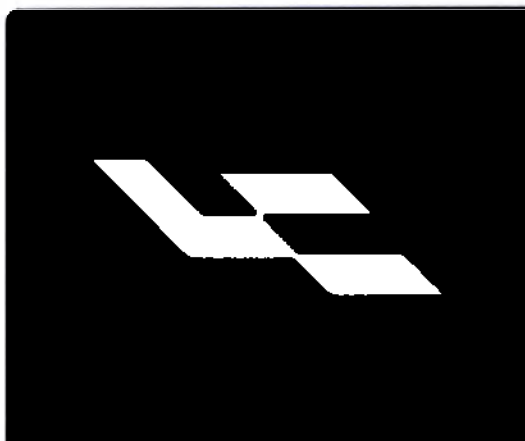


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022

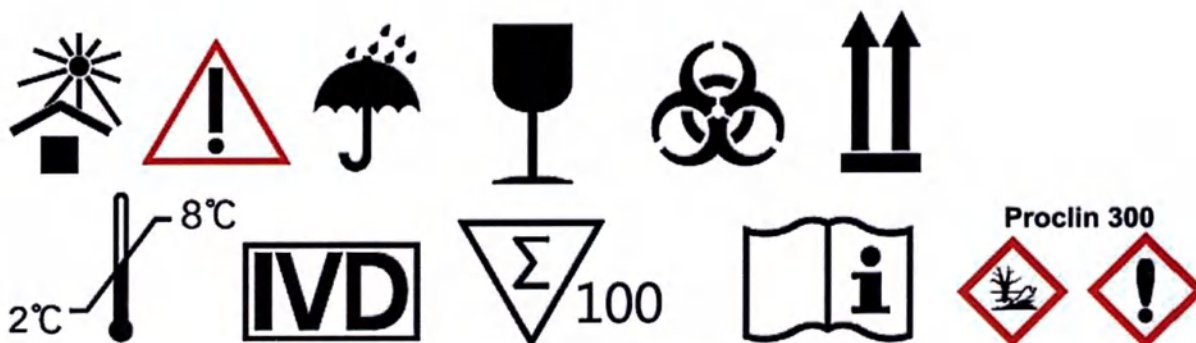


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88048

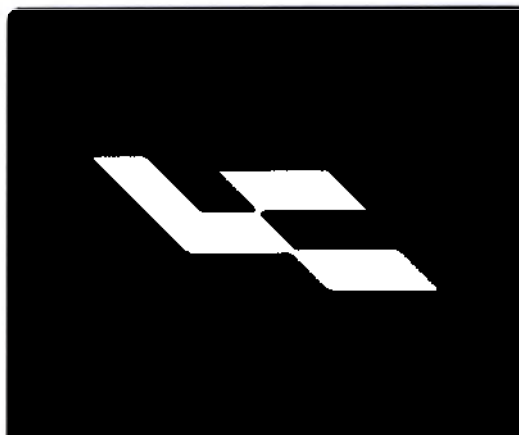


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022

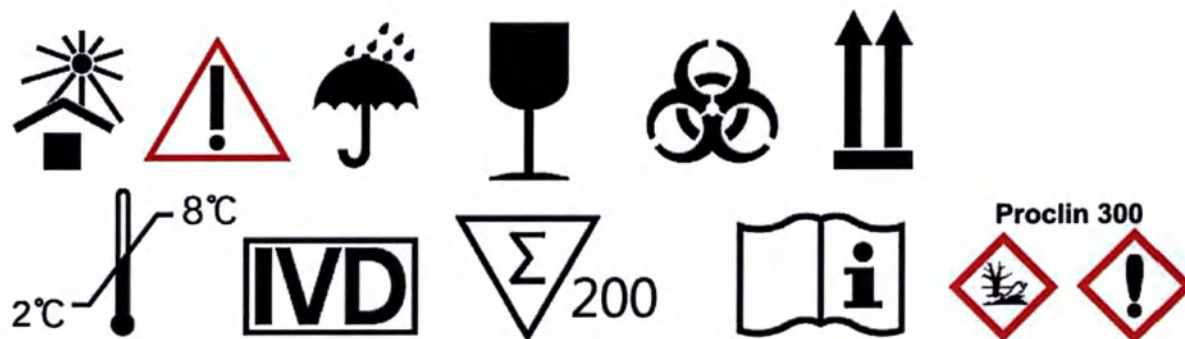


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88048	

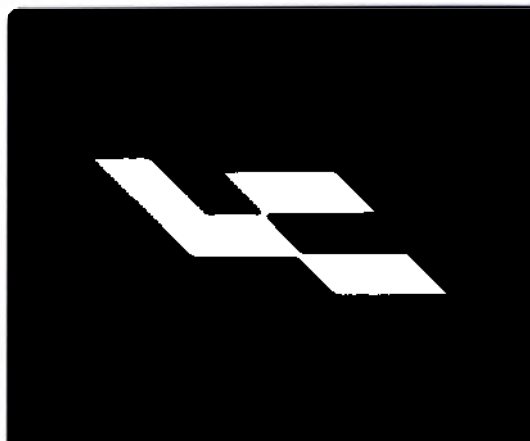


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022

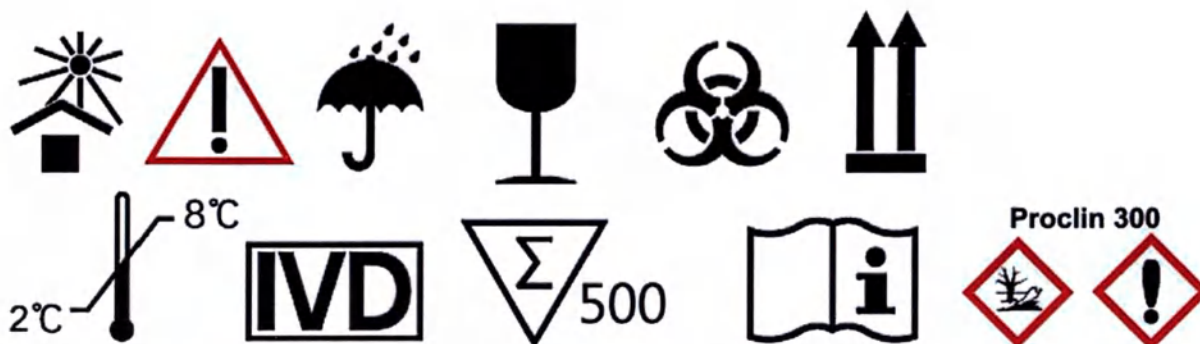


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88048

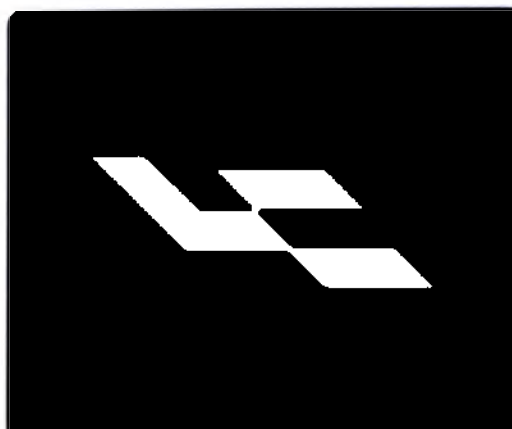


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022

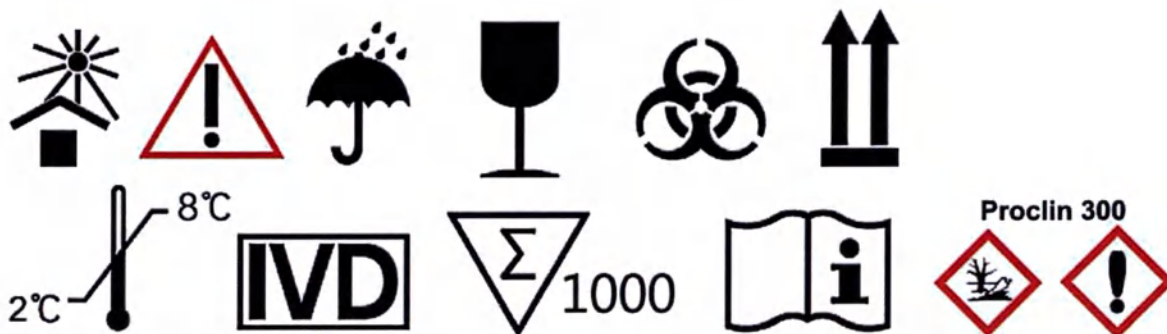

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88048

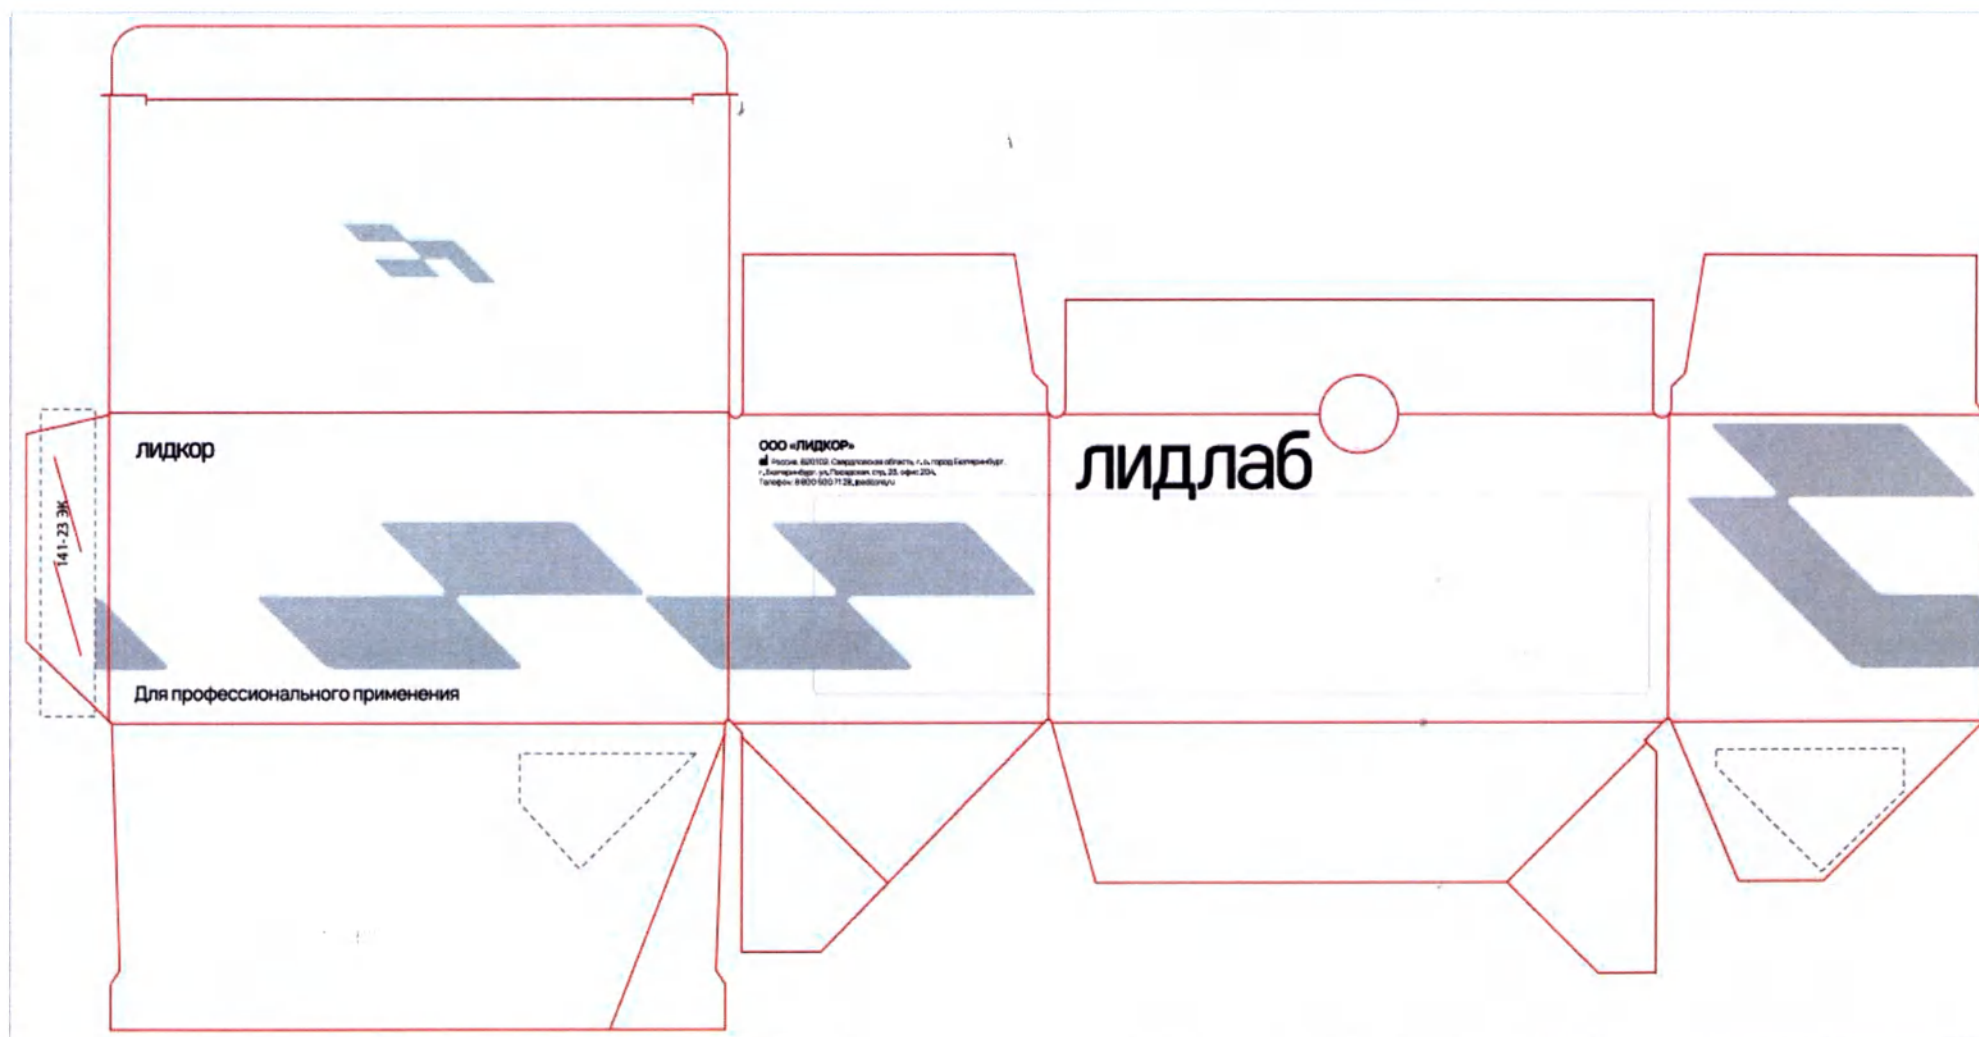

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

11 (одиннадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЛИДКОР»




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-266-65614693-2022

2023

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., Нейтрализующий реагент (R3), 3,25 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R4), 2,25 мл/уп.)

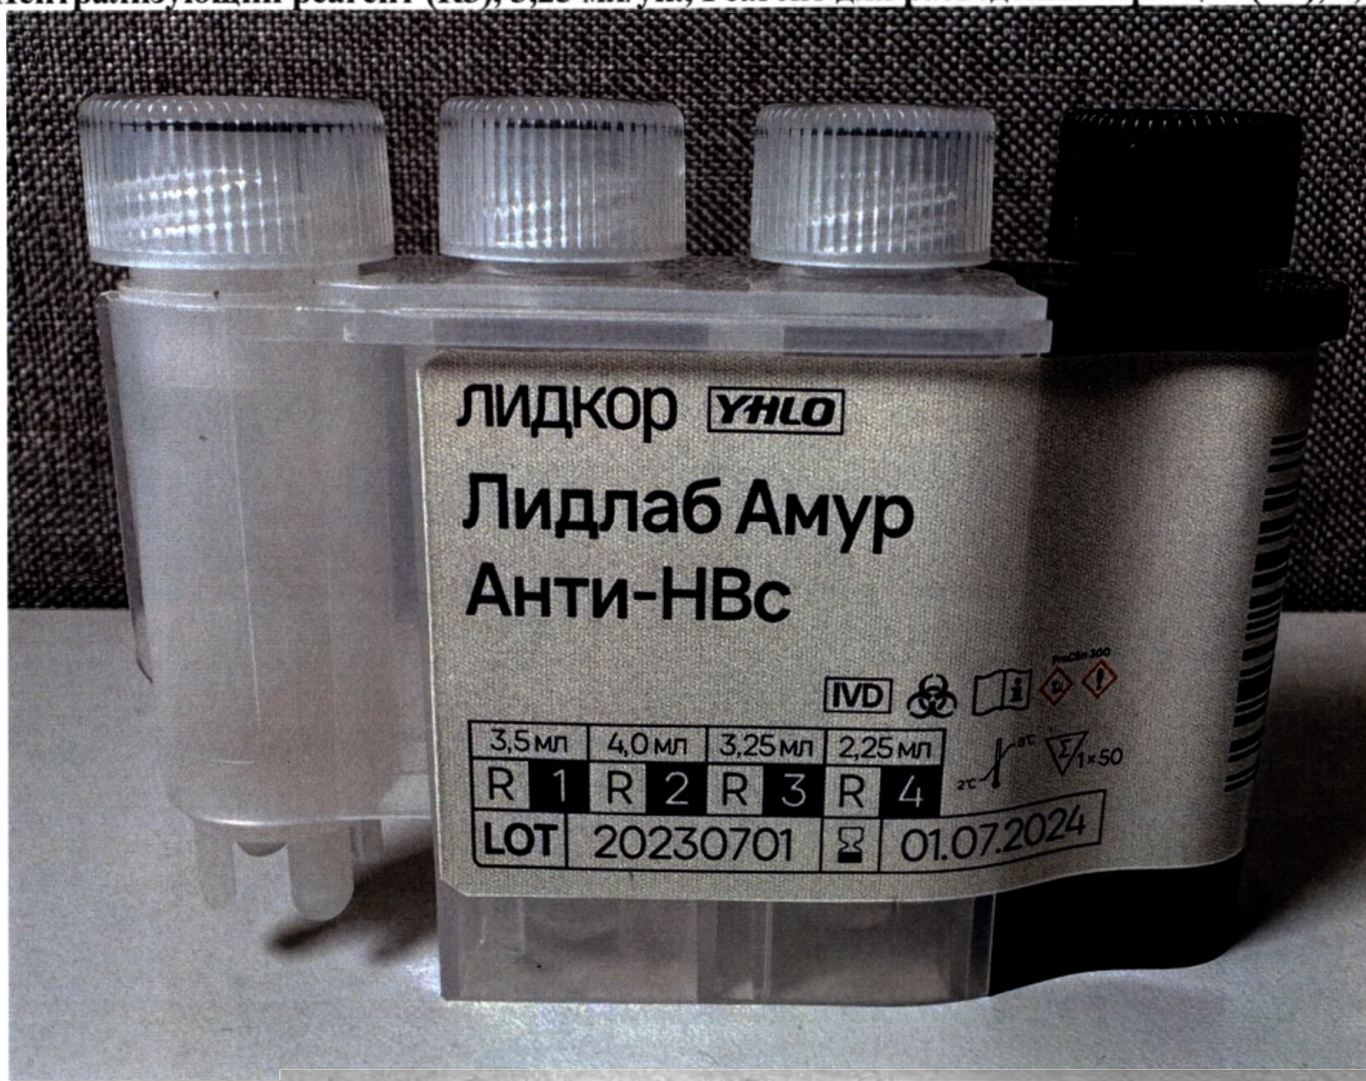

Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон



Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон



Пароизоляционные крышки

лидкор

Лидлаб Амур
Анти-НВс

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



01.07.2024

REF C88048




лидкор

Лидлаб Амур
Анти-НВс

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



01.07.2024


REF C88048




Набор реагентов на 100 тестов



Набор реагентов на 100 тестов. Вид сбоку

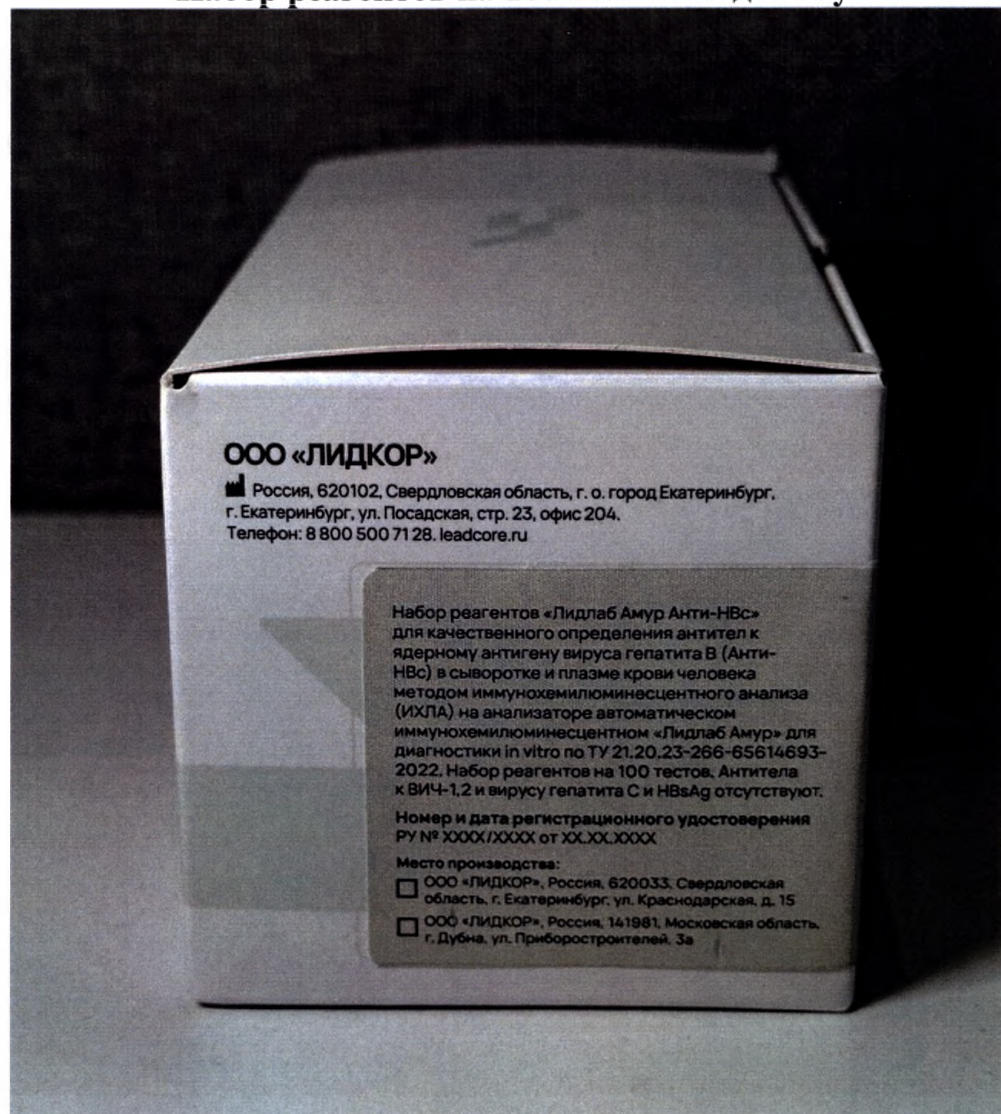

Набор реагентов на 100 тестов. Вид сзади

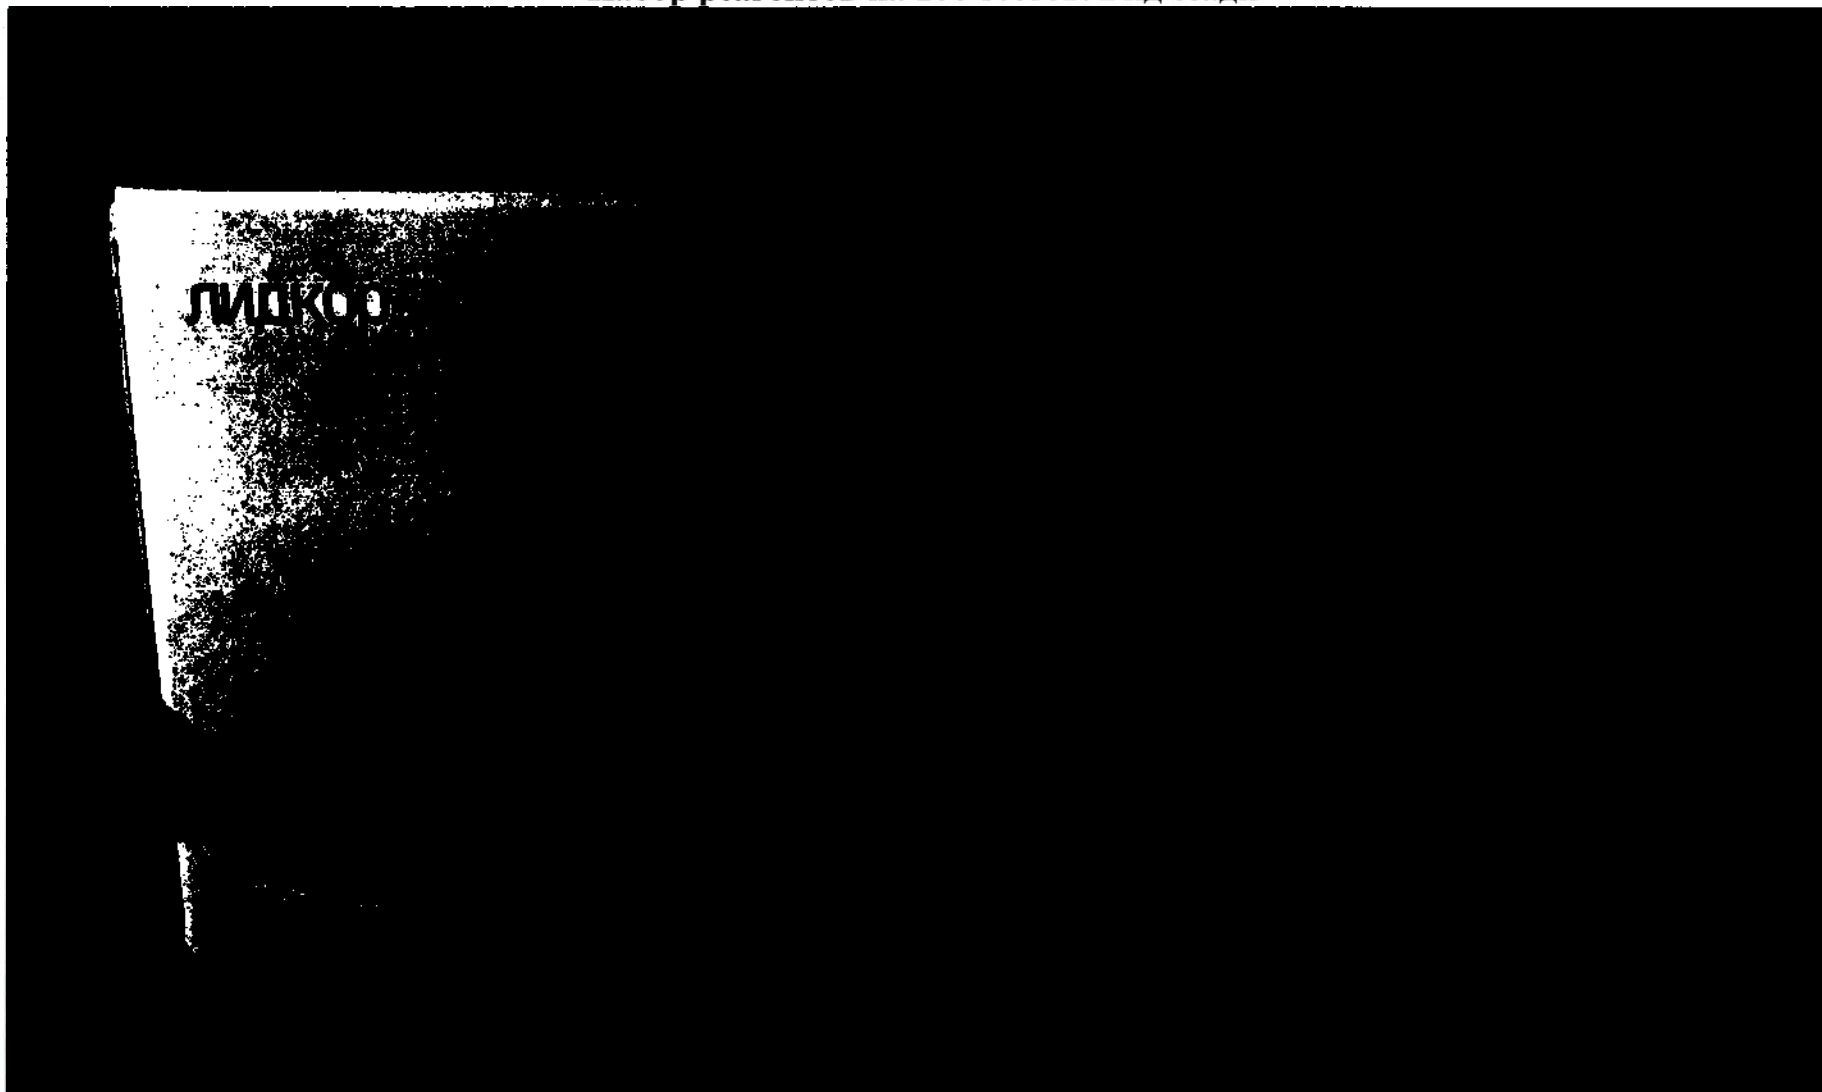

Набор реагентов на 200 тестов



Набор реагентов на 200 тестов. Вид сбоку

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс»
для качественного определения антител к
ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-
НВс) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-266-65614693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела
к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов на 200 тестов. Вид сзади




Набор реагентов на 500 тестов

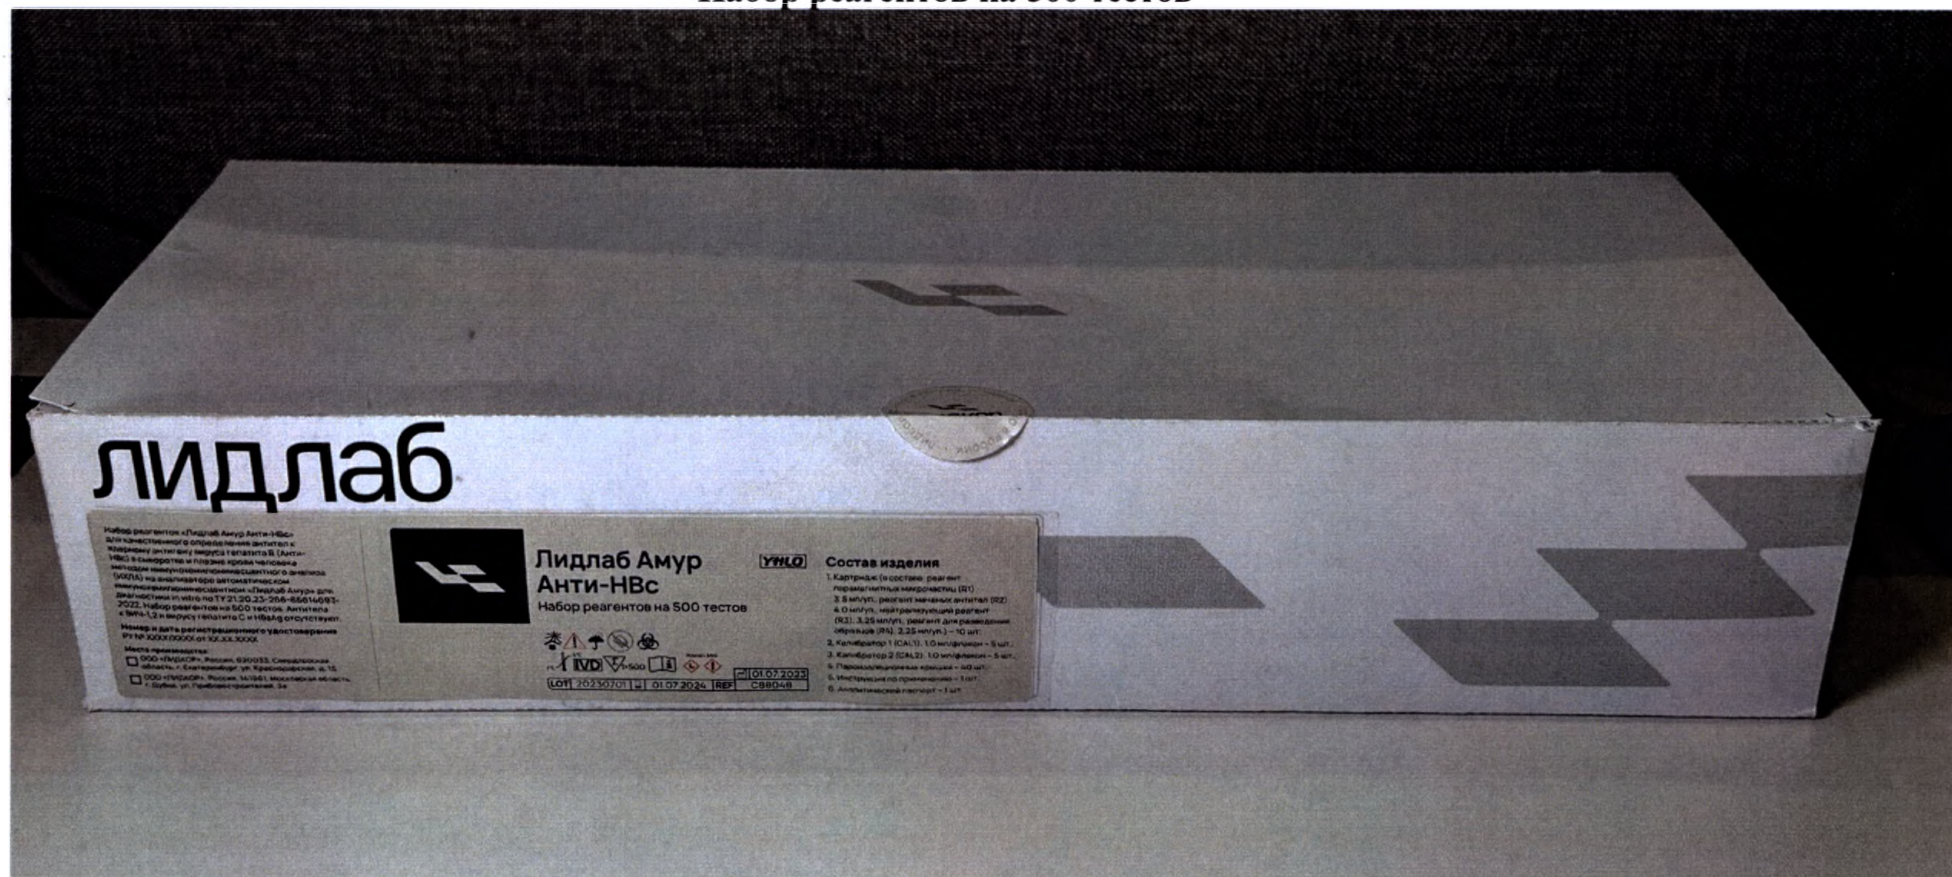

лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НВс» для качественного определения антител к возбудителю гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа (ИФА) на анализаторе автоматическом иммуноферментного анализа «Лидлаб Амур» для диагностики ИФА по ТУ 21.20.23-204-85614/083-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антигены к ВРНА-12 и вирусу гепатита С и НВсА9 отечественного.

Место производства:
☐ ООО «Цирми», Россия, 630033, Новосибирская область, г. Саяногорск, ул. Крайновская, в. 10.
☐ ООО «Лидлаб», Россия, 141641, Московская область, г. Луховицы, ул. Габриэлевская, 39.




Лидлаб Амур
Анти-НВс
Набор реагентов на 500 тестов

YHLO

Состав изделия


1. Карtridge (в составе: реагент-первичный микросмесь (D1).
2. 8 мл/шт. реагент-меченый антител (D2).
3. 0 мл/шт. нейтрализующий реагент (D3).
4. 3,35 мл/шт. реагент для разведения образца (P4).
5. 2,25 мл/шт. - 10 шт.
6. Катализатор 1 (CAL1): 1,0 мл/шт. - 5 шт.
7. Катализатор 2 (CAL2): 1,0 мл/шт. - 5 шт.
8. Платиноидирующие кристаллы - 40 шт.
9. Инструкции по применению - 1 шт.
10. Анализируемый материал - 1 шт.



ИВД V-500

LOT: 20230701 | W: 01.07.2024 | REF: C88048


Набор реагентов на 500 тестов. Вид сбоку

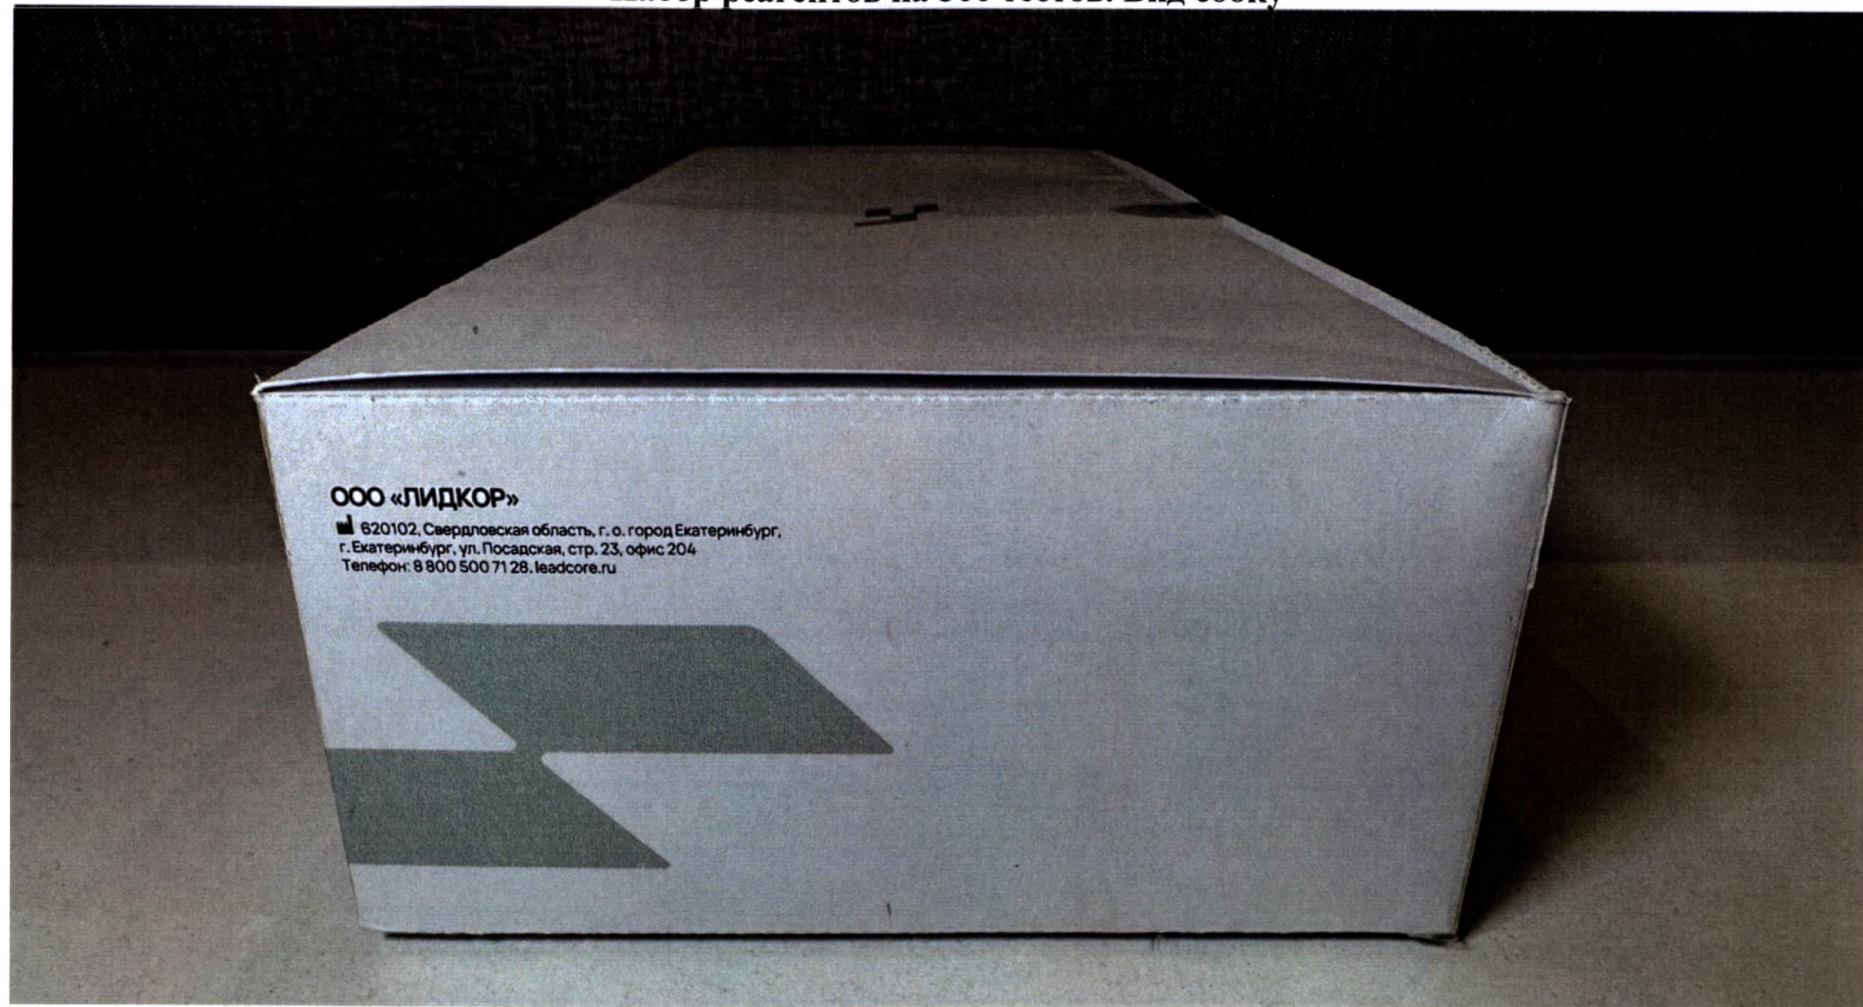

ООО «ЛИДКОР»

■ 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов на 500 тестов. Вид сзади

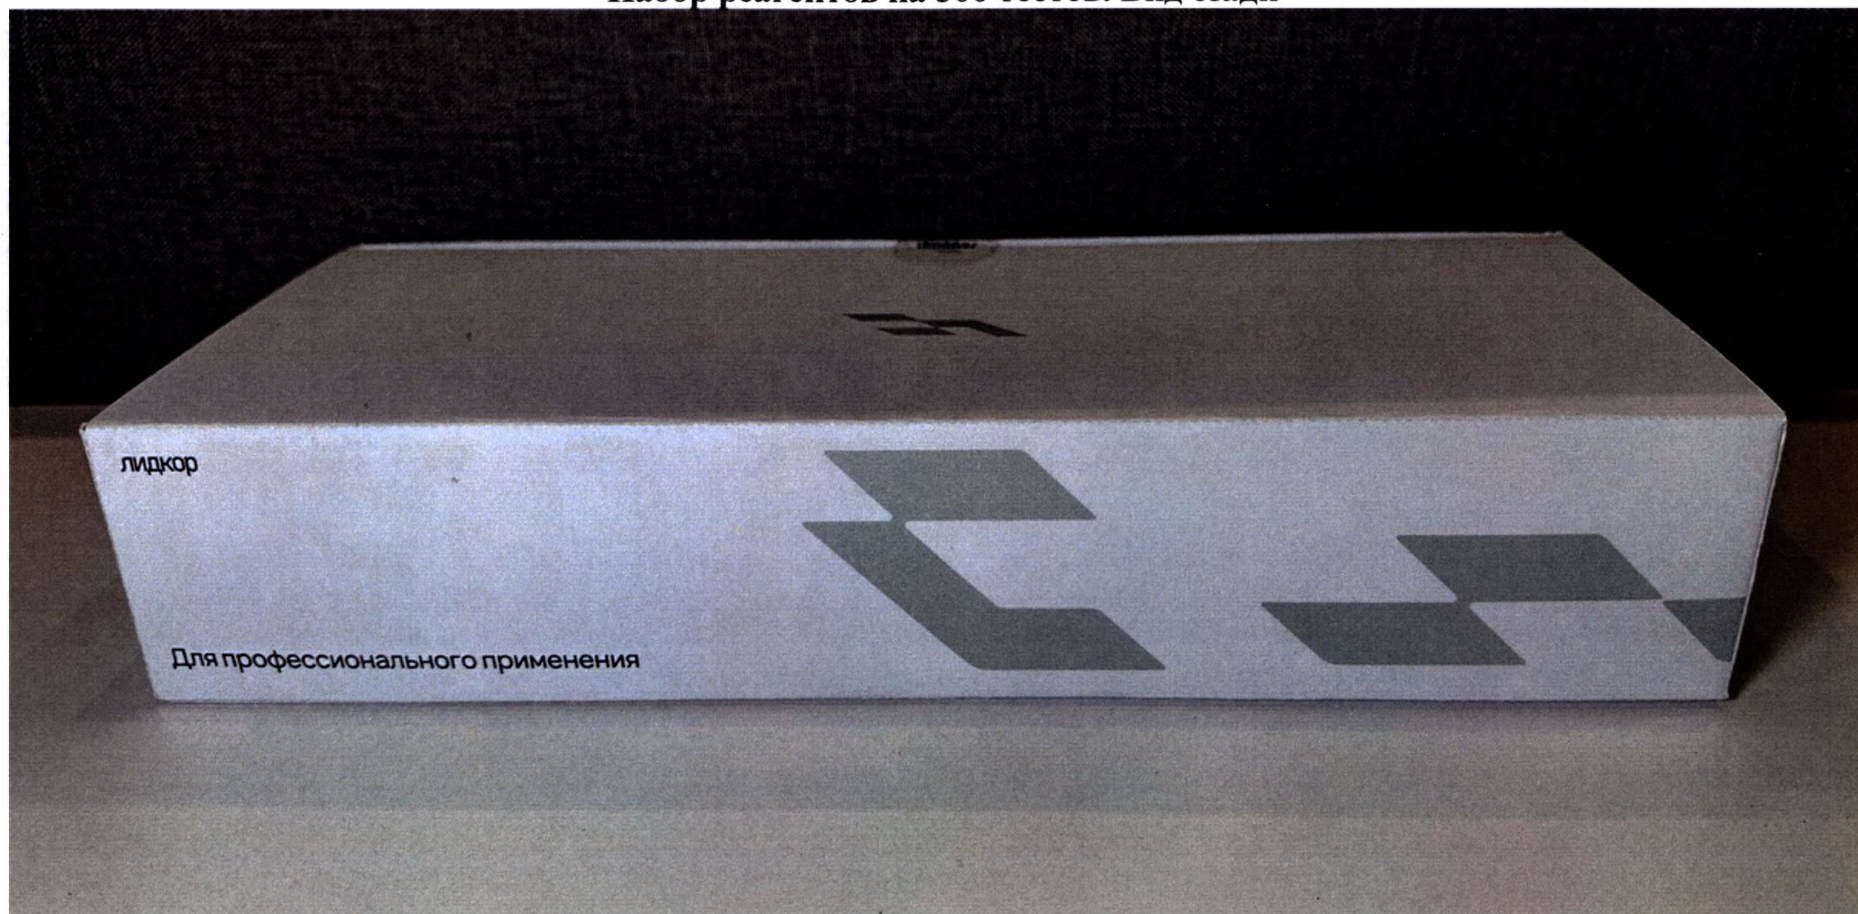

[illegible]


Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сбоку




Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сзади




Общий вид медицинского изделия

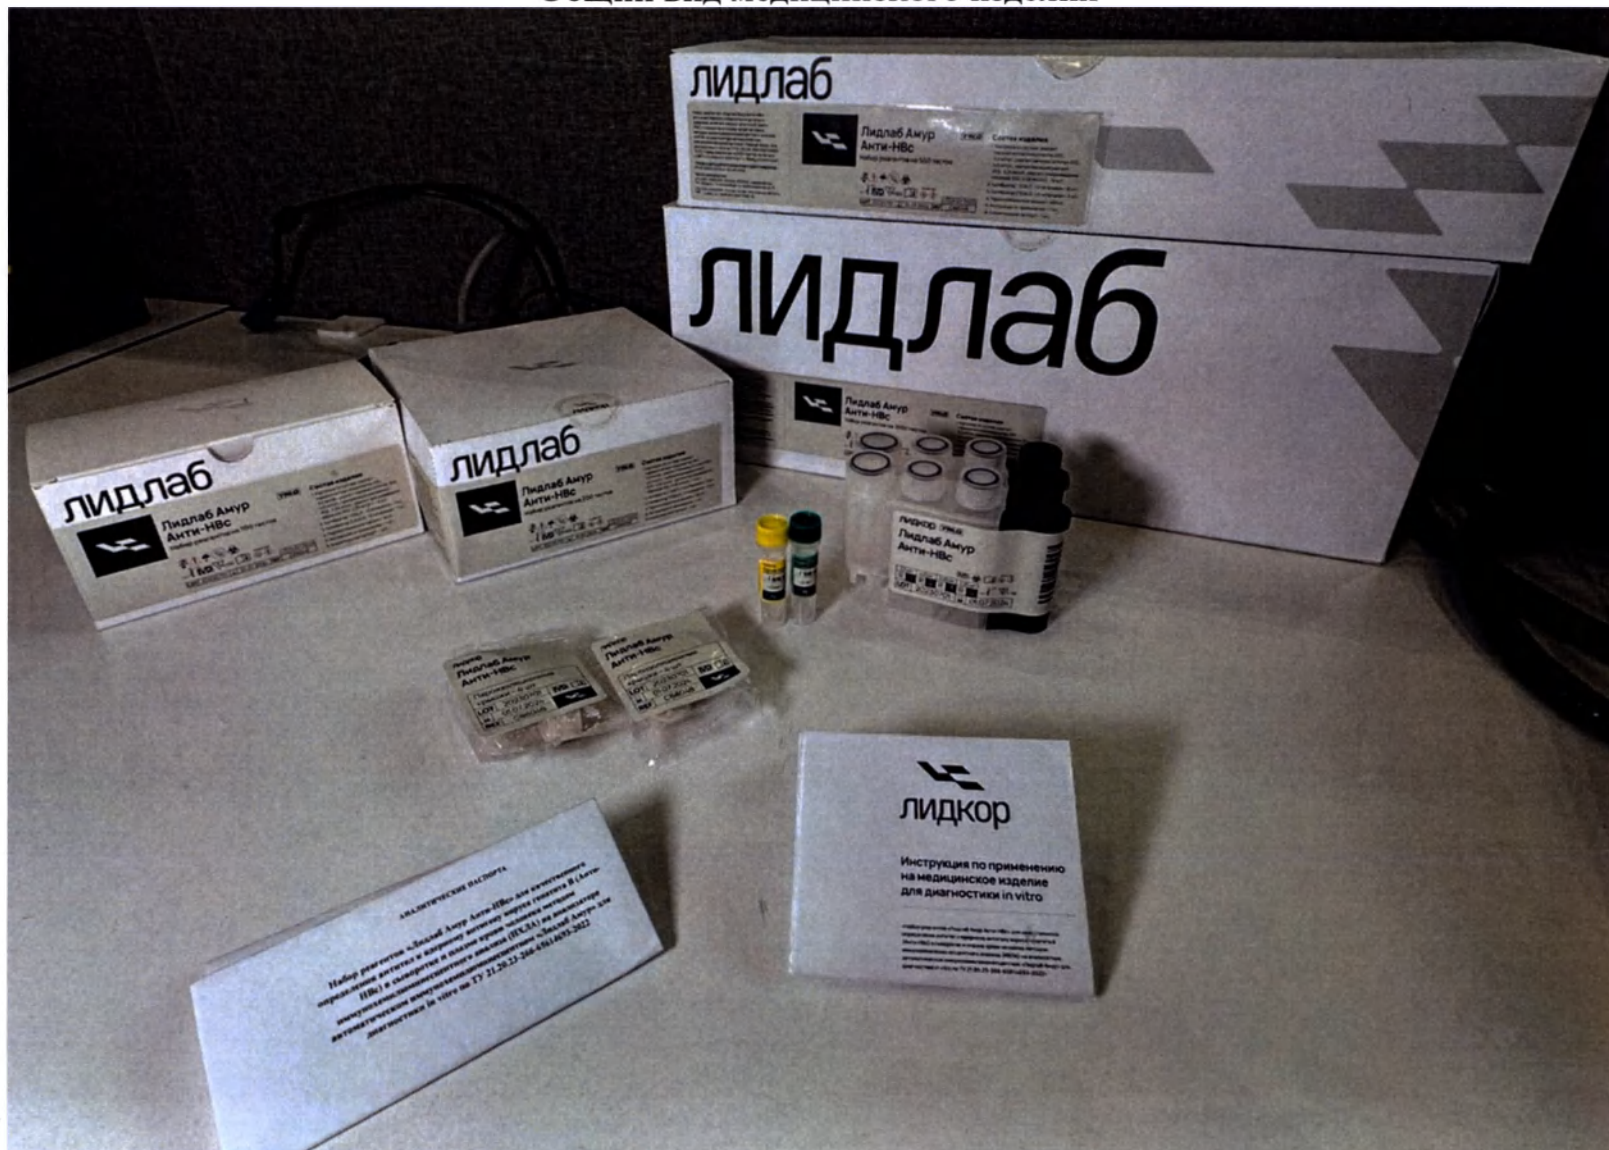

Транспортная упаковка Набора реагентов на 100 тестов

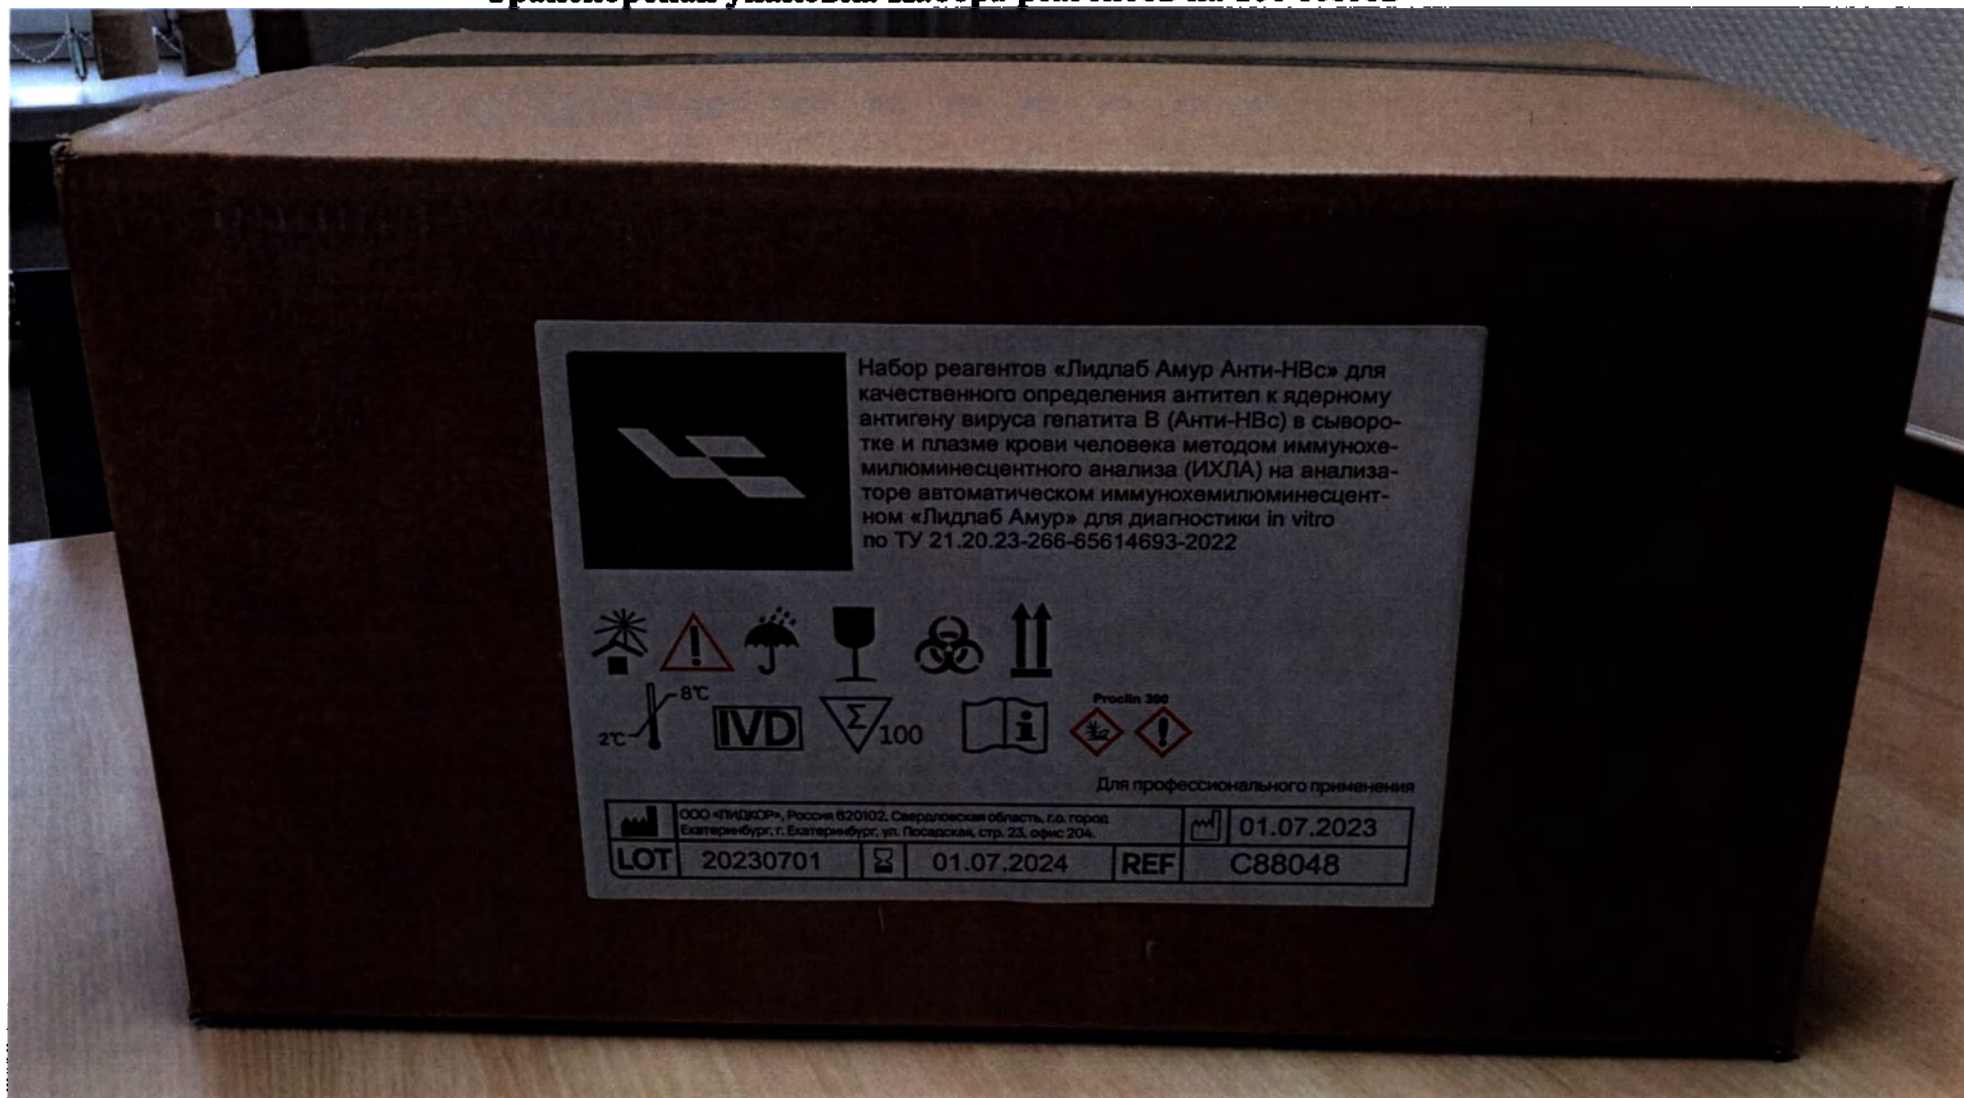


Транспортная упаковка Набора реагентов на 200 тестов

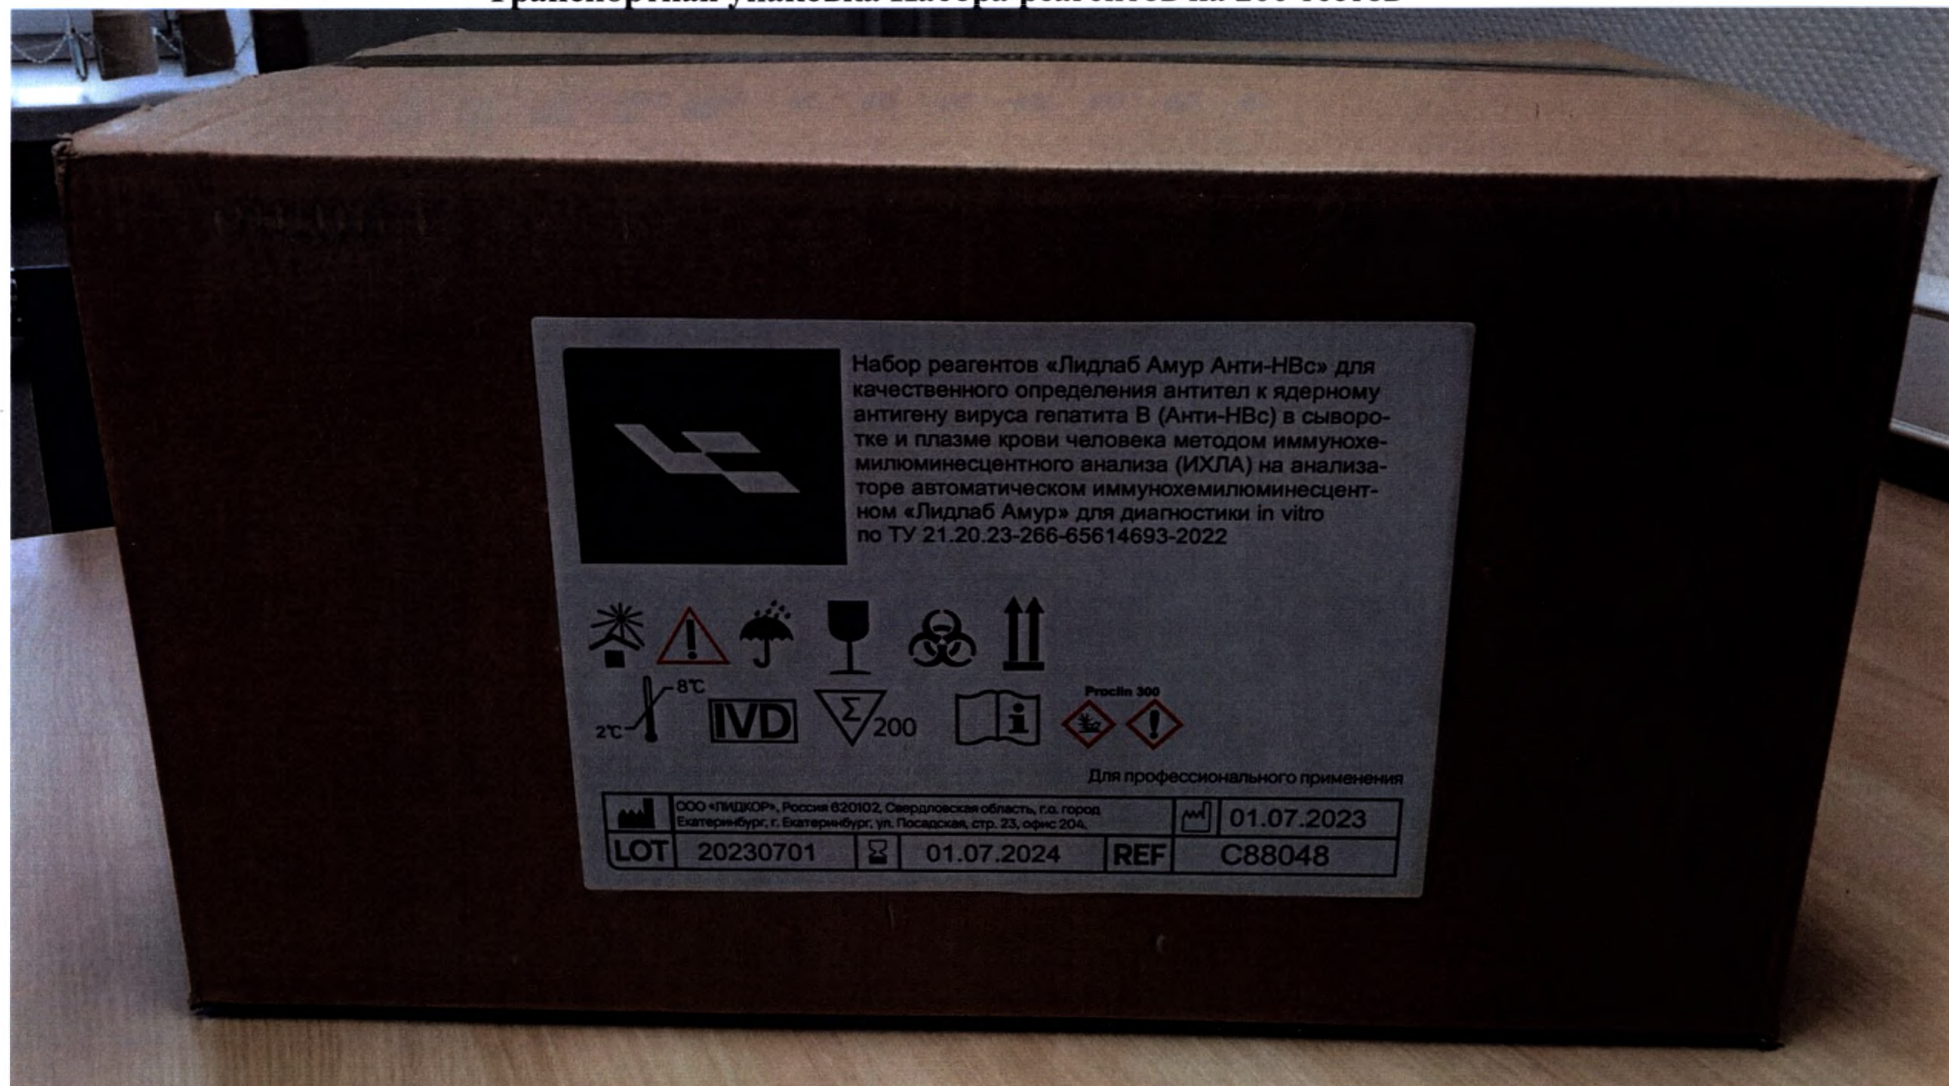

Транспортная упаковка Набора реагентов на 500 тестов



Транспортная упаковка Набора реагентов на 1000 тестов

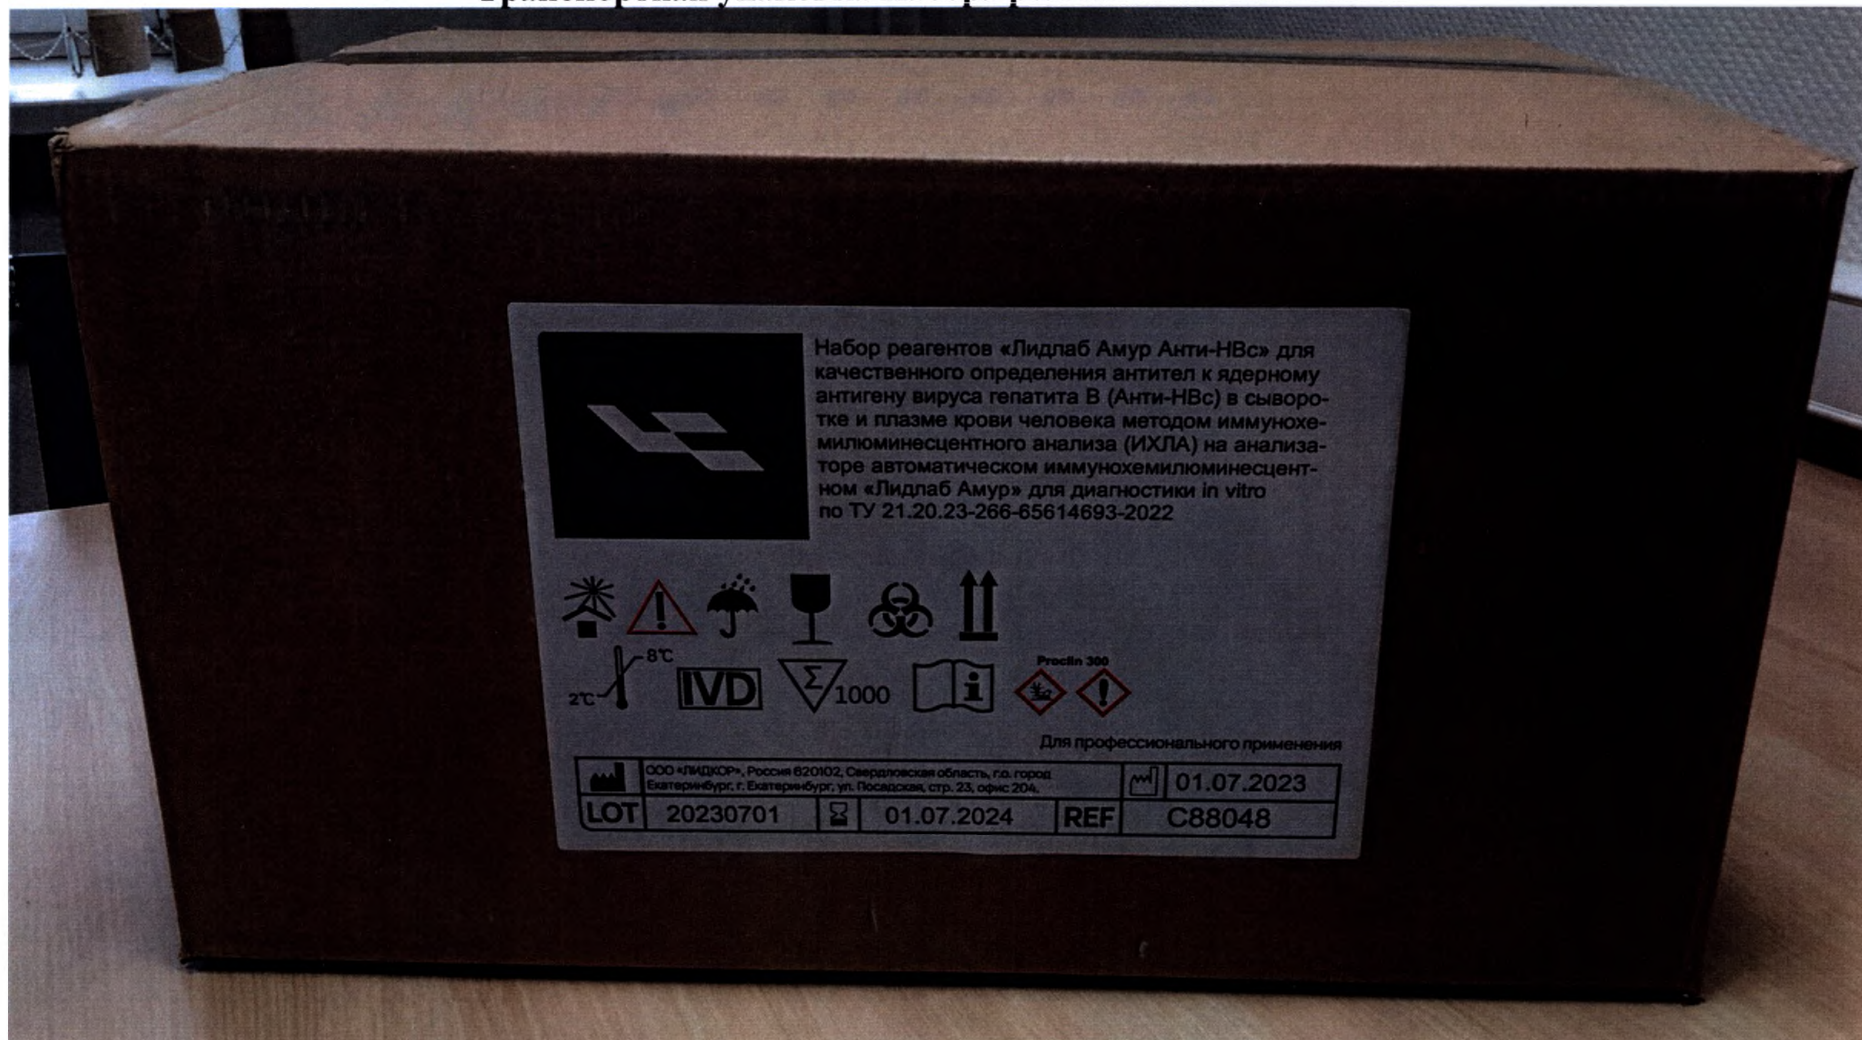

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

22 (двадцать два) л.

Директор

ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

