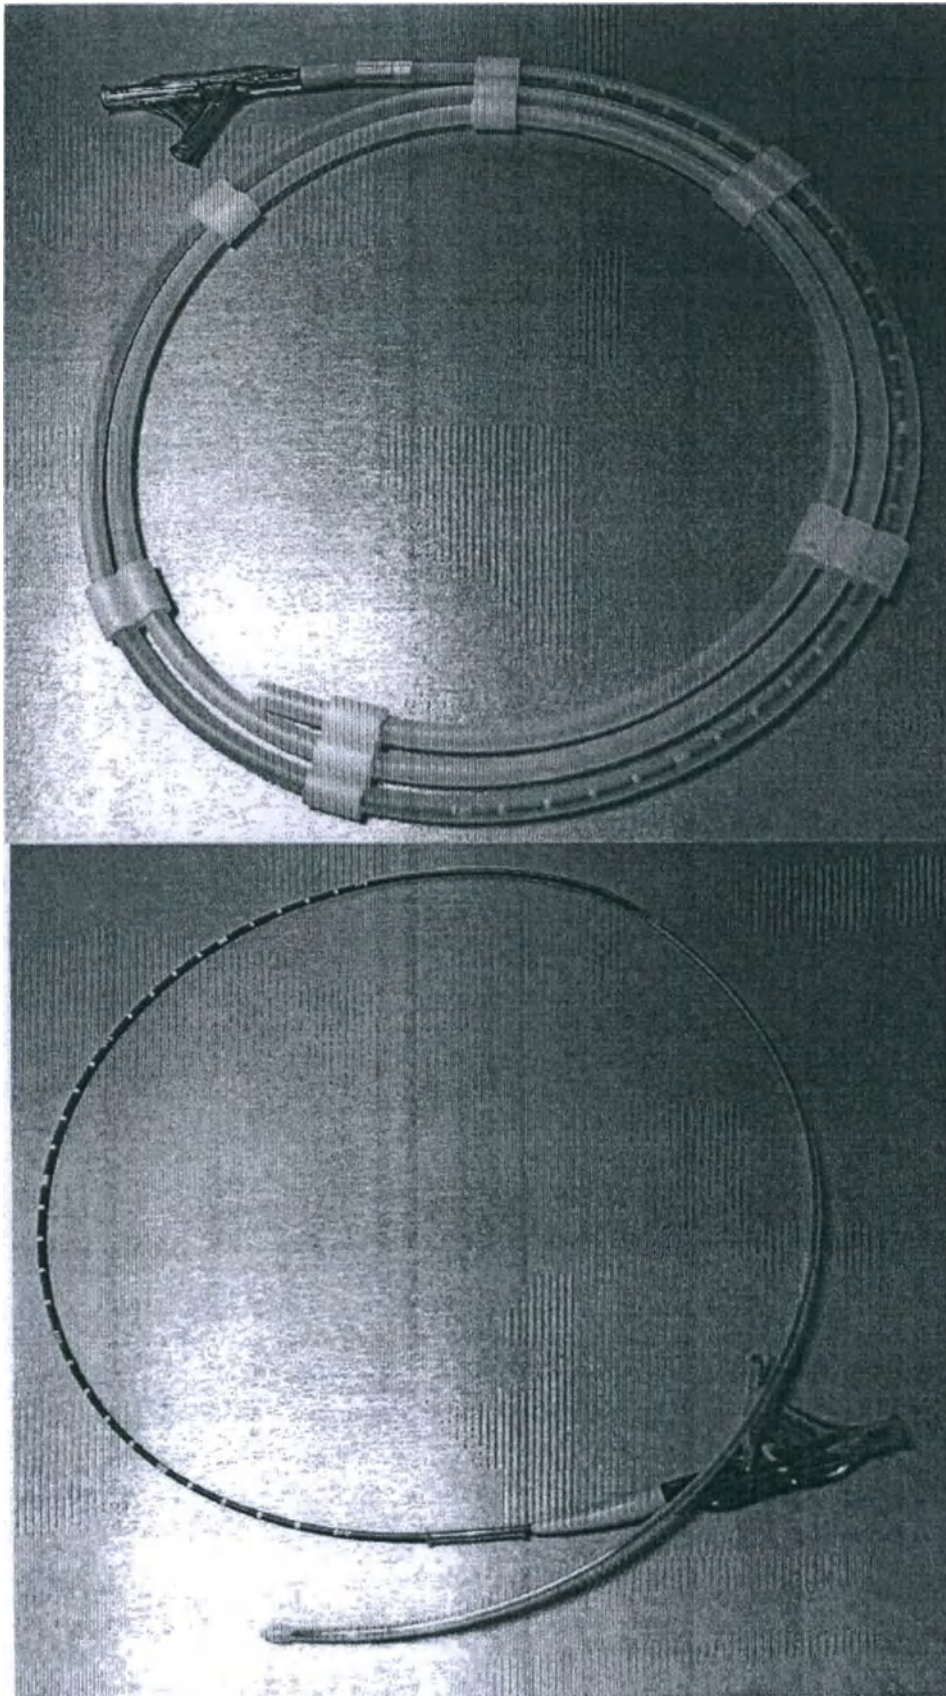


ФОТОГРАФИИ ИЗДЕЛИЯ



**Фото 1 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики:
Длина катетера 75 см - пример внешнего вида**

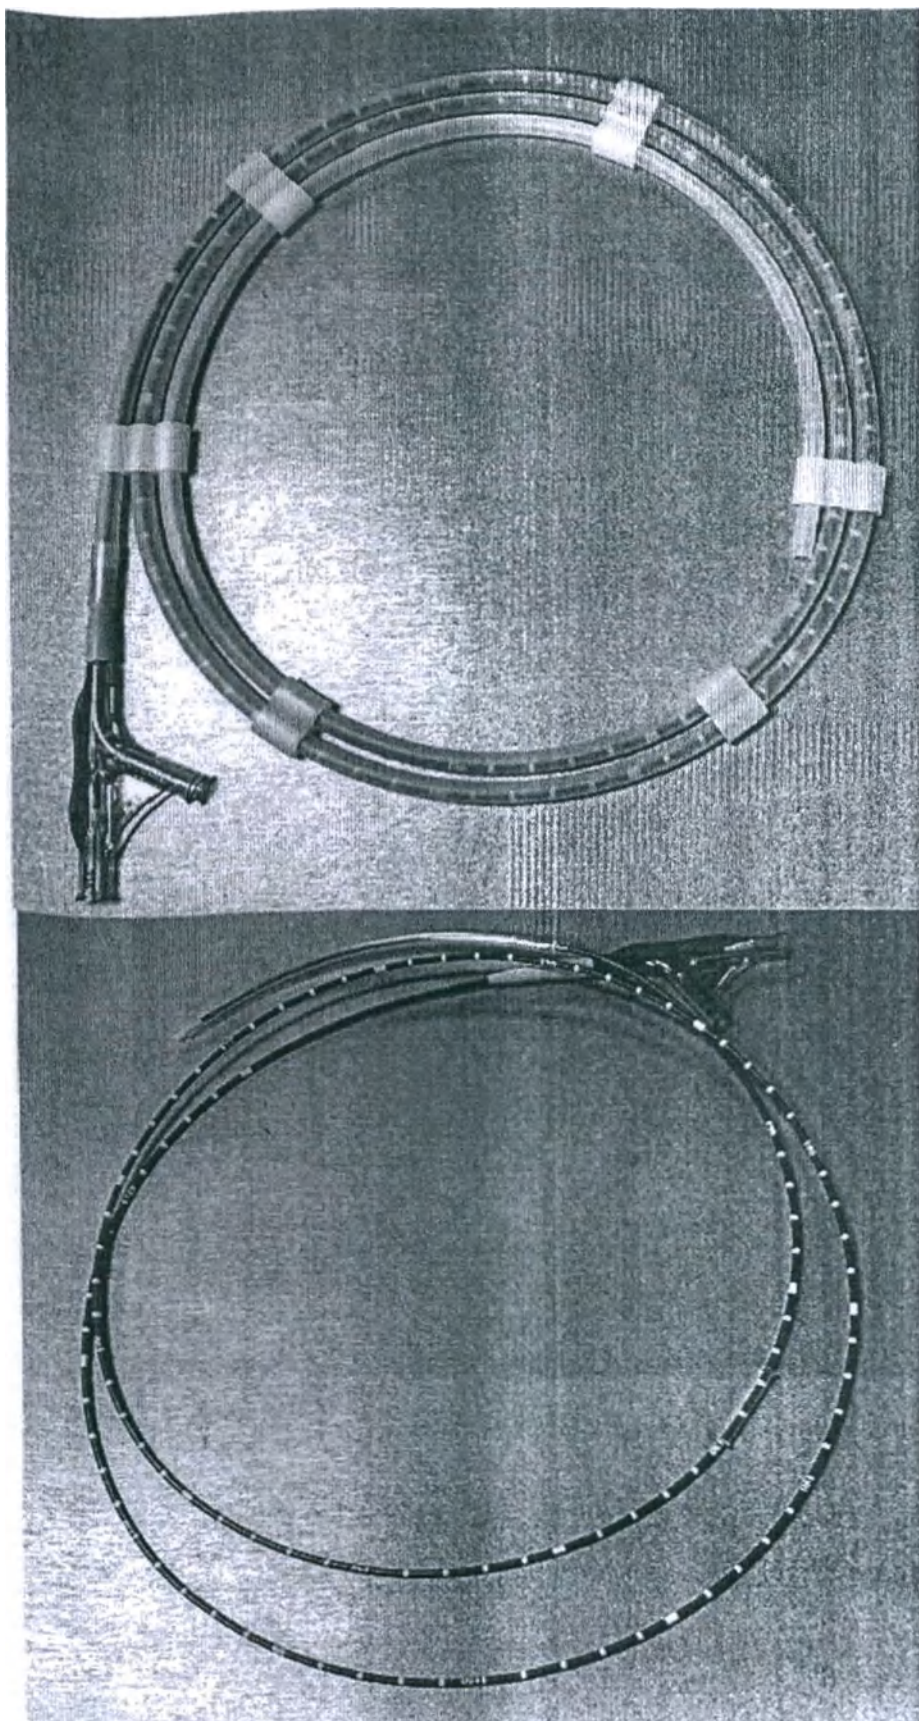


Фото 2 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse[®] 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики: Длина катетера 130 см - пример внешнего вида



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21.MIT26 от 22.07.2015



Фото 3 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики:
Длина катетера 75 см - *пример внешней упаковки изделия*



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

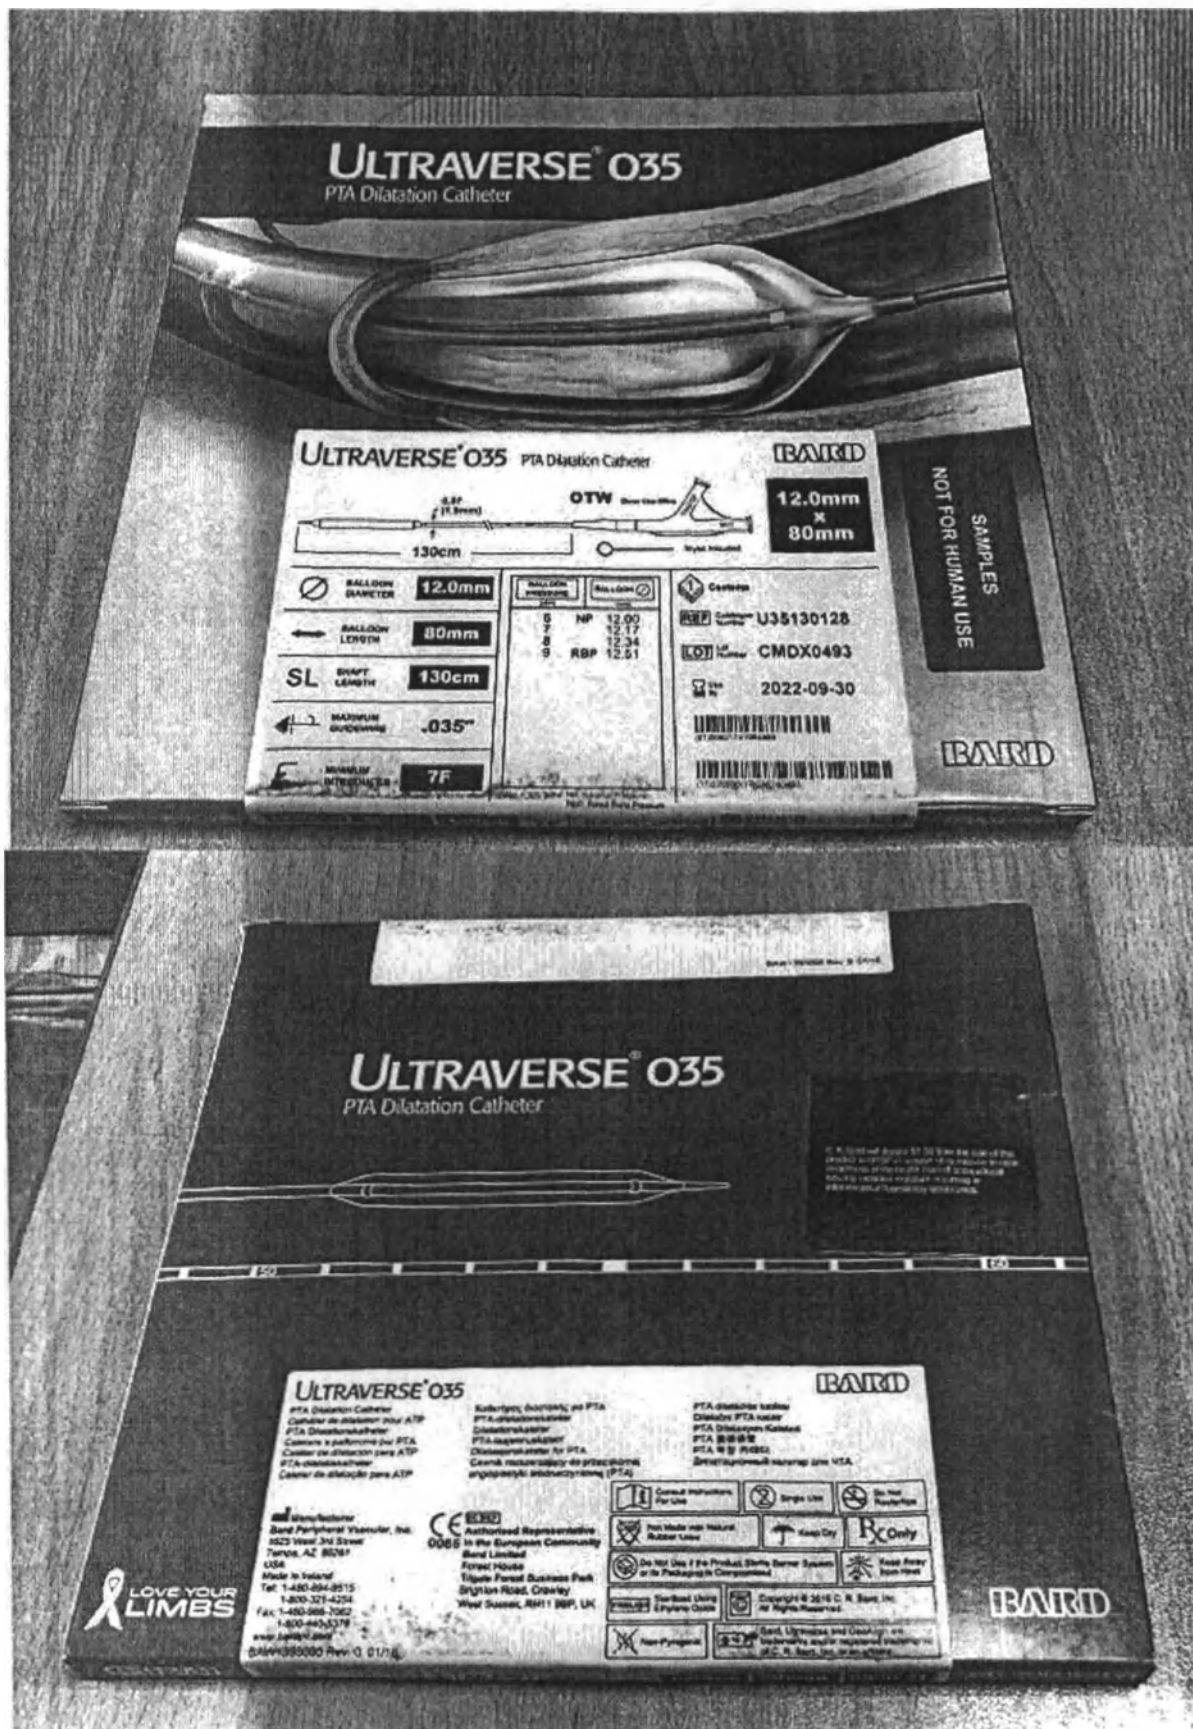


Фото 4 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслуминальной ангиопластики: Длина катетера 130 см - пример внешней упаковки изделия



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



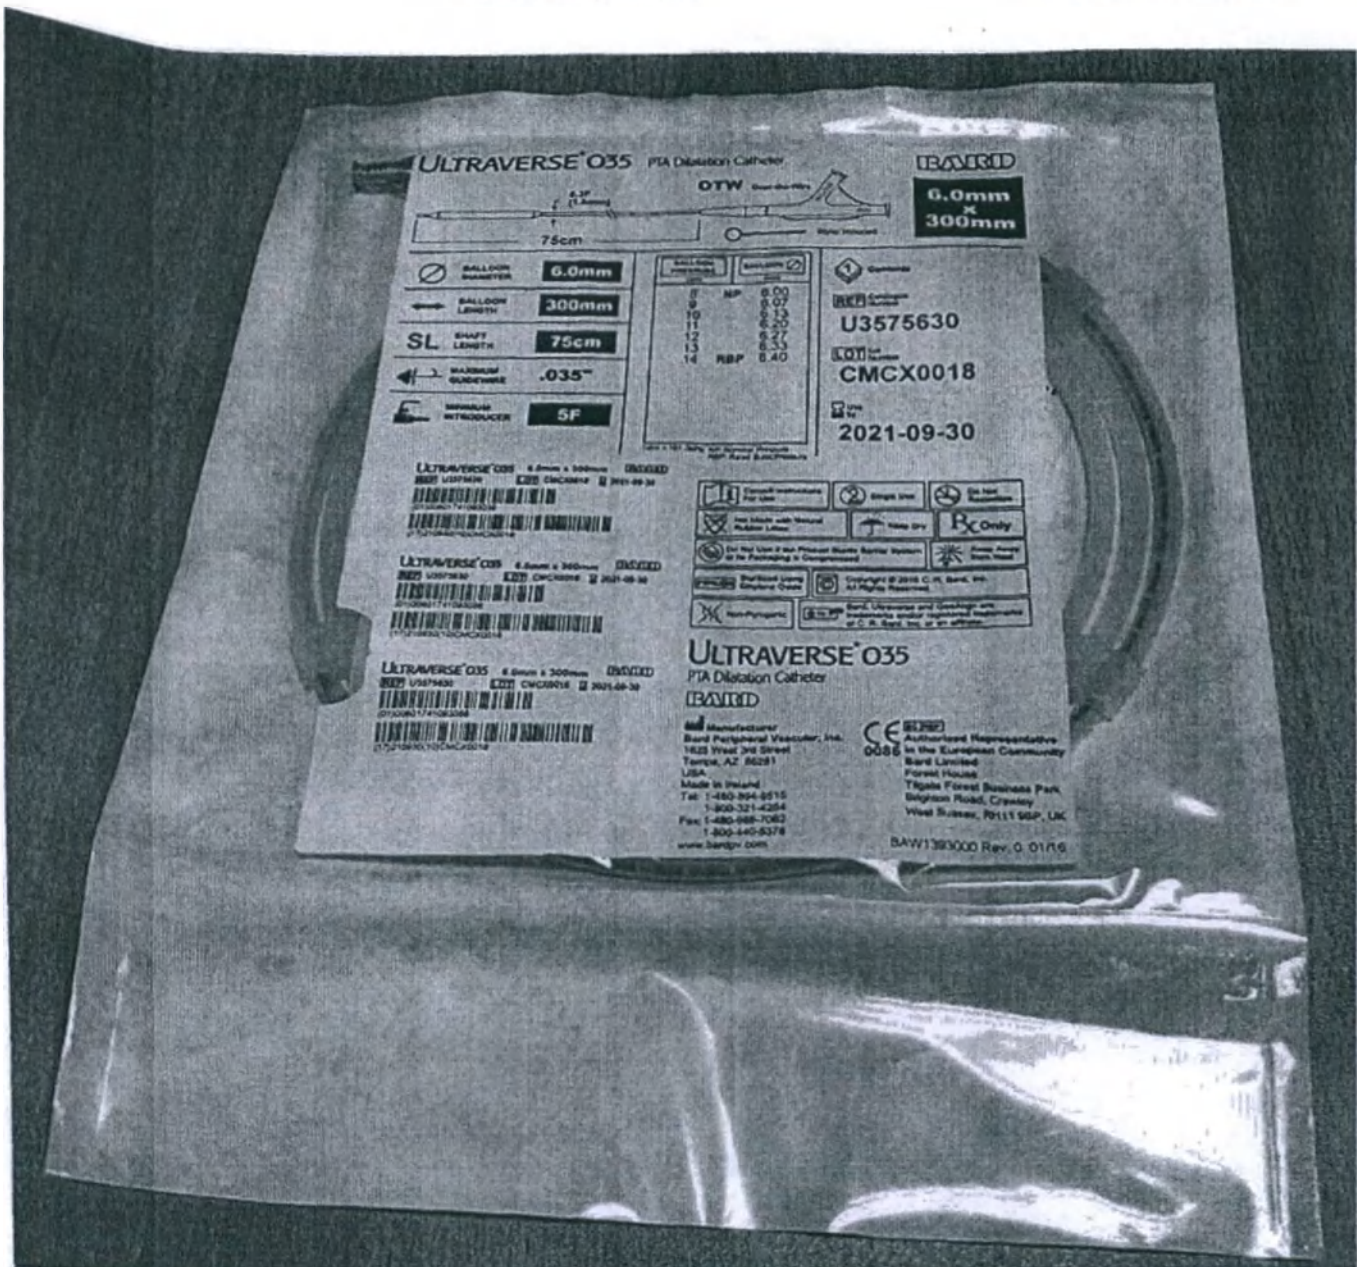


Фото 5 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики: Длина катетера 75 см, размер баллона: 6 x 300 мм –первичная упаковка и маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015





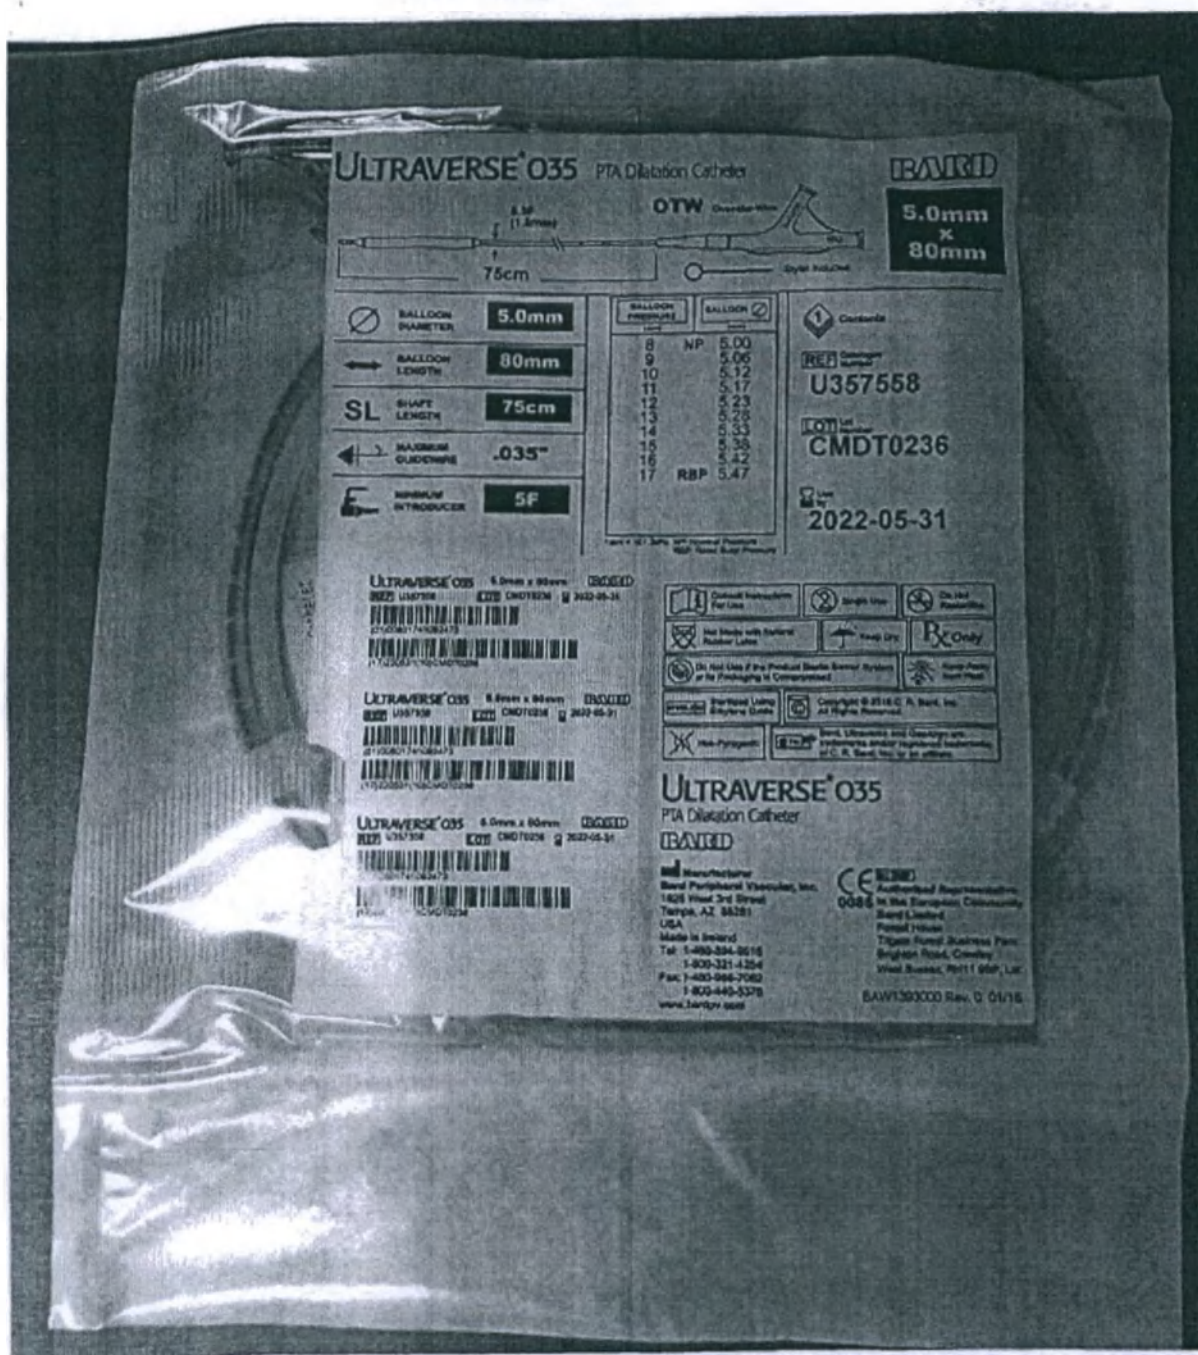


Фото 8 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики: Длина катетера 75 см, размер баллона: 5 x 80 мм – первичная упаковка и маркировка образца

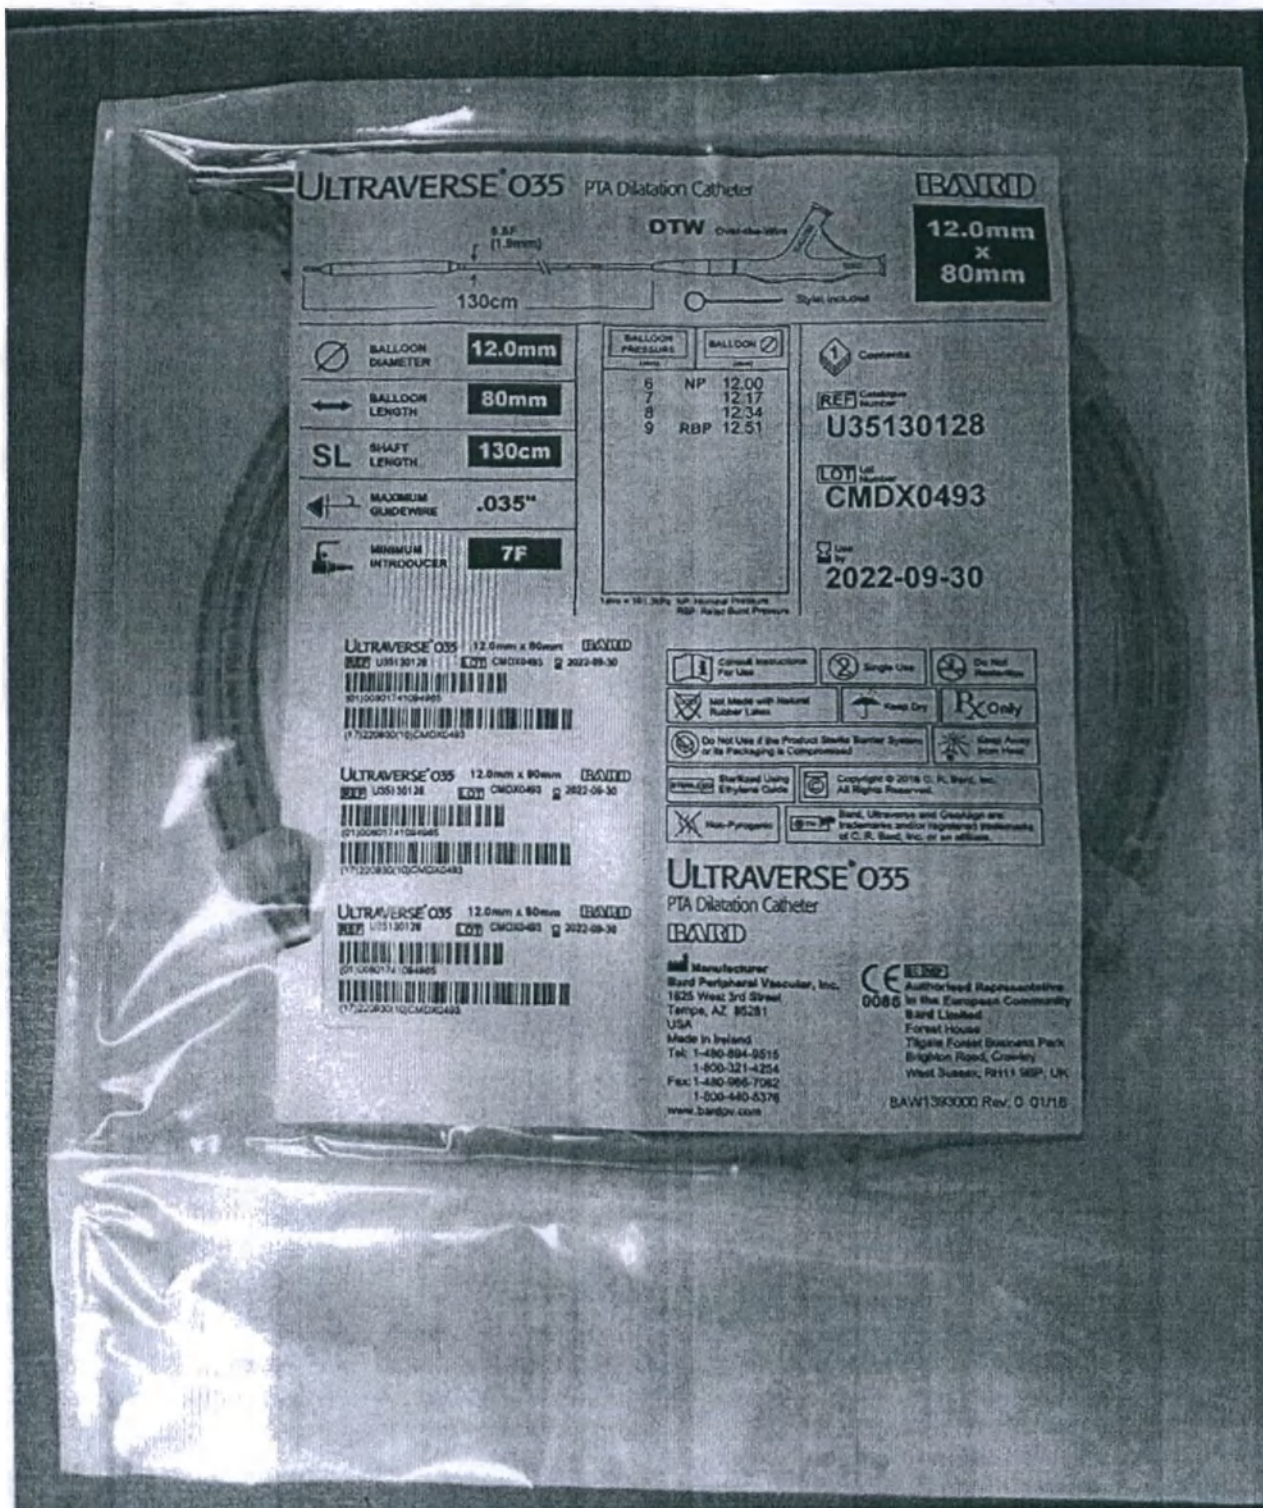


Фото 9 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики: Длина катетера 130 см, размер баллона: 12 x 80 мм –первичная упаковка и маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015


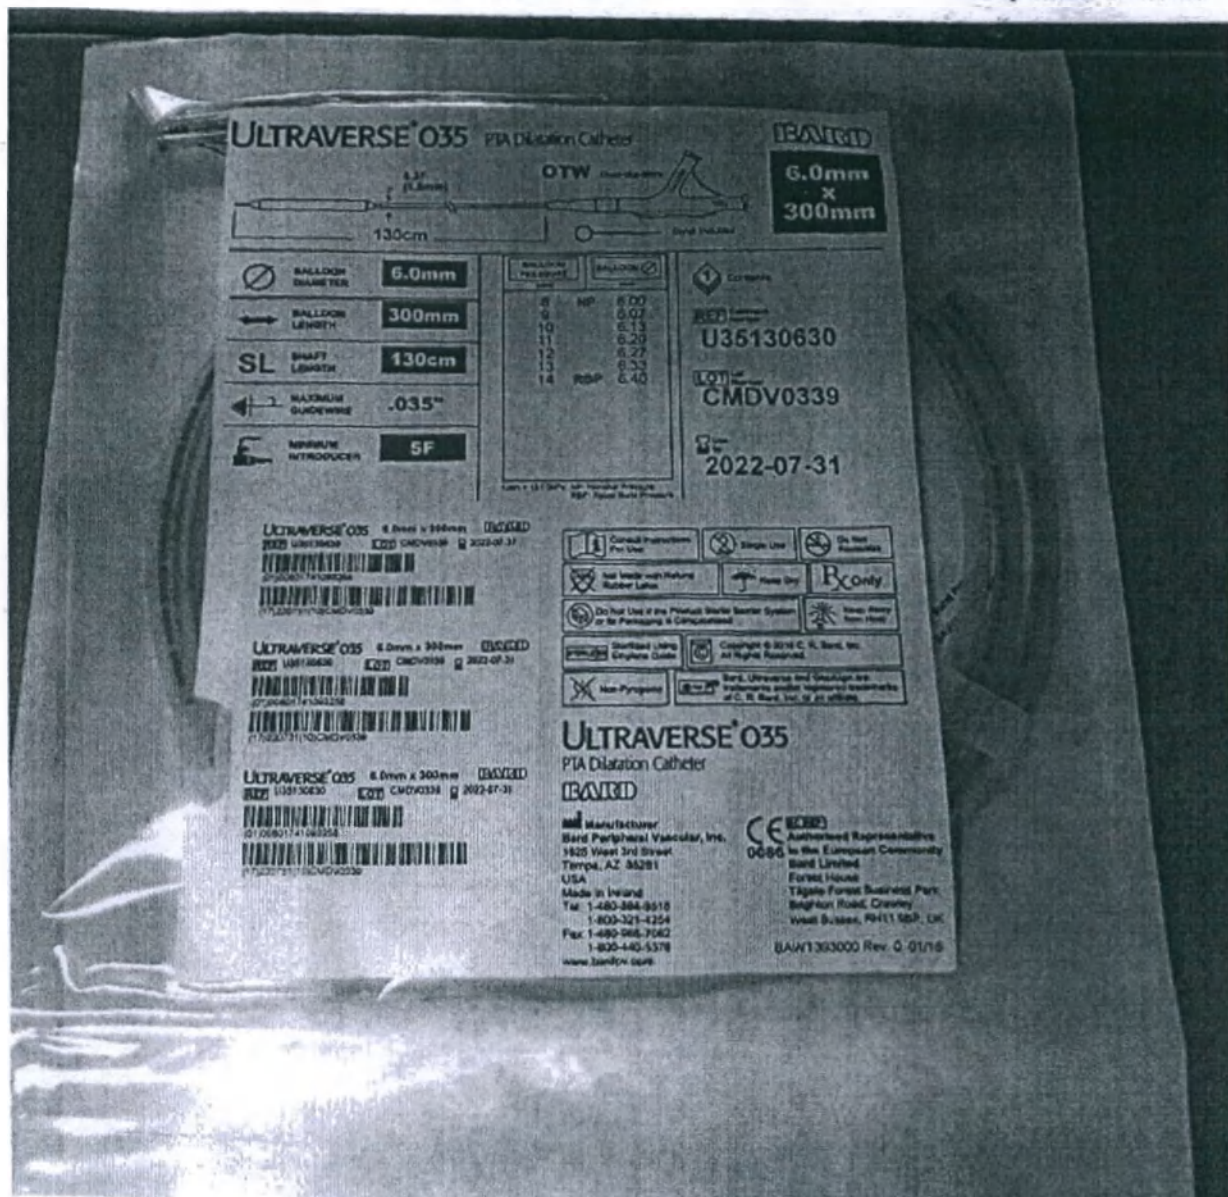


Фото 10 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики: Длина катетера 130 см, размер баллона 6 x 300 мм –первичная упаковка и маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015


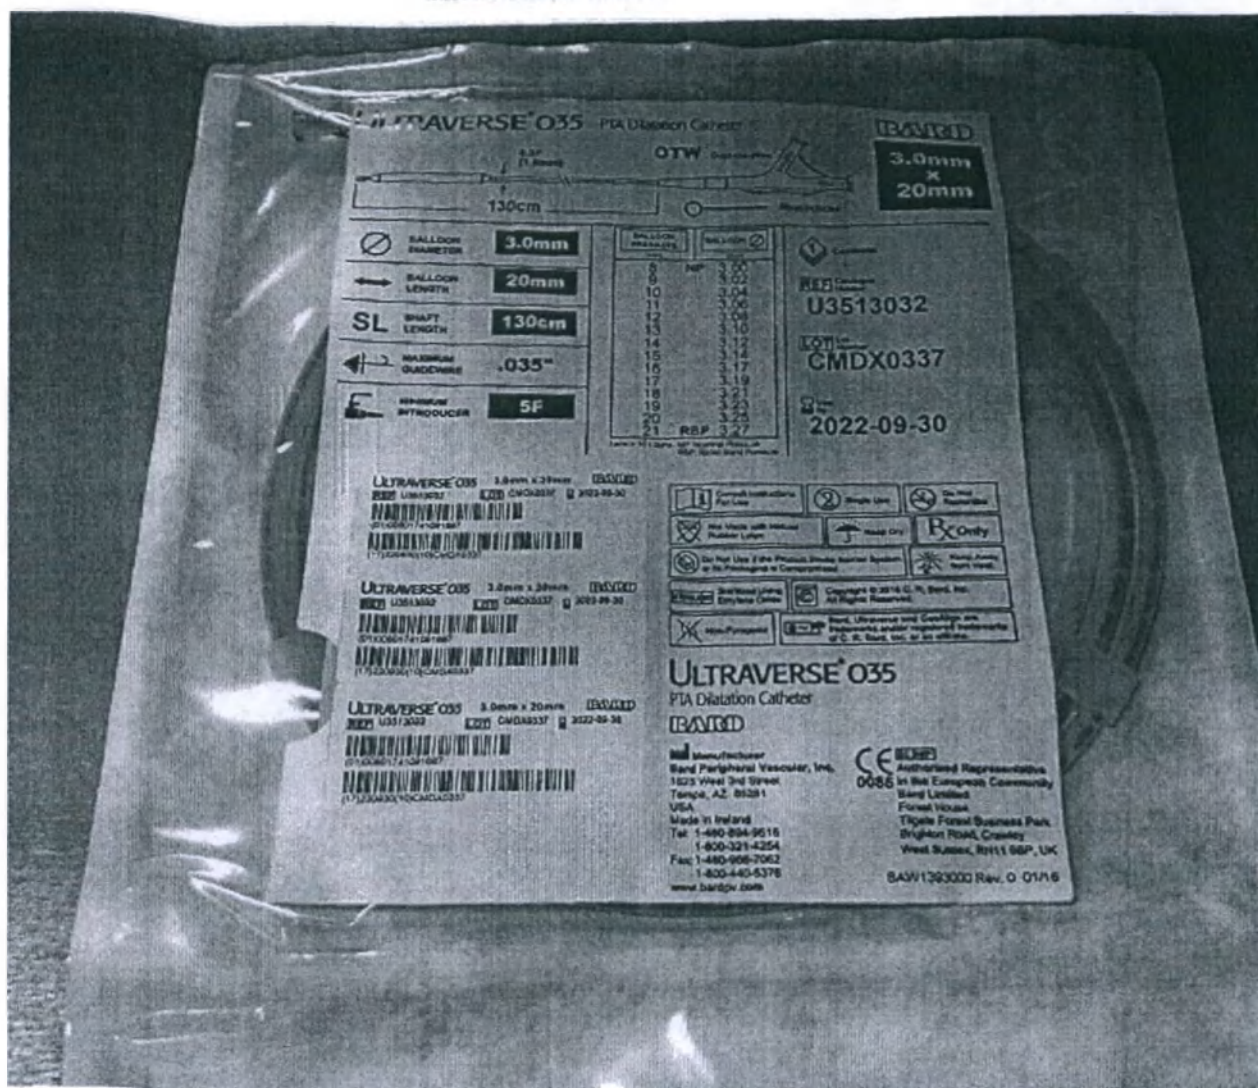


Фото 11 - Катетер баллонный дилатационный Ultraverse® 035 для чрескожно-транслюминальной ангиопластики: Длина катетера 75 см, размер баллона: 3 x 20 мм—первичная упаковка и маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено



печатью _____ листов

В.А. Кочегов