

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) по ТУ 9442-015-42254364- 2005

Макеты маркировки

Версия 4 от 29.06.2022

Основная маркировочная табличка



Дополнительная маркировка с электрическими параметрами

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 1 модификация ПроГраф-4000) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 12 кВА Кажущееся сопротивление – 1 Ом Напряжение – 220 В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 1 модификация ПроГраф-4000) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 24 кВА Кажущееся сопротивление – 0,6 Ом Напряжение – 380 В 3~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 1 модификация ПроГраф-5000) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 12 кВА Кажущееся сопротивление – 1 Ом Напряжение – 220 В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 1 модификация ПроГраф-5000) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 48 кВА Кажущееся сопротивление – 0,3 Ом Напряжение – 380 В 3~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 1 модификация ПроГраф-7000) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 12 кВА Кажущееся сопротивление – 1 Ом Напряжение – 220 В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B 

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 1 модификация ПроГраф-7000) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 117 кВА Кажущееся сопротивление – 0,12 Ом Напряжение – 380 В 3~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B 

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 2) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 12 кВА Кажущееся сопротивление – 1 Ом Напряжение – 220 В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B 

Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРЦ-РП (ПроГраф) (исполнение 2) ТУ 9442-015-42254364-2005	
Потребляемая мощность – 24 кВА Кажущееся сопротивление – 0,6 Ом Напряжение – 380В 3~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	IP20B 

Директор АО «РЕНТГЕНПРОМ»



А.Н. Гуржиев

29.06.2022

Всего прошито и пронумеровано
2 (два) листов


Исполнительный директор
АО "РЕНТГЕНПРОМ"
Сявбянов Мансур Рафитович



Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов
стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой

АРГЦ-РП (ПроГраф)

Фото общего вида со штативом с горизонтальной траверсой универсальным (АСЛВ 38639.731.000)

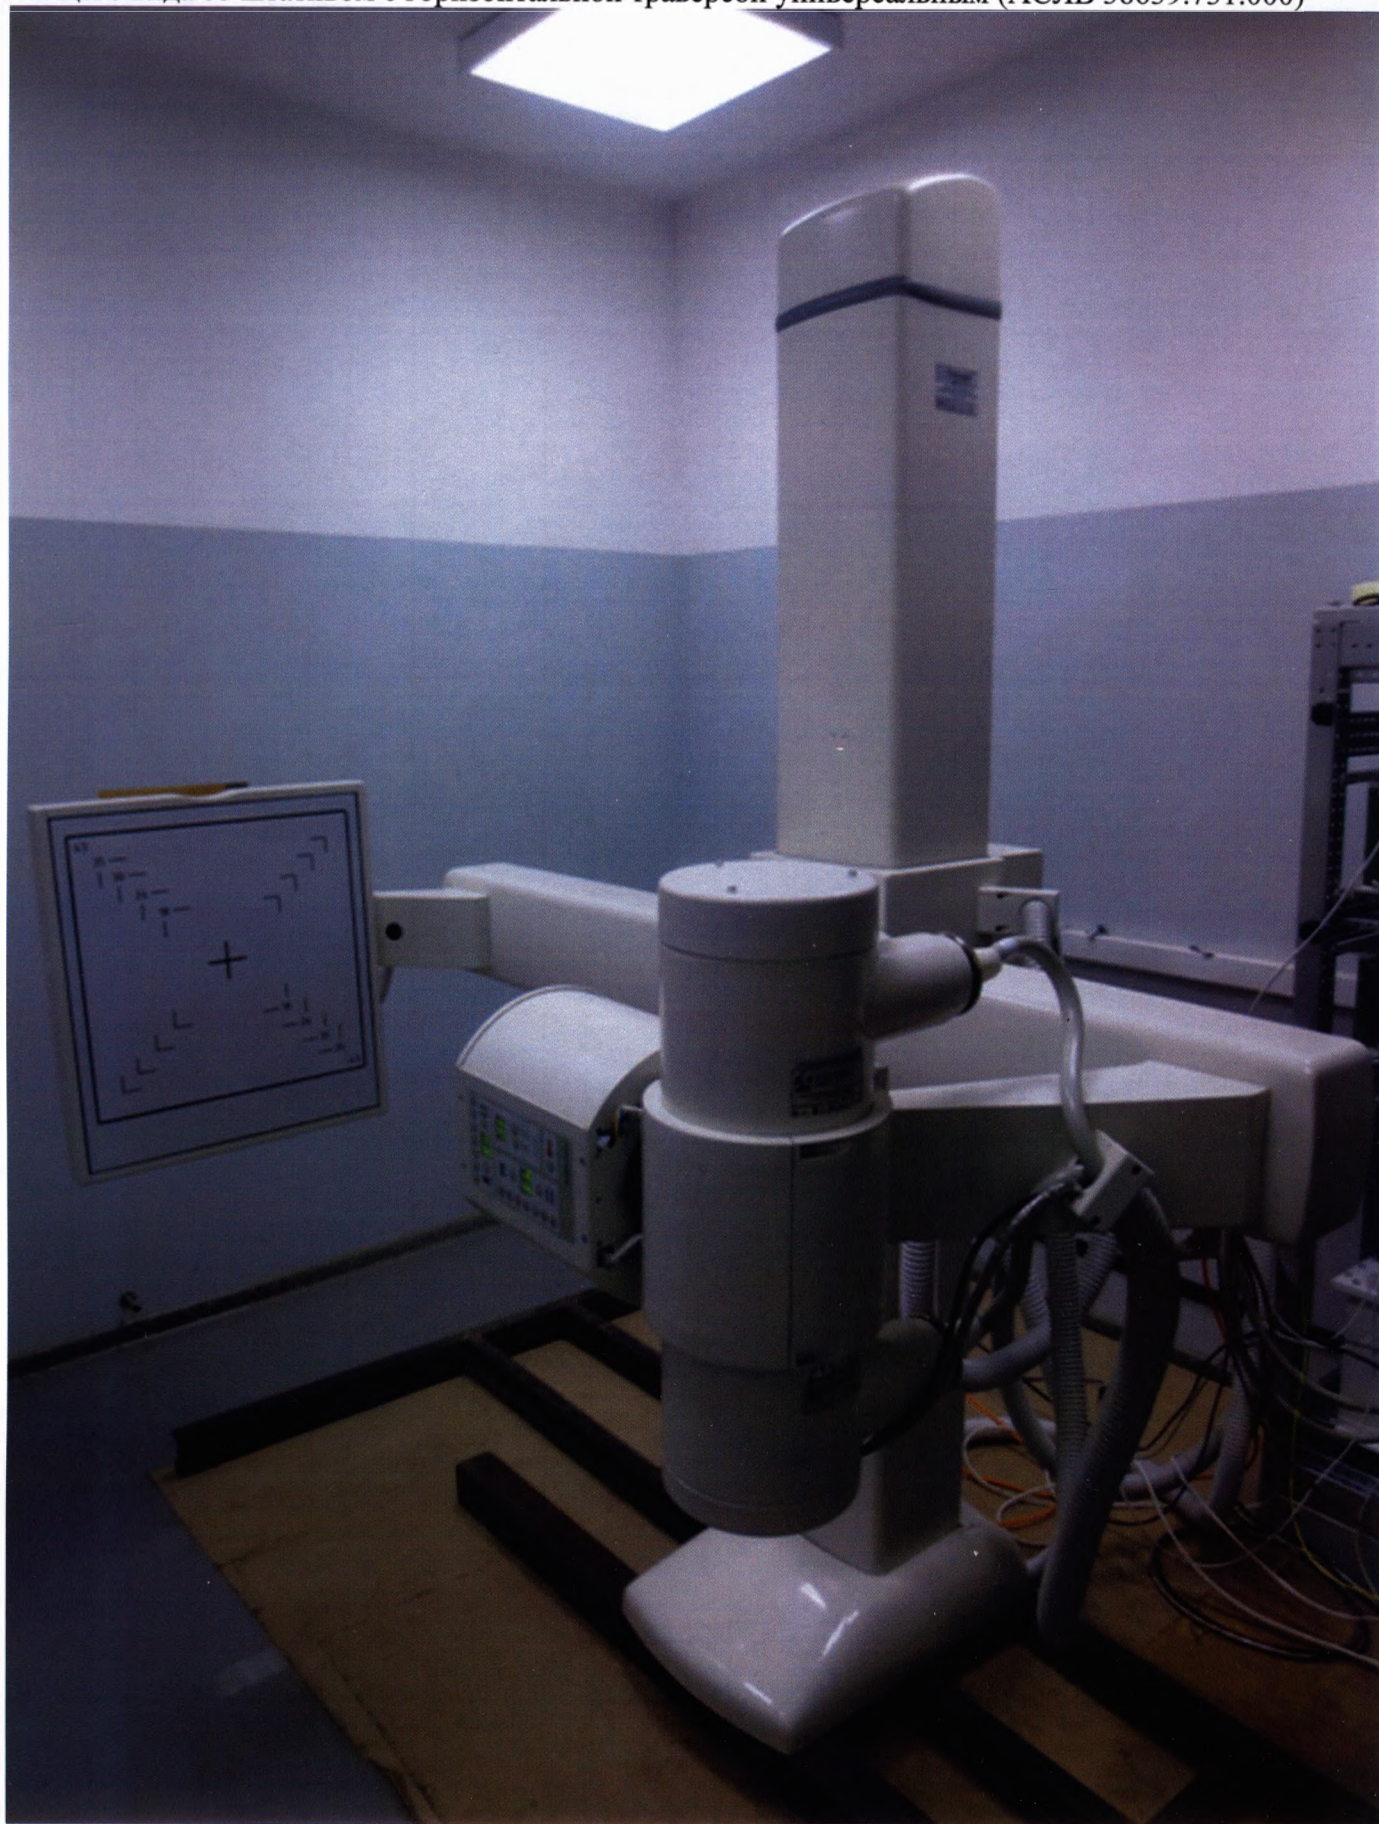

Маркировка Аппарата рентгенографического цифрового для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой
АРГЦ-РП (ПроГраф)






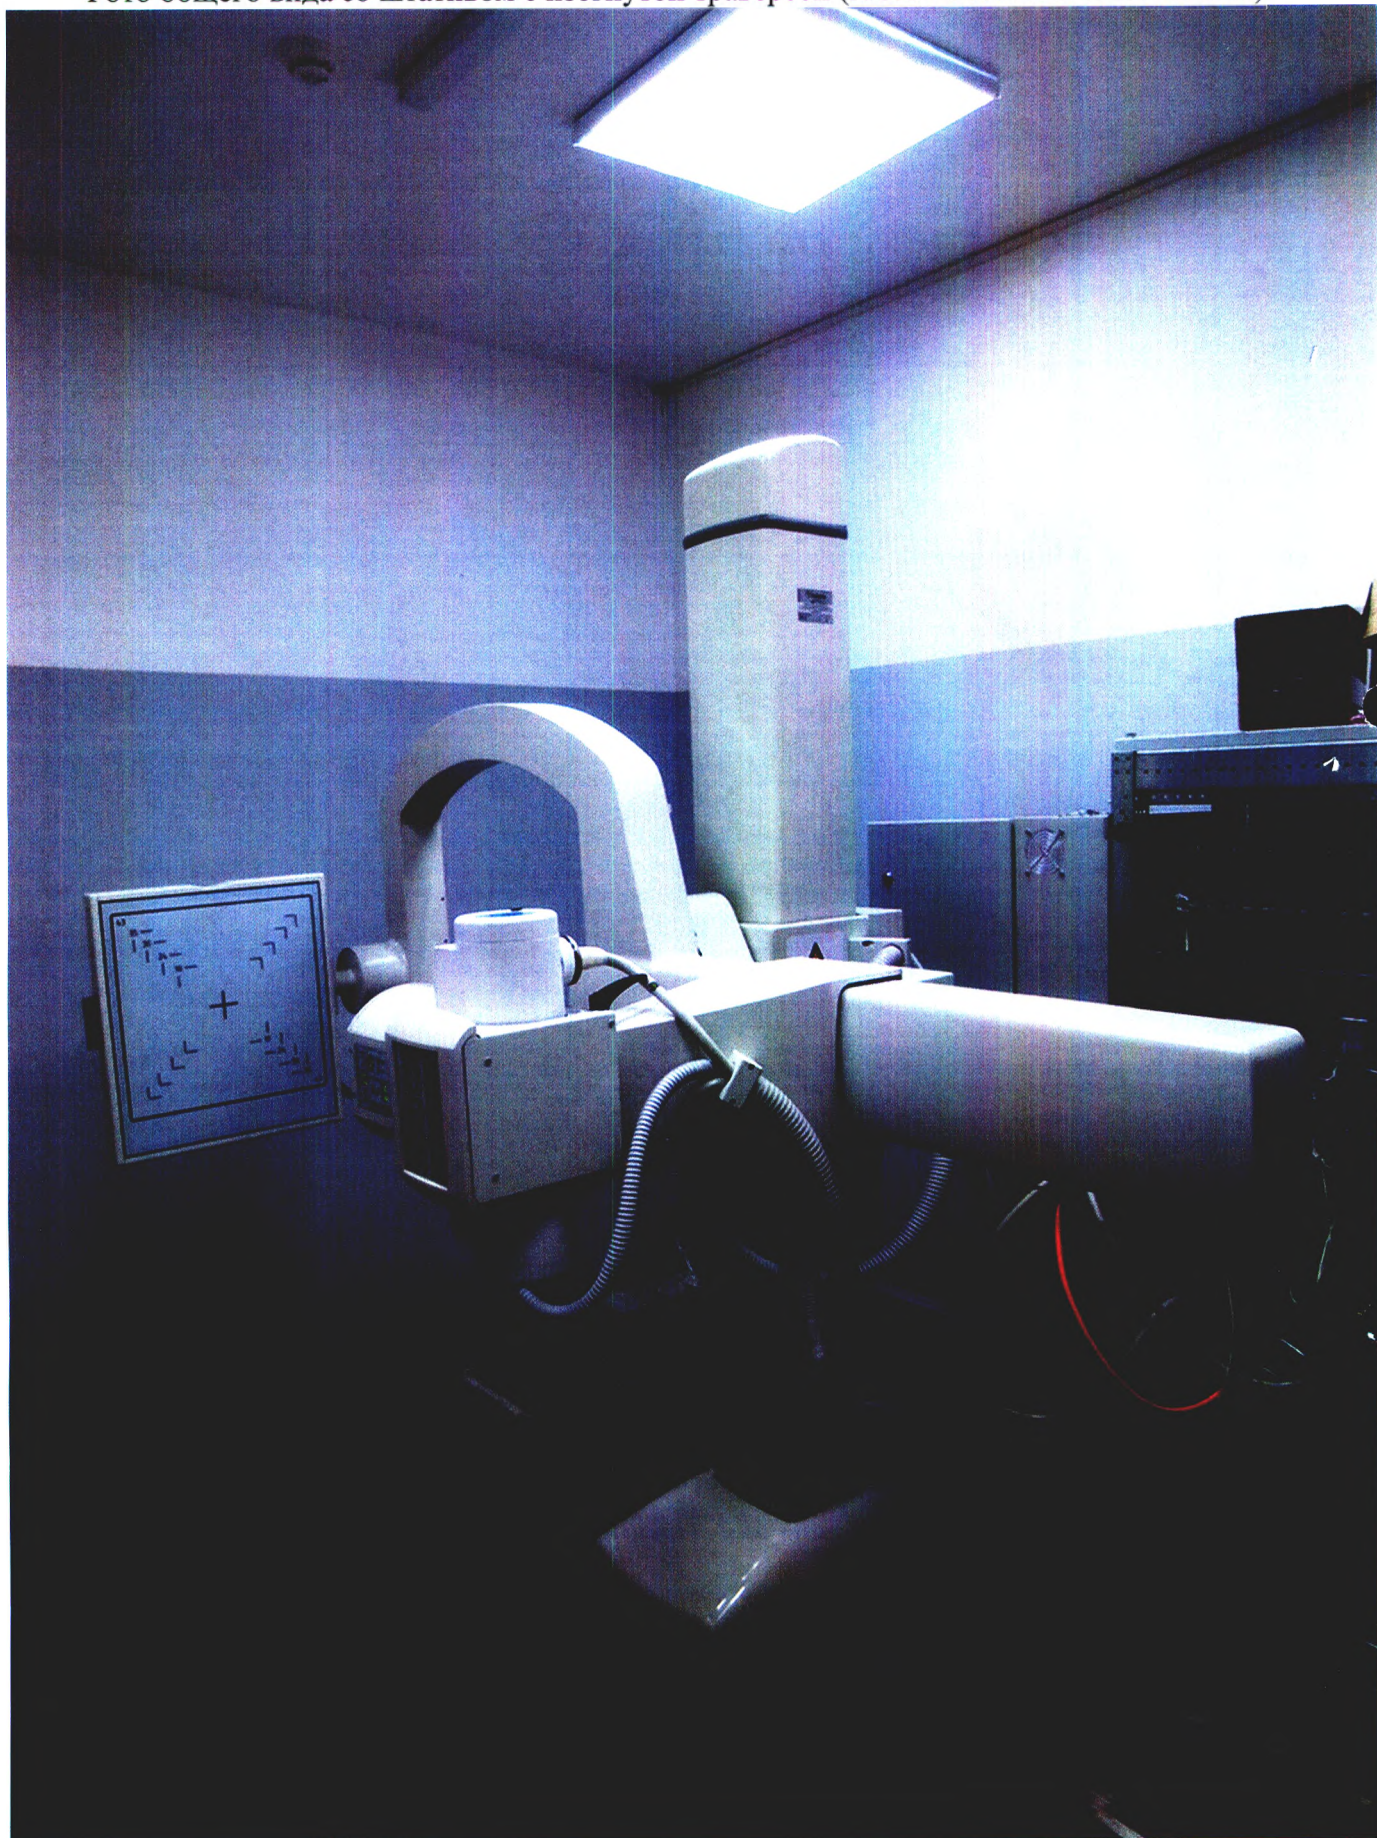


Фото общего вида со штативом на телескопической колонне простым (АСЛВ
38639.015.685.100.000)





Фото общего вида со штативом на телескопической колонне универсальным (АСЛВ 38639.038.737.100.000)

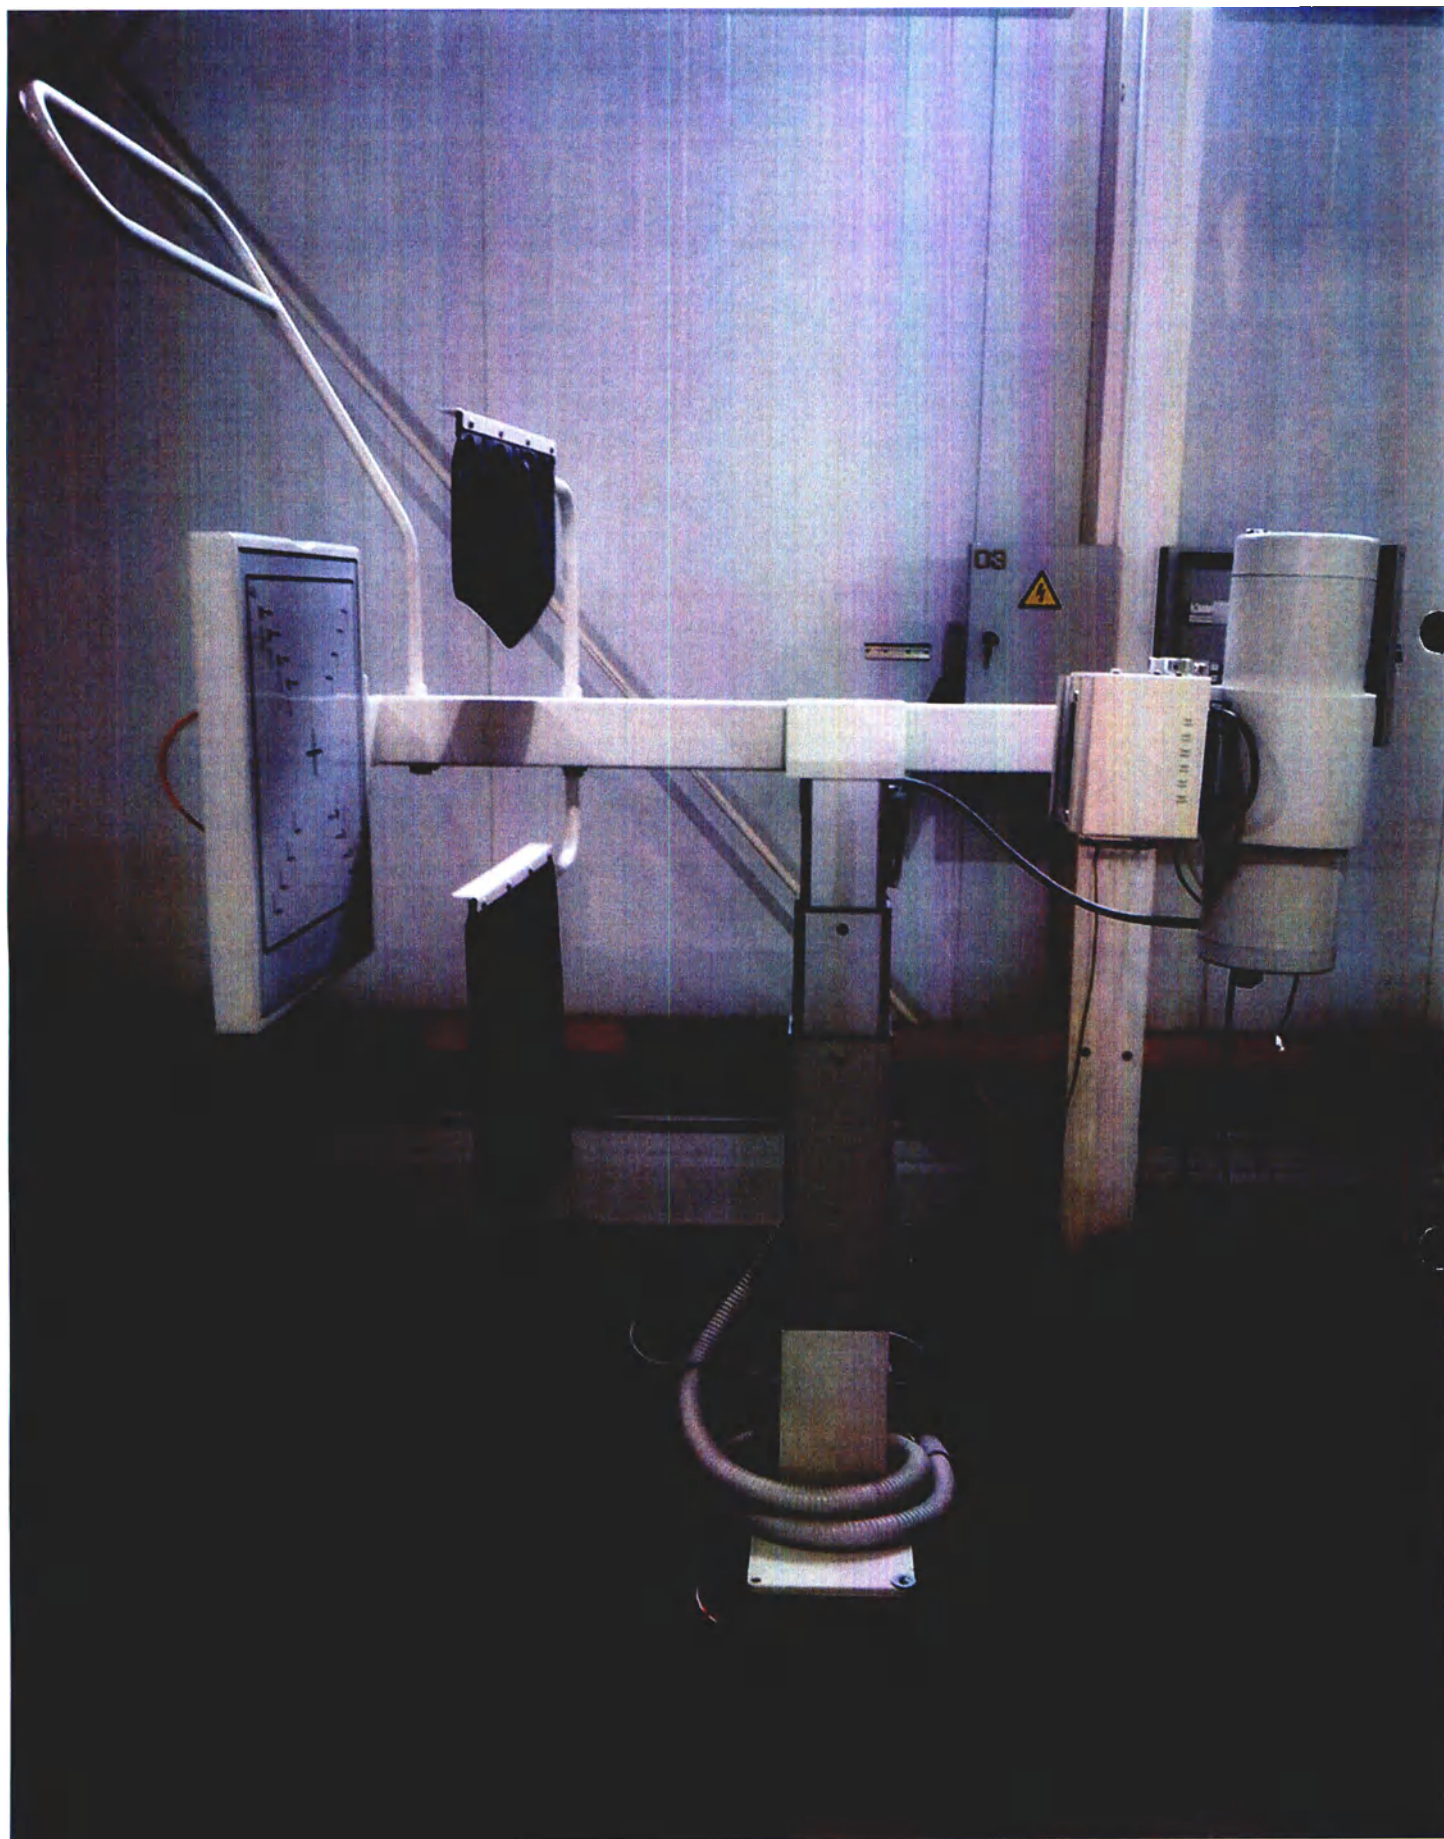


2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой




Маркировка стола-каталки с рентгенопрозрачной декой

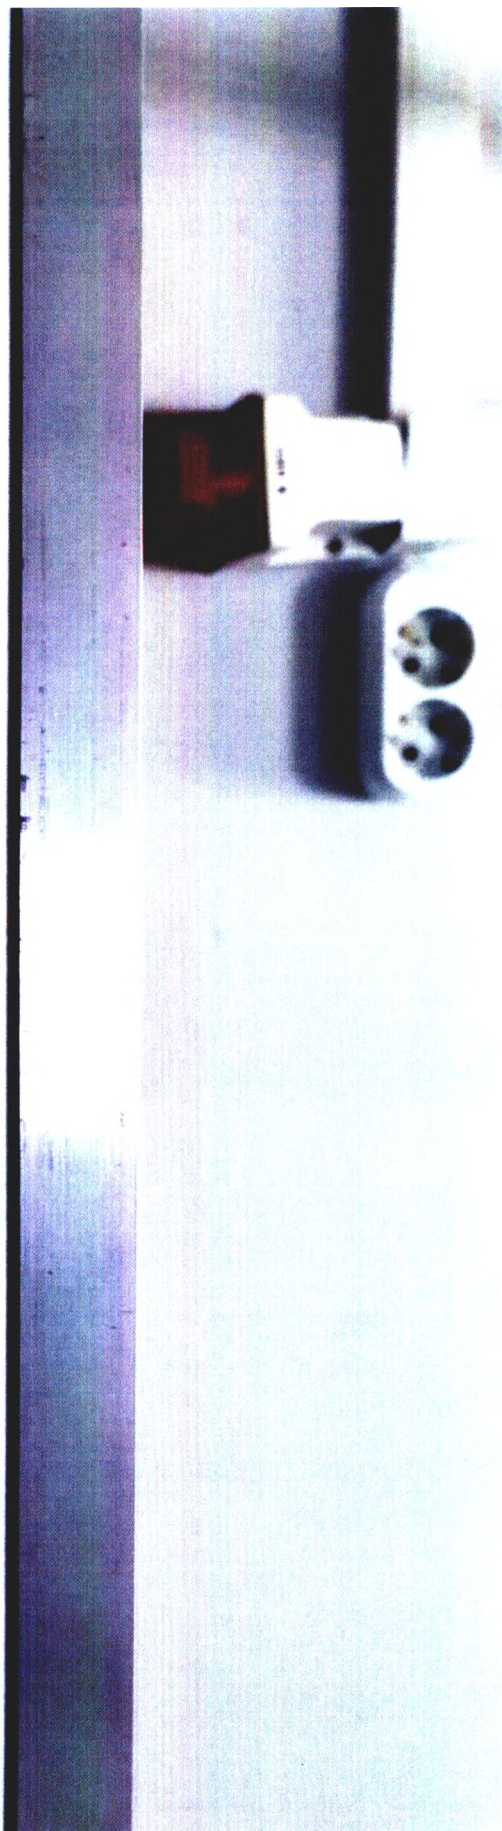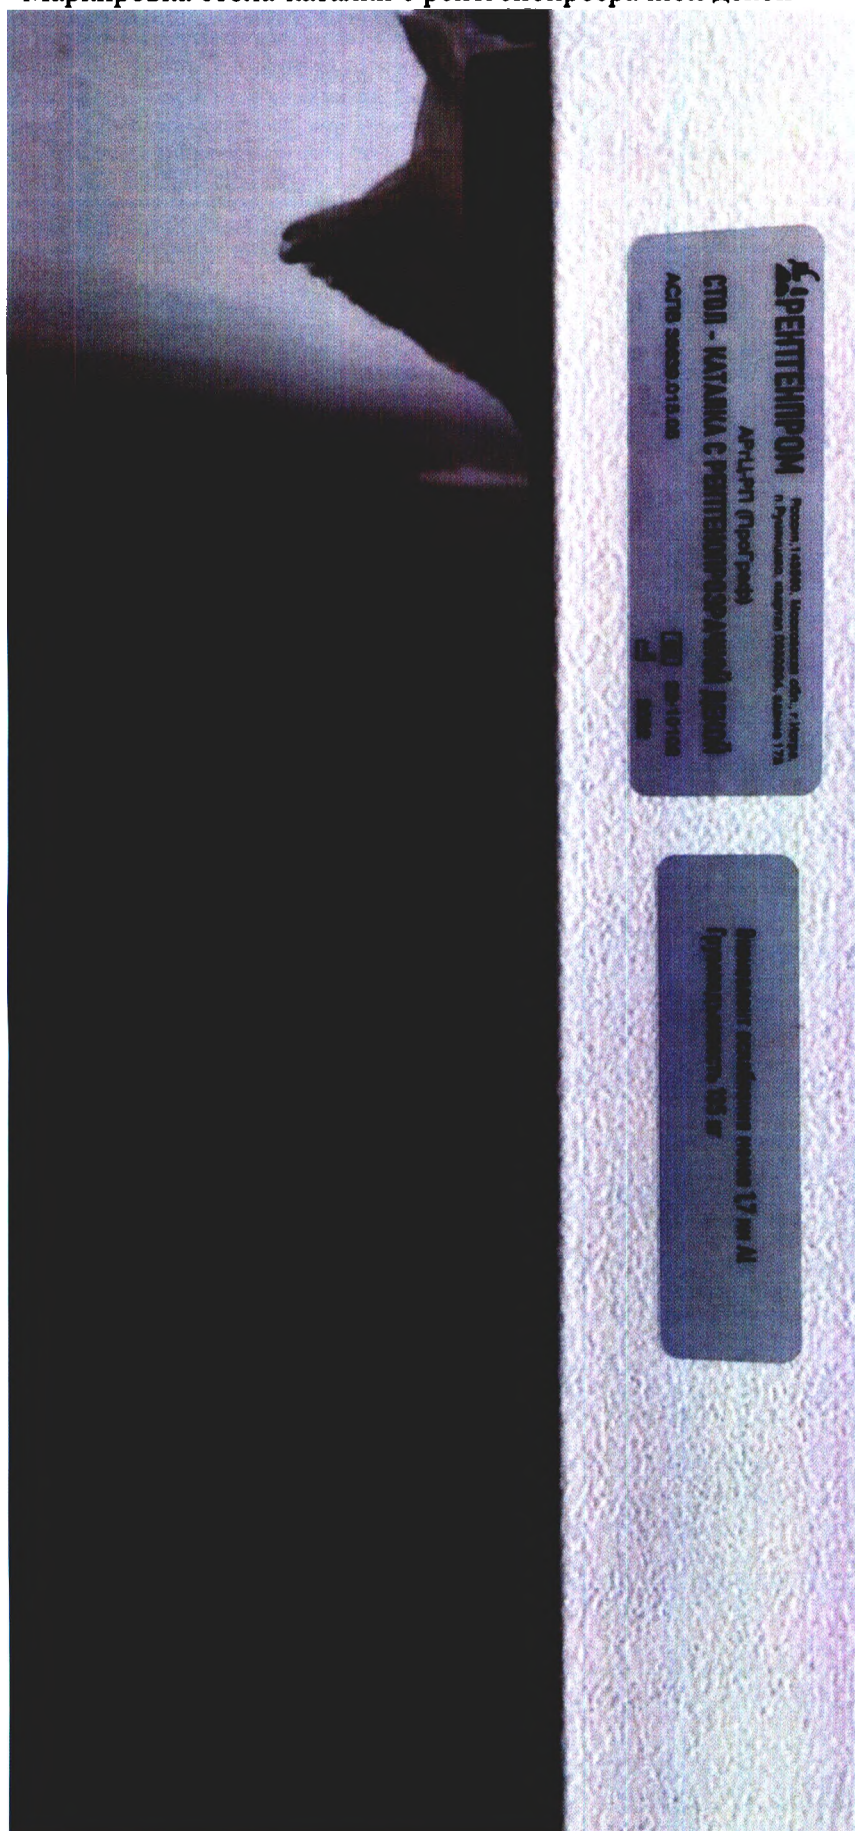

3. Камера рентгенографическая цифровая

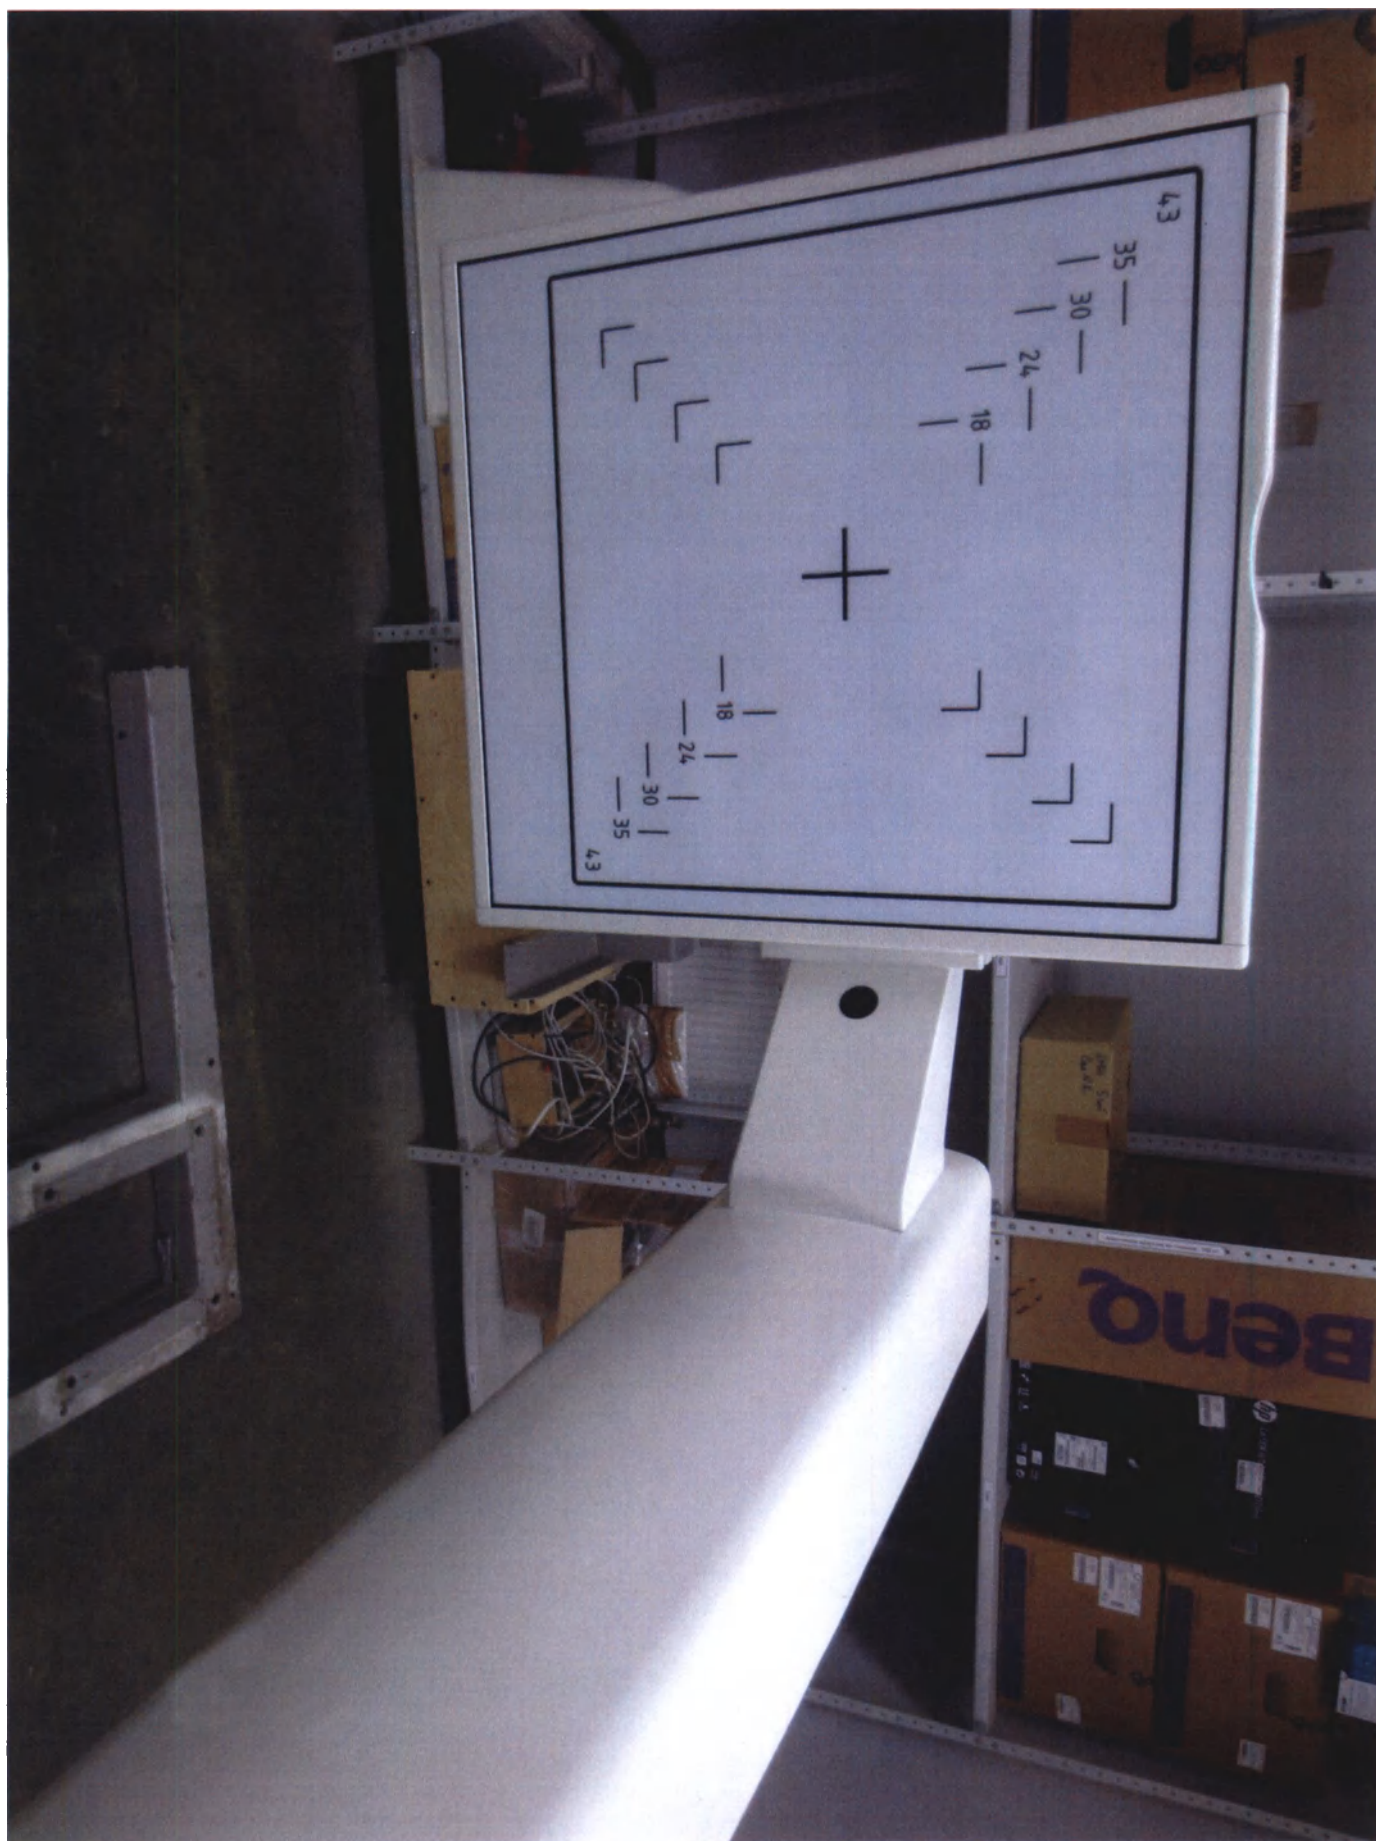


Маркировка камеры рентгенографической цифровой

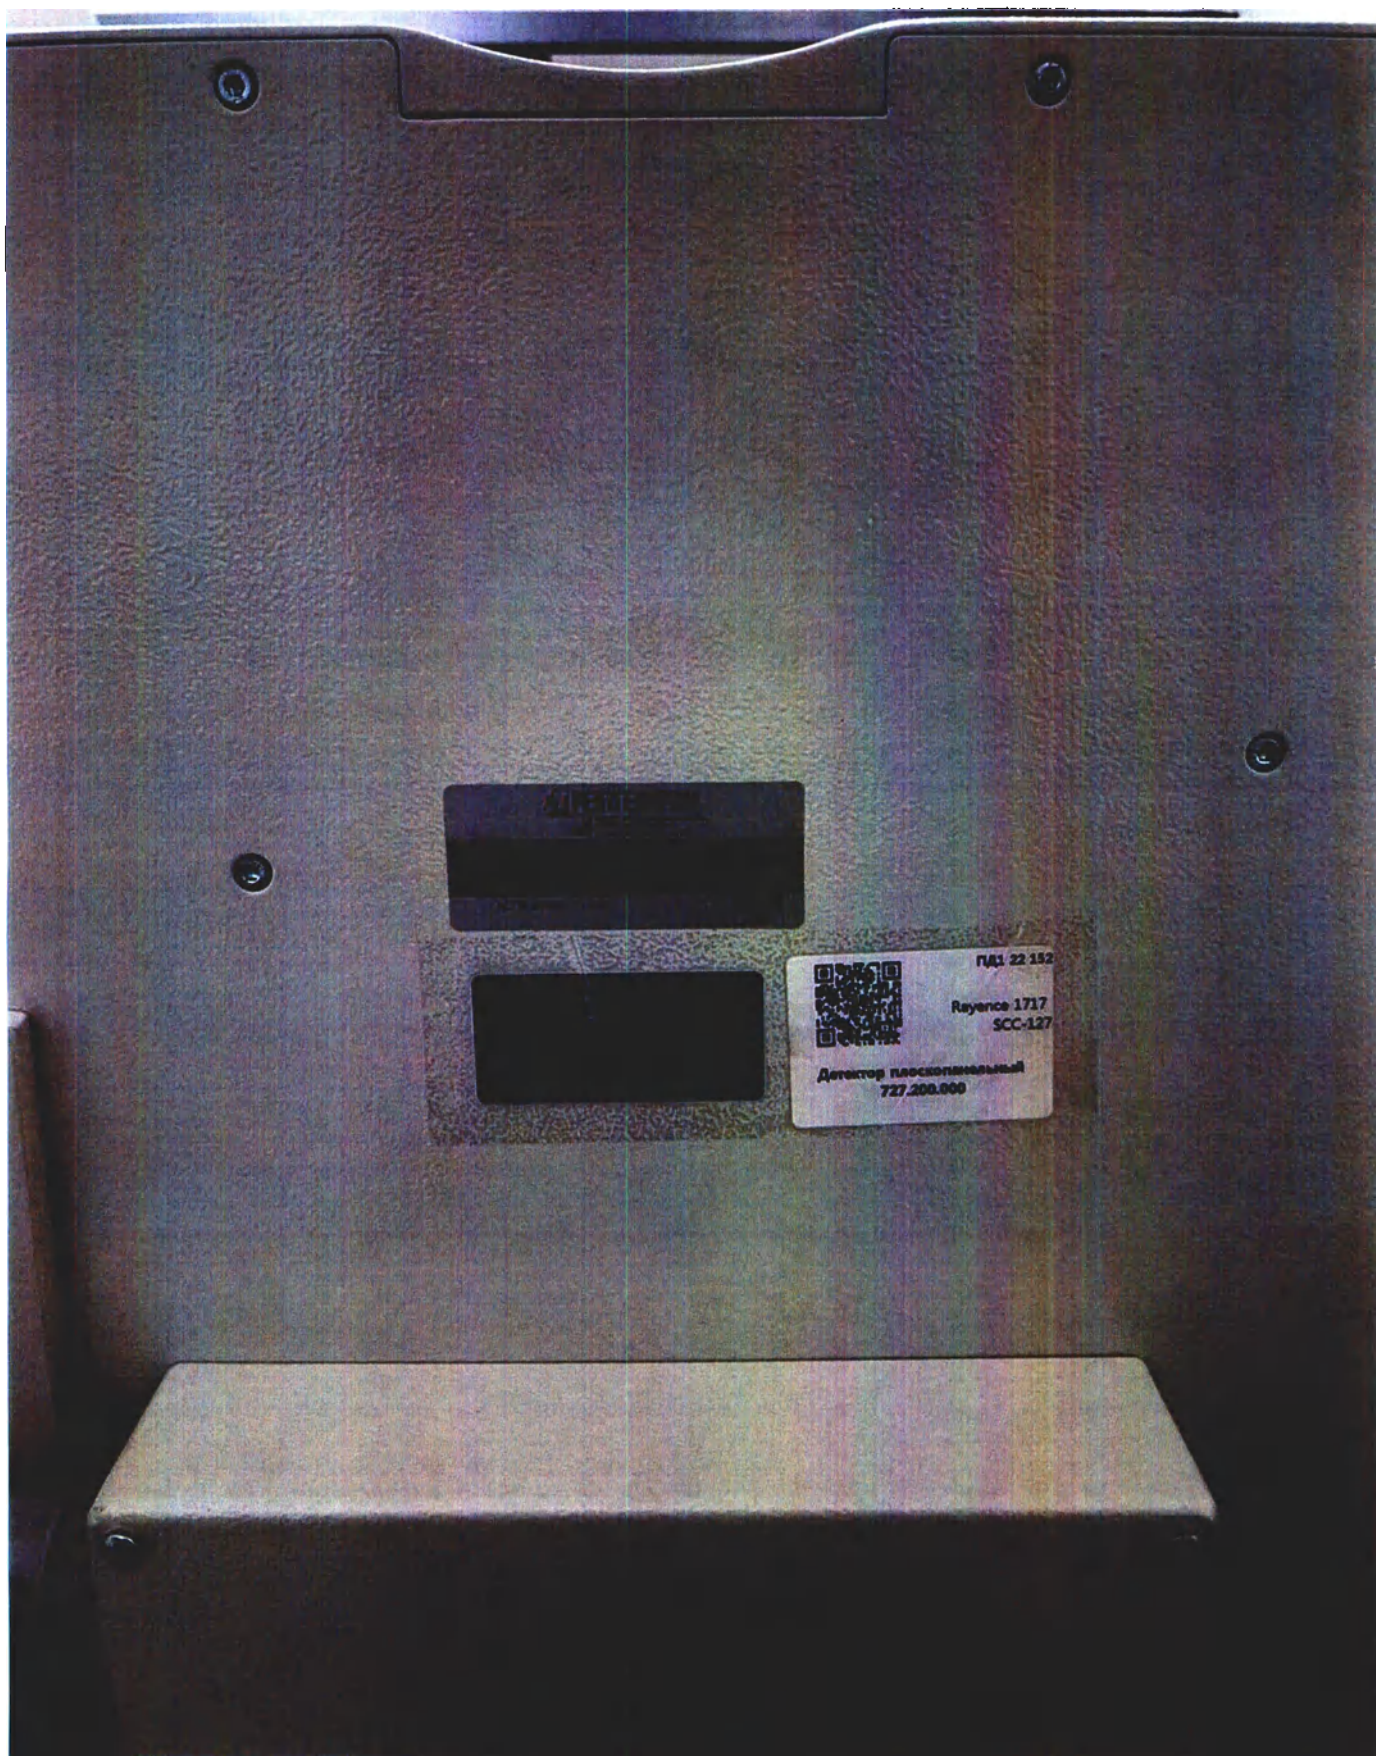

- 3.1.1. Сменный растр (на фокусное расстояние 86,36 см -111,76 см);**



3.1.2. Сменный растр (на фокусное расстояние 101,6 см -182,88 см)

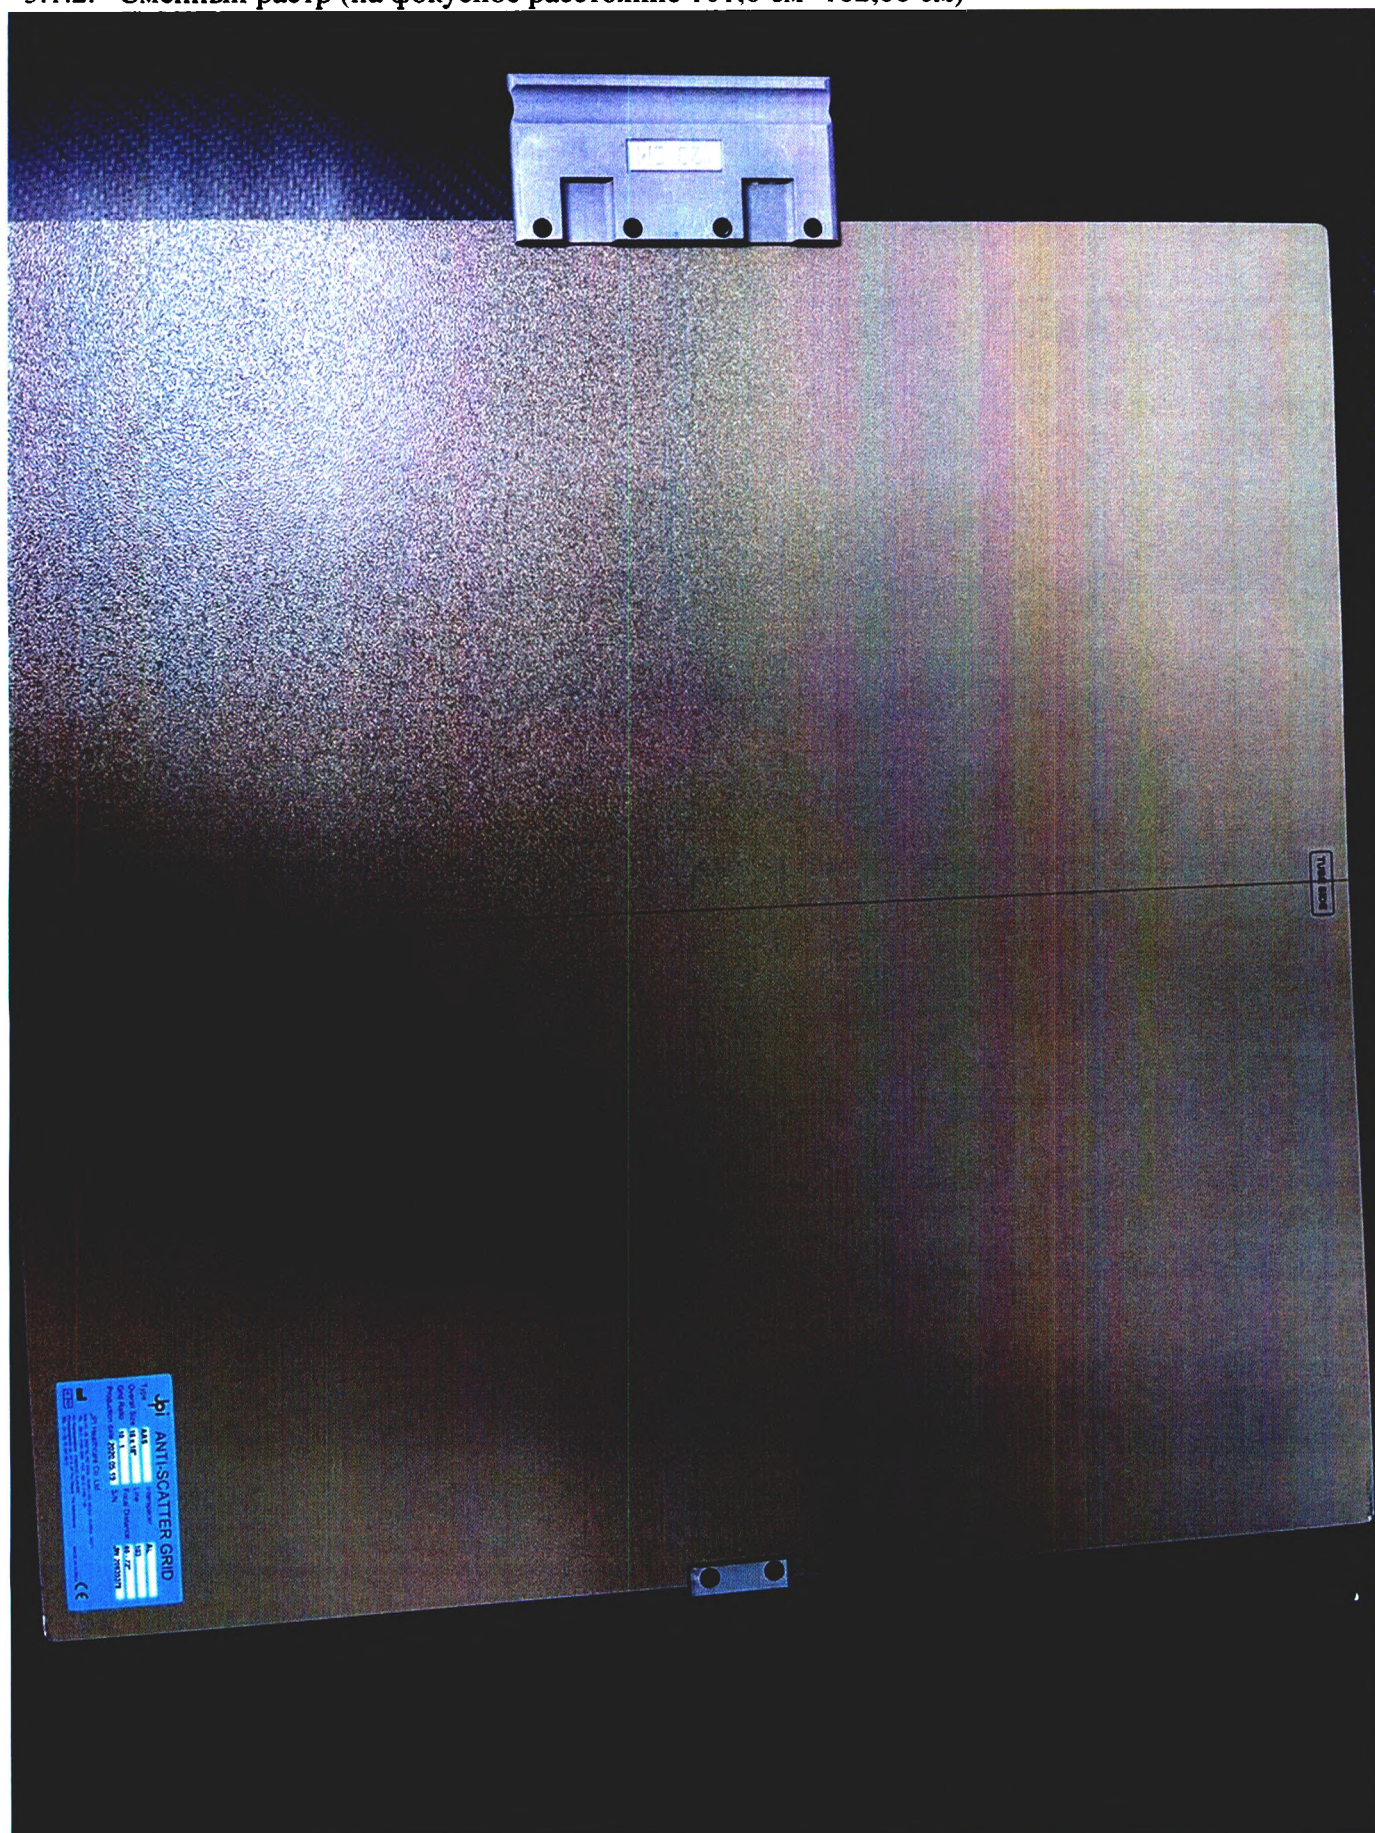

3.1.3. Сменный растр (на фокусное расстояние 121,92 см -182,88 см).



4. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП:




Маркировка Устройства рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП:



4.1. Комплекс средств управления на базе РС компьютера, укомплектованного монитором не менее 17" и программным обеспечением (АРМ 1).



Маркировка комплекса средств управления на базе РС компьютера, укомплектованного монитором не менее 17" и программным обеспечением (АРМ 1).

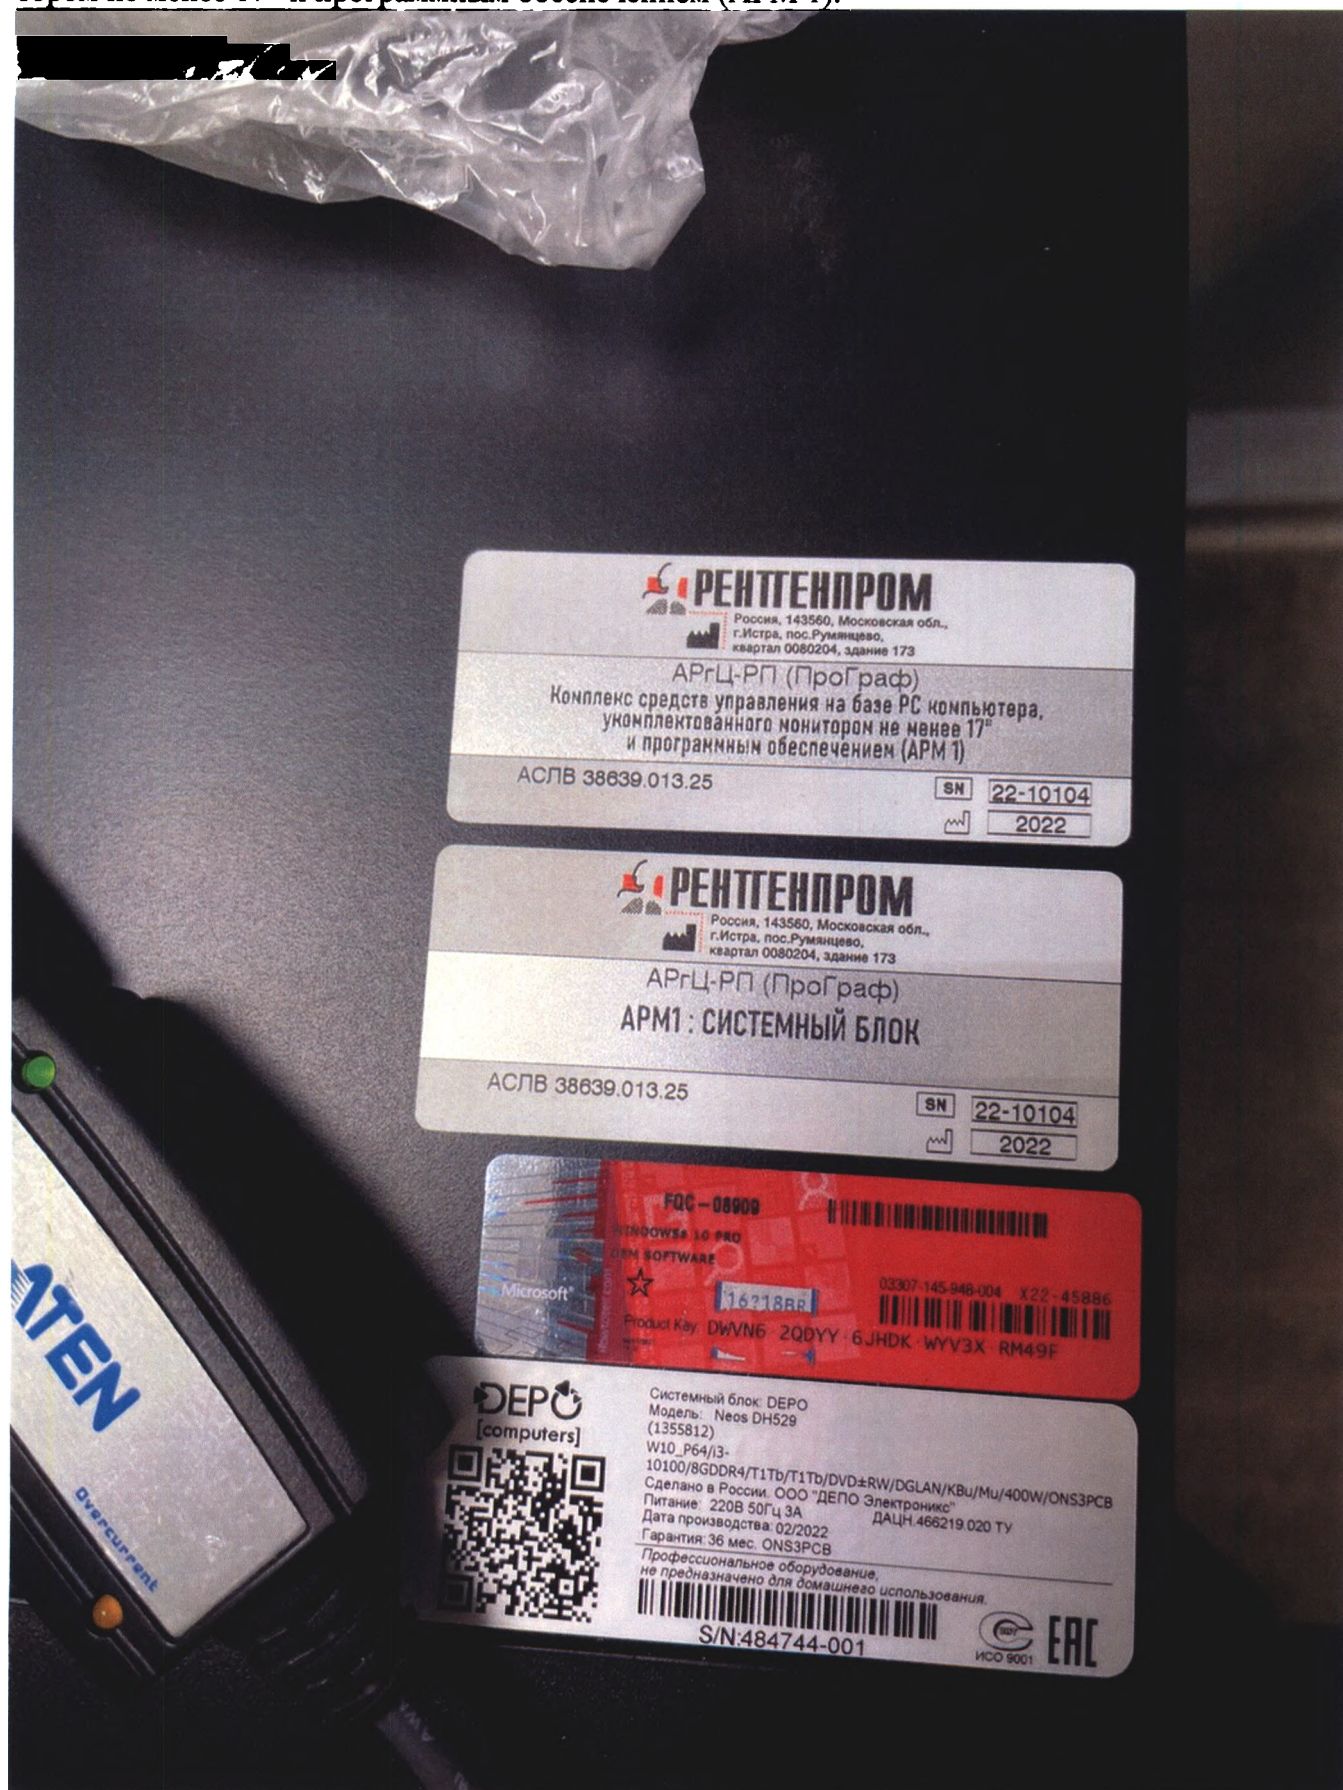

4.2. Излучатель (кожух с рентгеновский трубкой)




Маркировка излучателя (кожуха с рентгеновский трубкой)




4.3 Комплект высоковольтных кабелей



4.4 Коллиматор

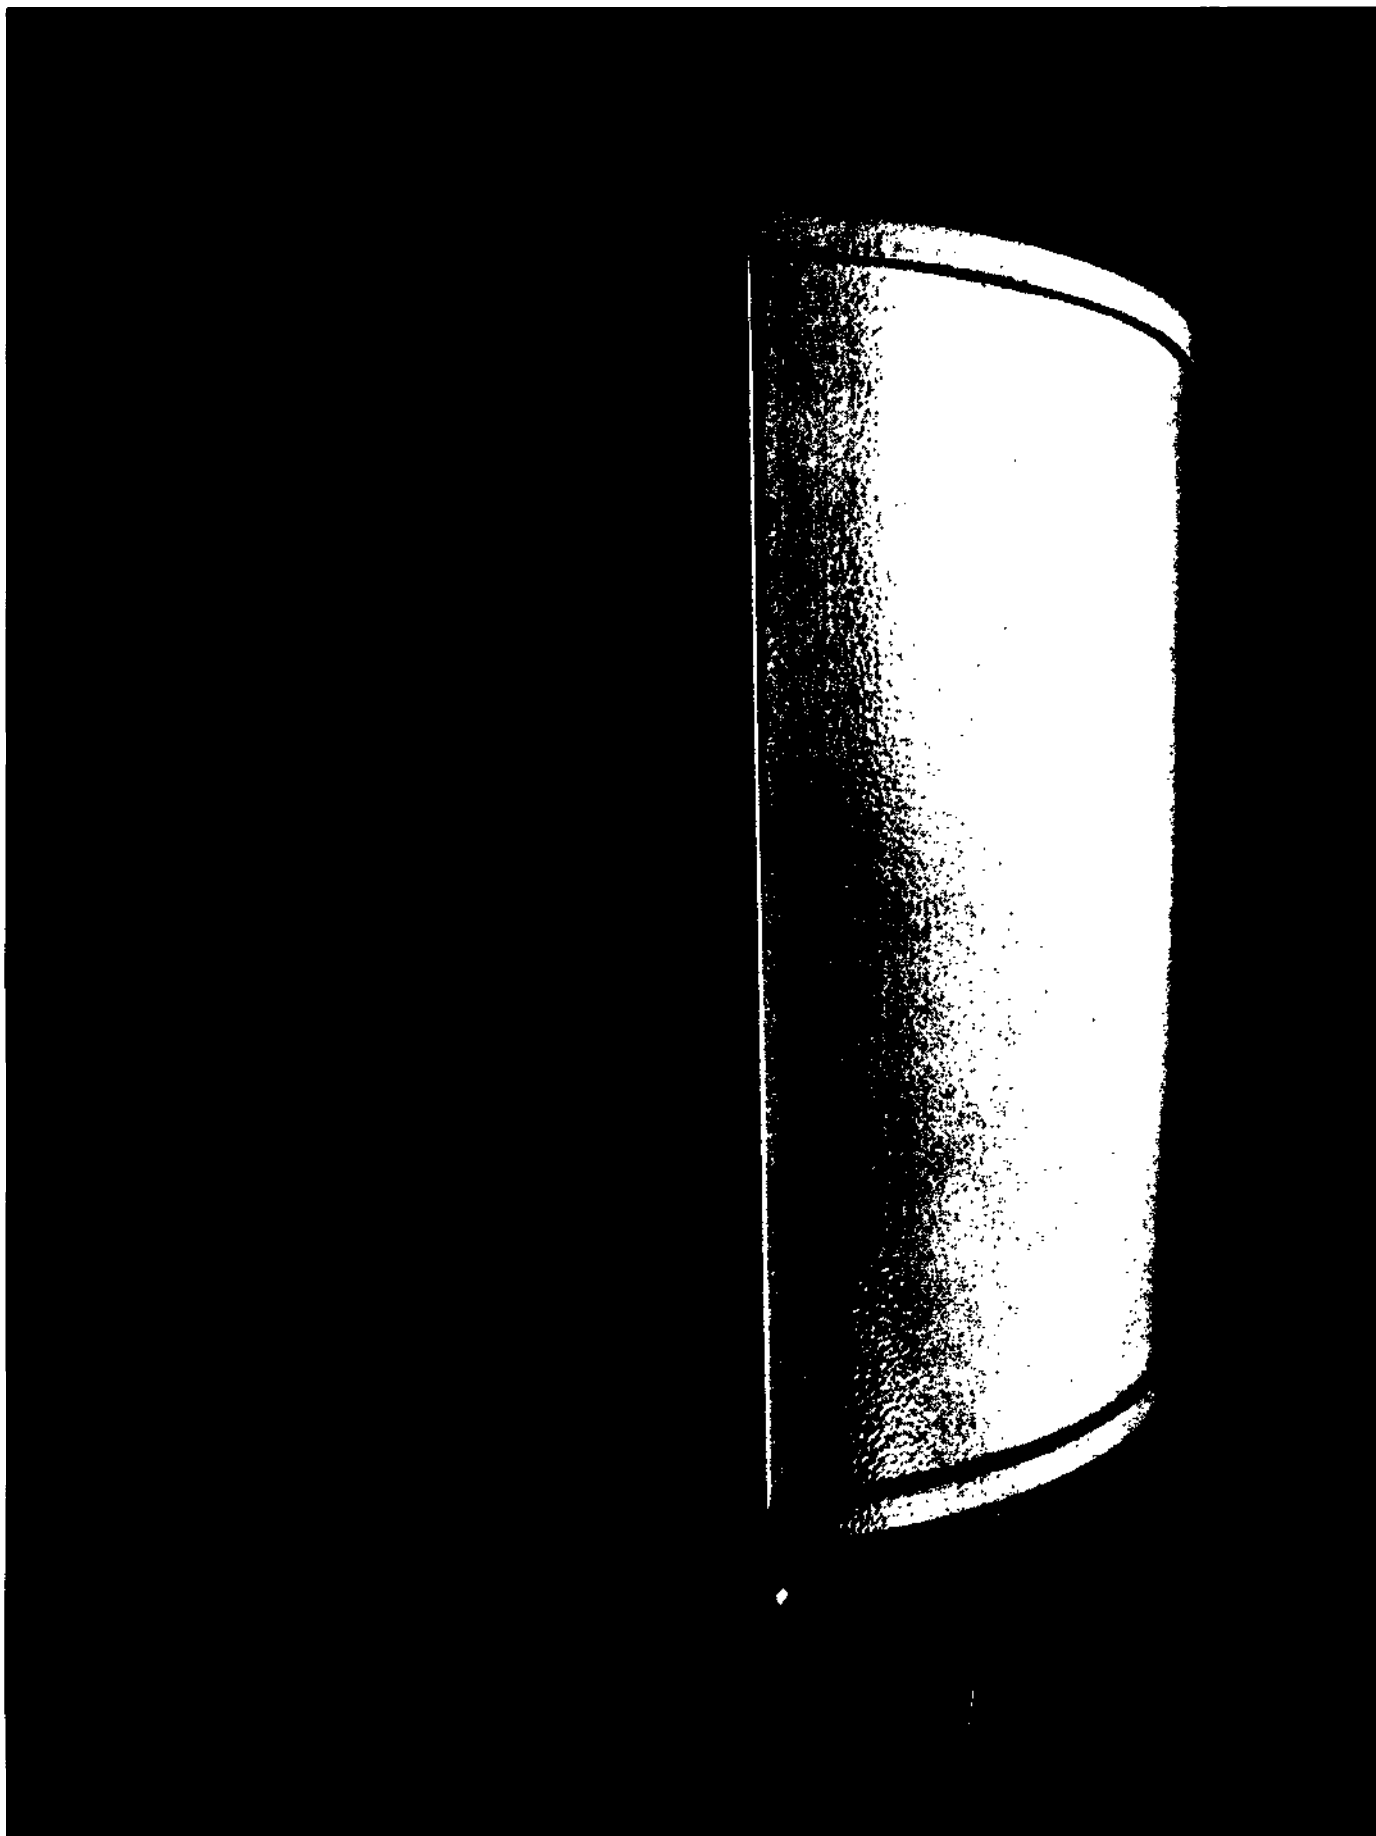

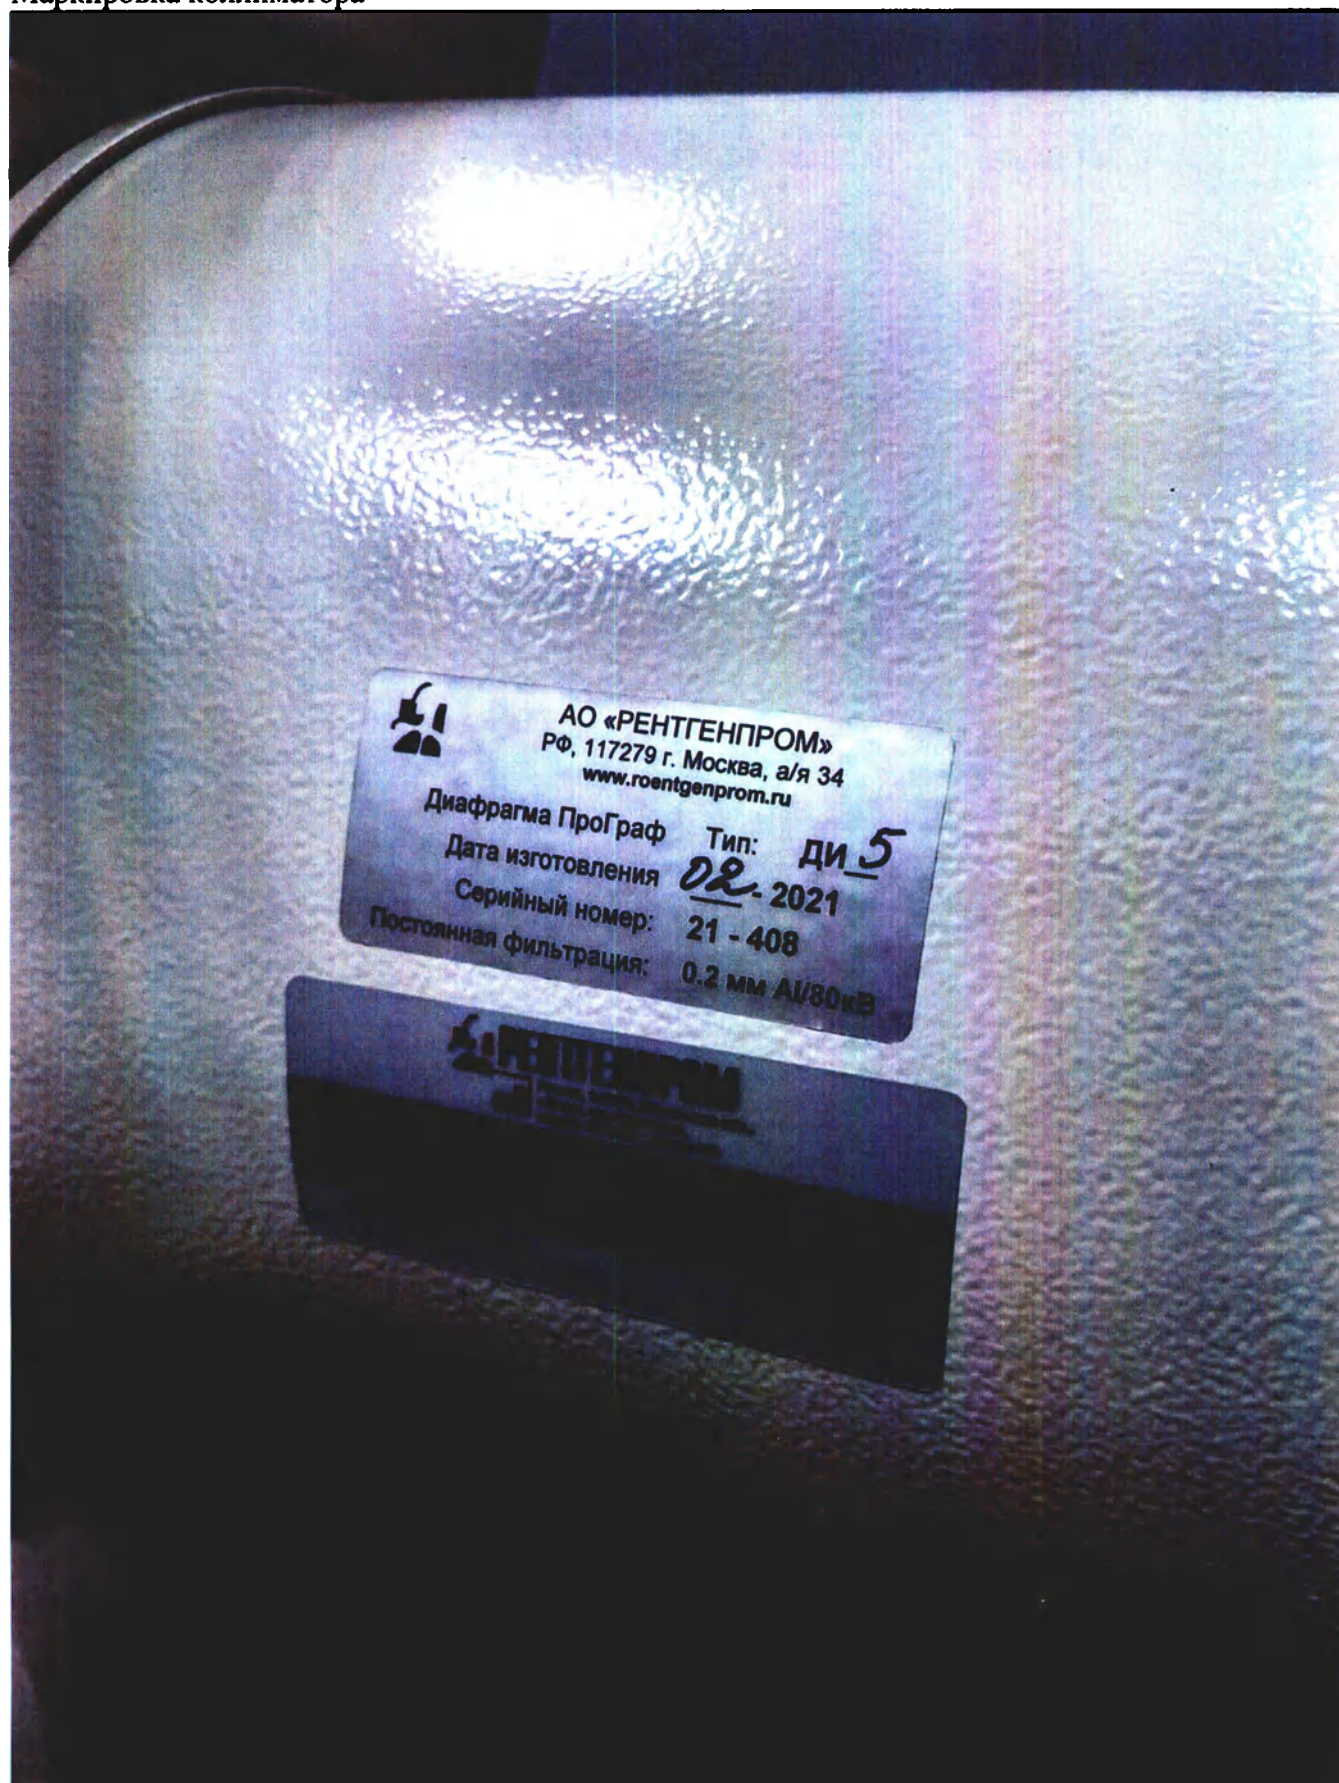

5. Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе PC компьютера (АРМ2)



Маркировка комплекса средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе РС компьютера (АРМ2)

 **РЕНТЕНПРОМ**
Россия, 143560, Московская обл.,
г.Истра, пос.Руменцево,
квартал 0080204, здание 173

АРЦ-РП (ПроГраф)
Комплекс средств для визуализации,
обработки и архивирования изображения на
базе РС компьютера (АРМ 2)

АСЛВ 38639.013.25

SN 22-10105
2022

 **РЕНТЕНПРОМ**
Россия, 143560, Московская обл.,
г.Истра, пос.Руменцево,
квартал 0080204, здание 173

АРЦ-РП (ПроГраф)
АРМ2 : СИСТЕМНЫЙ БЛОК

АСЛВ 38639.013.25

SN 22-10105
2022

FQC-00000

WINDOWS 10 PRO
OEM SOFTWARE

Microsoft

16?18BR

Product key: Microsoft JH K7XF2 F9TB4 R3KTR

03307-145-846-044 X22-45886

 **DEPO**
[computers]


Системный блок DEPO
Модель: Neos DHS29
(1355814)
W10_P64/I3-
10100/8GDDR4/T1Tb/DVD±RW/DGLAN/KBu/Mu/400W/ONS3PCB
Сделано в России ООО "ДЕПО Электроникс"
Питание 220В 50Гц 3А ДАЦН 466219 020 Ty
Дата производства 02/2022
Гарантия 36 мес. ONS3PCB

Профессиональное оборудование,
не предназначено для домашнего использования

S/N 484751-060

 EAC
WCO 9001

6. Шкаф управления ПроГраф-7000

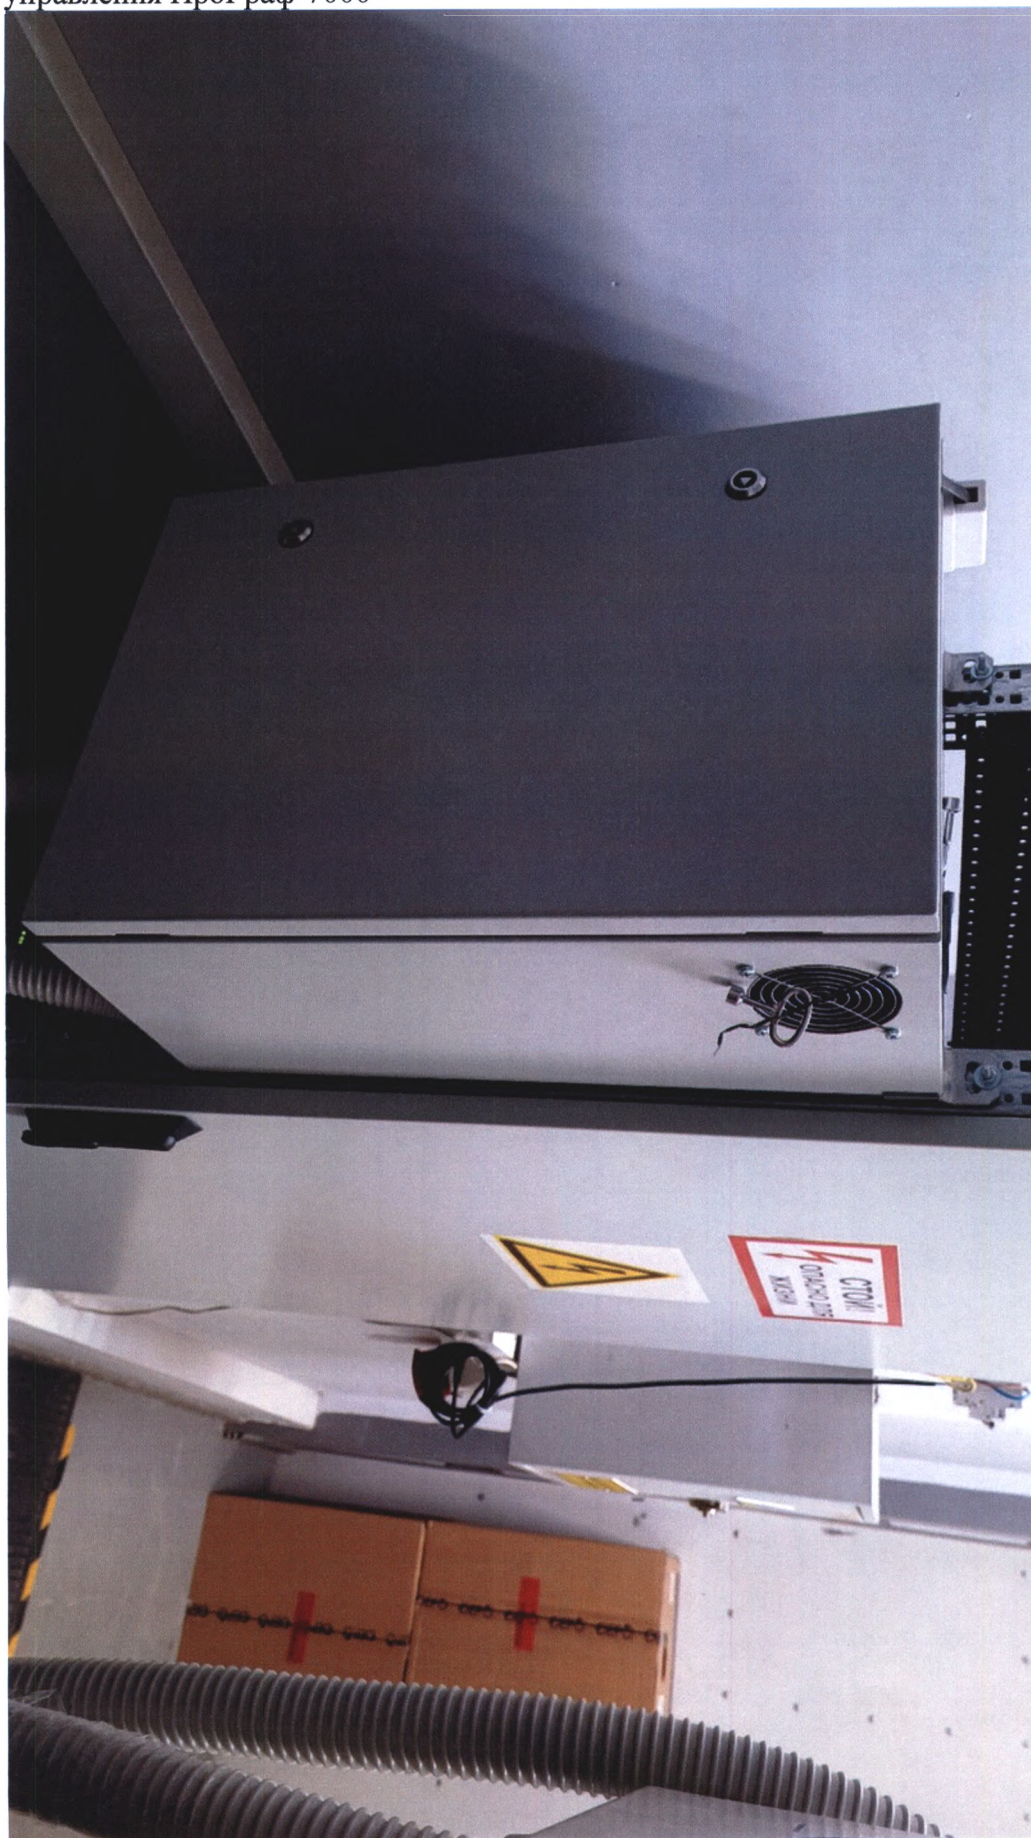



8. Рентгенозащитное ограждение



9. Ширма рентгенозащитная



10. Комплект транспортных ящиков многоразового использования



11. Набор мебели в составе:
Стол компьютерный





Всего прошито и пронумеровано
16 (шестнадцать) листов
Исполнительный директор
АО "РЕНТГЕНПРОМ"
Сявбянов Мансур Рафитович

