

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**«Томограф рентгеновский компьютерный Insitum в исполнениях
Insitum 32, Insitum 64S, Insitum 64 с принадлежностями»**

Томограф рентгеновский компьютерный Insitum, модель Insitum 32




Томограф рентгеновский компьютерный Insitum, модель Insitum 64S




Томограф рентгеновский компьютерный Insitum, модель Insitum 64




1. Гантри в составе:

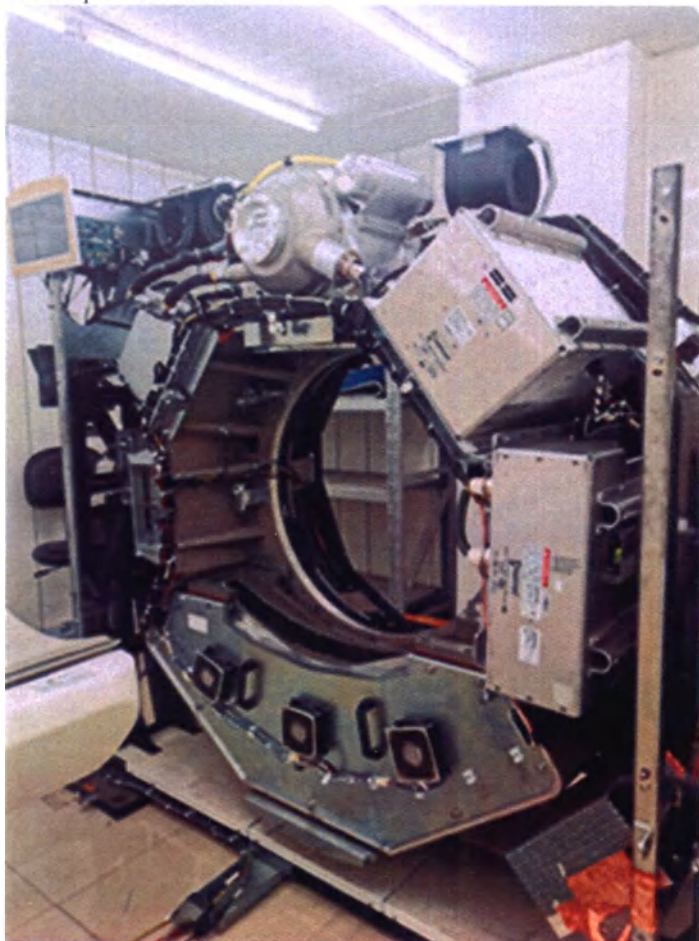


1.1 Детектор

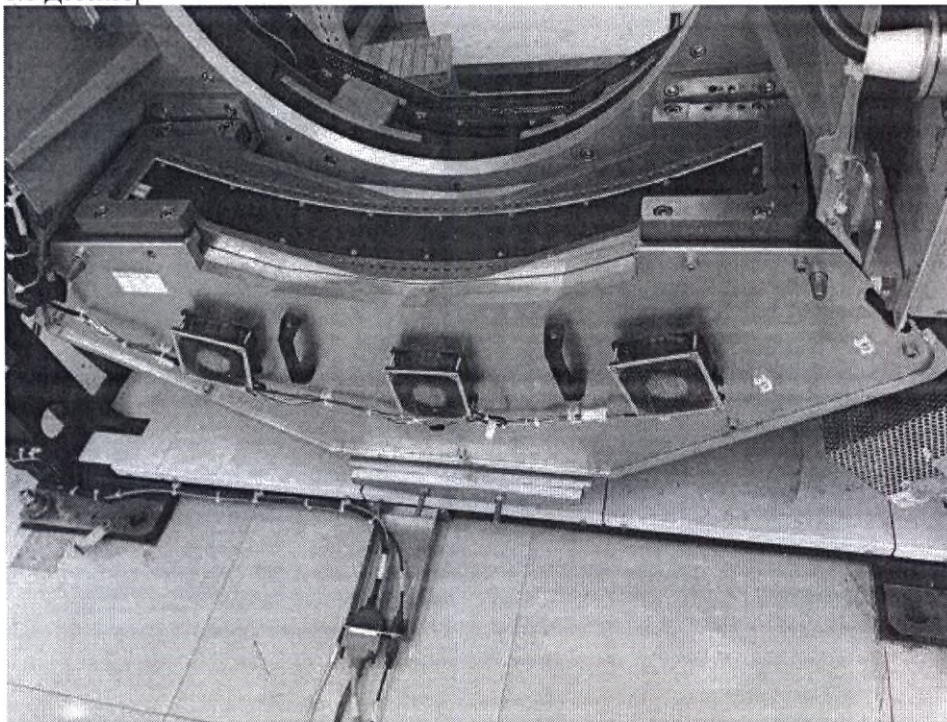


1.2 Генератор Spellman CT70PN80X4546.

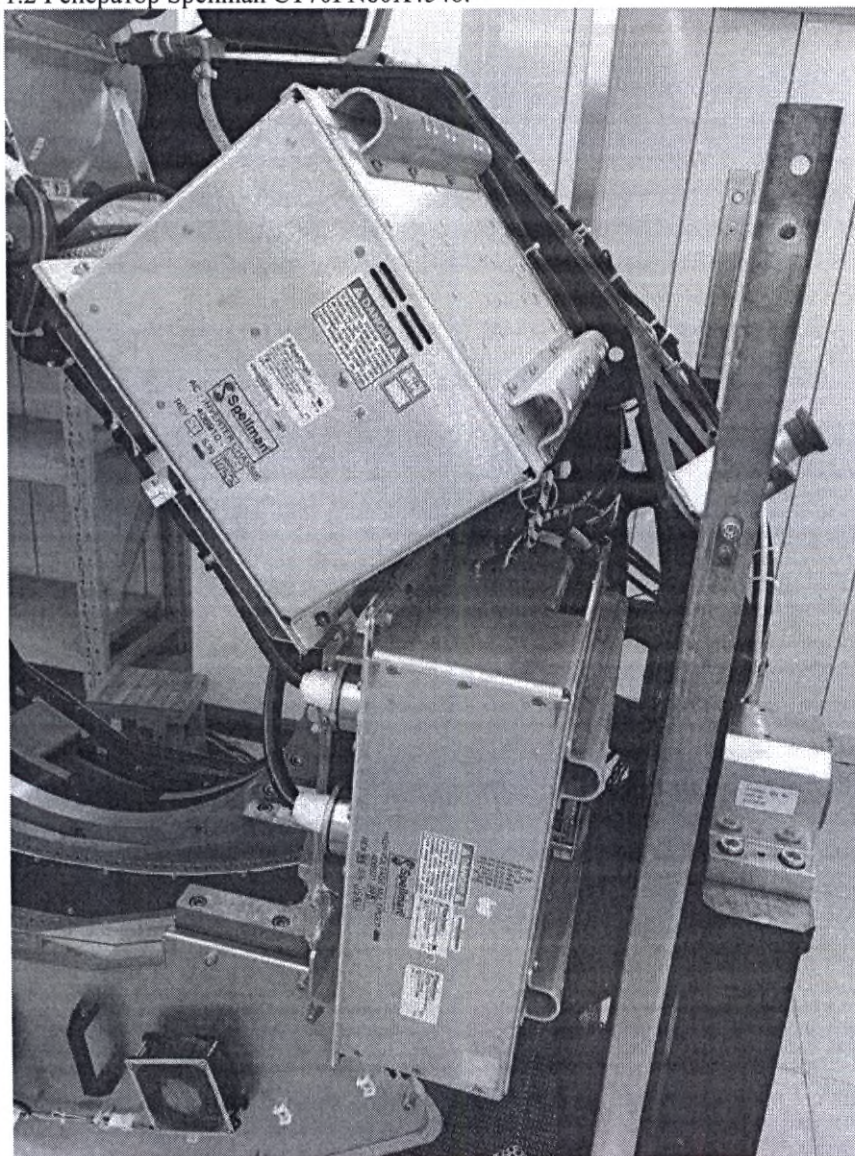


1.3 Излучатель рентгеновский с трубкой CTR 2280CESV.

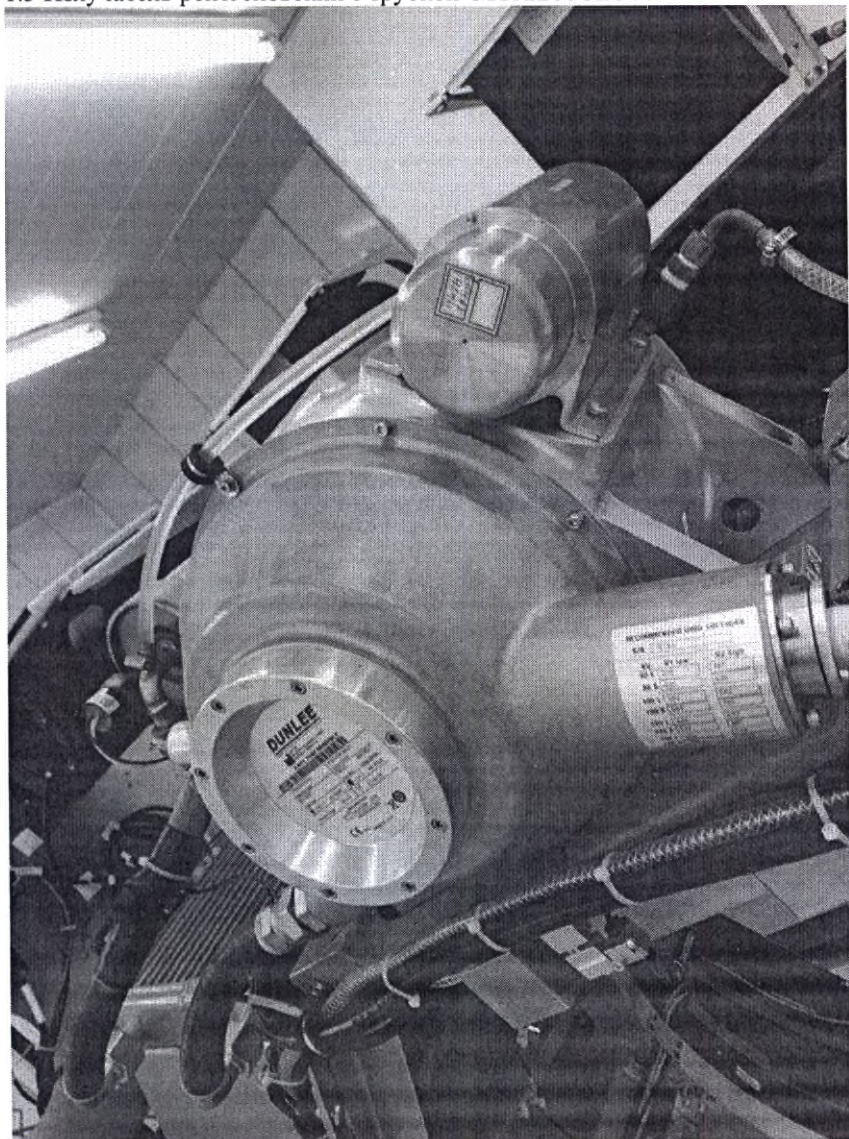


1.4 Коллиматор.

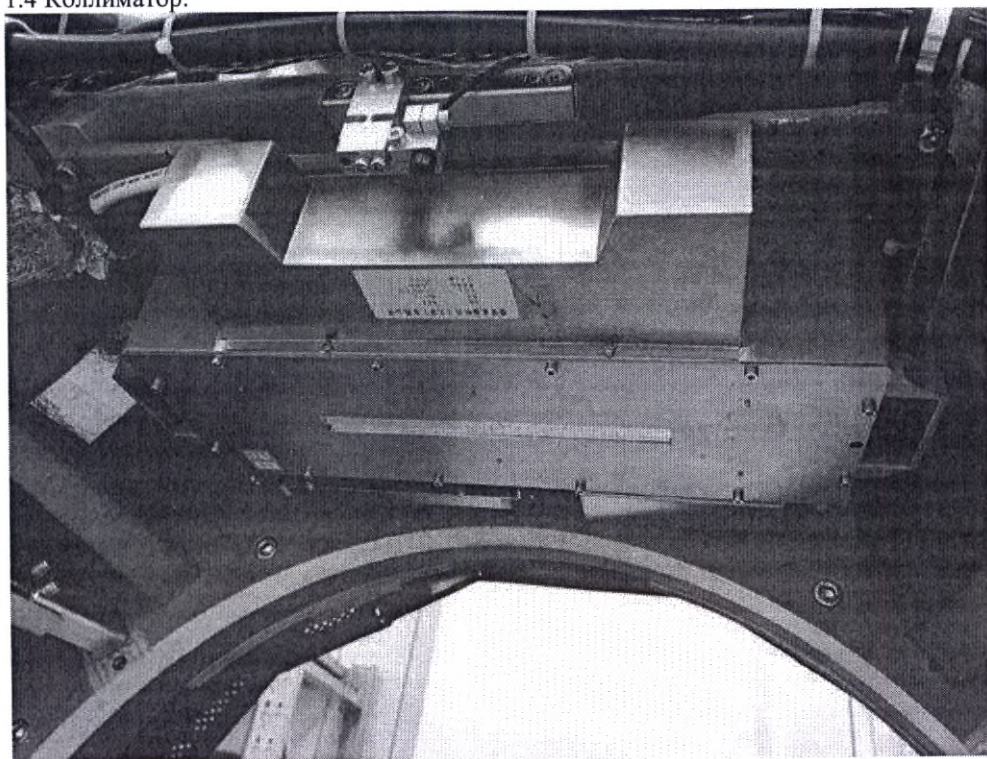


1.5 Дисплей управления (встроенный).

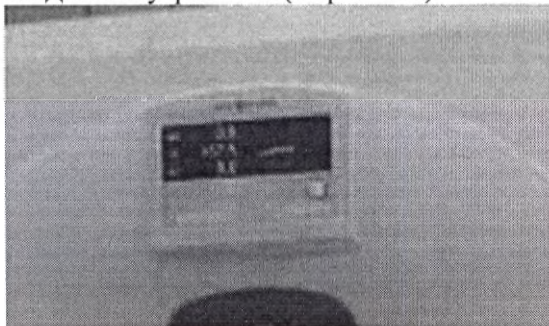

2. Стол для пациента.

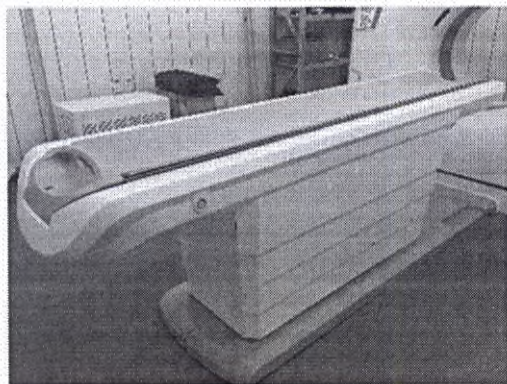

2.1 Ножной переключатель (при необходимости).

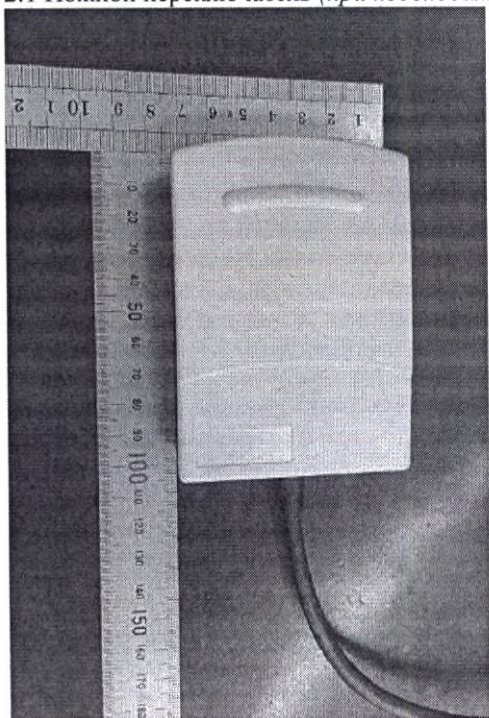

3. Консоль оператора, в составе:


3.1 Компьютерная система

3.2 Блок управления сканированием (КТ-блок).


3.3 Устройства манипуляции (клавиатура и мышь).

3.4 Система внутренней связи с пациентом.


3.5 Внешний накопитель (устройство хранения данных исследования).

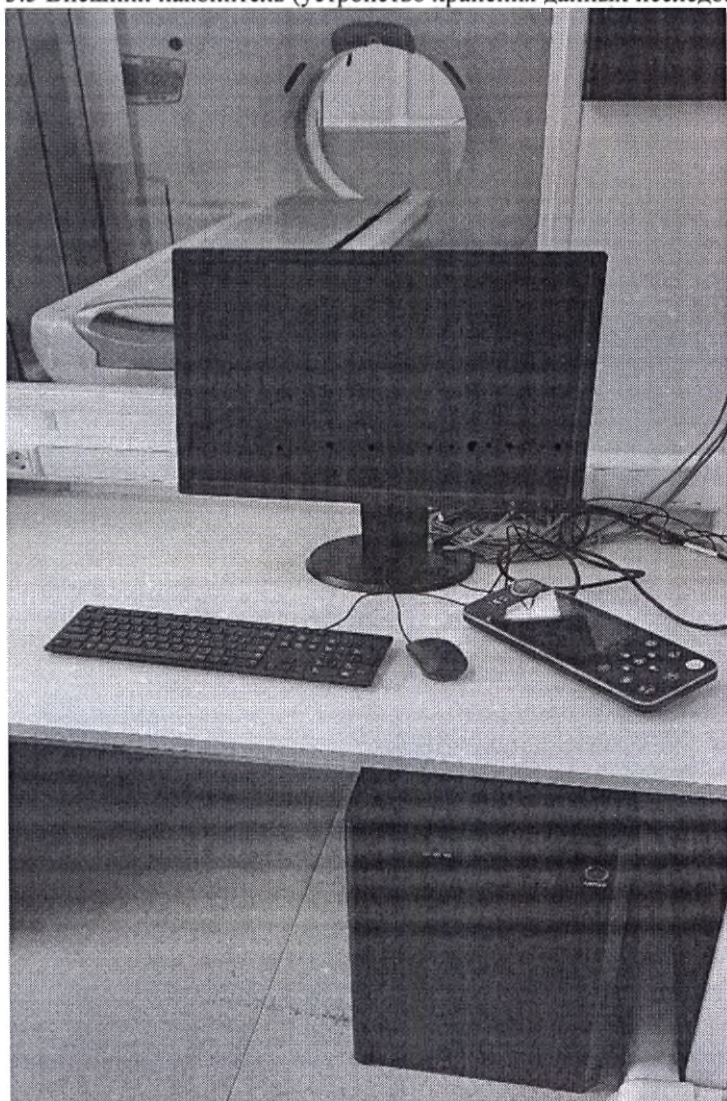


4. Адаптер питания

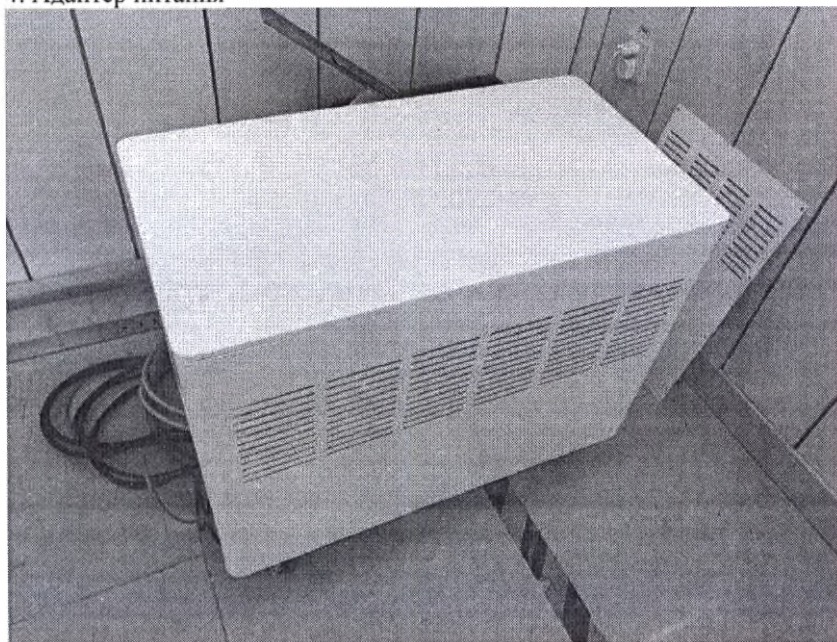


5. Специализированное программное обеспечение версии 1.X с дополнительными модулями программного обеспечения на CD-диске.

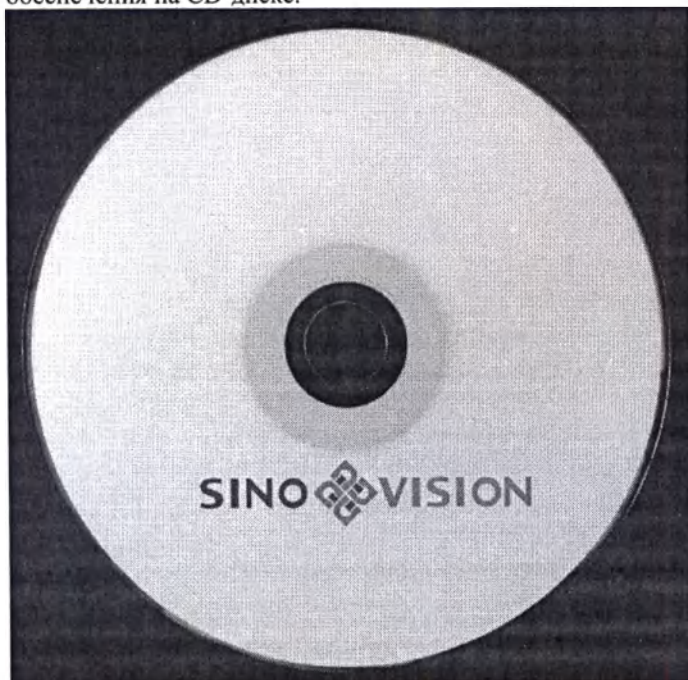


6. Специализированное программное обеспечение версии не менее 1.XX с дополнительными модулями программного обеспечения на CD-диске.

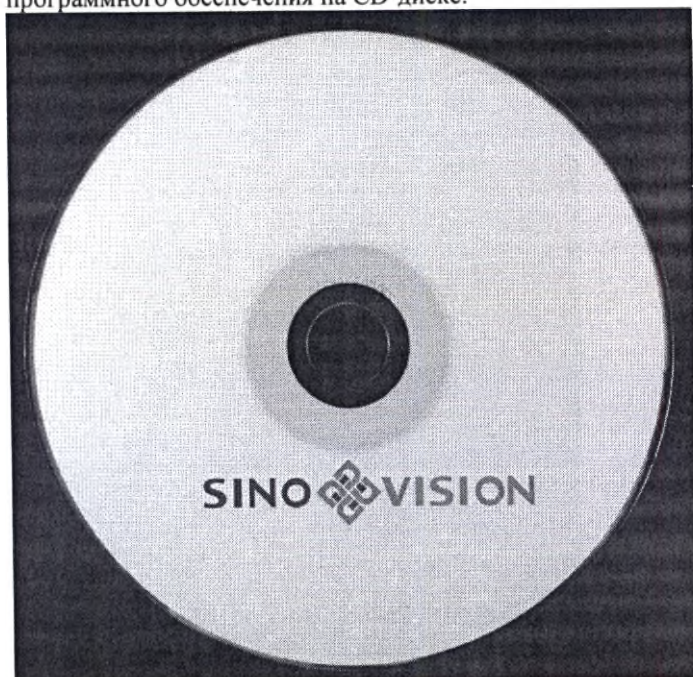

7. Держатель головы (при необходимости).

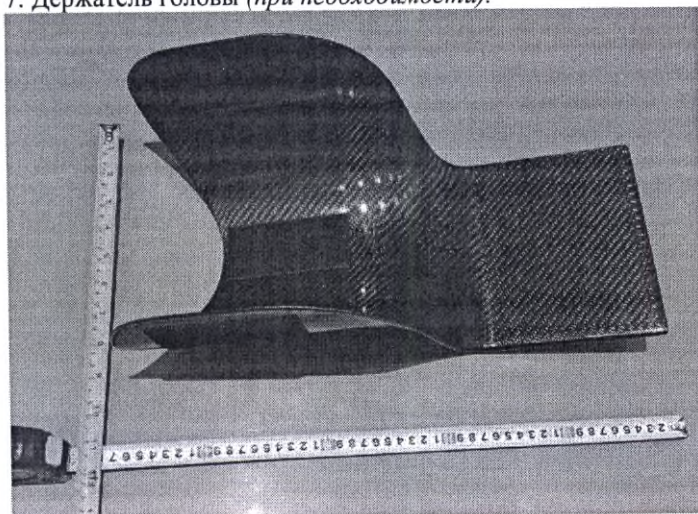


8. Подушка под голову (при необходимости).

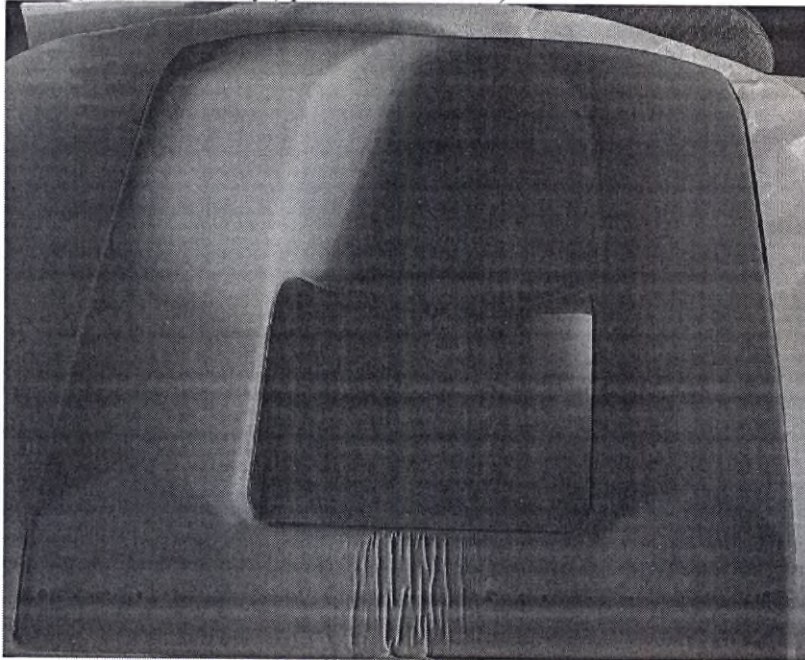


9. Подушка для укладки пациента (при необходимости).




10. Ремень для головы (при необходимости).

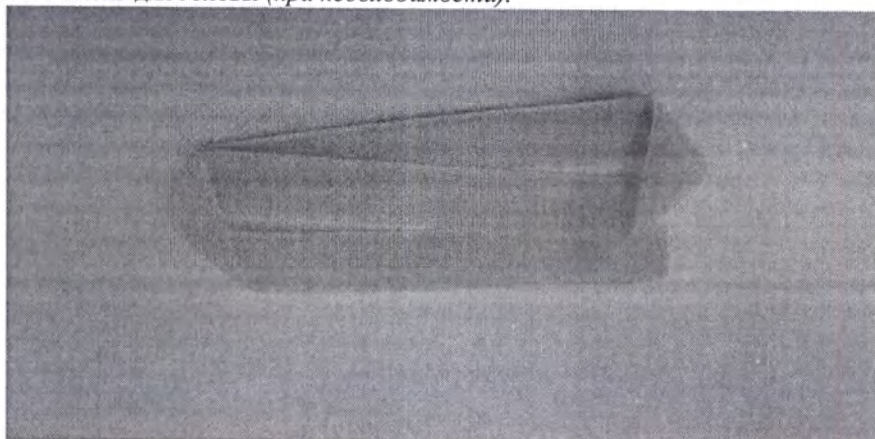


11. Фиксатор подбородка широкий (при необходимости).

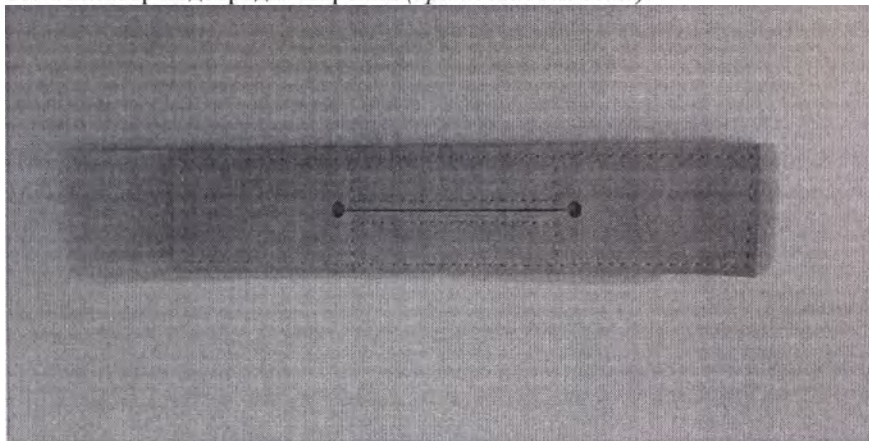


12. Фиксатор подбородка узкий (при необходимости).

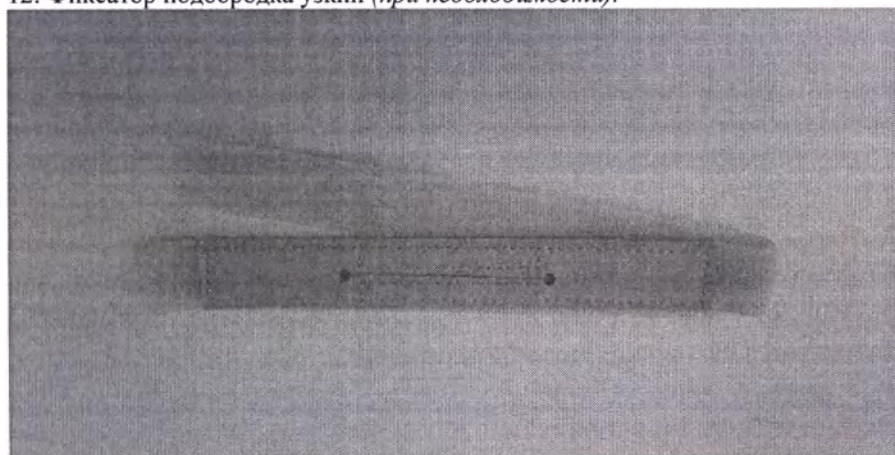


13. Фиксатор груди (при необходимости).

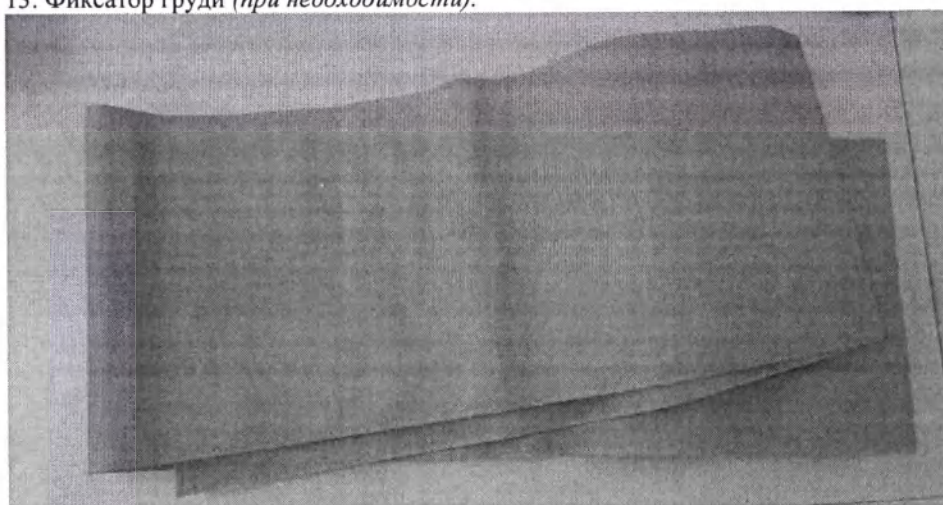


14. Ремень узкий (при необходимости).

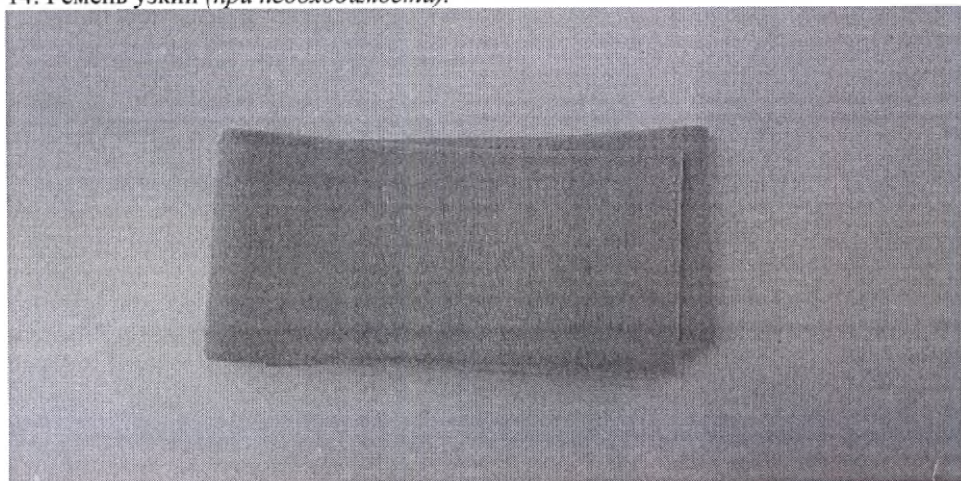

15. Фантом (системный) (при необходимости).

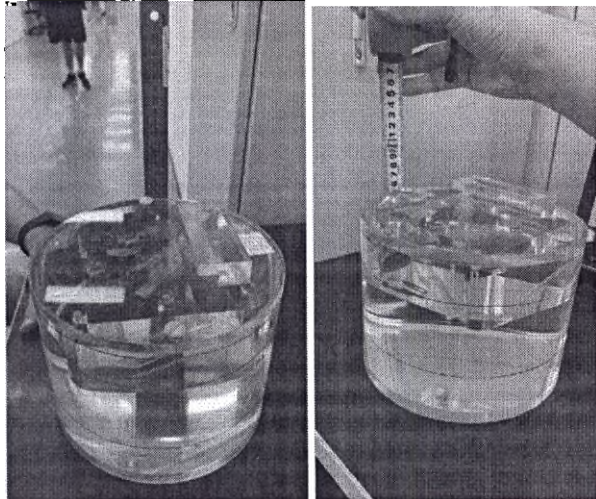


16. Фантомный держатель (при необходимости).

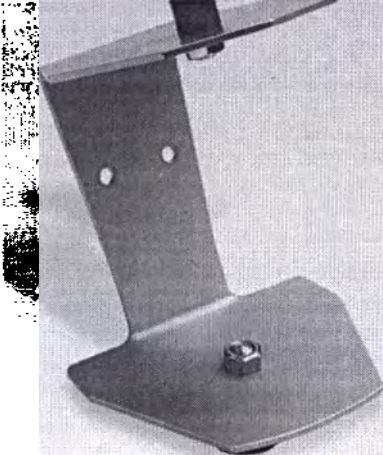


17. Кабели:

- Кабель питания гентри (высокое напряжение)

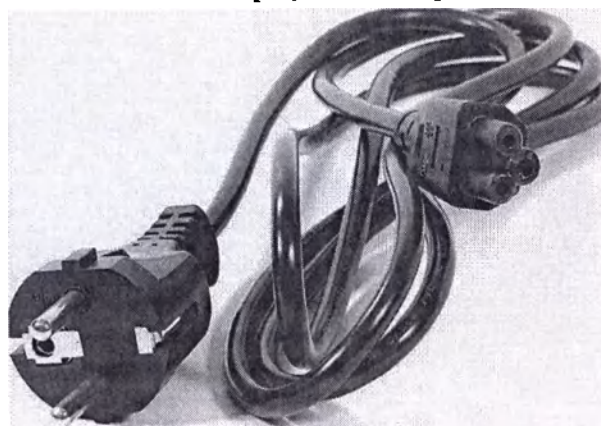

- Кабель питания гентри (низкое напряжение)

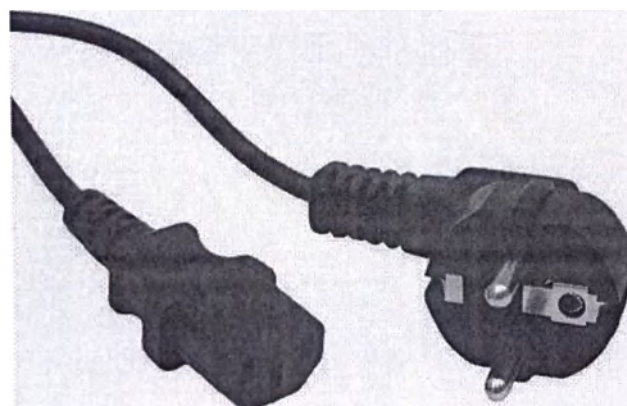


- Кабель защитного заземления гентри




- Кабель питания консоли управления




- Кабель защитного заземления консоли управления

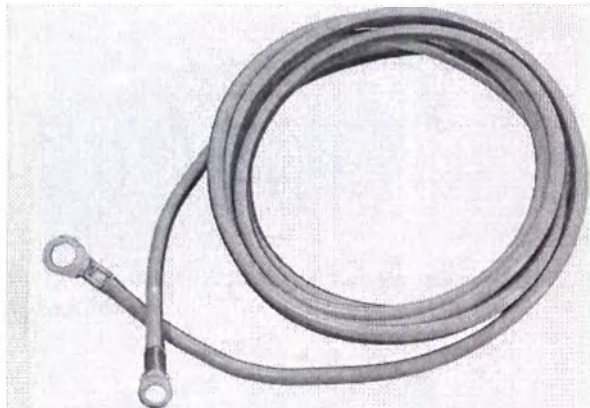

- Жгут кабелей управления консоли управления

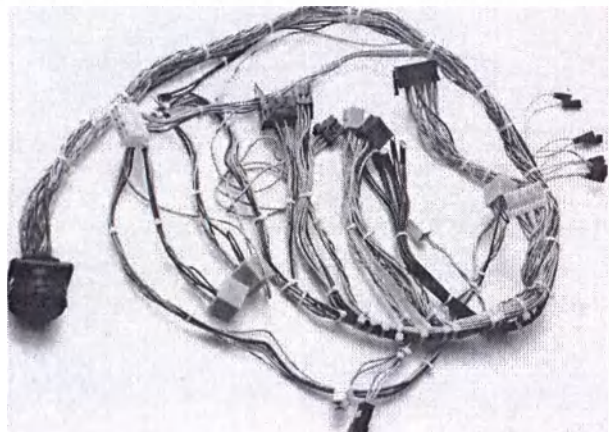

- Кабель Ethernet

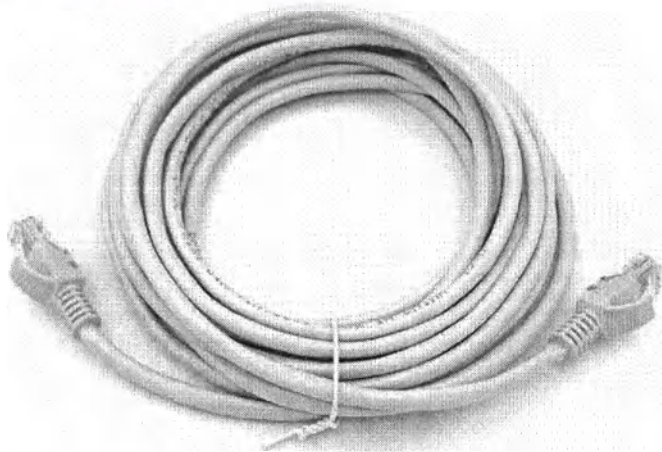

- Кабель оптоволоконный




II. Принадлежности:

1. Ключ лицензионный для активации модуля программного обеспечения для виртуальной эндоскопии




2. Ключ лицензионный для активации модуля программного обеспечения для проведения КТ - ангиографии

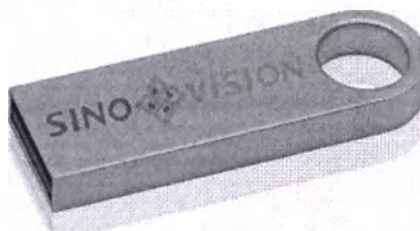


3. Ключ лицензионный для активации модуля программного обеспечения для оценки объема легких




4. Ключ лицензионный для активации модуля программного обеспечения для оценки жирового индекса

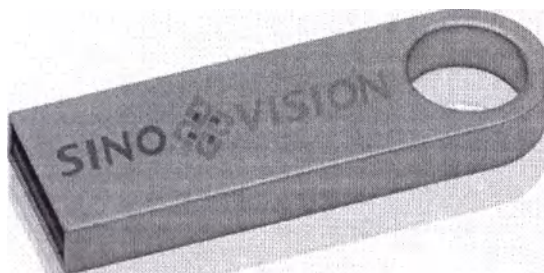



5. Ключ лицензионный для активации модуля программного обеспечения для виртуальной колоноскопии

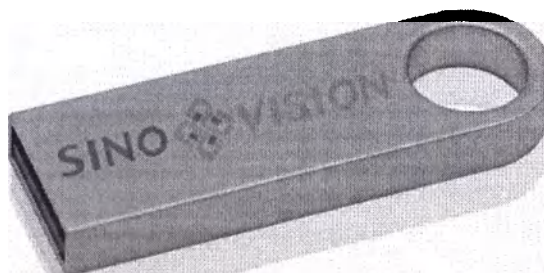

6. Ключ лицензионный для активации модуля программного обеспечения для анализа узелковых образований легких

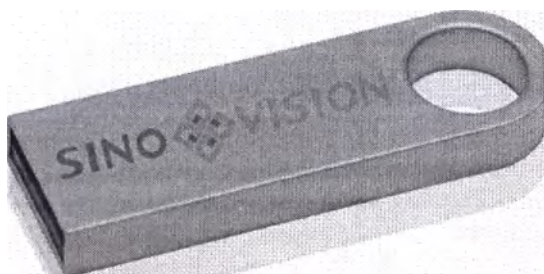

Транспортная упаковка

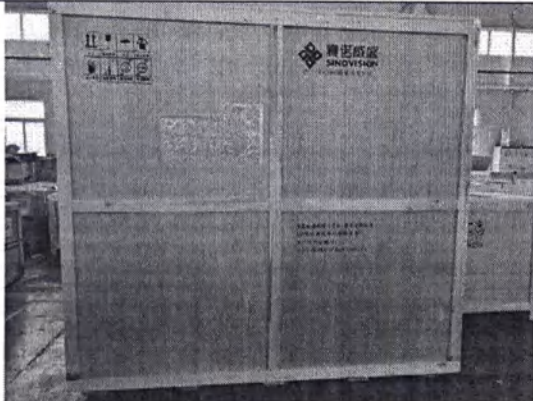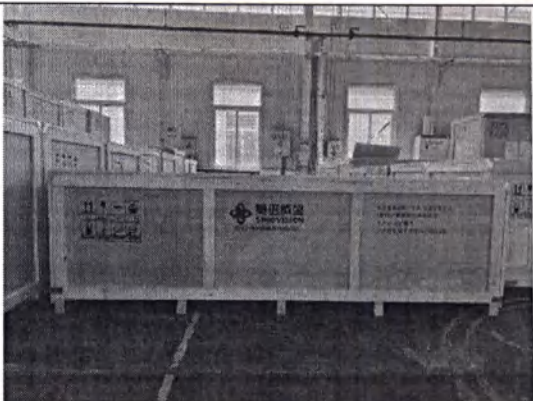	
Гентри	Стол
	
Принадлежности	Консоль оператора
	
Адаптер питания	

Генеральный директор

Е.Е.Жвакина

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

13

«Мип-Тест»
«MIP-Test», LLC
Для документов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСКВА