

СОГЛАСОВАНО

Директор центра постгеномных технологий Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)


Г.А. Шипулин
2023 г.






ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления генов металло- β -лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации
«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto»

Фотография до вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto»

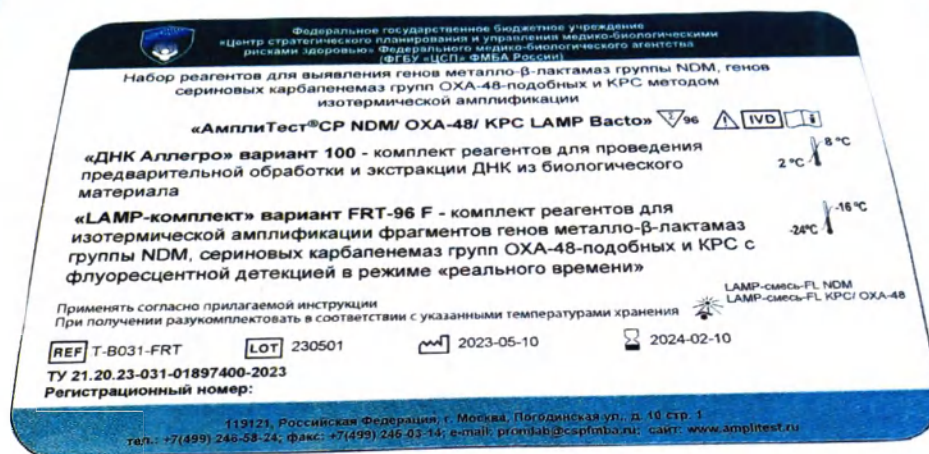

**Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto»**

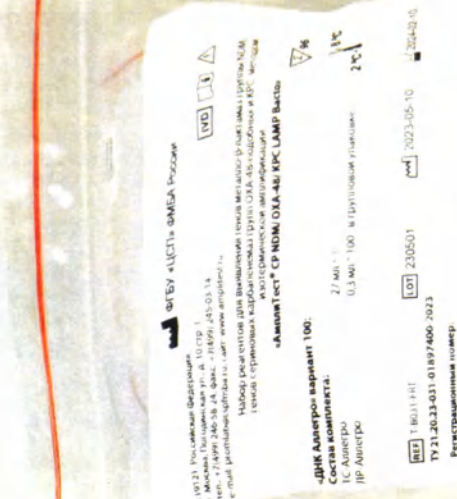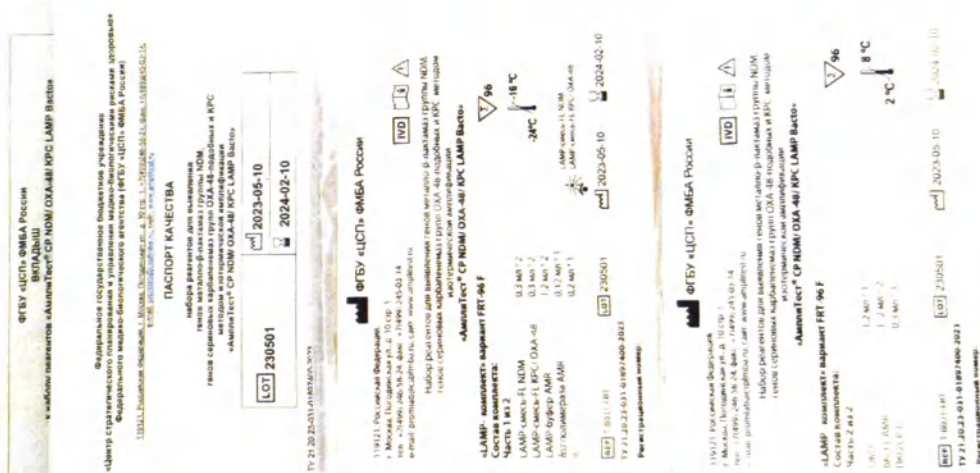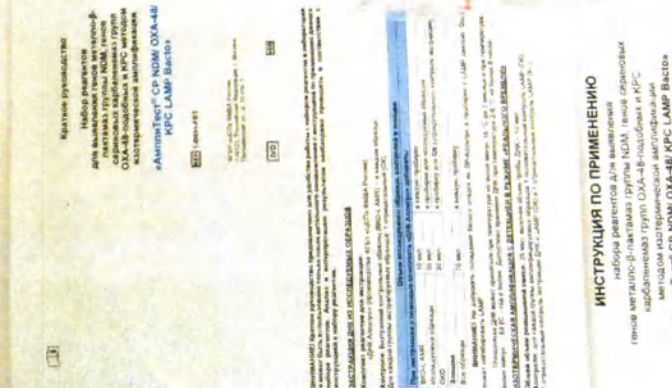

Фотография реагентов комплекта «LAMP - комплект» вариант FRT-96 F набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto» Часть 1 из 2



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@cspfmbs.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом изотермической амплификации

«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto»

«LAMP- комплект» вариант FRT-96 F

Состав комплекта:

Часть 1 из 2

LAMP-смесь-FL NDM	0,3 мл × 2
LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48	0,3 мл × 2
LAMP-буфер-AMR	1,2 мл × 2
Bst полимераза AMR	0,12 мл × 1
K-	0,2 мл × 1

Σ 96

-24°C -16°C



LAMP-смесь-FL NDM
LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48

REF T-B031-FRT

LOT 230501

2023-05-10

2024-02-10

ТУ 21.20.23-031-01897400-2023

Регистрационный номер:



Фотография реагентов комплекта «LAMP - комплект» вариант FRT-96 F набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto» Часть 2 из 2



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@cspfmfa.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом
изотермической амплификации


«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto»

«LAMP- комплект» вариант FRT-96 F

Состав комплекта:

Часть 2 из 2

ОКО	1,2 мл × 1
ВКО-L AMR	1, 2 мл × 2
ПКО CP-L	0,3 мл × 1



REF T-B031-FRT

LOT 230501

2023-05-10


2024-02-10

TU 21.20.23-031-01897400-2023

Регистрационный номер:



Фотография реагентов комплекта «ДНК Аллегро» вариант 100 набора реагентов
«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP Bacto»

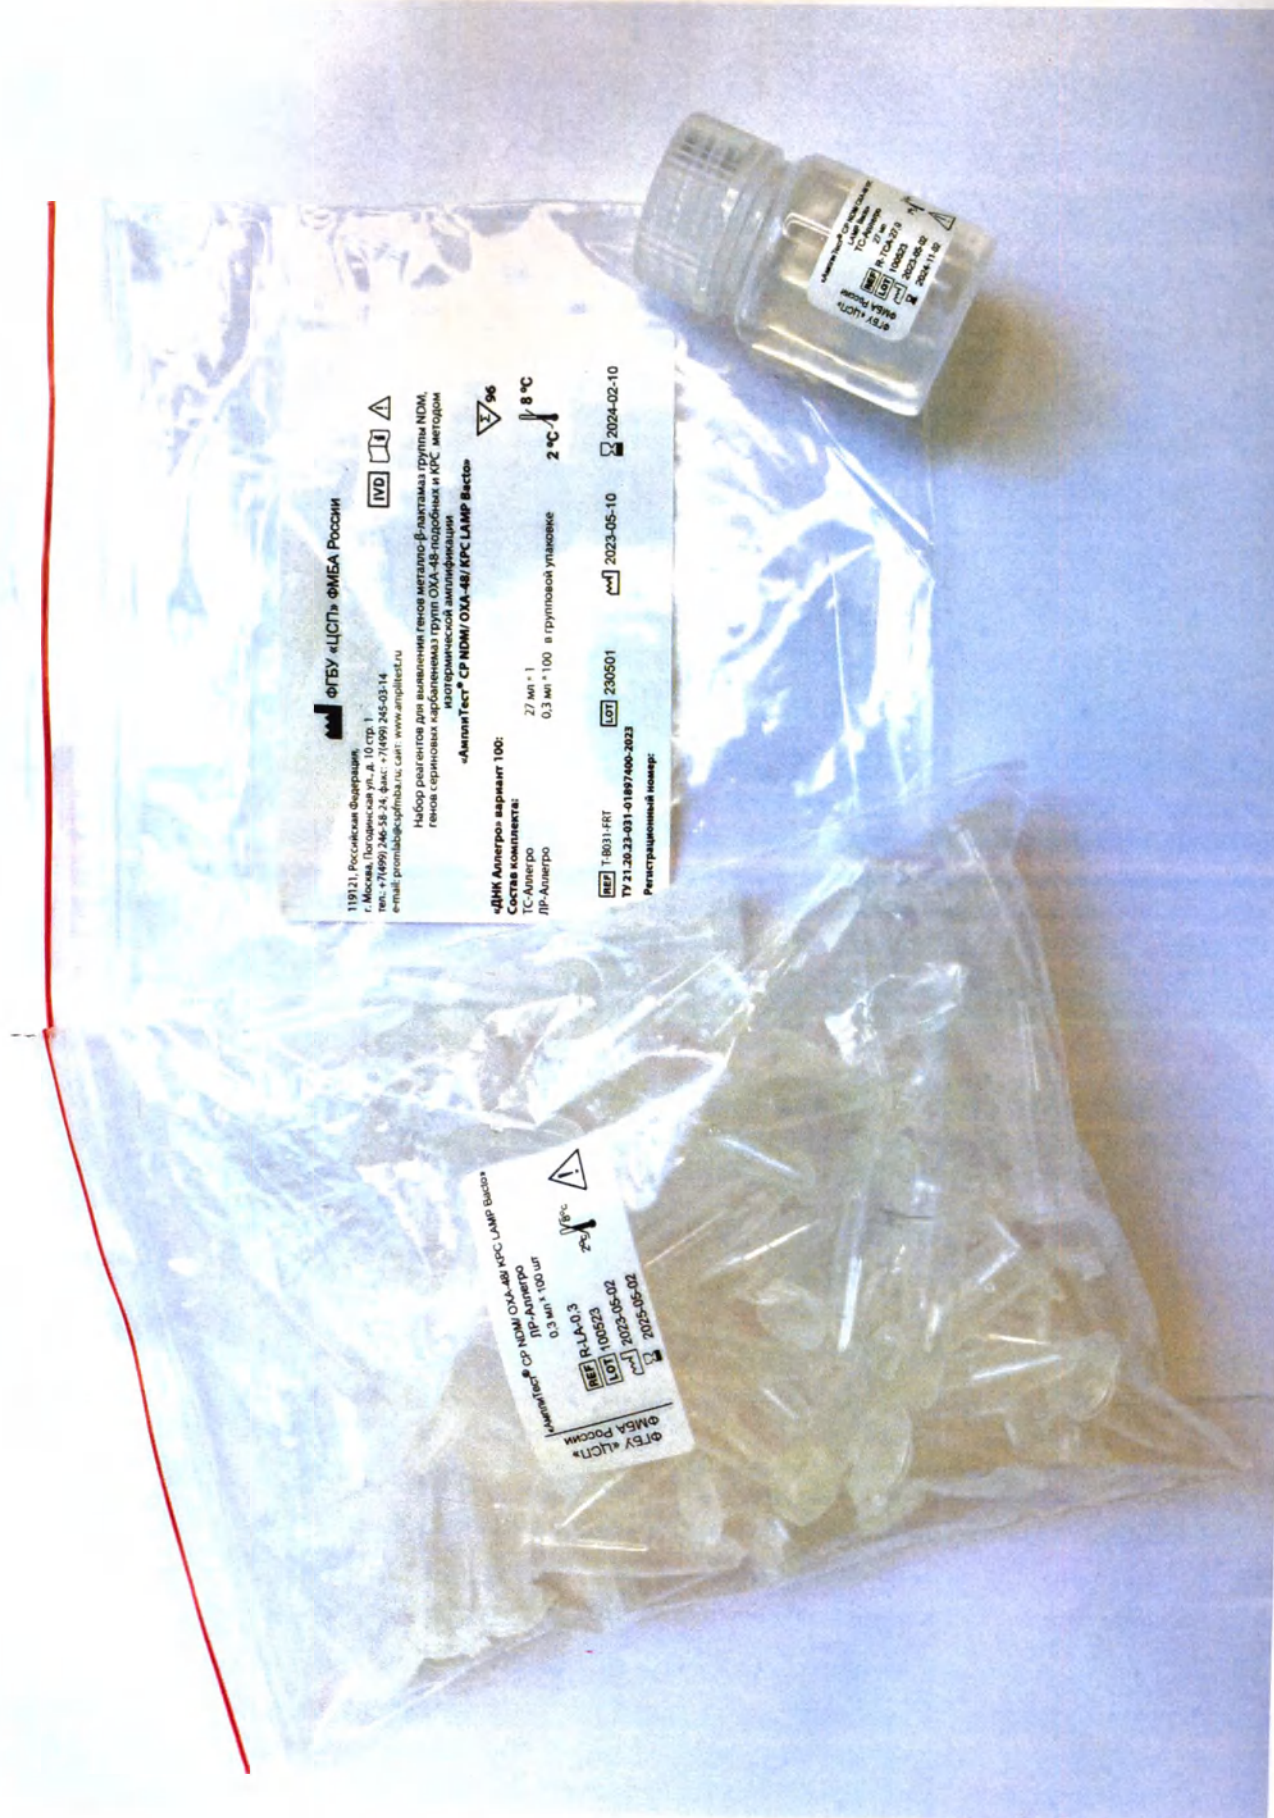

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 6 лист dv
Директор центра постгеномных технологий ФГБУ
«ЦСП» ФМБА России

Г.А. Шипулин

