

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МУТАЦИЙ
2080delA(insA) В ГЕНЕ *BRCA1* И 6174delT В ГЕНЕ *BRCA2*
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
С ДЕТЕКЦИЕЙ КРИВЫХ ПЛАВЛЕНИЯ
(РеалБест-Генетика *BRCA1* 2080delA(insA) / *BRCA2* 6174delT)
по ТУ 9398-591-23548172-2016

«Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016»

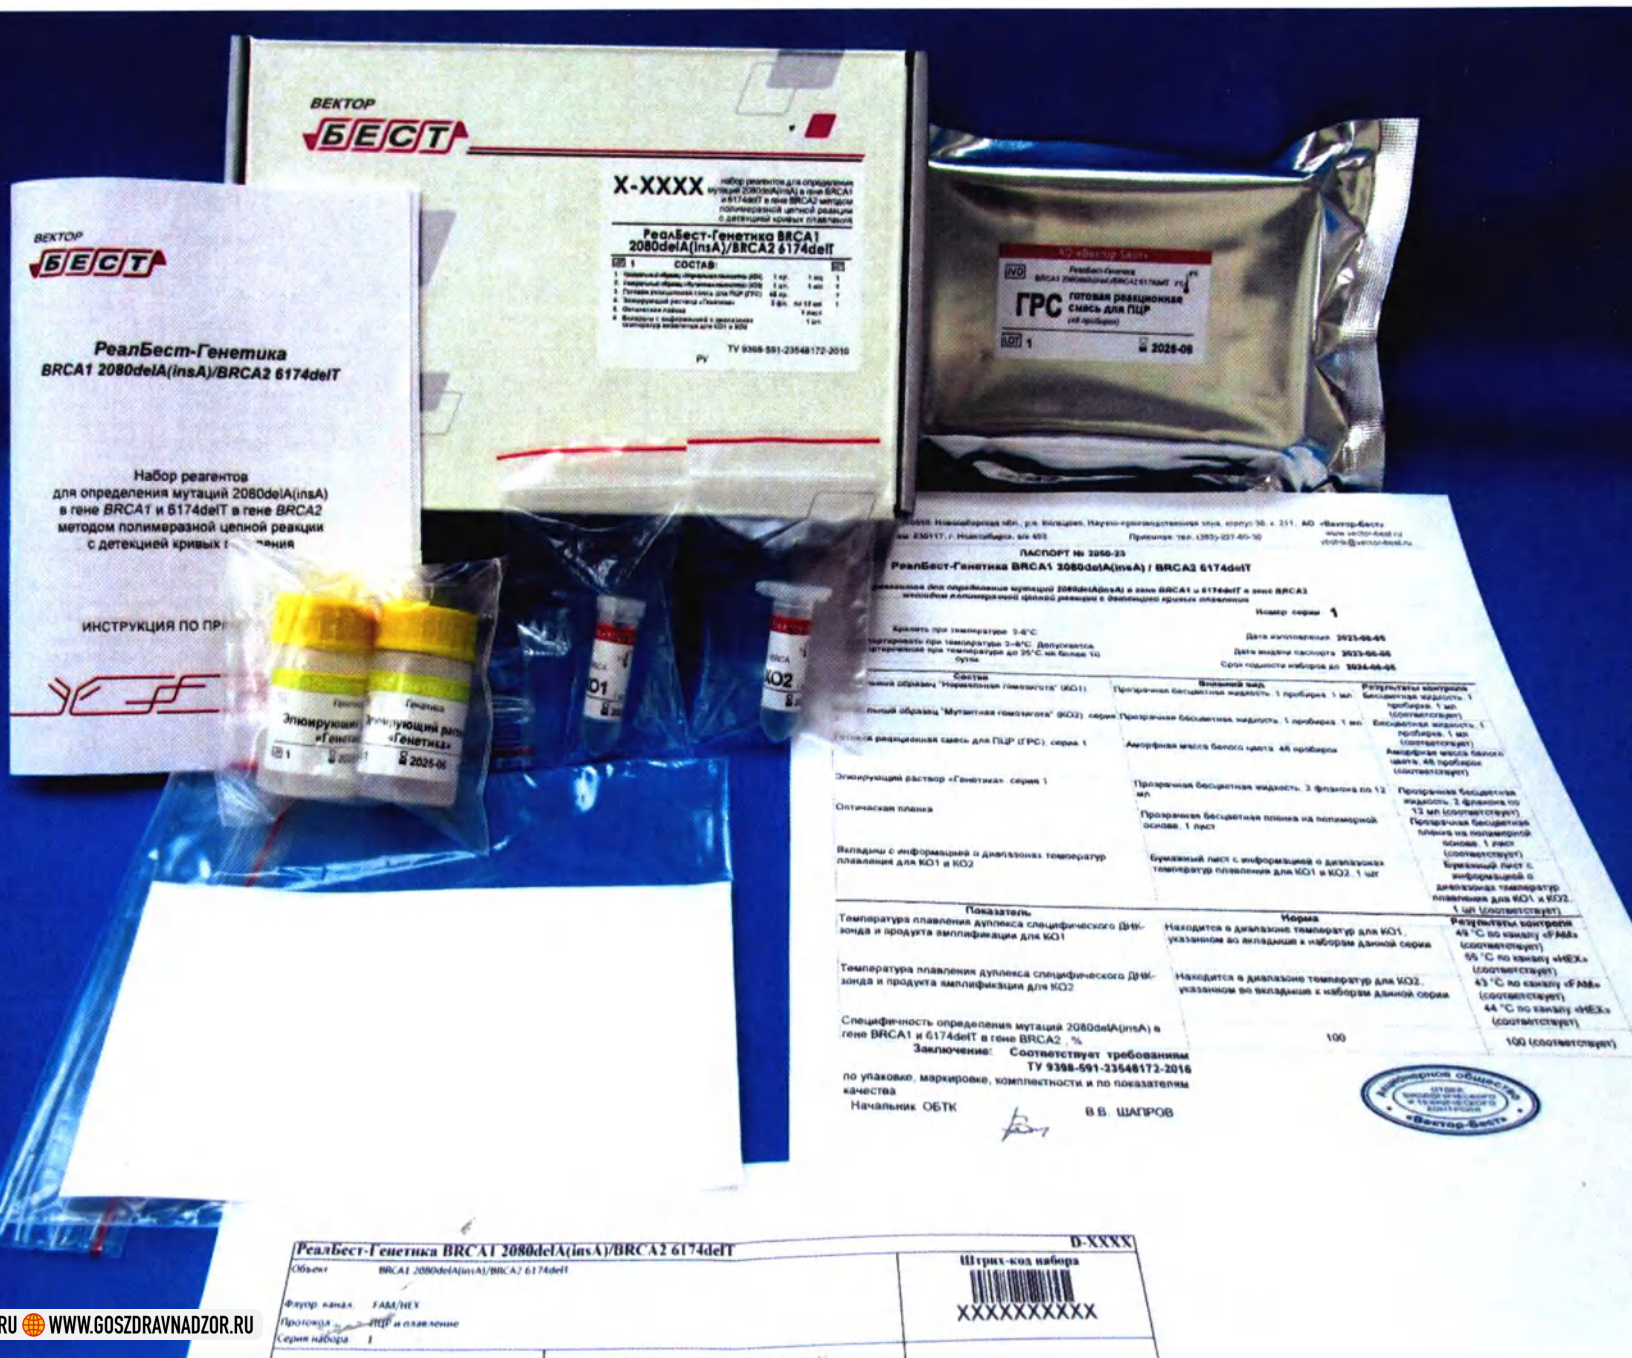

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» № 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» № 2




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» № 3



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» № 4



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» № 5

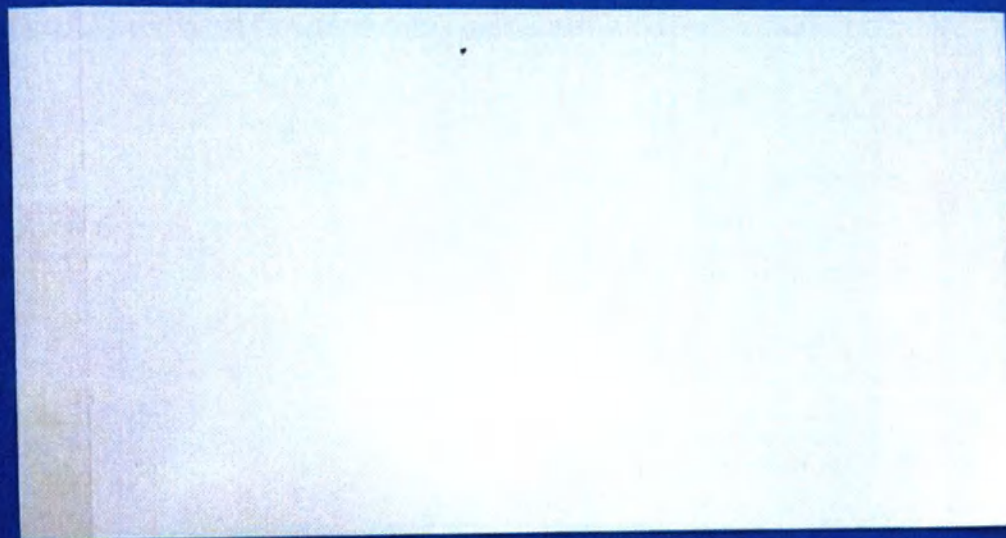

РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA)/BRCA2 6174delT				D-XXXX	
Объект			BRCA1 2080delA(insA)/BRCA2 6174delT		Штрих-код набора  XXXXXXXXXXXX
Флуор. канал: FAM/HEX					
Протокол: ПЦР и плавление					
Серия набора: 1					
			Диапазон температур плавления, °C		
	серия	FAM	HEX		
KO1	1	(49 ± 2) °C	(55 ± 2) °C		
KO2	1	(43 ± 2) °C	(44 ± 2) °C		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» № 1

ВЕКТОР
БЕСТ

X-XXXX

набор реагентов для определения
мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1
и 6174delT в гене BRCA2 методом
полимеразной цепной реакции
с детекцией кривых плавления


**РеалБест-Генетика BRCA1
2080delA(insA)/BRCA2 6174delT**

ЛОТ	1	СОСТАВ:	ЛОТ
1.	Контрольный образец «Нормальная гомозигота» (КО1)	1 пр. 1 мл	1
2.	Контрольный образец «Мутантная гомозигота» (КО2)	1 пр. 1 мл	1
3.	Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	48 пр.	1
4.	Элюирующий раствор «Генетика»	2 фл. по 12 мл	1
5.	Оптическая пленка	1 лист	
6.	Вкладыш с информацией о диапазонах температур плавления для КО1 и КО2	1 шт.	

ТУ 9398-591-23548172-2016

РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» № 2

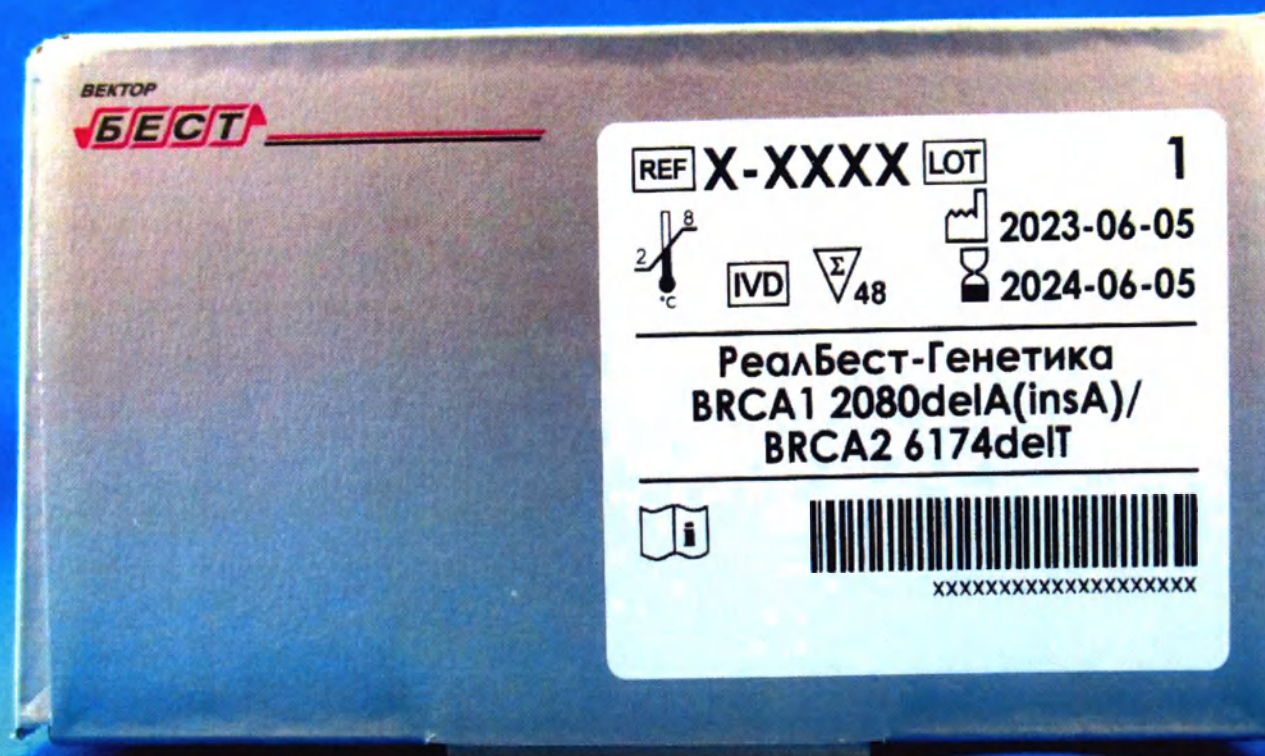

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения мутаций 2080delA(insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT) по ТУ 9398-591-23548172-2016» №3



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
«30» 10 20 23 г.