

Medtronic

ООО «Медтроник»

Вн. тер. г., м.о. Пресненский
Пресненская наб., д.10
Башня С
9 эт., пом. III, ком.41
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Плясунова Е.В.



«05» февраля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Коннекторы нестерильные для остеосинтеза позвоночника
производства Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк. (Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.), США

ОБРАЗЕЦ

использовать только в
демонстрационных целях

Medtronic

REF 6 1x522

LOT 08677-03327

HORIZON® Spinal System
CROSSLINK® PLATE 2.5mm

Size 72mm

Material TITANIUM ALLOY

Date of Manufacture QTY
2022-01-26 1EA
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
WARSAW ORTHOPEDIC, INC
Also Known As Medtronic Sofamor
Danek Manufacturing
2500 SILVEUS CROSSING
WARSAW, IN USA 46582

IUSA
For US
Audiences
Only

Consult
Instructions
For Use

NON
STERILE

Do Not
Reuse

CE 0123

EC REP
Medtronic B.V.
East Bakkenstraat 10
8422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel +31 45 566 80 80

Initial Print WARSAW, IN US 220126 WN



Medtronic

REF 8115622

LOT 08672133V

CD HORIZON® Spinal System
X10 CROSSLINK® PLATE 5.5mm

Size: 22mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY

 Date of Manufacture: Q1Y
2022-01-26 IFA
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone: 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax: 901 396 0356

Manufactured in
WARSAW ORTHOPEDIC, INC.
Also Known As Medtronic Sofamor
Danek Manufacturing
2500 SILVEUS CROSSING
WARSAW, IN USA 46582



(01)00721902729423(10)0867793V

USA 
For US
Audiences
Only



CE 0123

FC REP
Medtronic B.V.
Earl Rijkmanstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 45 566 80 80

Initial Print: WARSAW, IN USA 220126 Wn

CD HORIZON™ Spinal System

M708348B414 Rev. E

2018-03-21



Medtronic



* M 7 0 8 3 4 8 B 4 1 4 - E *



Electronic instructions for use/manuals

To view, download, print, or order manuals for this product, go to www.medtronic.com/manuals, or contact a Medtronic representative.


Software requirements

Manuals can be viewed online at www.medtronic.com/manuals



Коннектор 6.35MM POST CLOSED ILIAC CONNECTOR FOR 4.75MM ROD (п. 1.1–1.3)

Варианты исполнения по п. 1.1–1.3 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор 6.35MM POST CLOSED ILIAC CONNECTOR FOR 4.75MM ROD, 20MM»

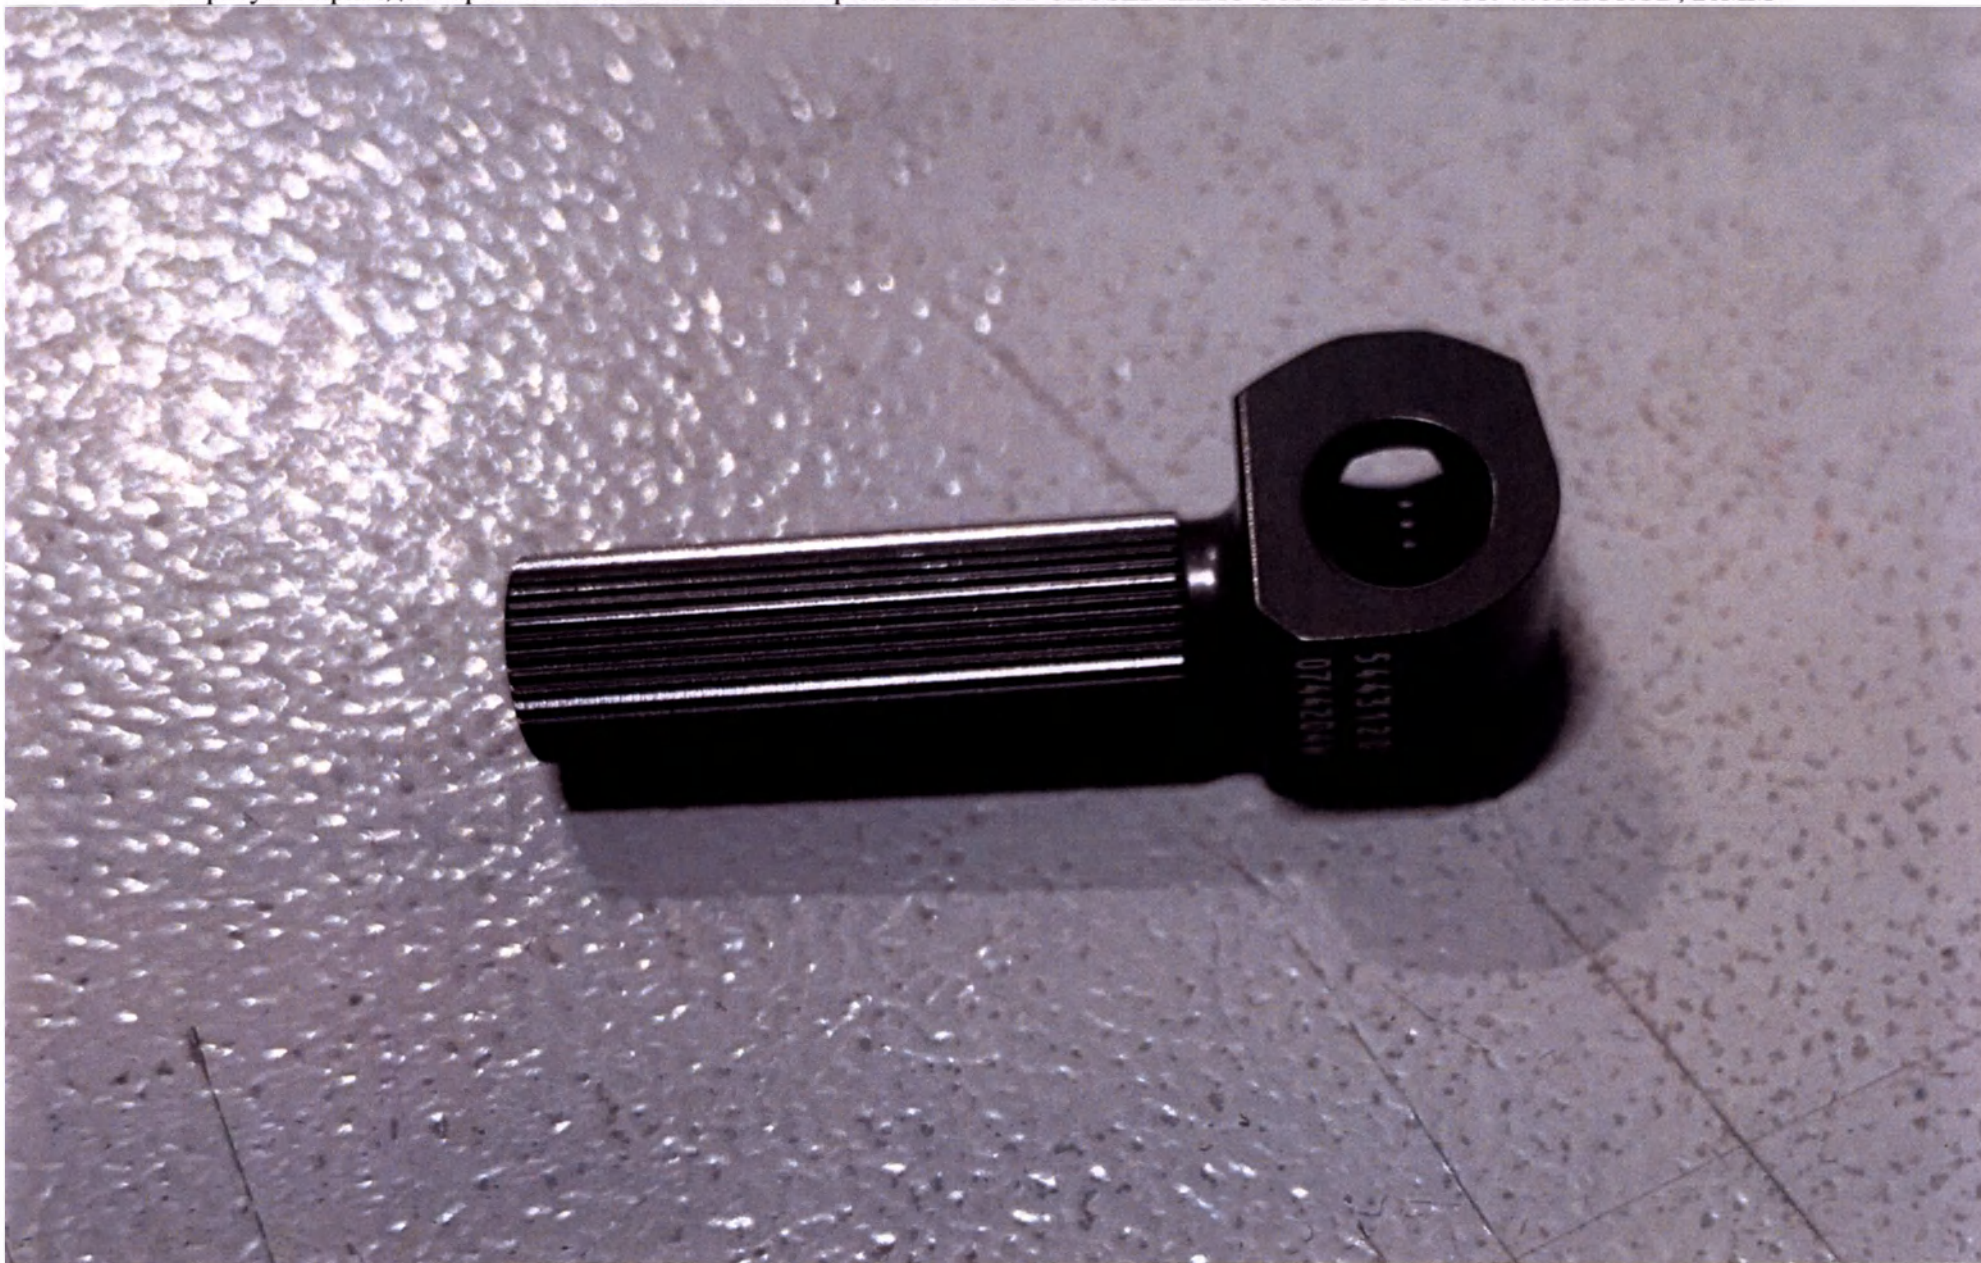

Коннектор CLOSED LATERAL CONNECTOR, 6.35MM POST (п. 1.4-1.9)

Варианты исполнения по п. 1.4-1.9 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор CLOSED LATERAL CONNECTOR 6.35 MM POST, 5.5 MM EYE, 60 MM»



Коннектор DOMINO CONNECTOR, OPEN 5.5MM DIA/ CLOSED 5.5MM DIA



Коннектор LATERAL CONNECTOR SIDE LOAD (п. 1.11-1.13, 1.17-1.19, 1.23-1.25)

Варианты исполнения по п. 1.11-1.13, 1.17-1.19, 1.23-1.25 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор LATERAL CONNECTOR SIDE LOAD, 4.75MM X 5.5MM X 35MM»




Коннектор LATERAL CONNECTOR CLOSED (п. 1.14-1.16, 1.20-1.22)

Варианты исполнения по п. 1.14-1.16, 1.20-1.22 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор LATERAL CONNECTOR CLOSED, 4.75MM X 5.5MM X 35MM»




Коннектор MULTI-SPAN PLATE (п. 1.26-1.41)

Варианты исполнения по п. 1.26-1.41 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор CONNECTOR MULTI-SPAN PLATE FOR 4.75 ROD, 35MM/42MM»

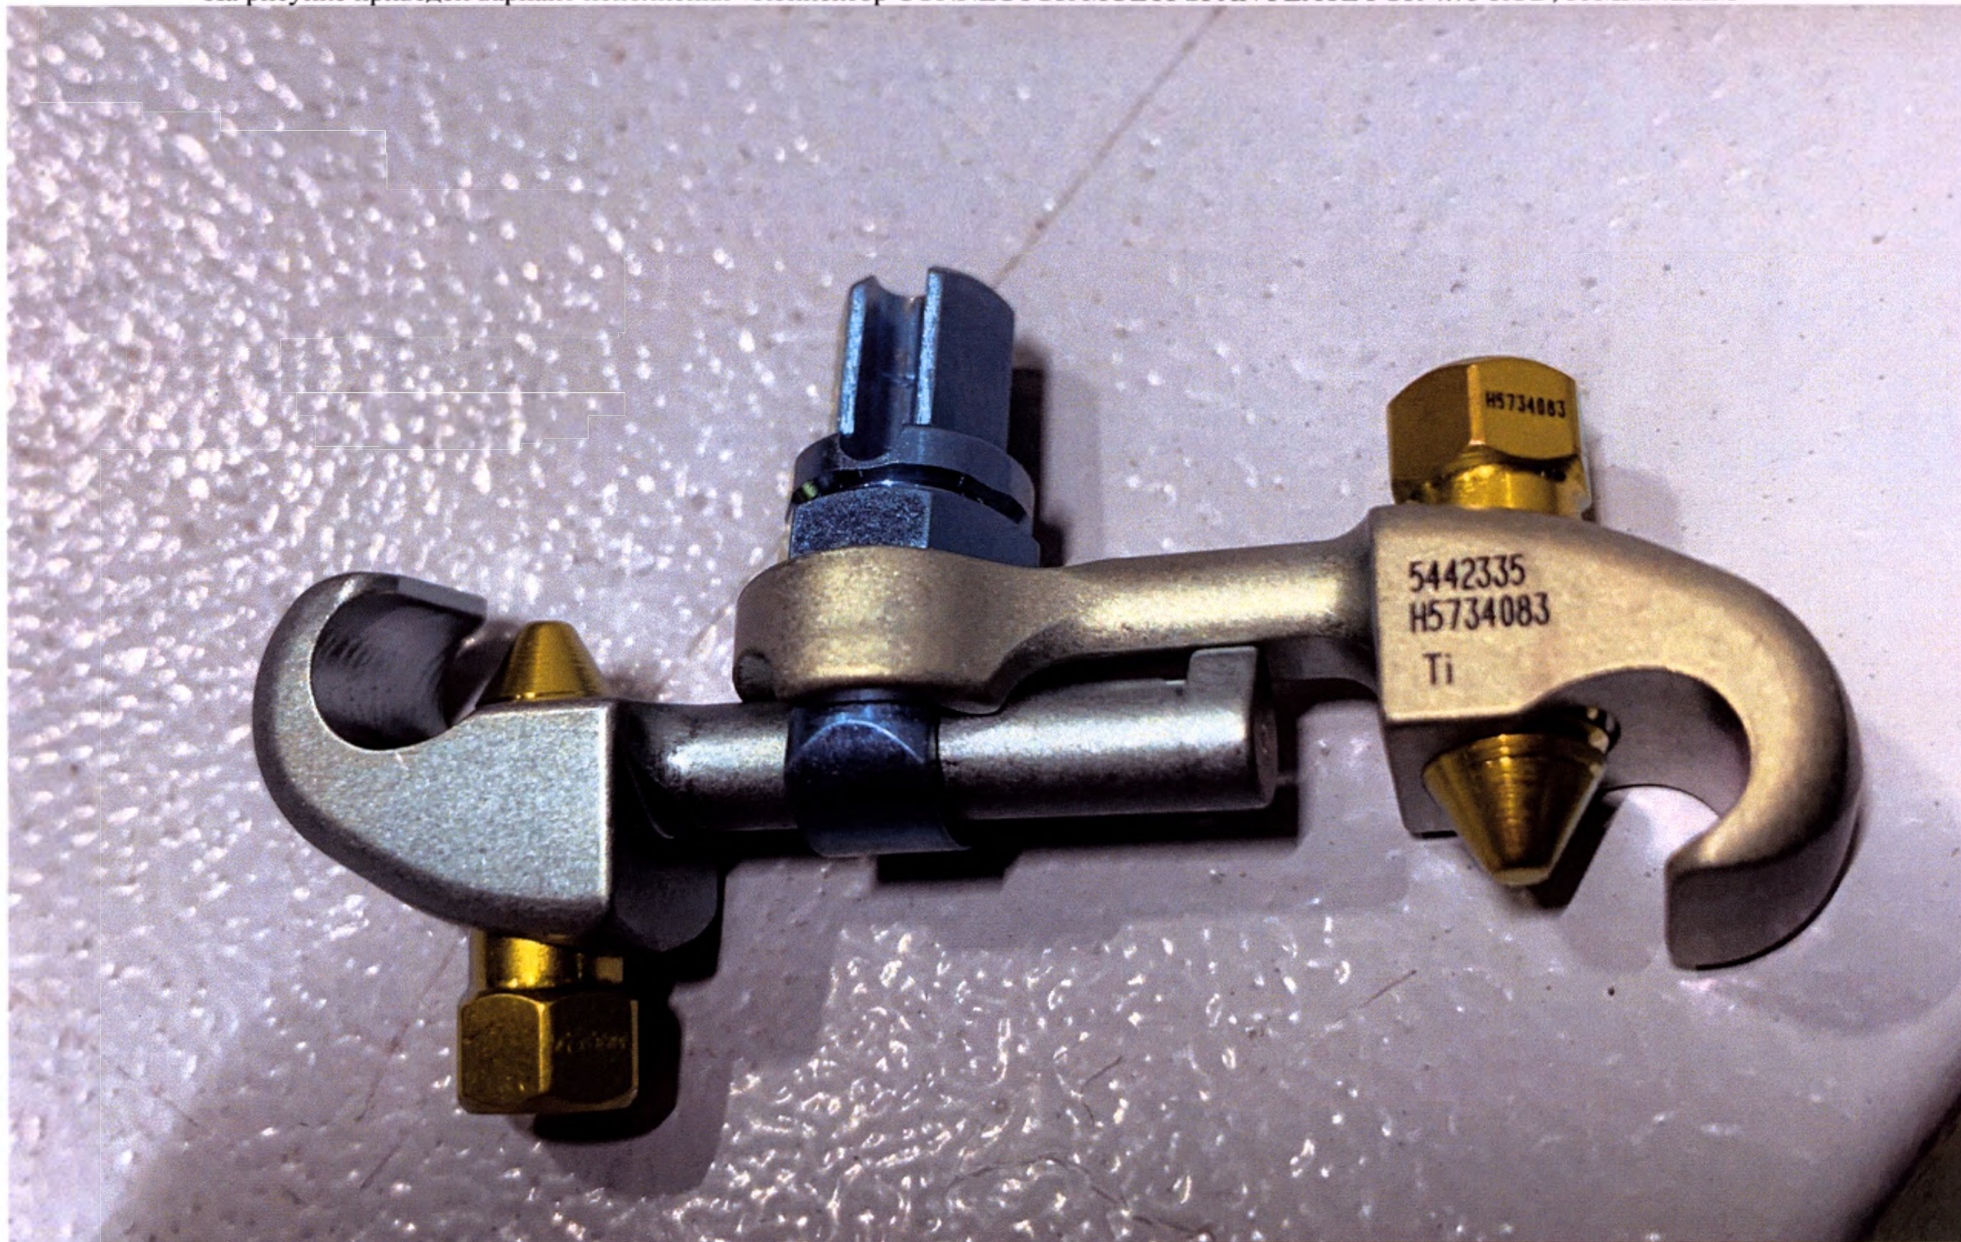


Коннектор поперечный FIXED X10 CROSSLINK PLATE FOR 4.75 ROD (п. 2.1–2.6)

Варианты исполнения по п. 2.1–2.6 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор поперечный FIXED X10 CROSSLINK PLATE FOR 4.75 ROD, 25MM»

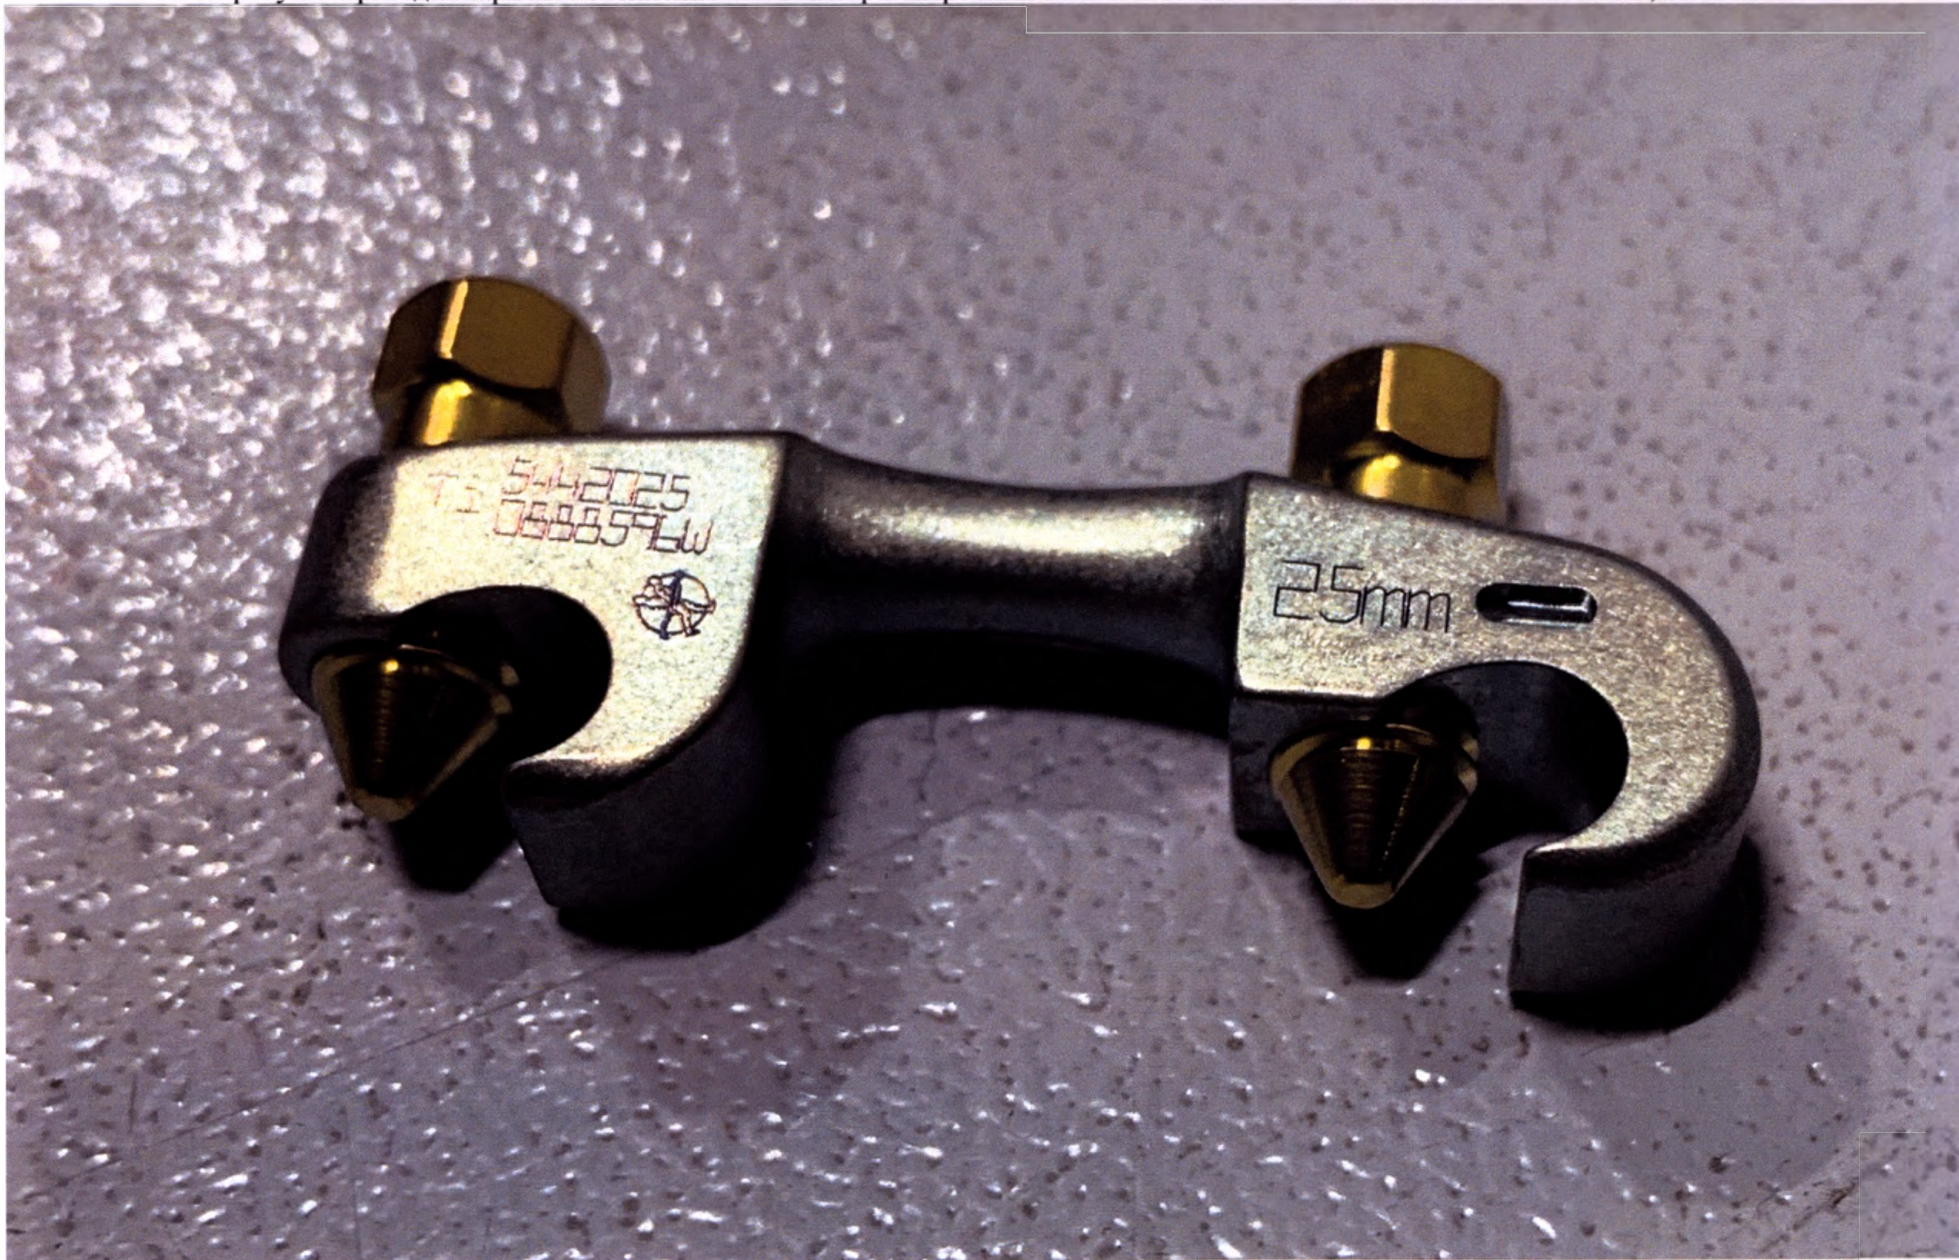


Коннектор поперечный MULTI-SPAN X10 CROSSLINK PLATE FOR 4.75MM ROD (п. 2.7-2.13)
Варианты исполнения по п. 2.7-2.13 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор поперечный MULTI-SPAN X10 CROSSLINK PLATE FOR 4.75MM ROD, 38MM/42MM»

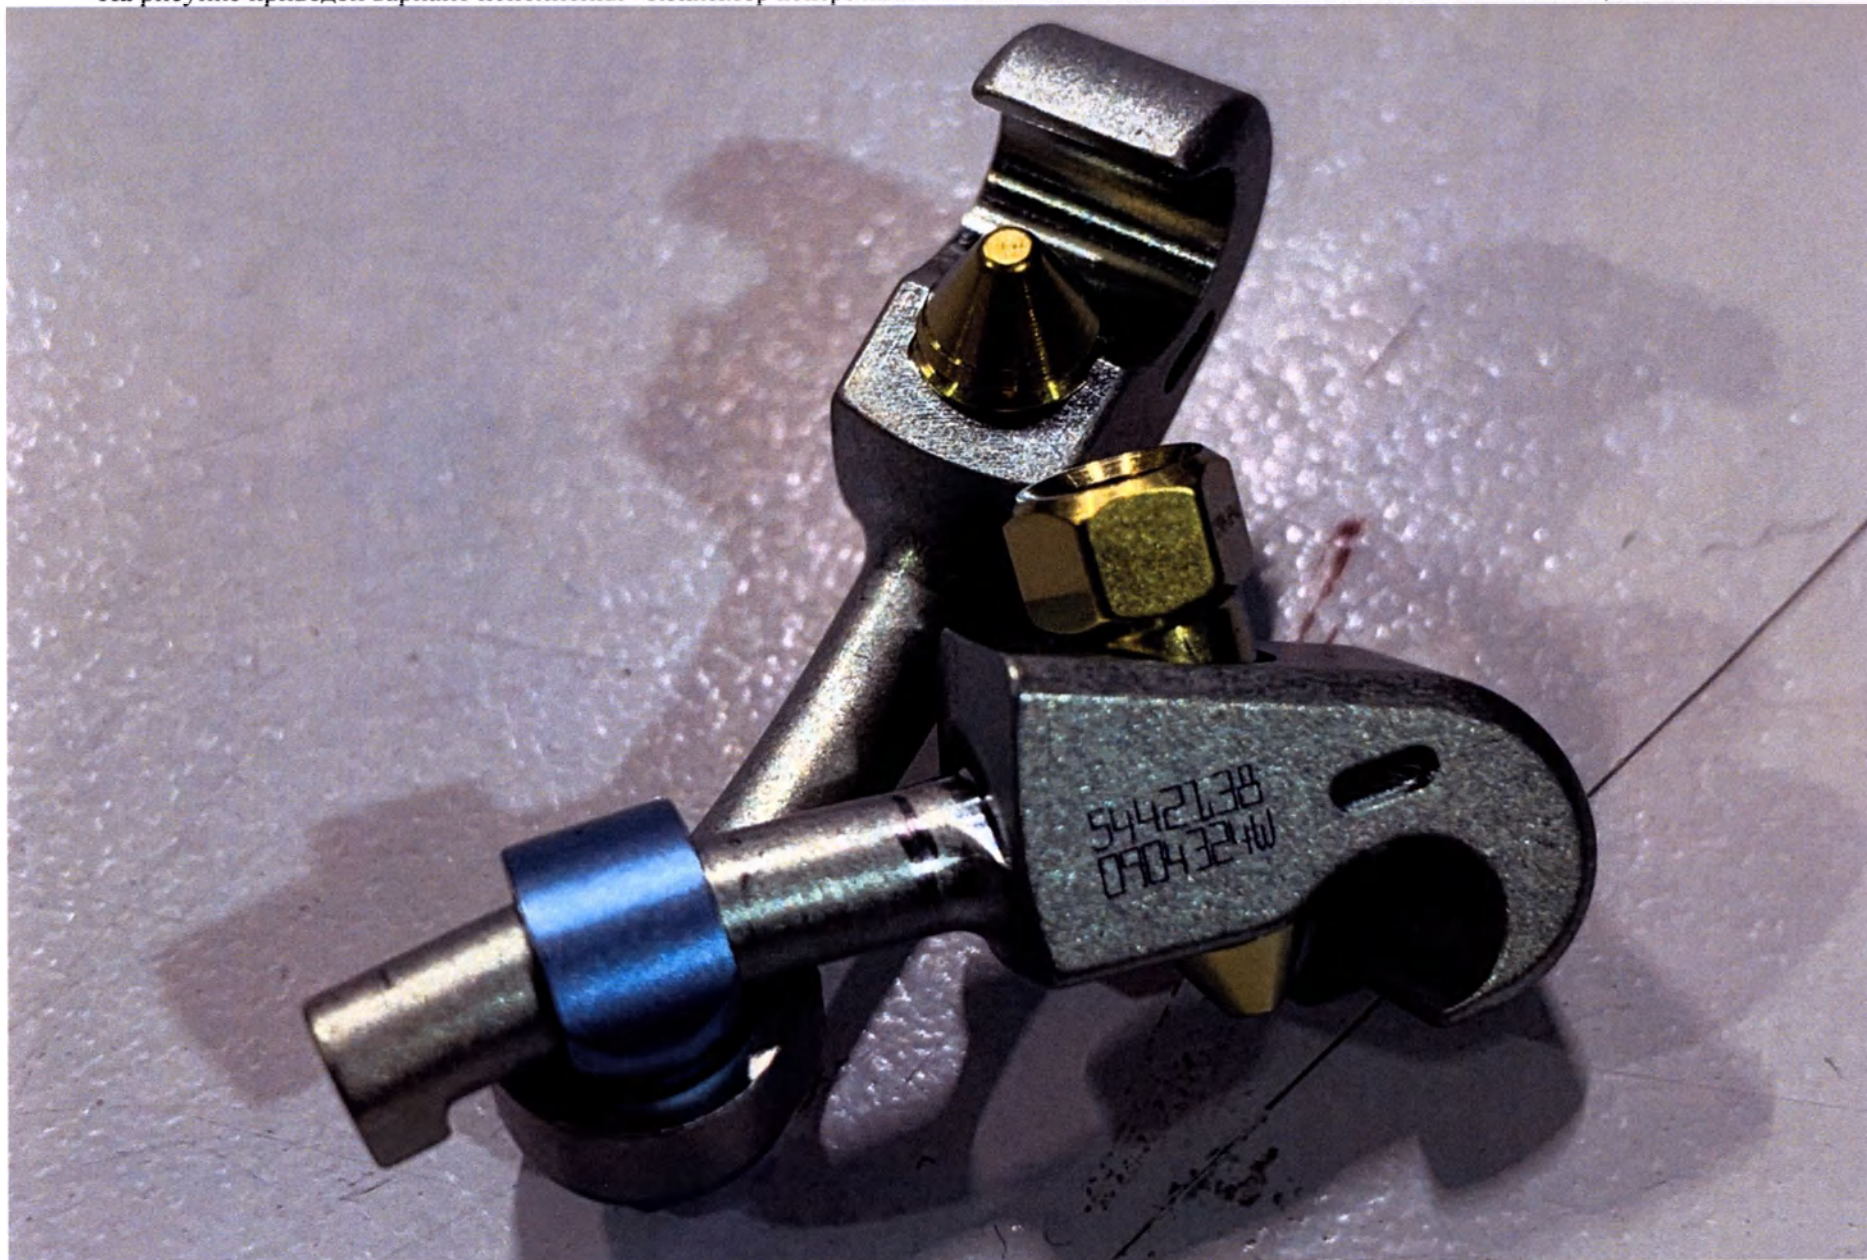


Коннектор поперечный X10 CROSSLINK PLATE 5.5MM, 16MM-25MM (п. 2.14-2.17)
Варианты исполнения по п. 2.14-2.17 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор поперечный X10 CROSSLINK PLATE 5.5MM, 16MM»




Коннектор поперечный X10 CROSSLINK PLATE 5.5MM, Коннектор поперечный X10 CROSSLINK PLATE 6.35MM (п. 2.18-2.31)
Варианты исполнения по п. 2.18-2.31 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор поперечный X10 CROSSLINK PLATE 5.5MM, 34-36MM»

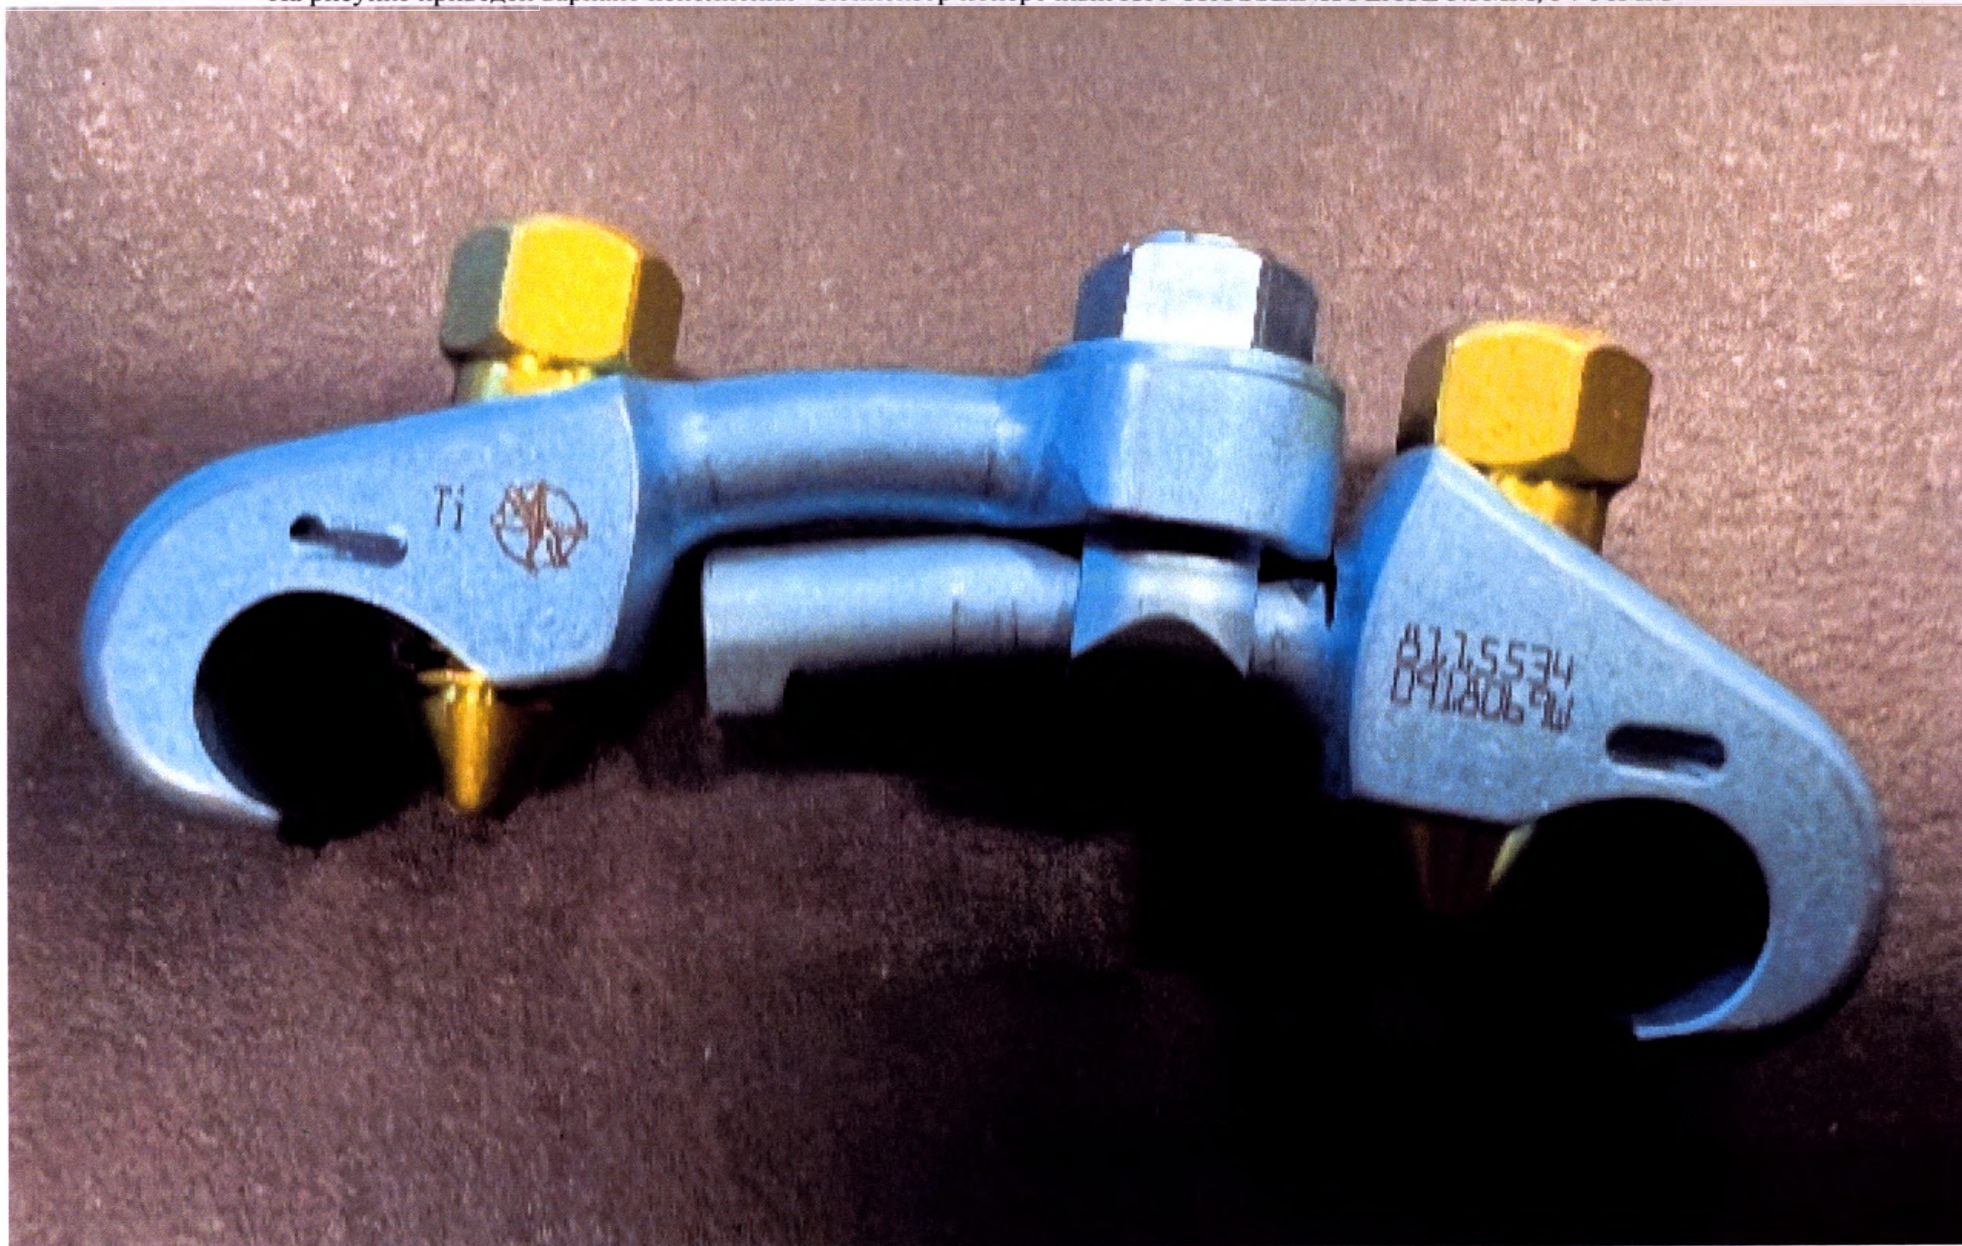

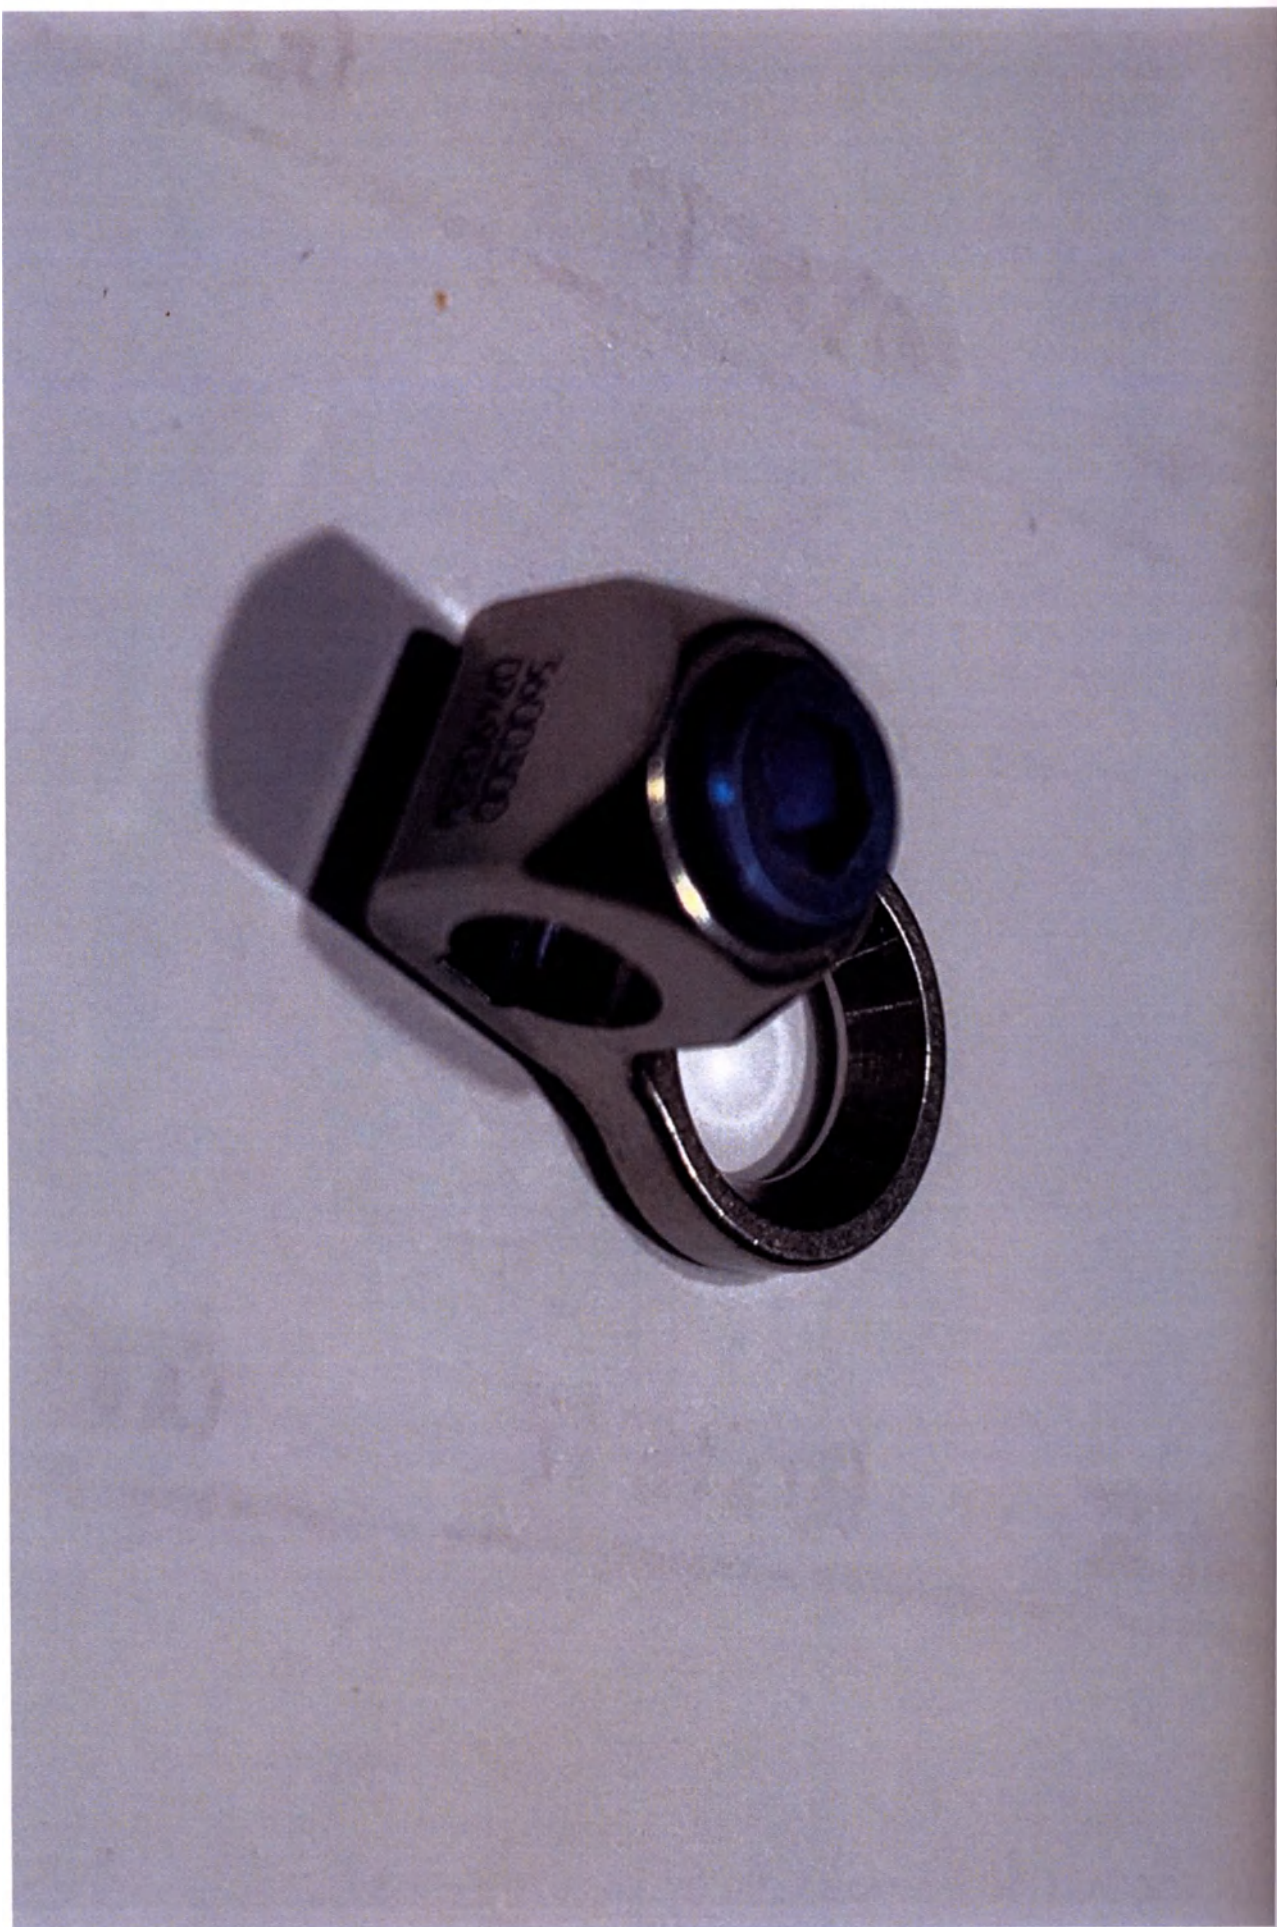



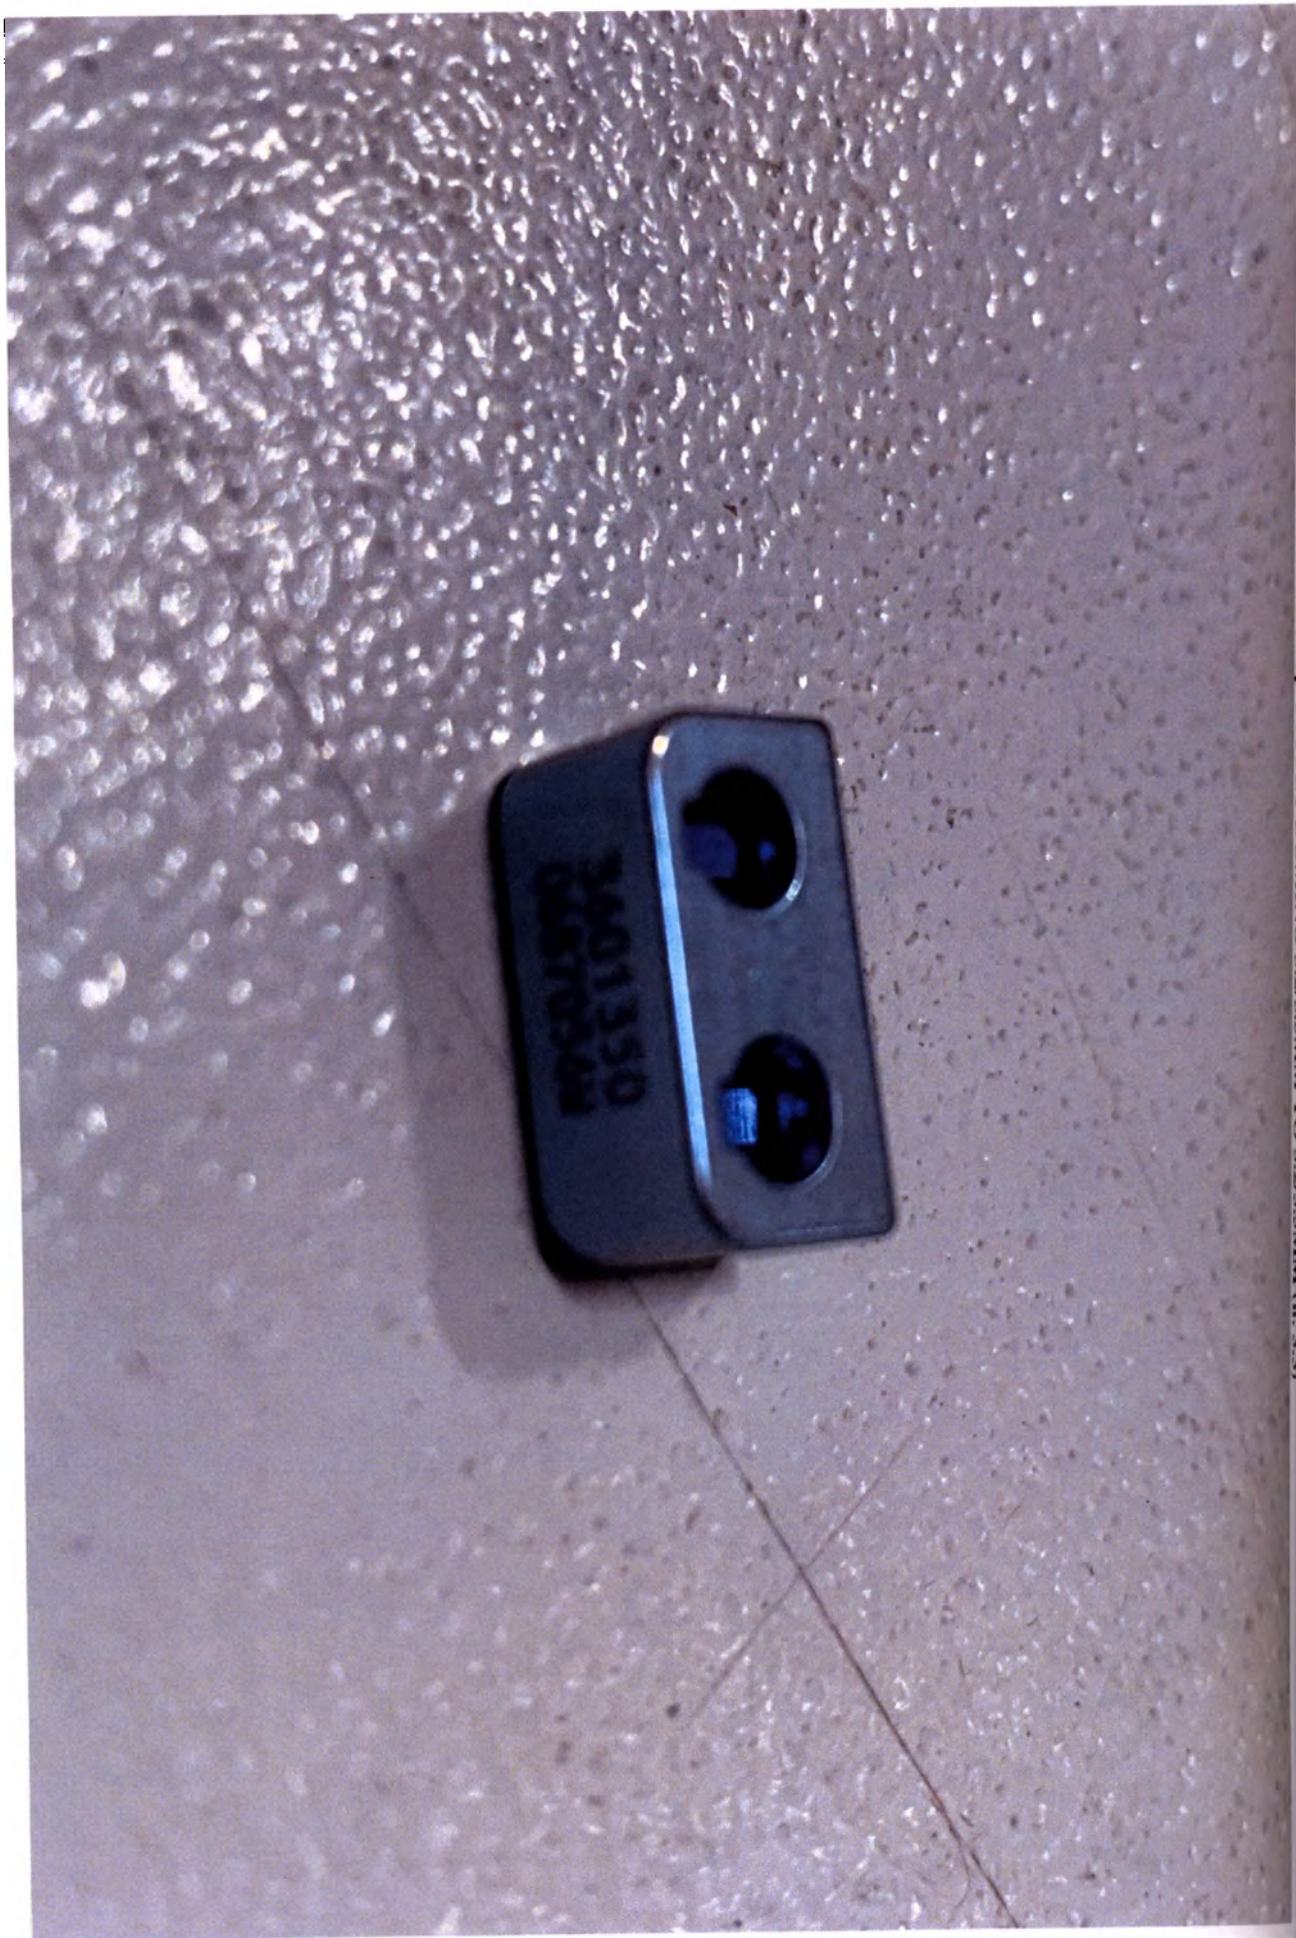





ГОСТ 12345-2015 ГОСТ 6789-2015 ГОСТ 12345-2015 ГОСТ 6789-2015
















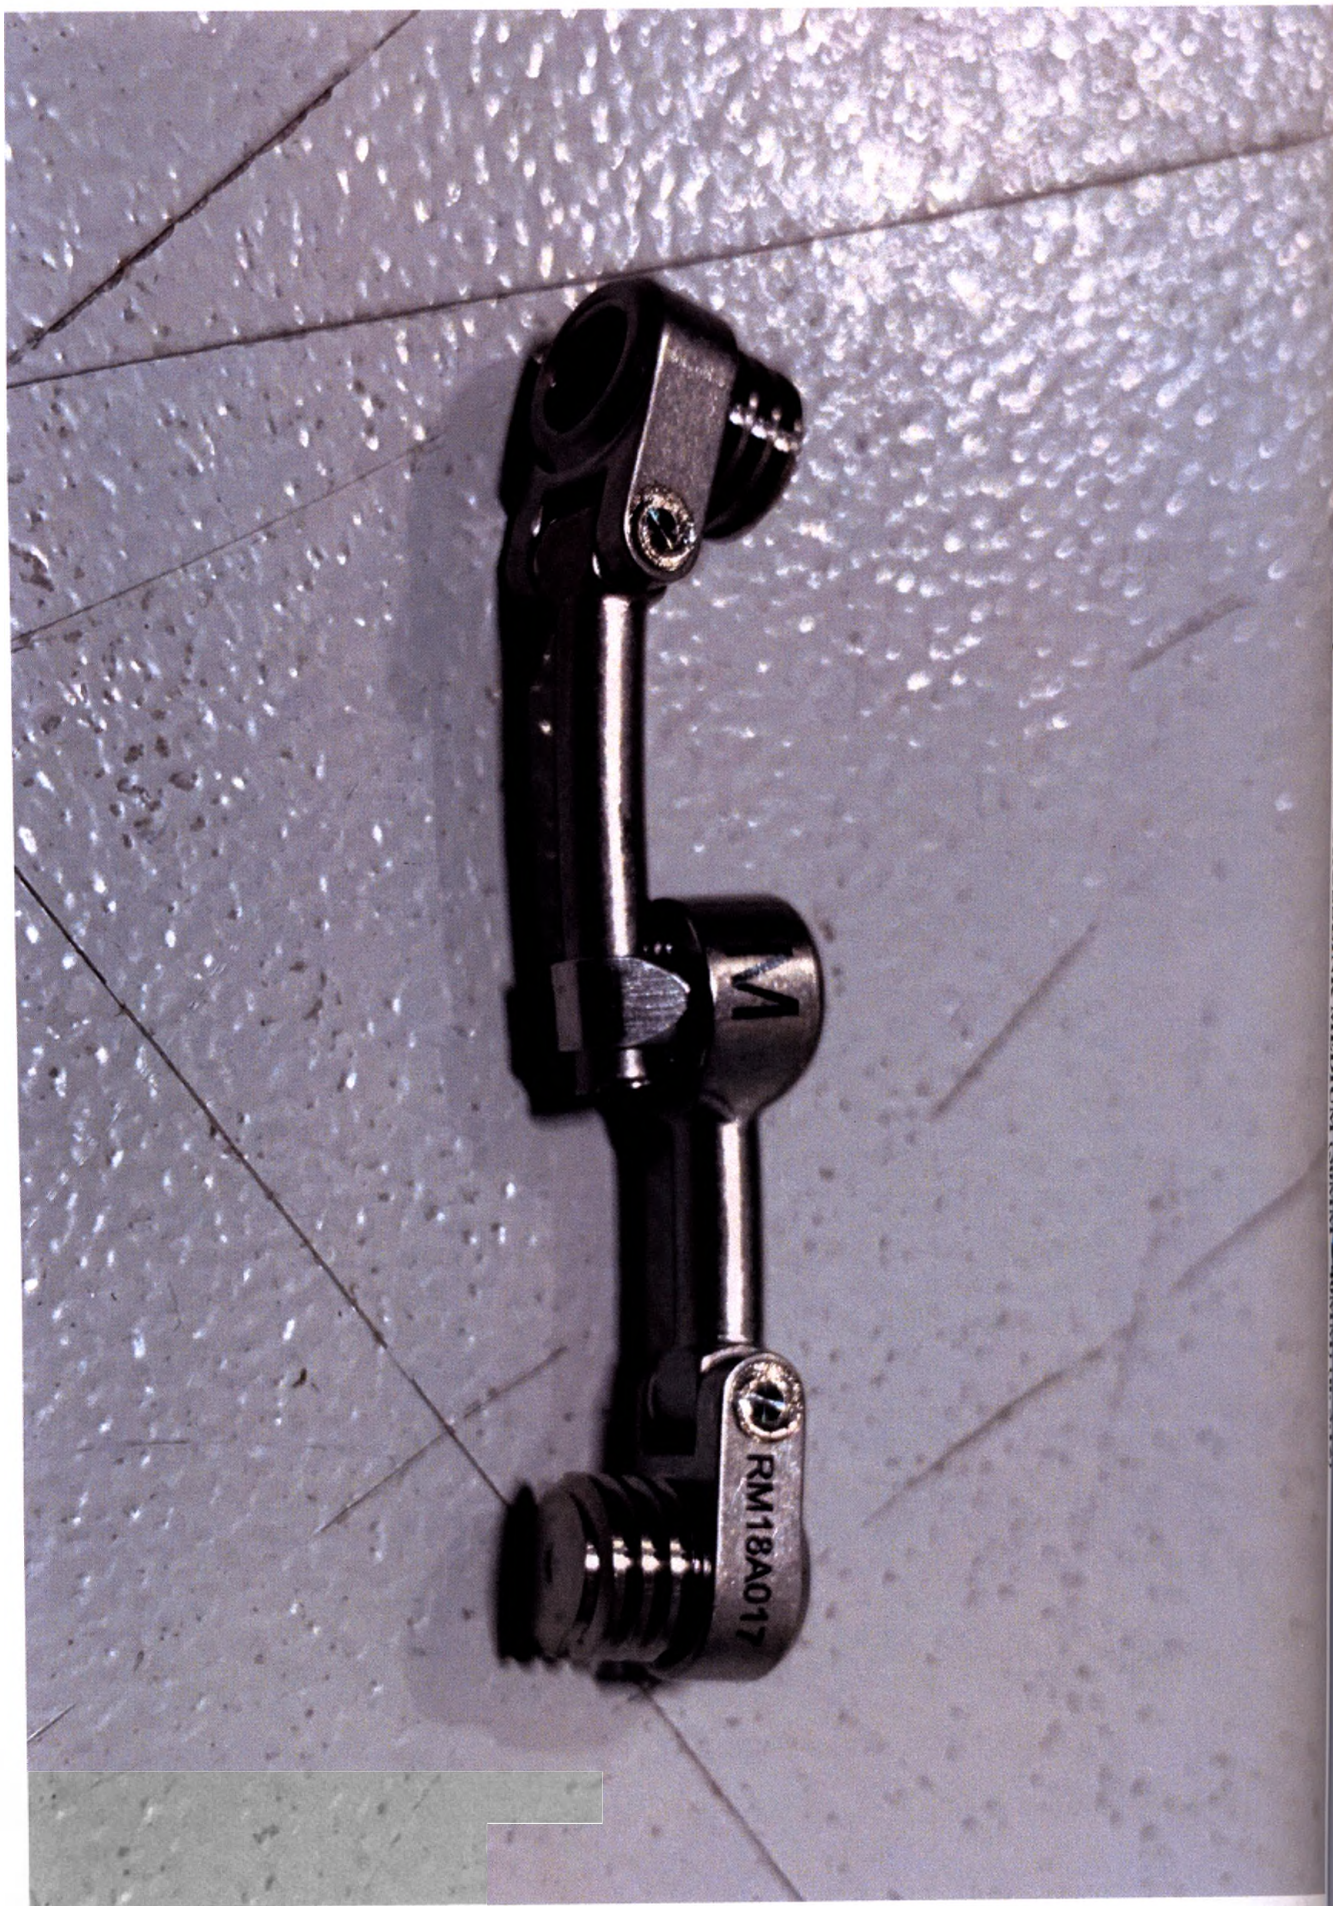





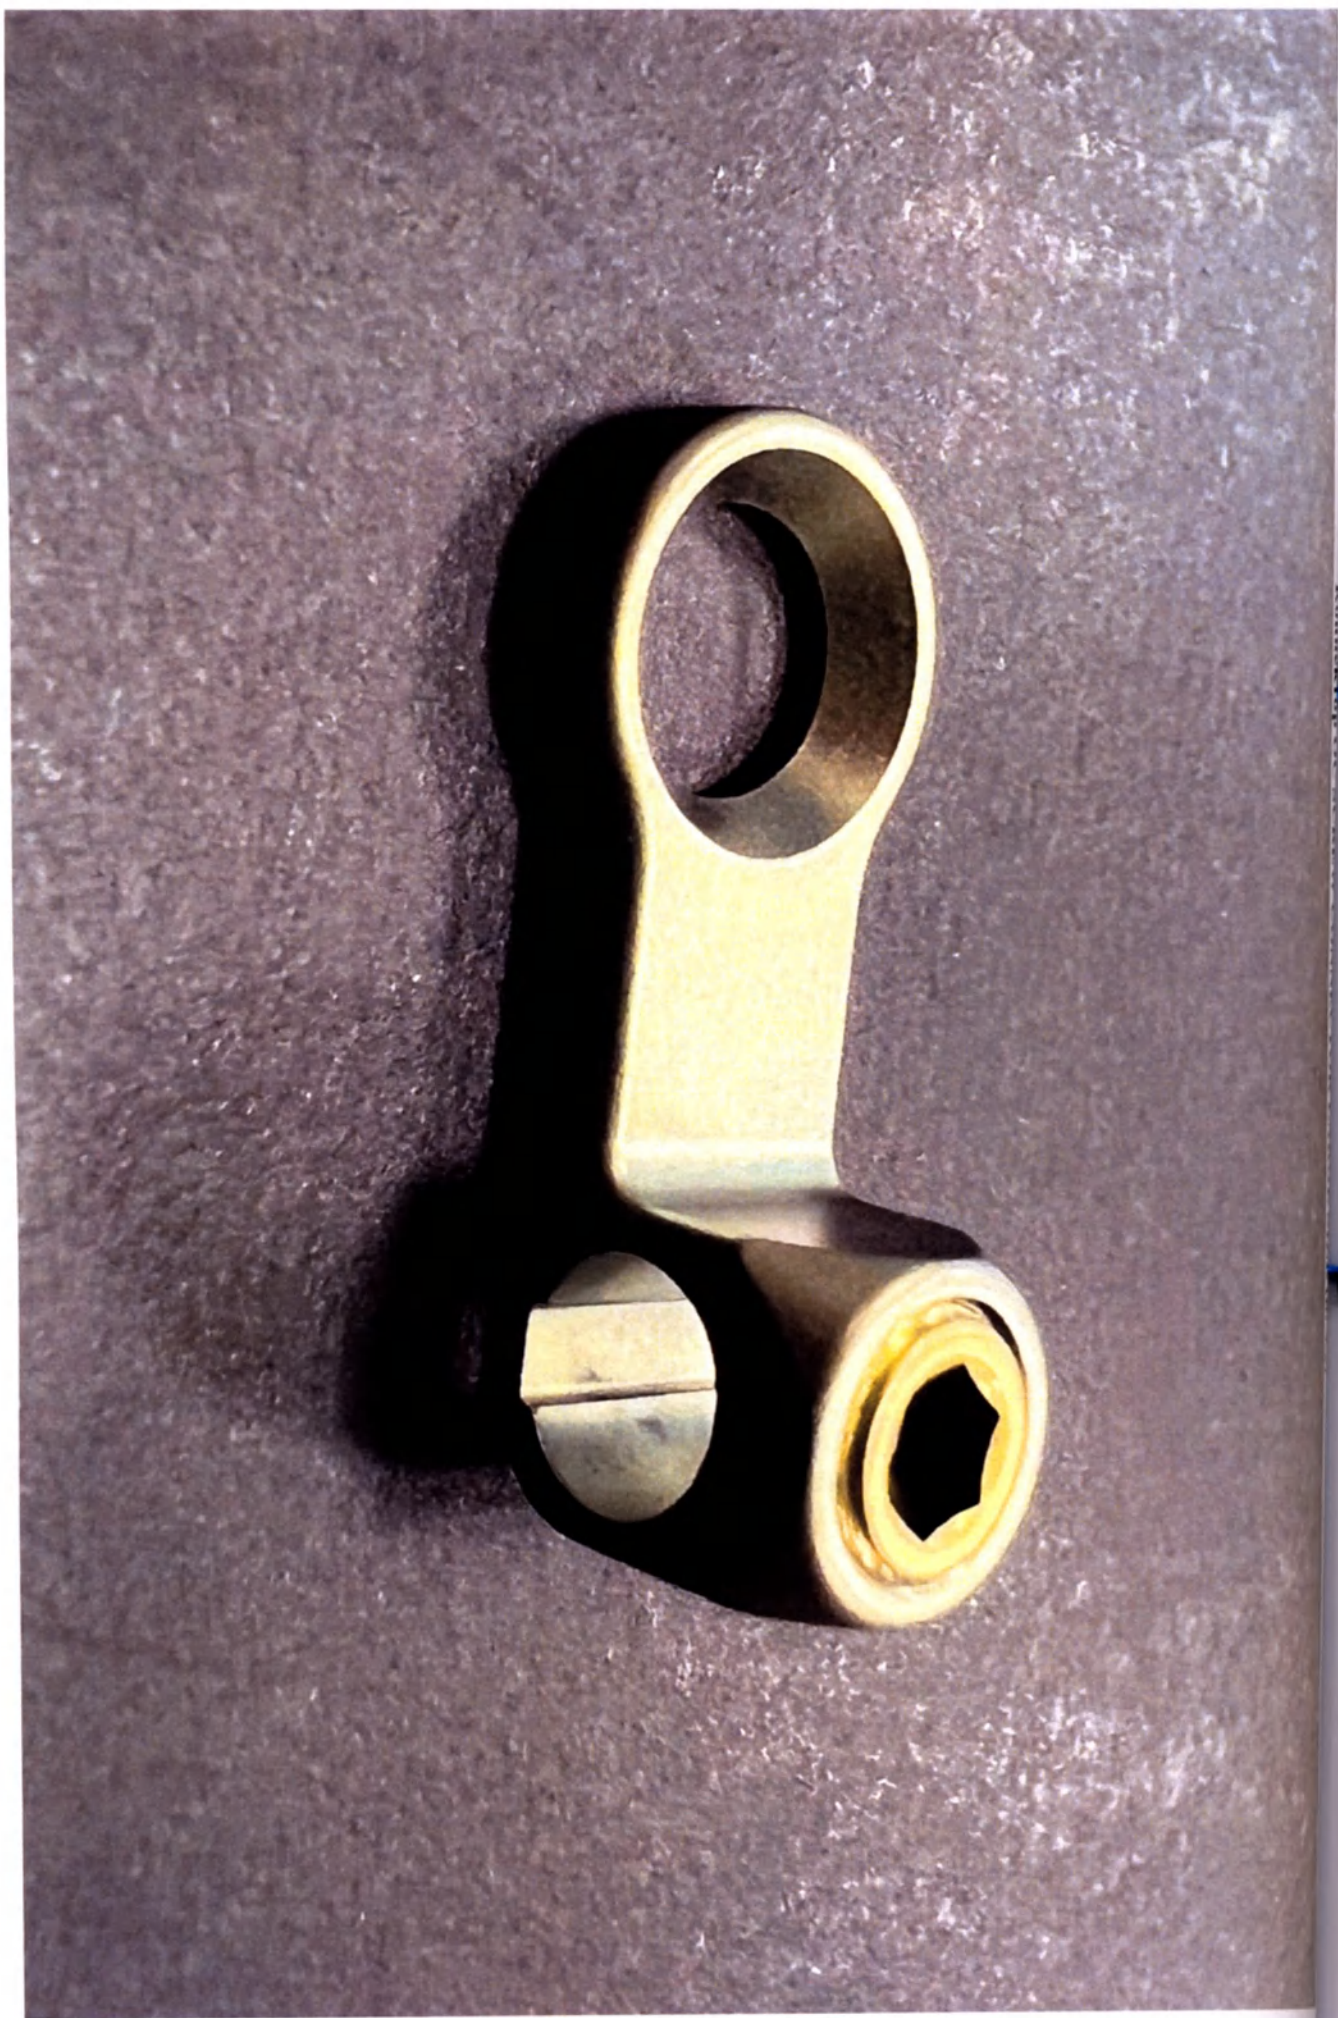


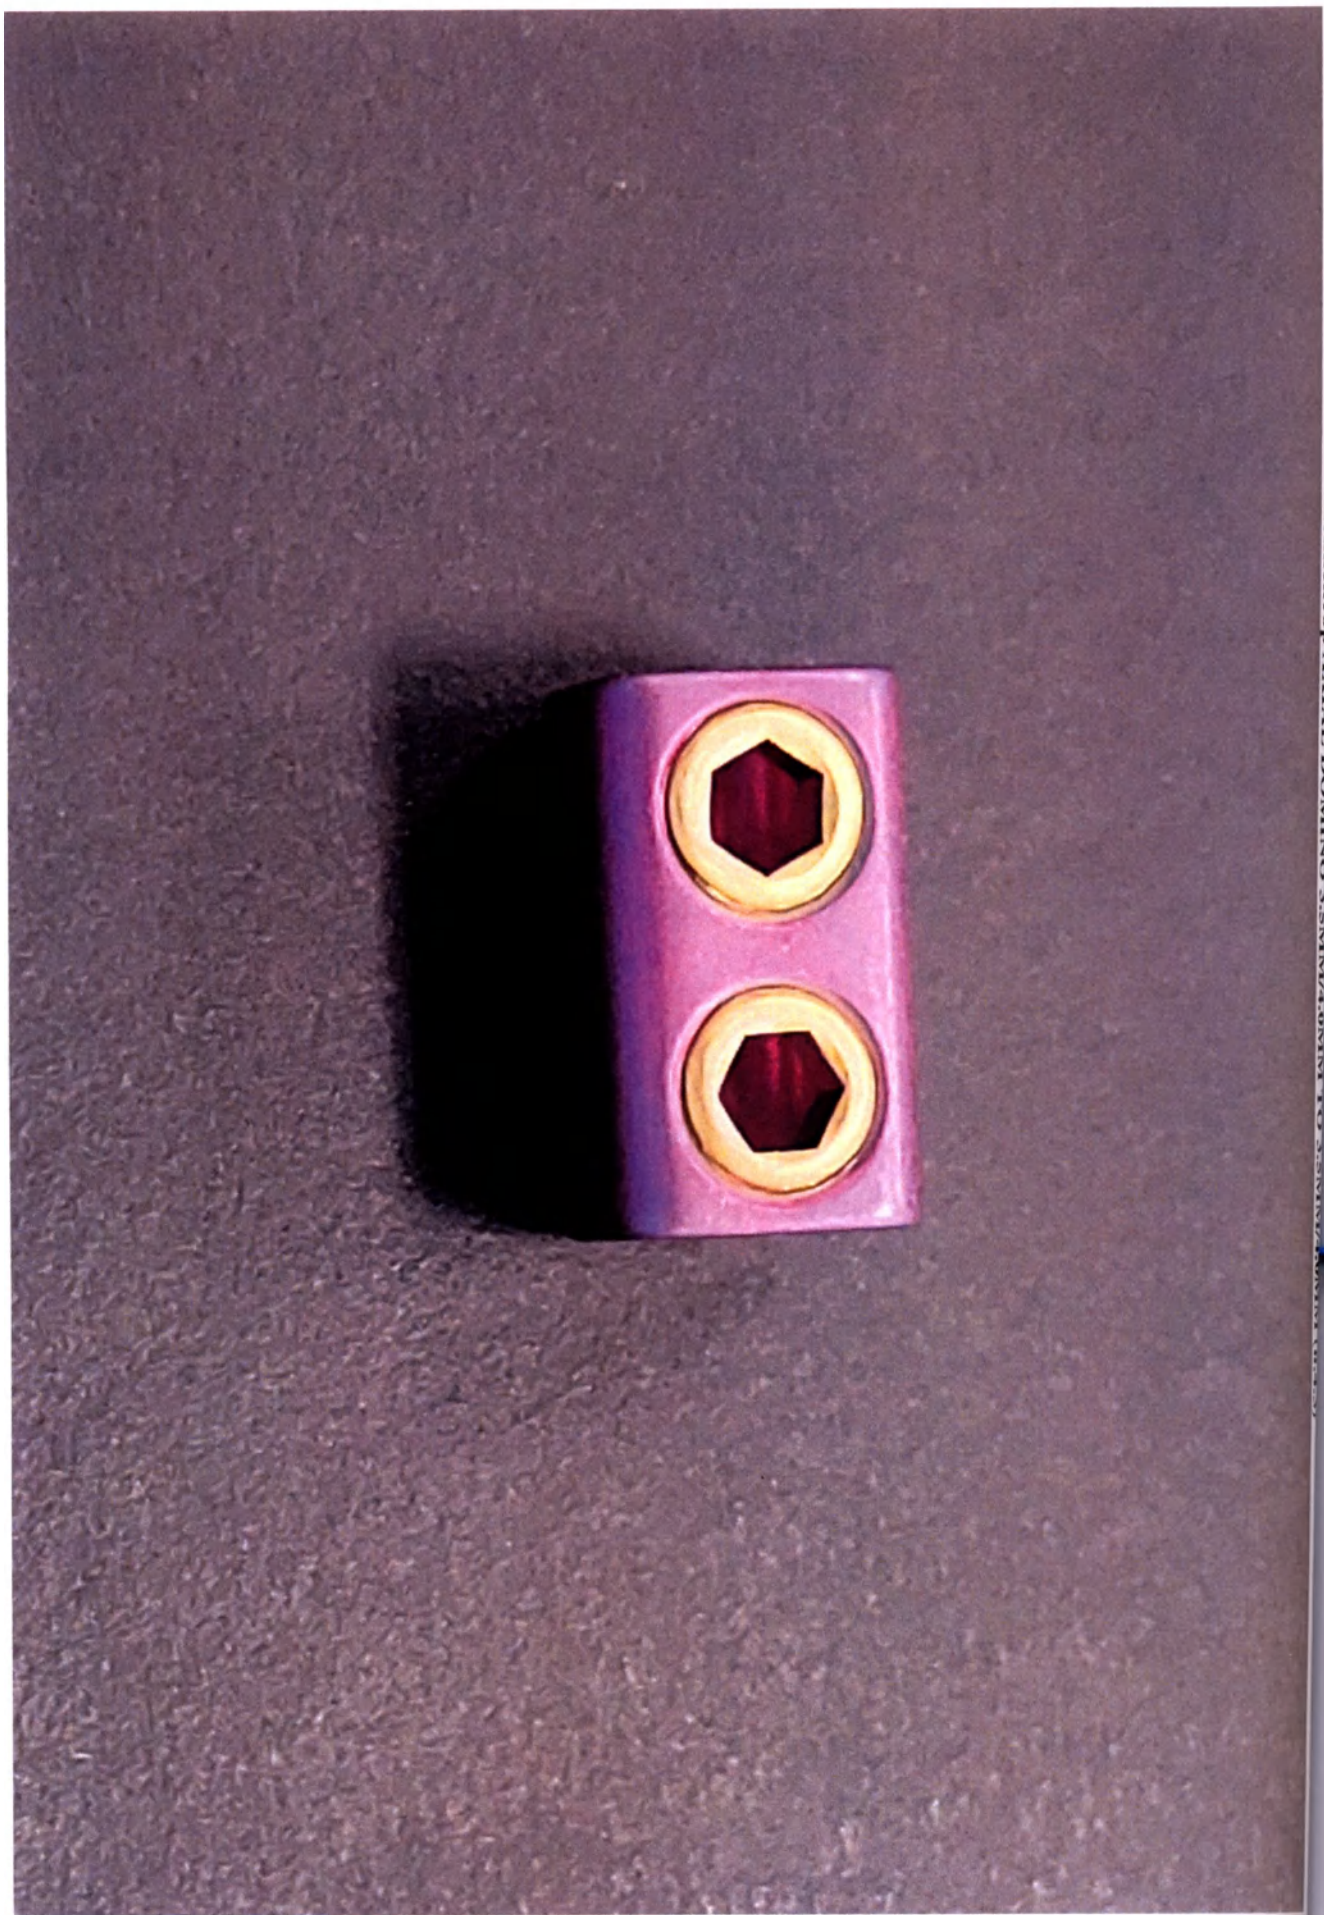










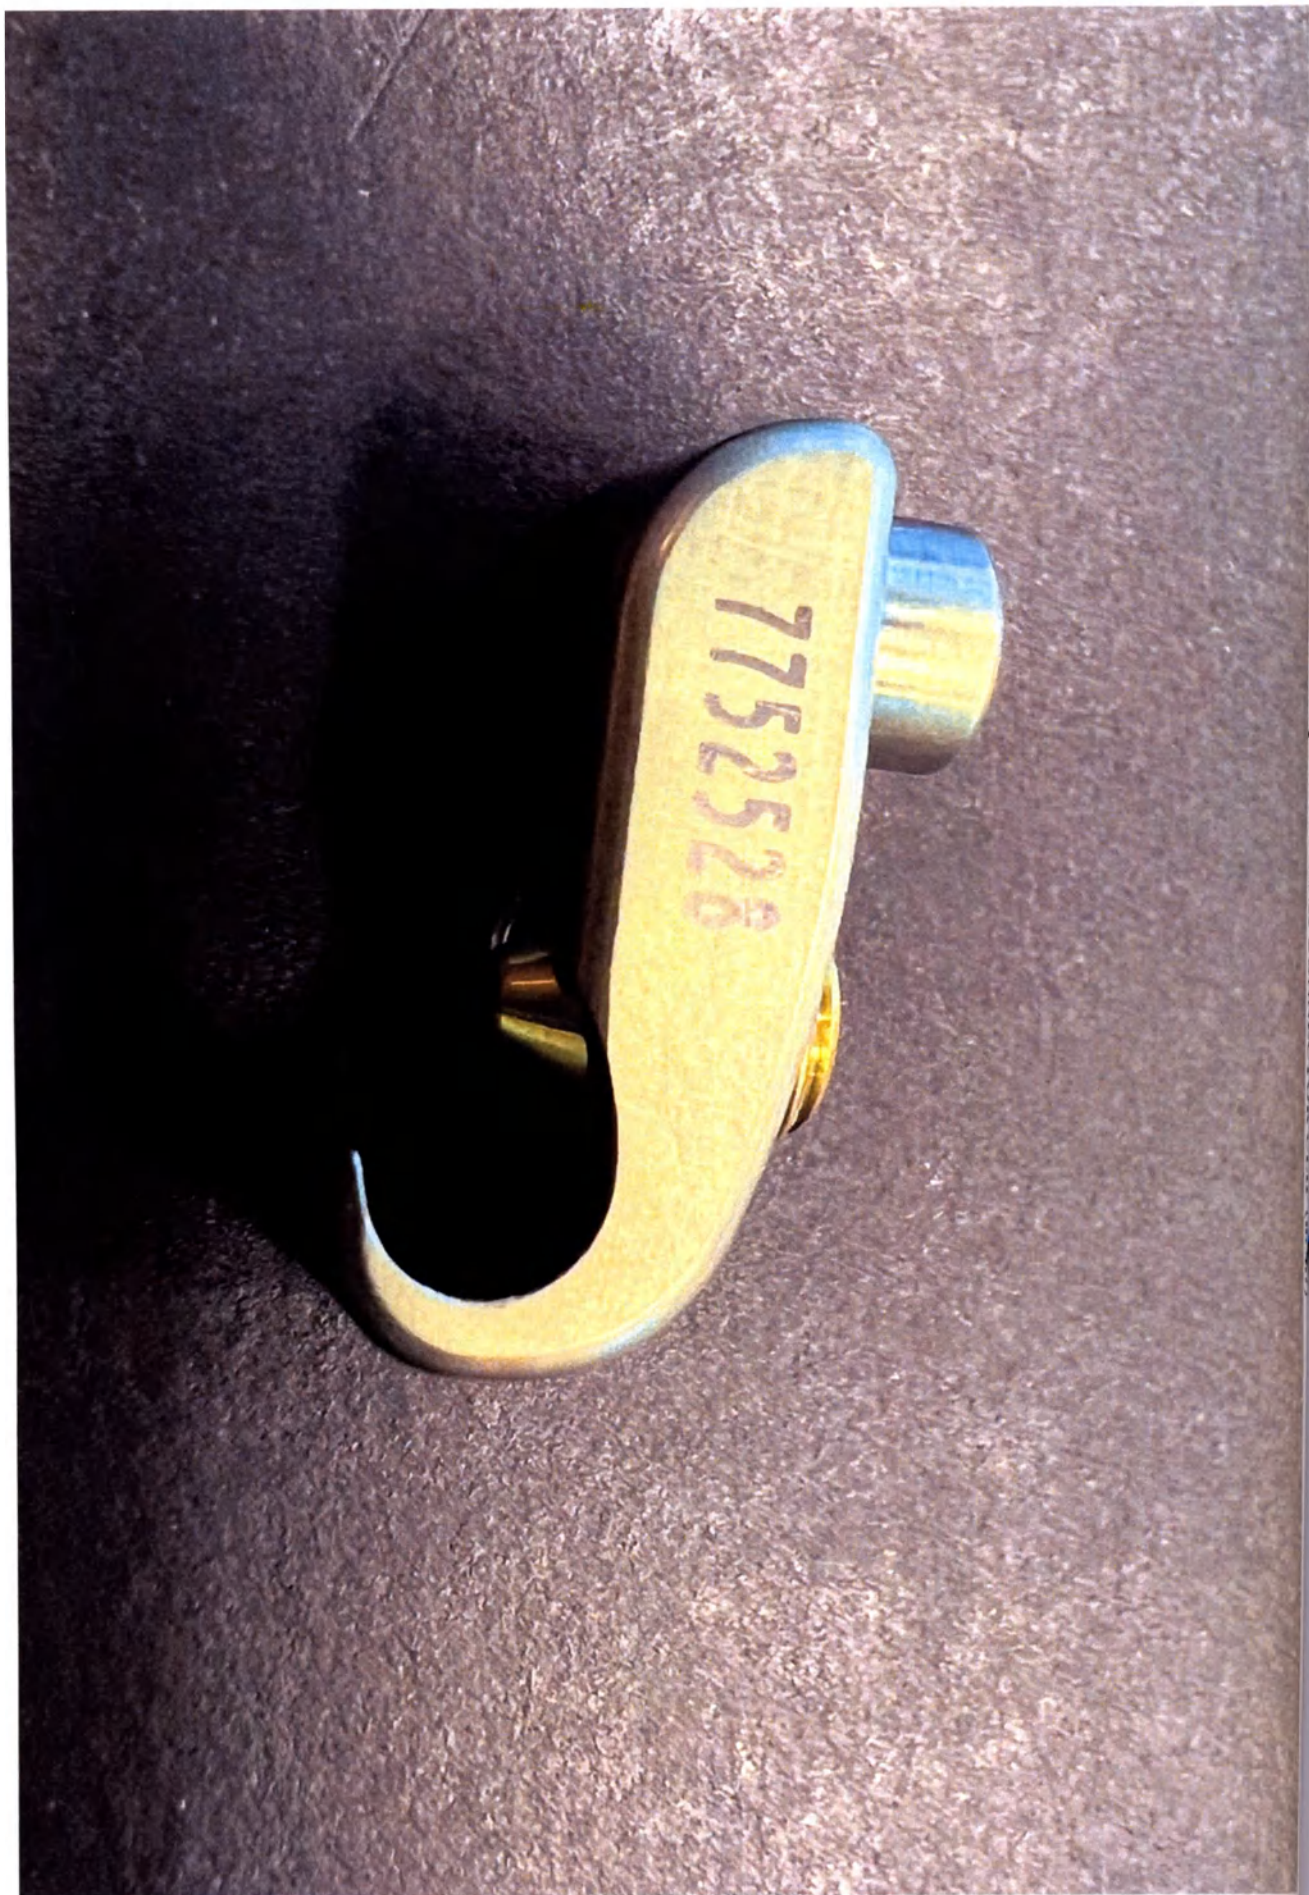


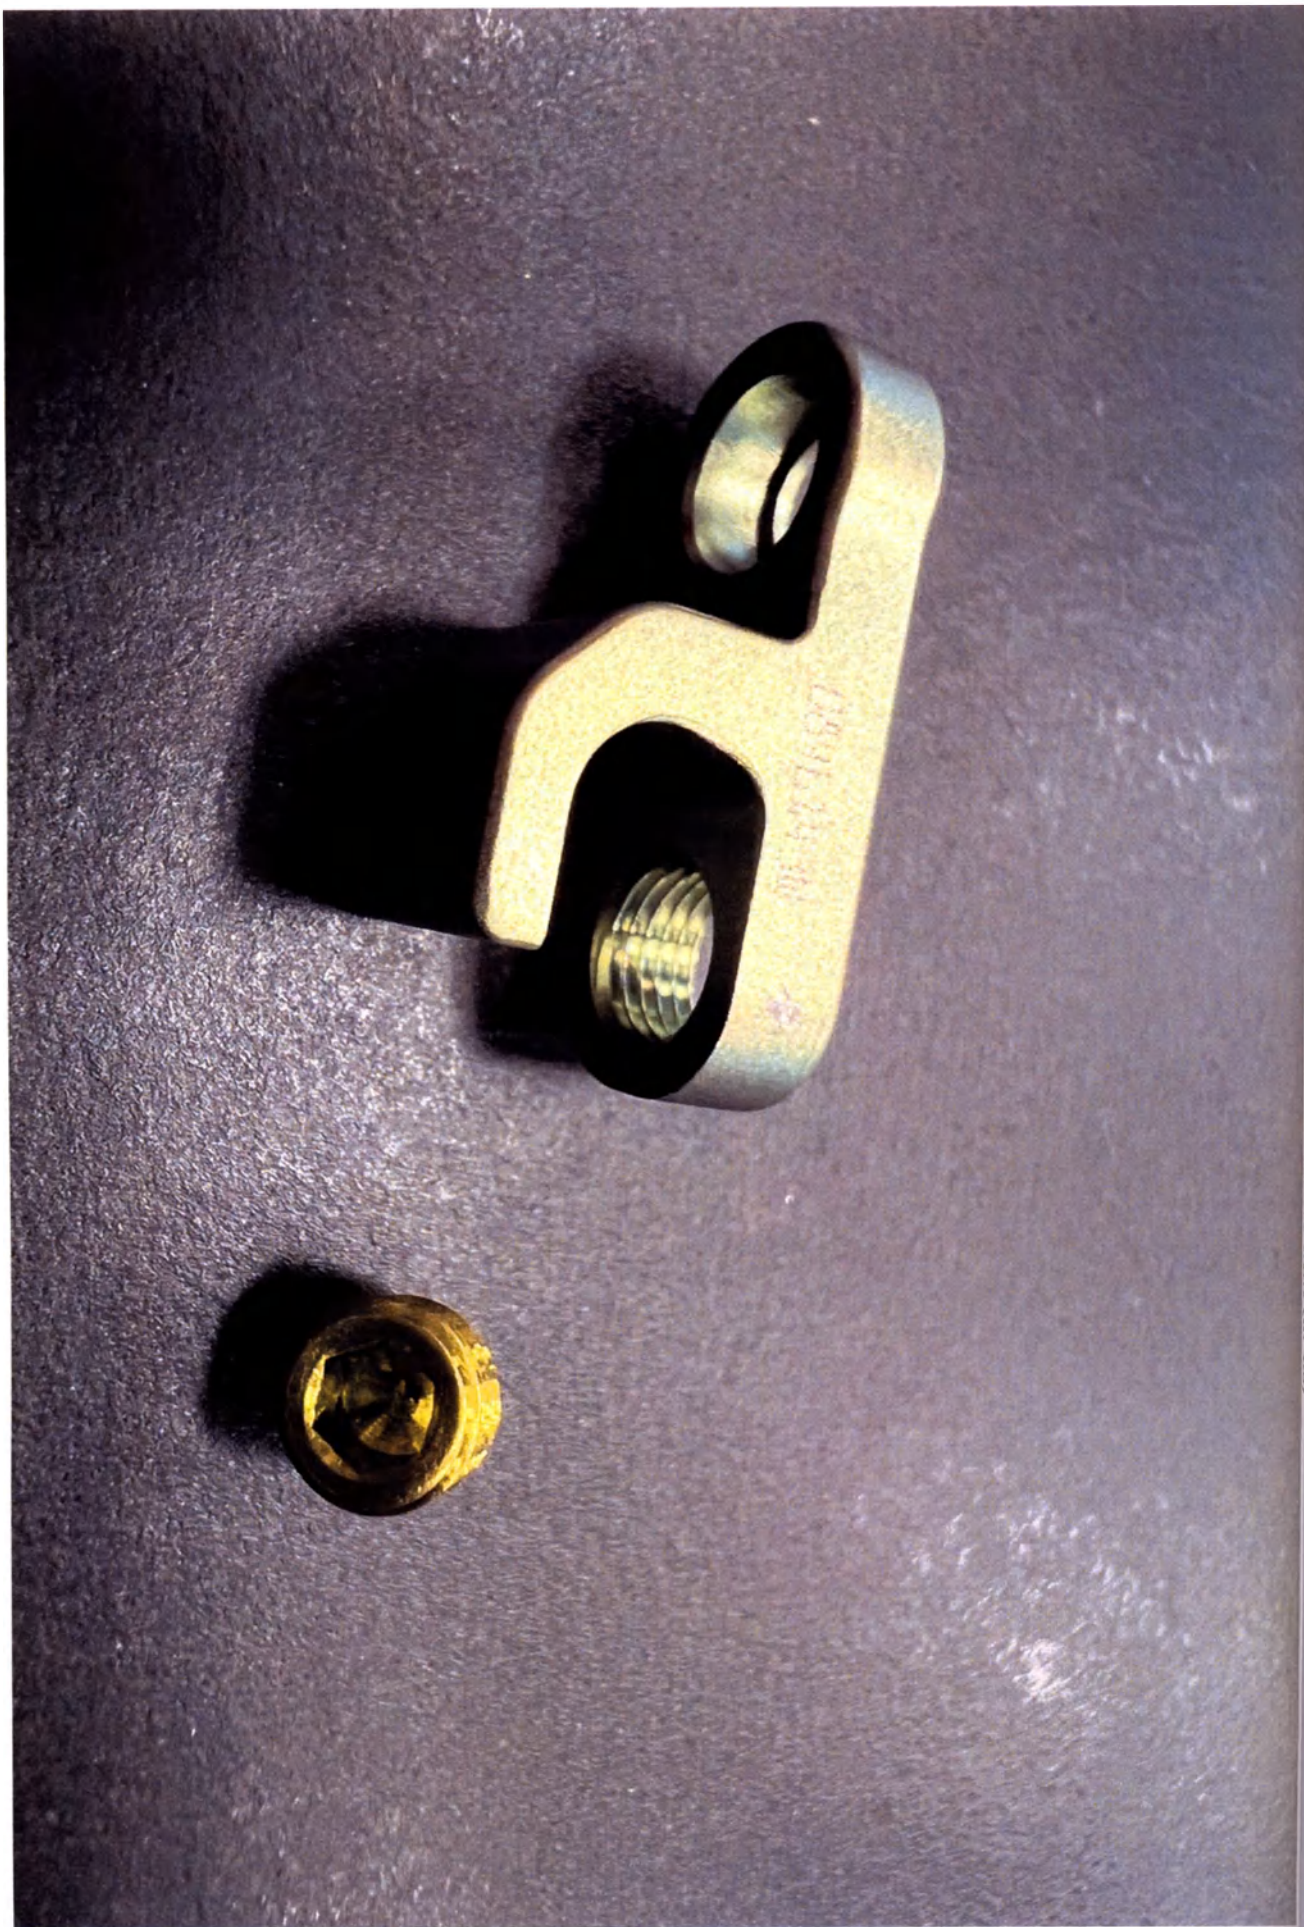

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЕВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЕВ

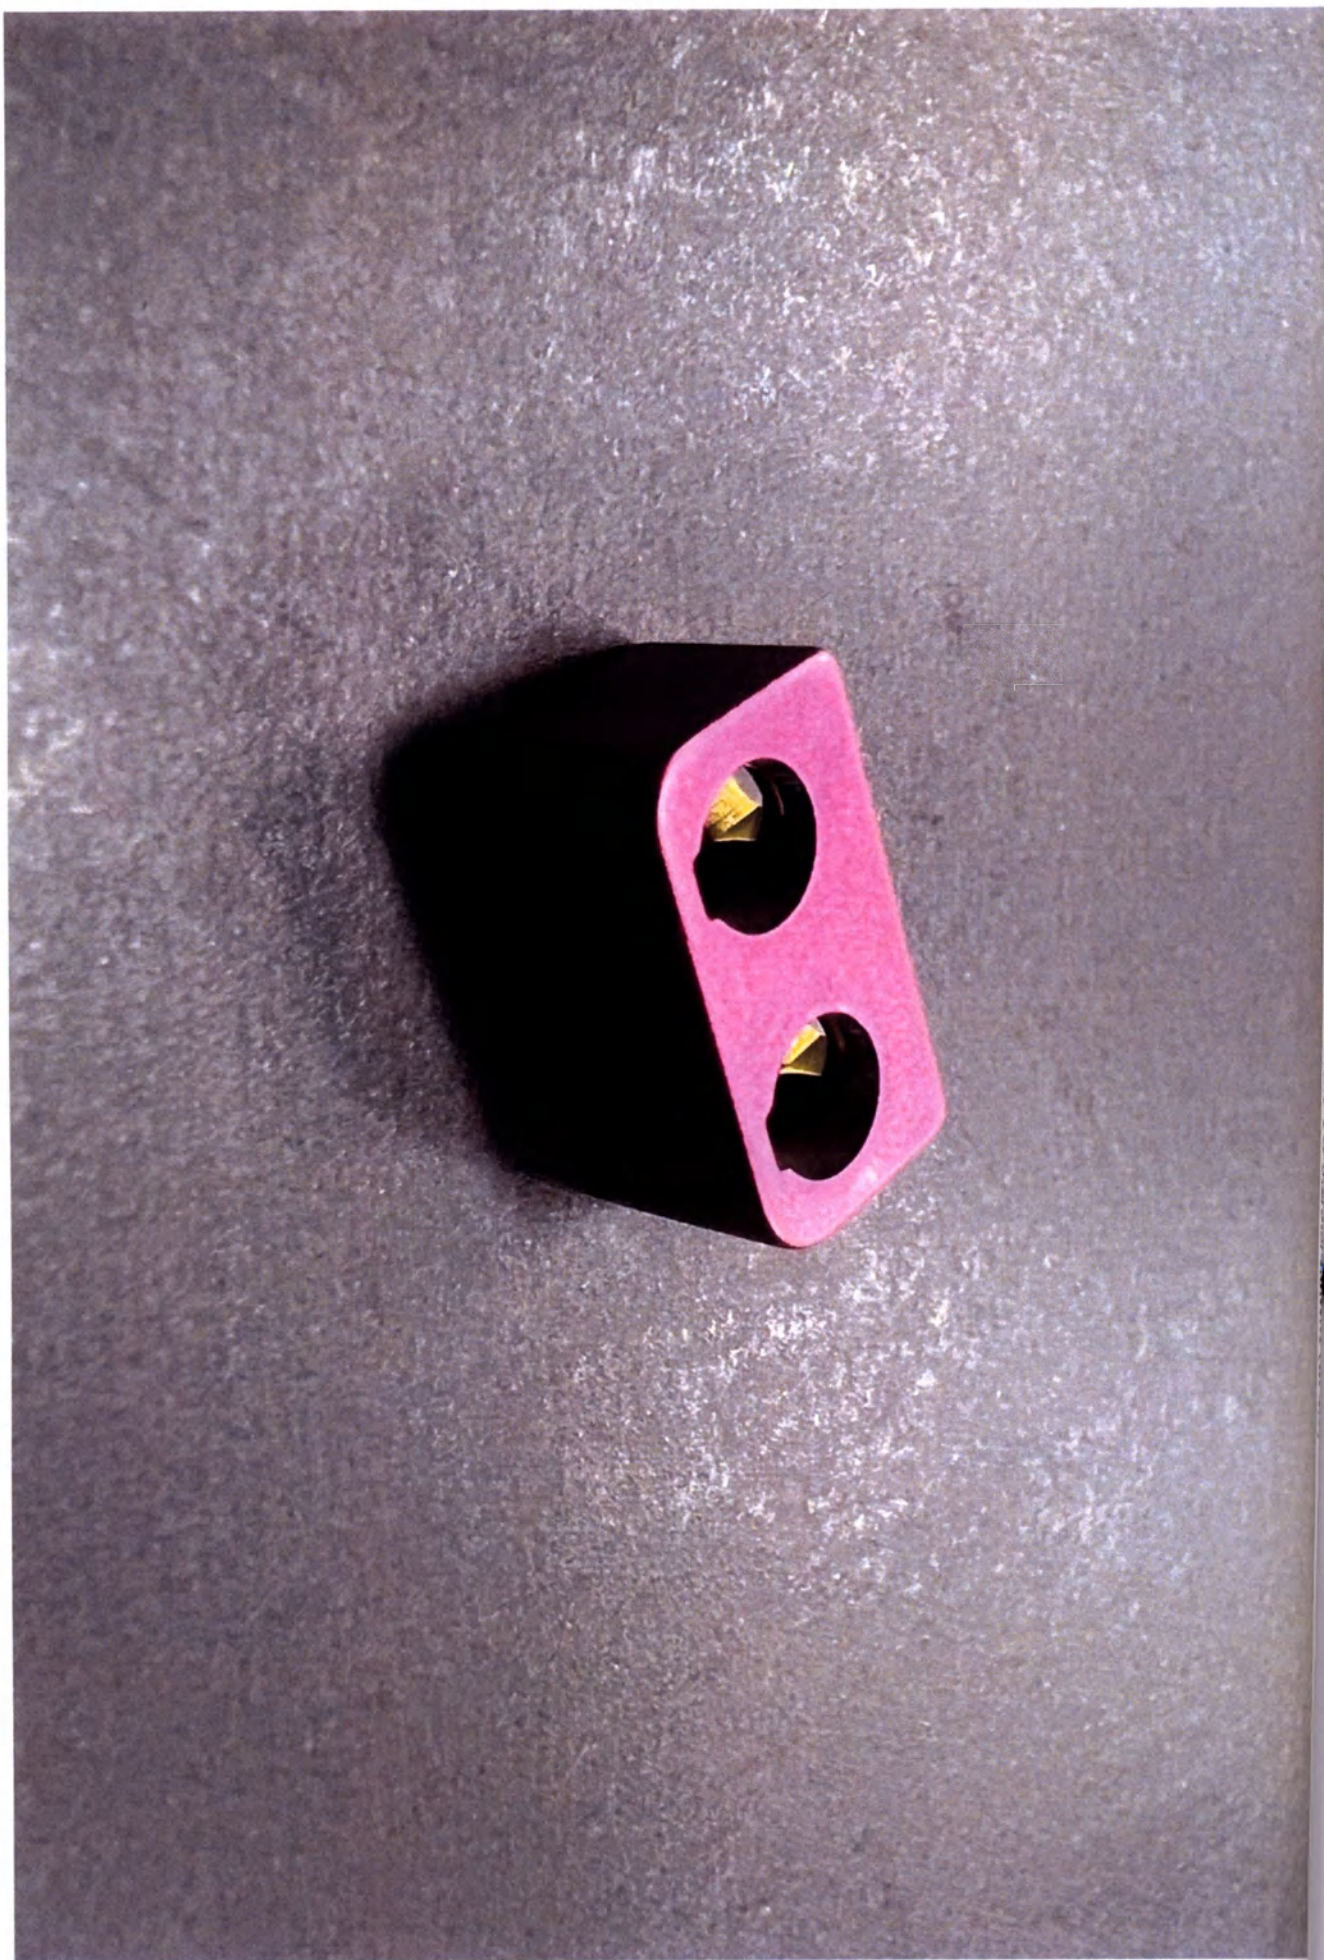

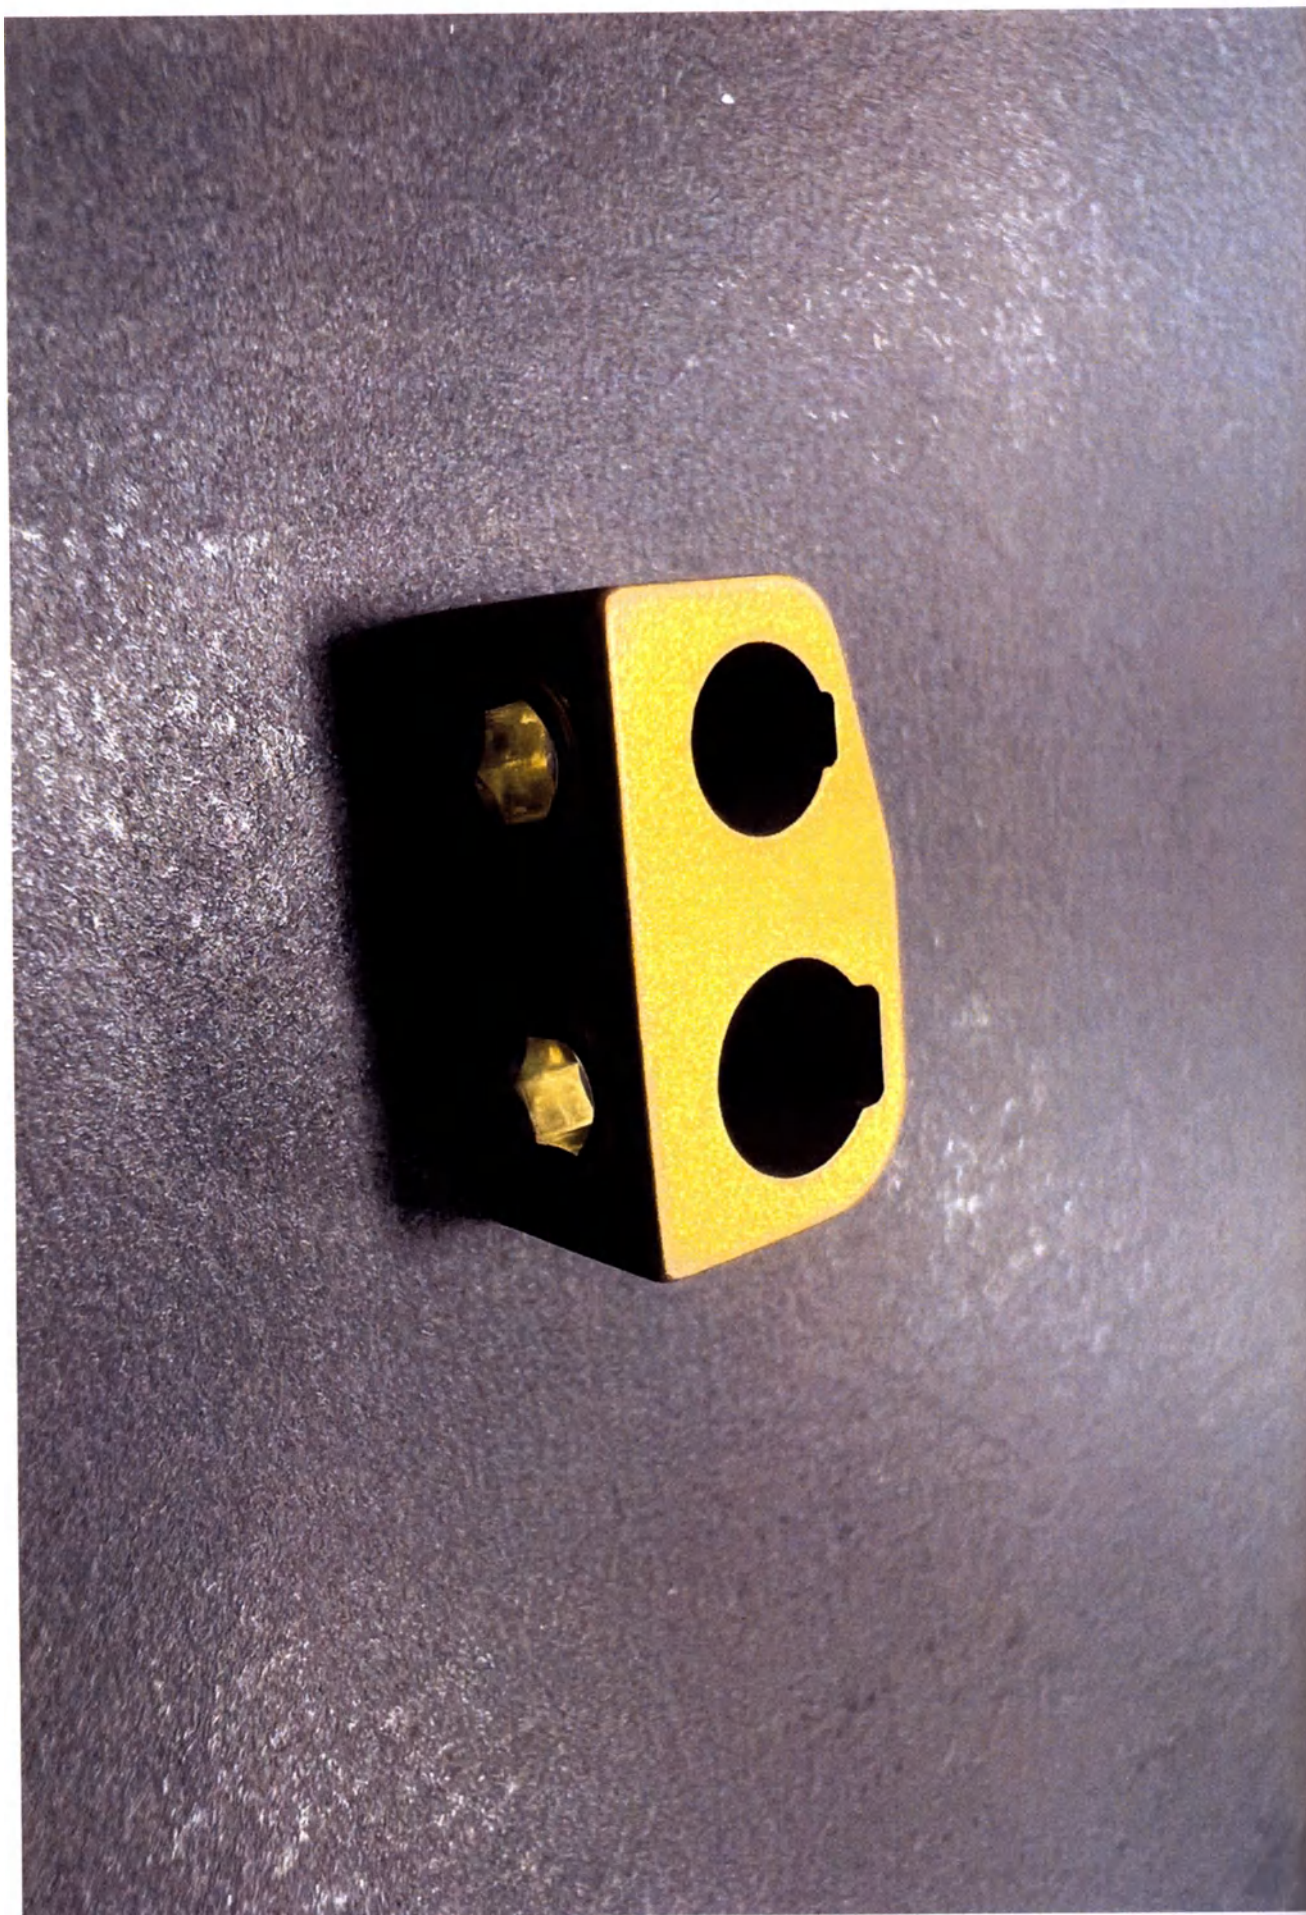

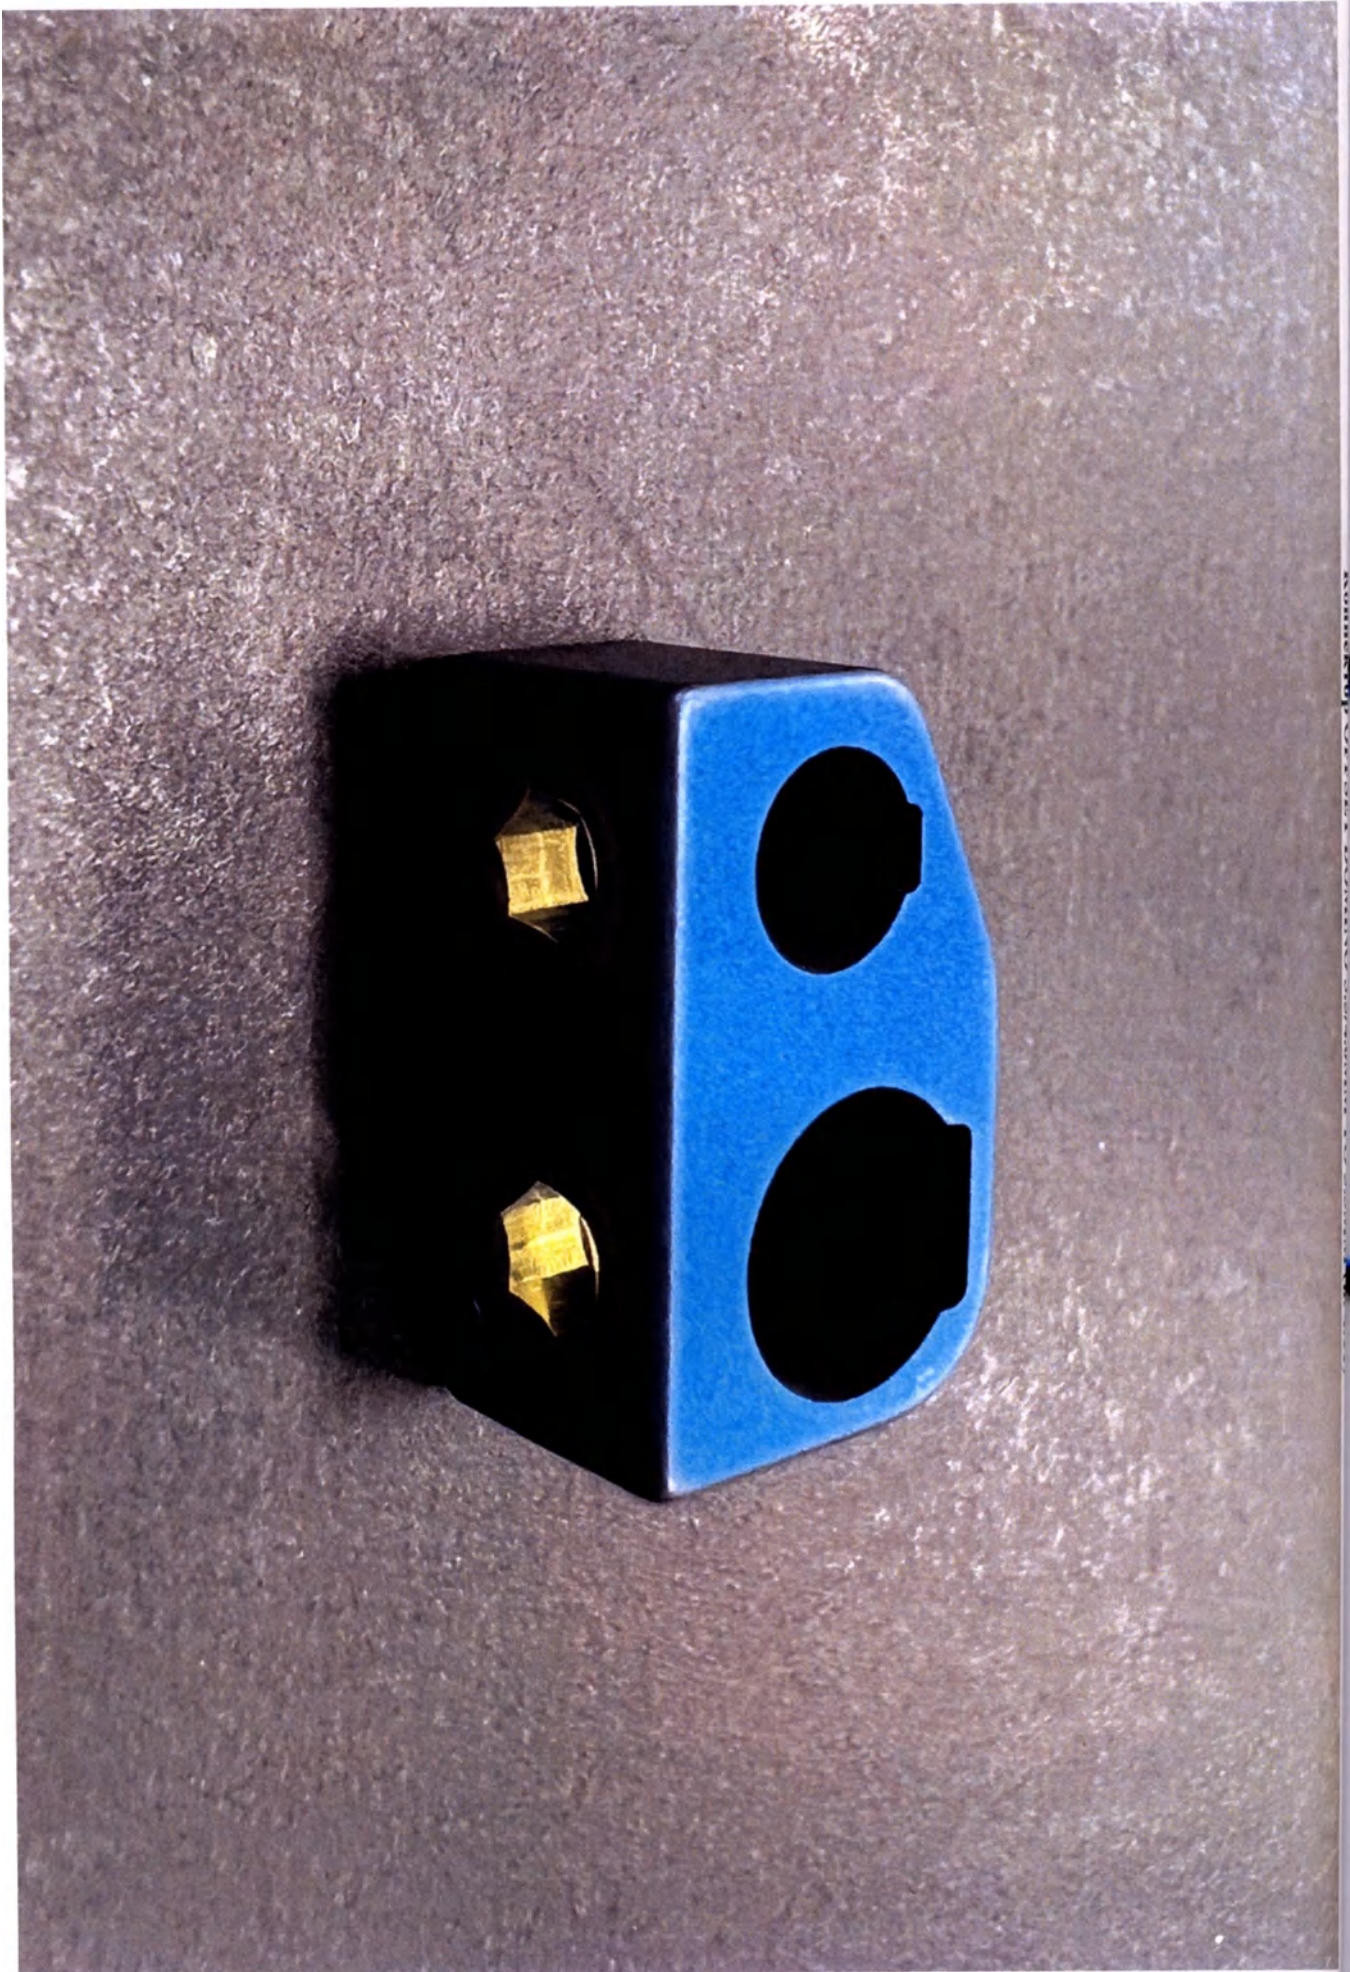

Коннектор OPEN LATERAL OFFSET CONNECTOR (10MM)
Варианты исполнения по п. 4.12-4.13 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор OPEN LATERAL OFFSET CONNECTOR, 10MM»



Варианты исполнения по п. 4.14-4.15 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.
На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор CLOSED LATERAL OFFSET CONNECTOR, 10MM»



Коннектор MAS EXTENSION CONNECTOR (п. 4.16-4.17)

Варианты исполнения по п. 4.16-4.17 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор MAS EXTENSION CONNECTOR 3.2/3.5/4.0MM»



Коннектор поперечный MAS CROSSLINK (п. 4.18-4.20)

Варианты исполнения по п. 4.18-4.20 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор поперечный MEDIUM MAS CROSSLINK»



Коннектор поперечный ROD CROSSLINK (п. 4.21-4.23)

Варианты исполнения по п. 4.21-4.23 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Коннектор поперечный ROD CROSSLINK - MEDIUM»





Образец стикера на русском языке:

	Коннекторы нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON: Коннектор 6.35MM POST CLOSED ILIAC CONNECTOR FOR 4.75MM ROD, 20MM	
	Производитель: Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк., США, Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 1800 Pyramid Place, Memphis, TN 38132, USA	
	Страна происхождения: США	Код UPN
		Код CFN
	Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник» вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, этаж, 9, помещ. III, ком. 41, Тел: +7-495-580-73-77	
	Регистрационное Удостоверение № РЗН от	
	Дата изгот. / Серия / Годен до: см. упаковку	
	см. инструкцию	
	см. символы на упаковке	



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
44 листа(ов)