



В. А. Головнева
В. А. Головнева

22 ноября 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор для гемодиализа половолоконный HD в вариантах исполнения

Диализатор для гемодиализа половолоконный высокопоточный: HD-13H



Диализатор для гемодиализа полуволоконный высокопоточный: HD-14H

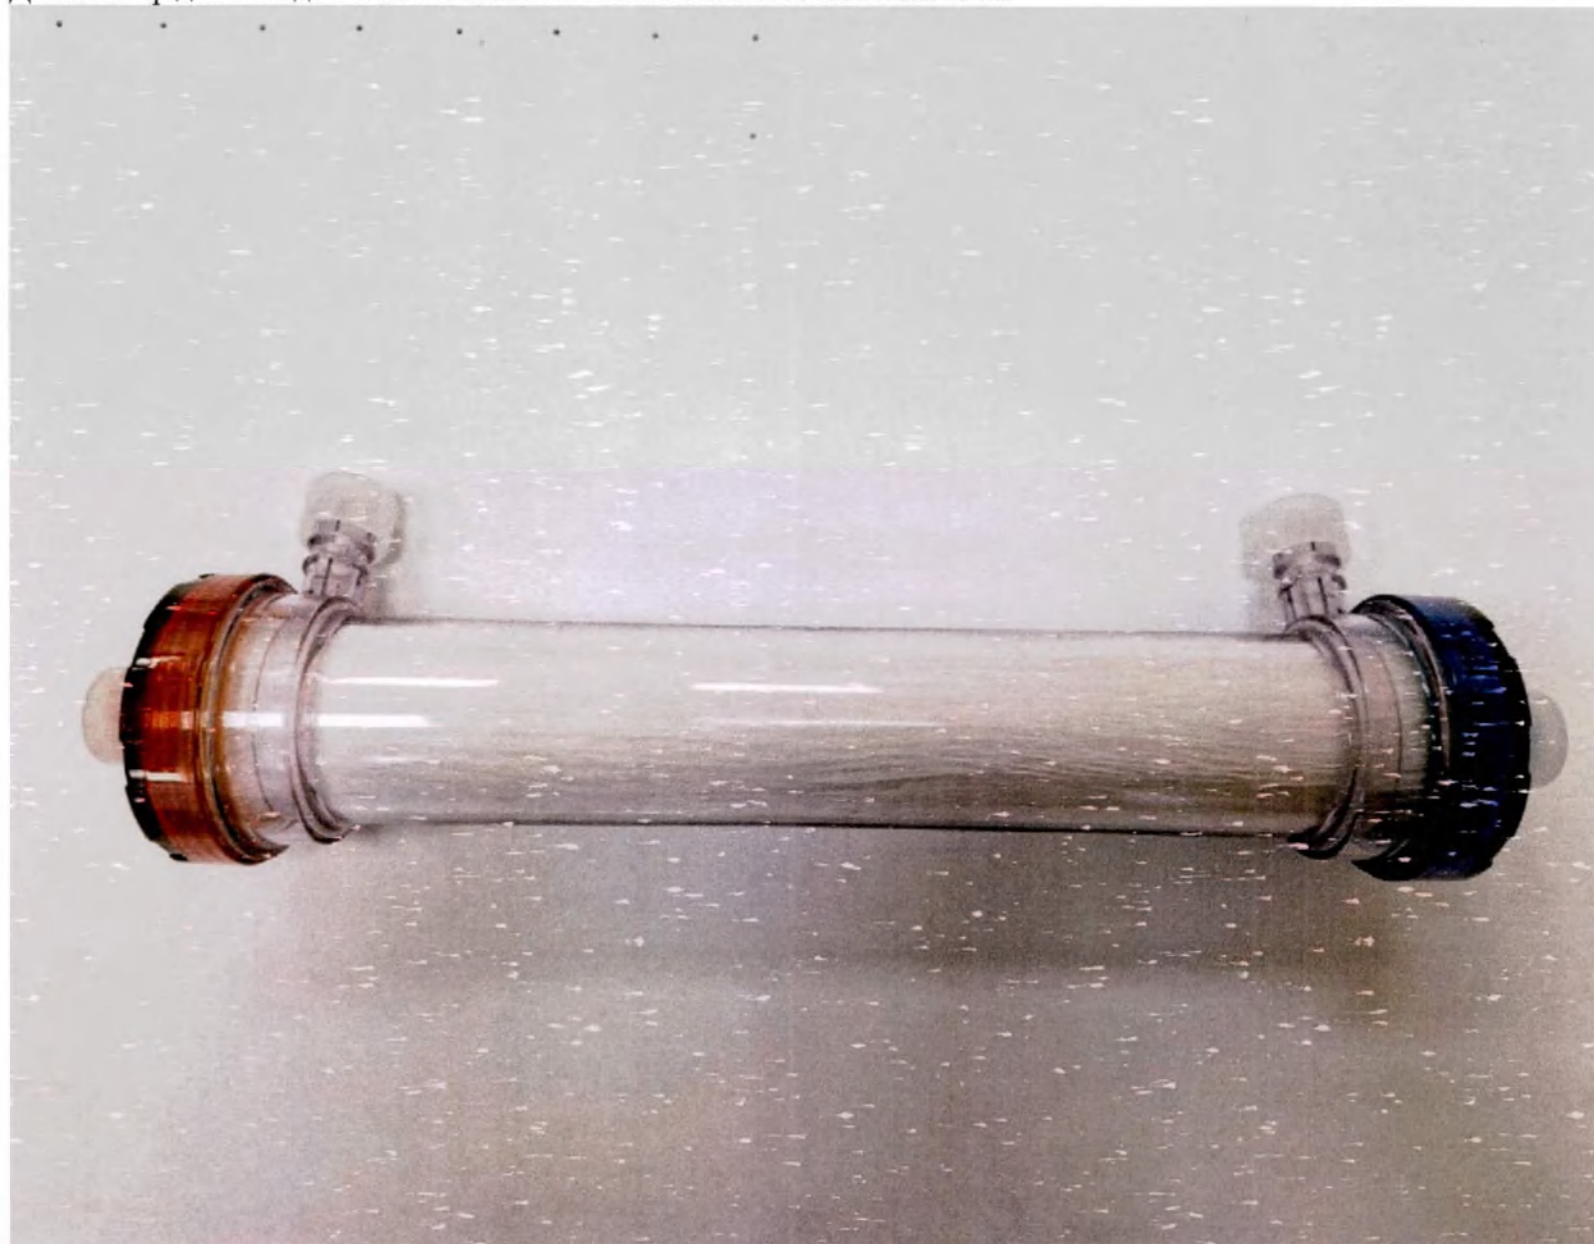

Диализатор для гемодиализа полволоконный высокопоточный: HD-15H



Диализатор для гемодиализа полуволоконный высокопоточный: HD-16H



Диализатор для гемодиализа половолоконный высокопоточный: HD-17H



Диализатор для гемодиализа полволоконный высокопоточный: HD-18H




Диализатор для гемодиализа полволоконный высокопоточный: HD-19H



Диализатор для гемодиализа полволоконный высокопоточный: HD-20H



Диализатор для гемодиализа половолоконный низкопоточный: HD-13L

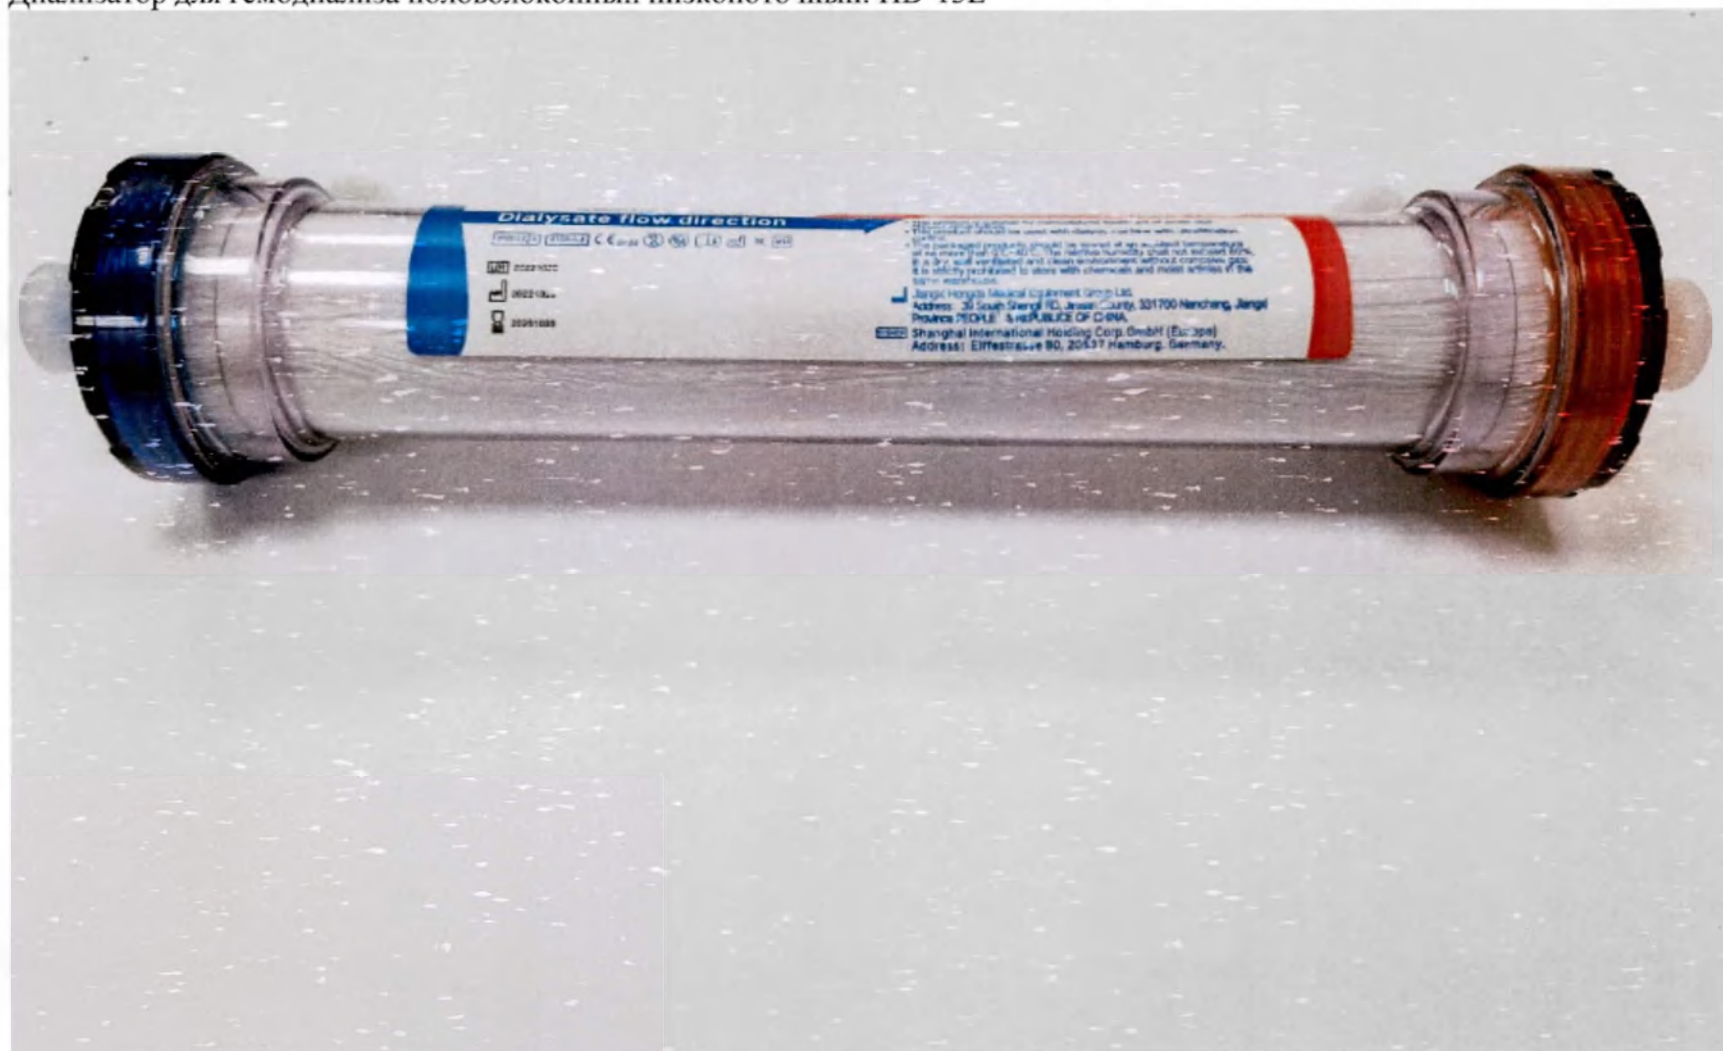

Диализатор для гемодиализа половолоконный низкопоточный: HD-14L



Диализатор для гемодиализа полволоконный низкопоточный: HD-15L



Диализатор для гемодиализа полволоконный низкопоточный: HD-16L



Диализатор для гемодиализа полуволоконный низкопоточный: HD-17L



Диализатор для гемодиализа полволоконный низкопоточный: HD-18L



Диализатор для гемодиализа полволоконный низкопоточный: HD-19L



Диализатор для гемодиализа полволоконный низкопоточный: HD-20L



№РУ от 00.00.0000 года

HD-17H

Высокопоточный диализатор для гемодиализа полволоконный HD

Площадь фильтрующей поверхности мембраны : 1,7 м²

Максимальное трансмембранное давление 66,5 кПа (500мм рт.ст.)

Направление потока диализата Поток крови

Направление потока диализата

STERILE R STERILE CE 0123 [Icons: No flame, No open flame, No fire, No smoke, No explosion, No gas] MD

LOT [Icon: Wavy line]

[Icon: Plug]

- Медицинское изделие предназначено для гемодиализного лечения при острой и хронической почечной недостаточности.
- Медицинское изделие следует использовать с диализным аппаратом с контролем ультрафильтрации.
- Медицинское изделие следует хранить при температуре окружающей среды в пределах 0 °C ~ 40 °C; с относительной влажностью не более 80%, в сухом, хорошо проветриваемом, чистом помещении без коррозионно-активных газов : строго запрещается.

Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.
(Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.)
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi Province, P.R.China
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТОН»
690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17 Тел: +79084599262 Email: ooo.uniton@yandex.ru

Макет маркировки транспортной упаковки (коробки):

 №ПУ от 00.00.0000 года Высокопоточный диализатор для гемодиализа полволоконный HD HD-17H STERILE R STERILE CE 0123 Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd. (Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.) Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi Province, P.R.China Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТОН» 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17 Тел: +79084599262 Email: ooo.uniton@yandex.ru	Диализатор для гемодиализа полволоконный HD Модель : HD - 17 H LOT 	 №ПУ от 00.00.0000 года Высокопоточный диализатор для гемодиализа полволоконный HD HD-17H STERILE R STERILE CE 0123 Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd. (Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.) Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi Province, P.R.China Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТОН» 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17 Тел: +79084599262 Email: ooo.uniton@yandex.ru	 Количество : Объем : Вес : • Медицинское изделие стерильное и асептическое. • Хранить изделия от агрессивных дезинфицирующих средств, таких как хлор. • Медицинское изделие должно быть защищено от прямых солнечных лучей, дождя и снега. • Медицинское изделие следует хранить в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении в среде без коррозионно-активных газов. • Для получения подробных инструкций обратитесь к инструкции по применению.
 №ПУ от 00.00.0000 года Высокопоточный диализатор для гемодиализа полволоконный HD HD-17H STERILE R STERILE CE 0123 Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd. (Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.) Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi Province, P.R.China Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТОН» 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17 Тел: +79084599262 Email: ooo.uniton@yandex.ru	Диализатор для гемодиализа полволоконный HD Модель : HD - 17 H LOT 		



№РУ от 00.00.0000 года

Высокопоточный диализатор для
гемодиализа половолоконный HD

HD-17H



 Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.
(Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.)
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi
Province, P.R.China
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТОН»
690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул.
Комсомольская, д.1, офис 17
Тел: +79084599262 Email: ooo.uniton@yandex.ru



Количество :

Объем :

Вес :

- Медицинское изделие стерильное и асептическое.
- Хранить вдали от агрессивных дезинфицирующих средств, таких как хлор.
- Медицинское изделие должно быть защищено от прямых солнечных лучей, дождя и снега.
- Медицинское изделие следует хранить в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении в среде без коррозионно-активных газов.
- Для получения подробных инструкций обратитесь к Инструкции по применению.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 20
(двадцать)
листа (ов).

Генеральный директор

Должность



Подпись

Гонимцева В.А.

Ф.И.О.

«22»

ноября

20 23

М.П.