



Инсуффлятор эндоскопический для желудочно-кишечного тракта «ФОТЕК», ШГИД.941625.001ТУ


Блок управления (передняя панель)

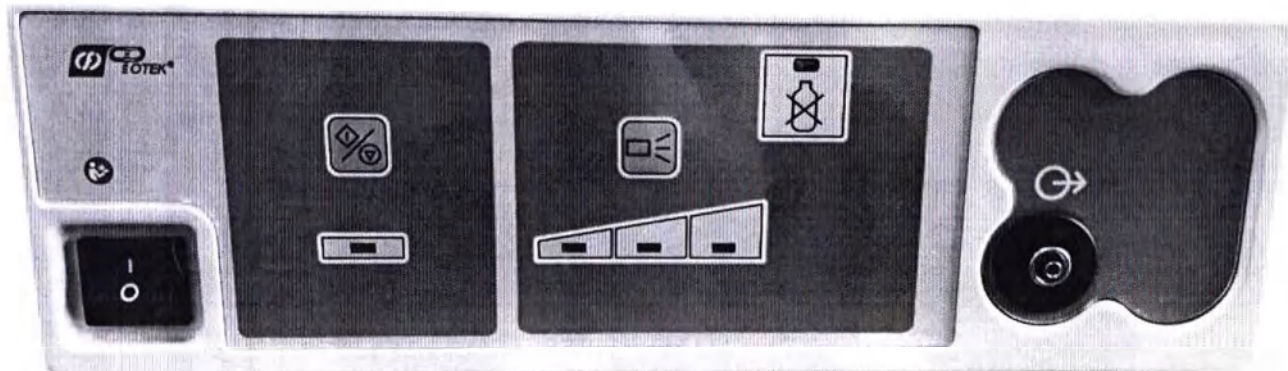

Блок управление (задняя панель)

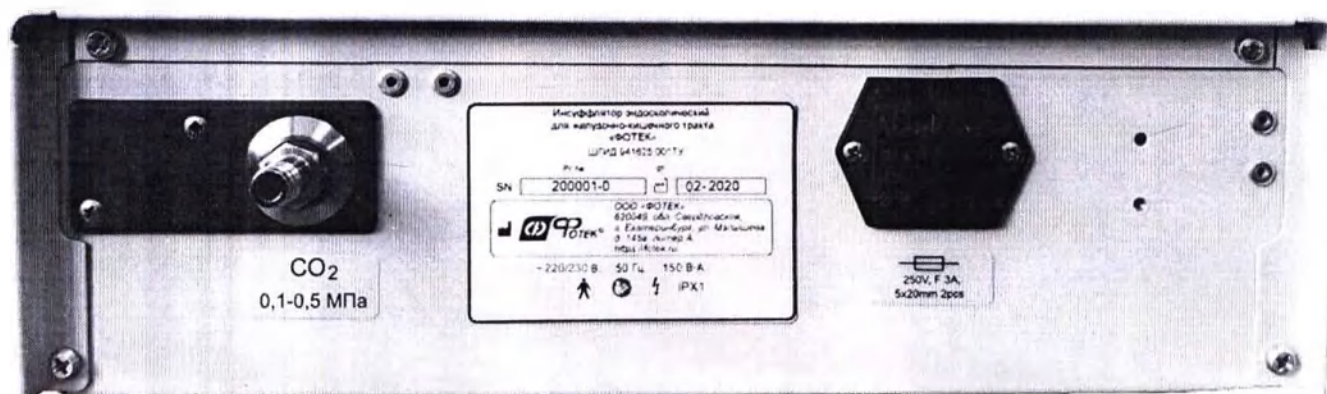


Блок управления (нижняя панель)

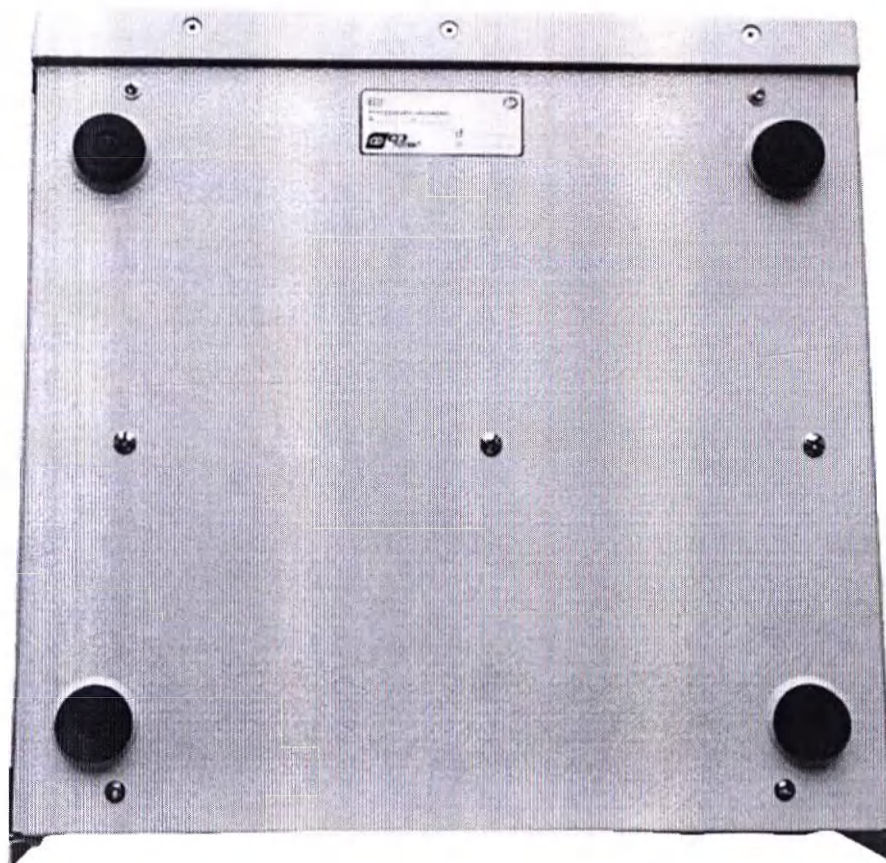

Шнур питания



Шланг выходной

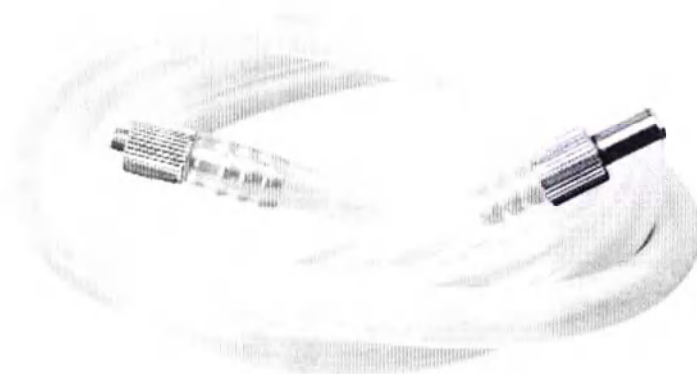


Шланг для подключения фильтра



Шланг входной, исполнение 1




Шланг входной, исполнение 2

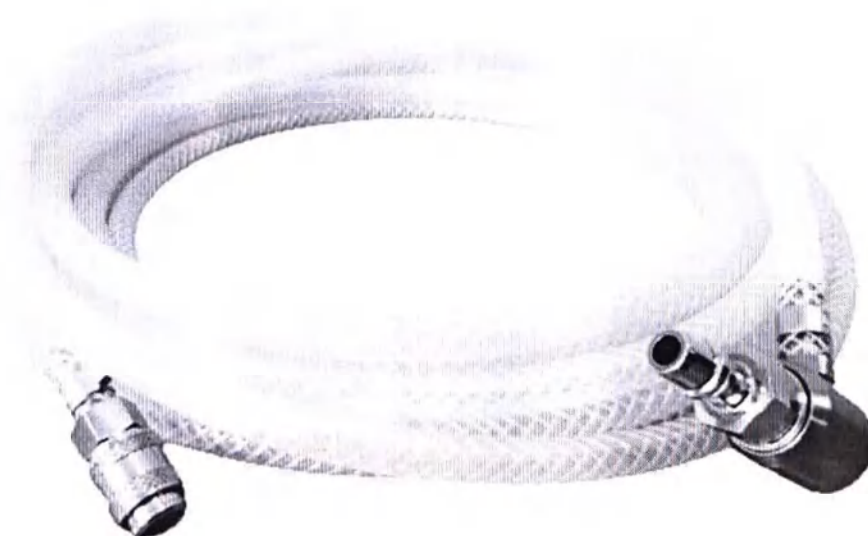

Переходник, исполнение 1



Переходник, исполнение 2

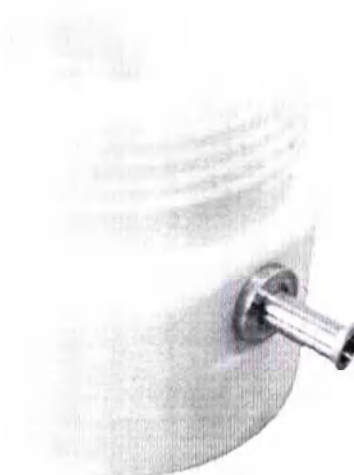

Переходник, исполнение 3



Переходник, исполнение 4



Переходник, исполнение 5



Переходник, исполнение 6




Регулятор давления (редуктор) баллонный углекислотный одноступенчатый
типа УР-6-6 ТУ 3645-012-56164015-2013




Баллон для углекислого газа 5-150У ГОСТ 949-73




Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях. Фильтр для инфузии 2000/09, "Джи Ви Эс С.П.А." (Италия), РУ от 09.07.2019 № РЗН 2019/8590

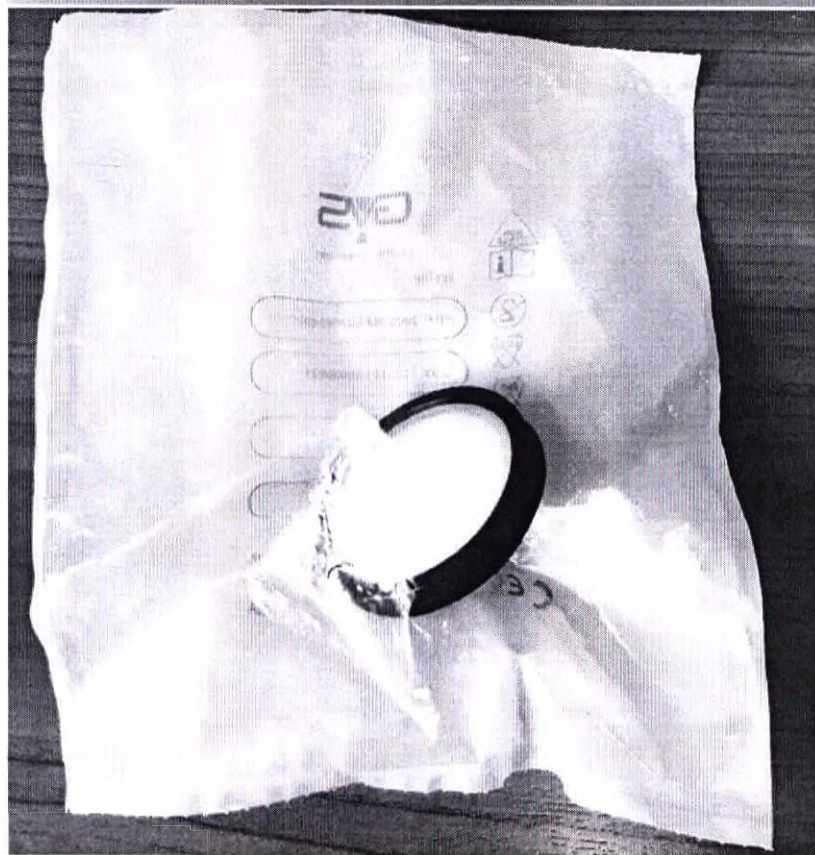


Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях. Фильтр для инфузии высокопоточный 2200/05, "Джи Ви Эс С.П.А." (Италия), РУ от 09.07.2019 № РЗН 2019/8590

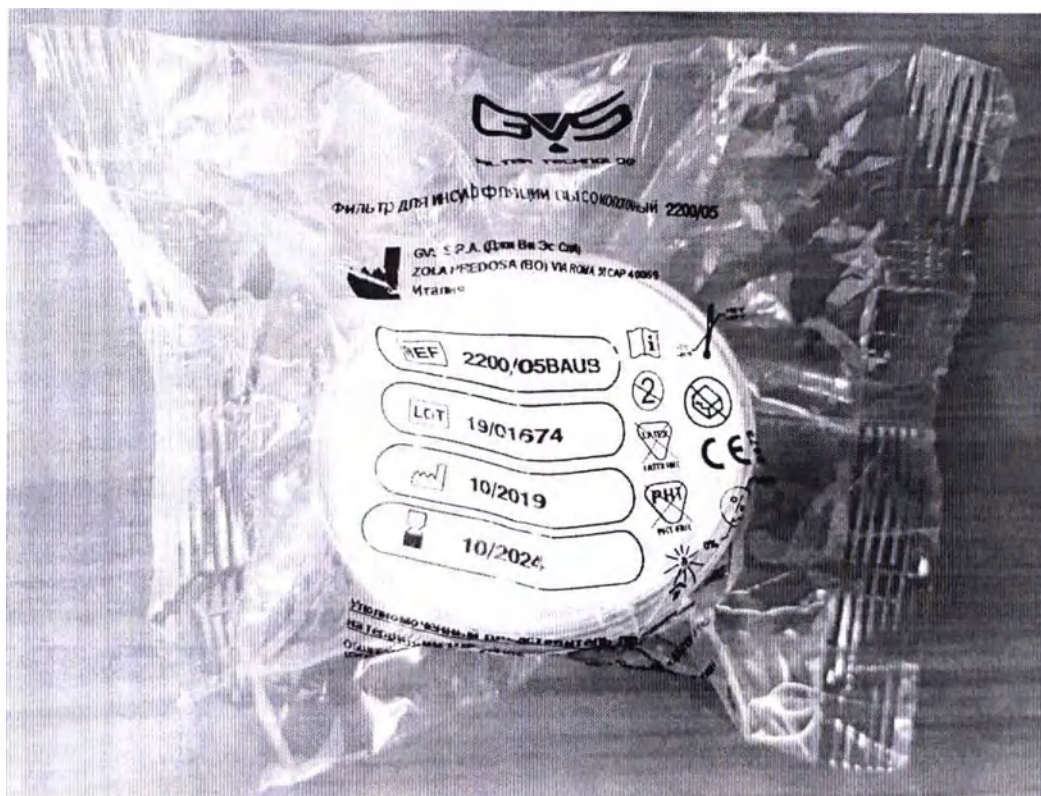

Стойка передвижная с принадлежностями СП-«ФОТЕК» по
ТУ 9452-001-41747567-2015, вариант исполнения: стойка передвижная с
принадлежностями с одной колонной СП1-01-«ФОТЕК», ООО "ФОТЕК", (РФ),
РУ от 29.05.2017 № РЗН 2017/5790

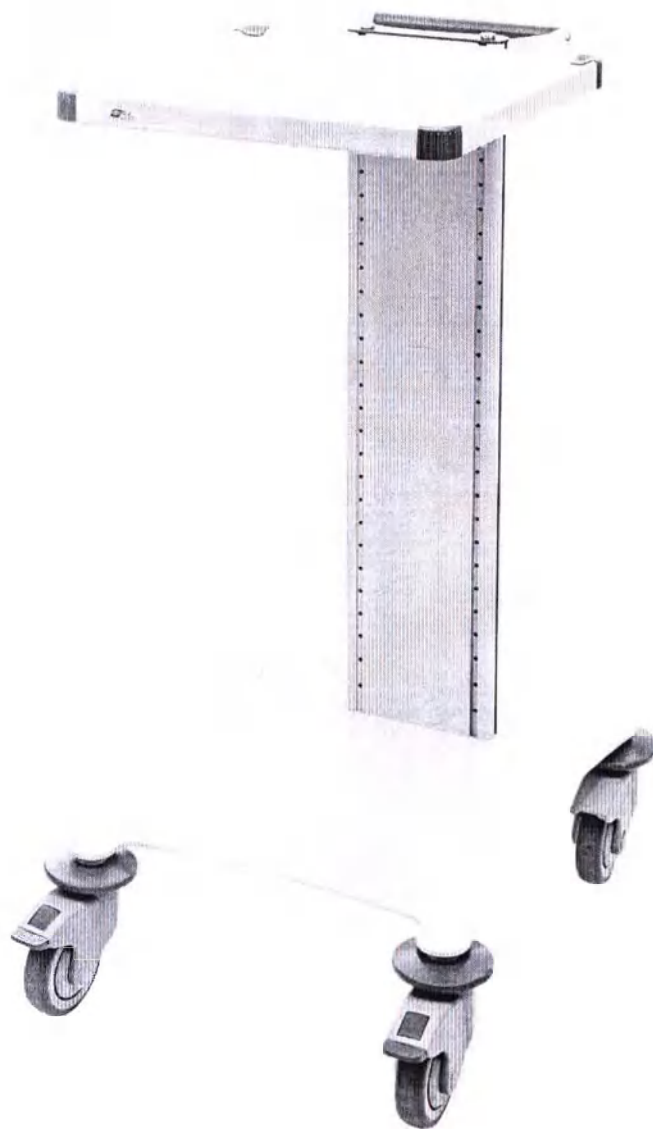


Стойка передвижная с принадлежностями СП-«ФОТЕК» по
ТУ 9452-001-41747567-2015, вариант исполнения: стойка передвижная с
принадлежностями с одной колонной СП1-02-«ФОТЕК», ООО "ФОТЕК", (РФ),
РУ от 29.05.2017 № РЗН 2017/5790

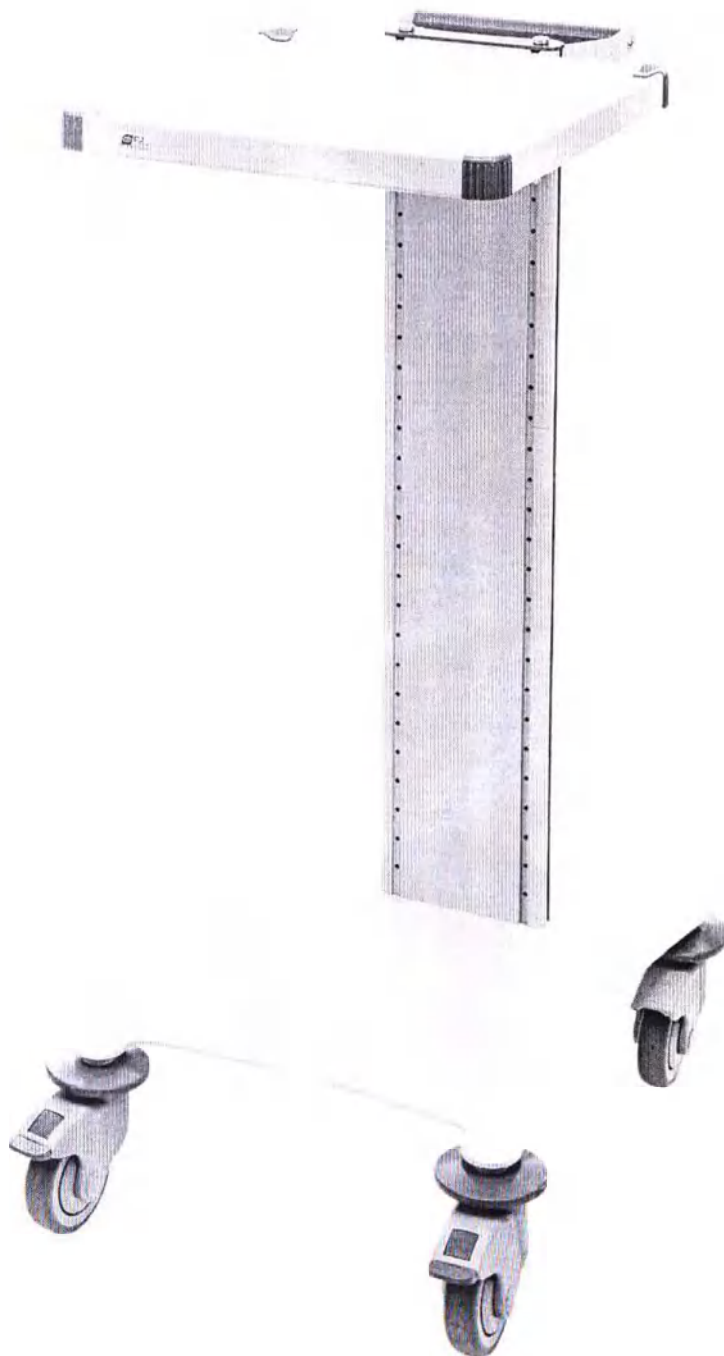


Стойка передвижная с принадлежностями СП-«ФОТЕК» по
ТУ 9452-001-41747567-2015, вариант исполнения: стойка передвижная с
принадлежностями с двумя колоннами СП2-03-«ФОТЕК», ООО "ФОТЕК", (РФ),
РУ от 29.05.2017 № РЗН 2017/5790



Стойка передвижная с принадлежностями СП-"ФОТЕК" в упаковке

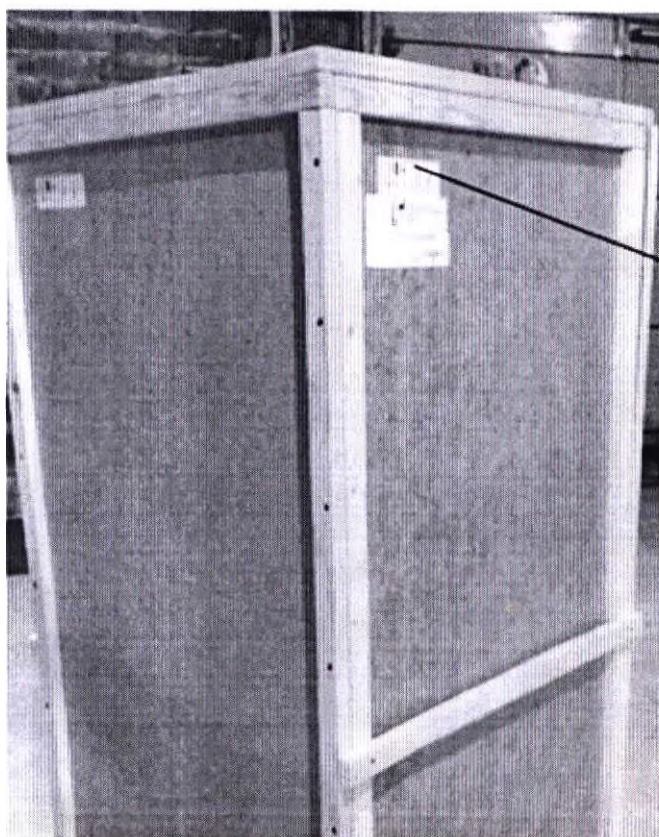

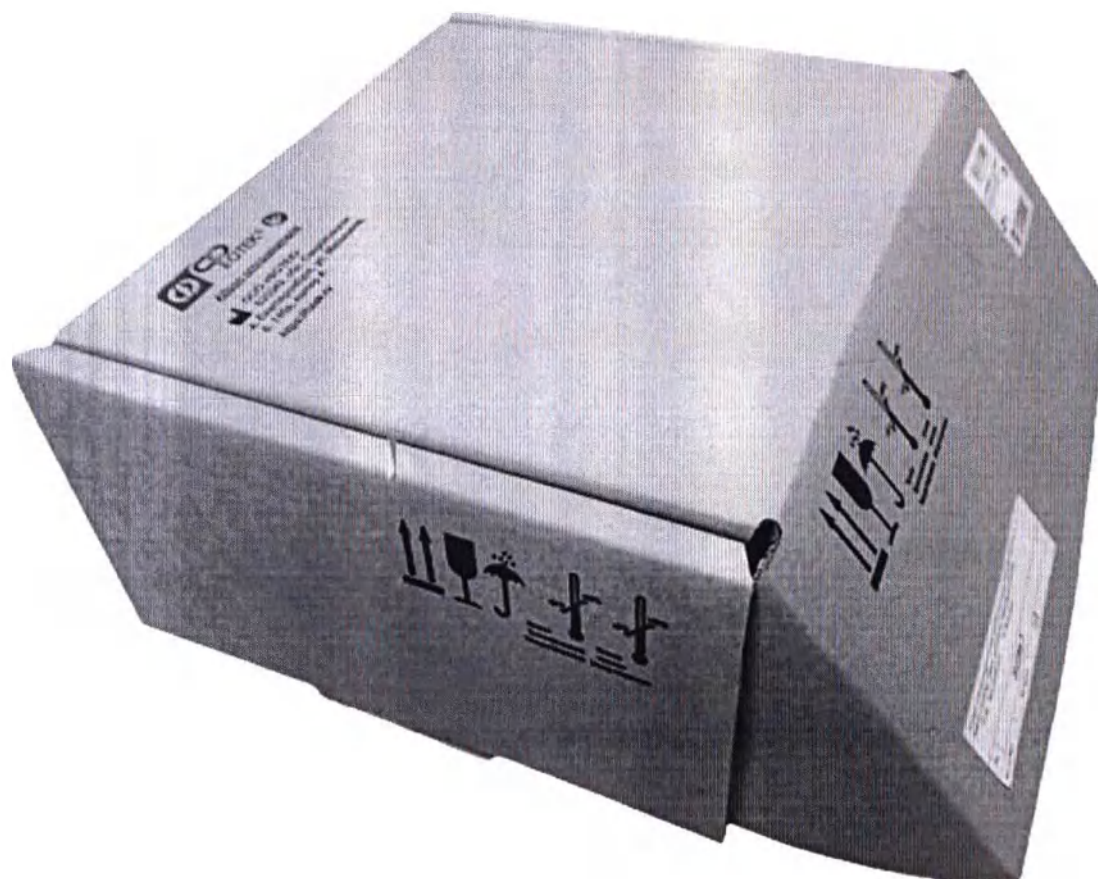

Прошито и пронумеровано 14
(сентября 2015) листов.
Директор ООО "ФОТЕК"
_____ А.В.Малеев
М.П. _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ФОТЕК»

А.В. Малеев

2021 г.




Маркировка медицинского изделия

Инсуффлятор эндоскопический для желудочно-кишечного тракта «ФОТЕК», ШГИД.941625.001ТУ

1. Маркировка блока управления


1.1. Маркировка передней панели

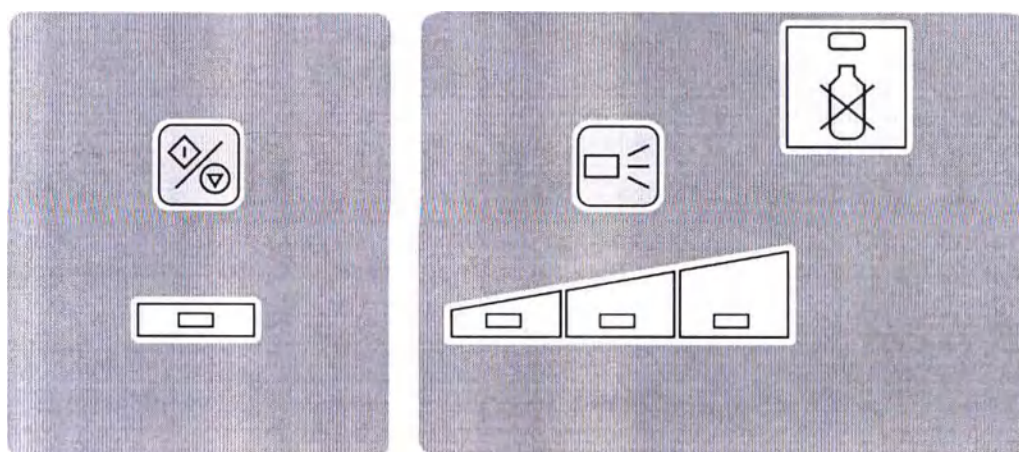


1.2. Маркировка места присоединения шланга выходного (выход газа)




1.3. Основная маркировка на задней панели:

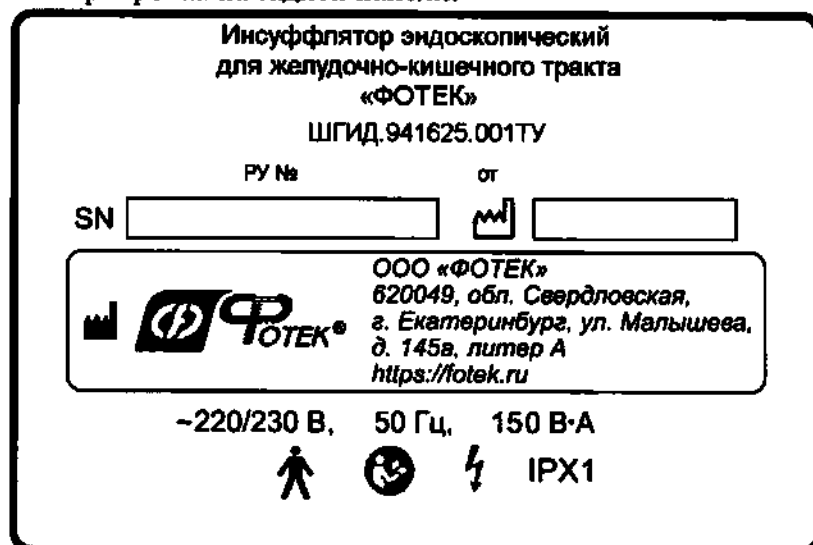


1.4. Маркировка места присоединения шланга входного

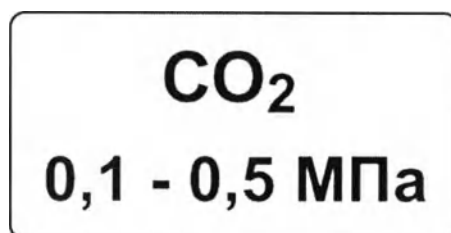

1.5. Маркировка схематического обозначения, типа и номинала предохранителей на задней панели

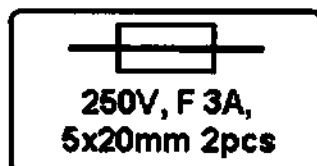

1.6. Маркировка нижней панели блока управления инсуффлятора

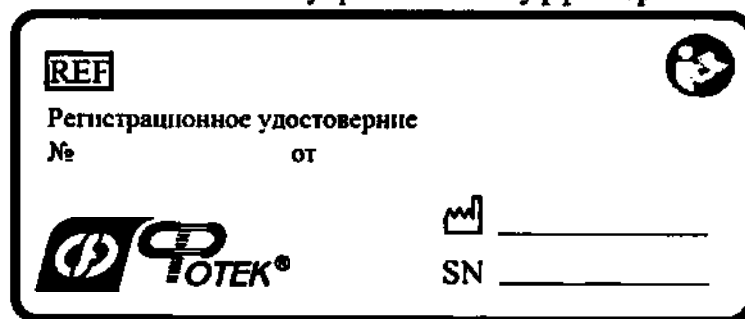

2. Маркировка шнура питания, переходников, шланга выходного, шланга для подключения фильтра


REF	
Регистрационное удостоверение	
№	от
	 _____
Партия (LOT) _____	

3. Маркировка шлангов входных исполнений 1 – 2

REF	
Регистрационное удостоверение	
№	от
	 _____
Партия (LOT) _____	



4. Маркировка упаковки

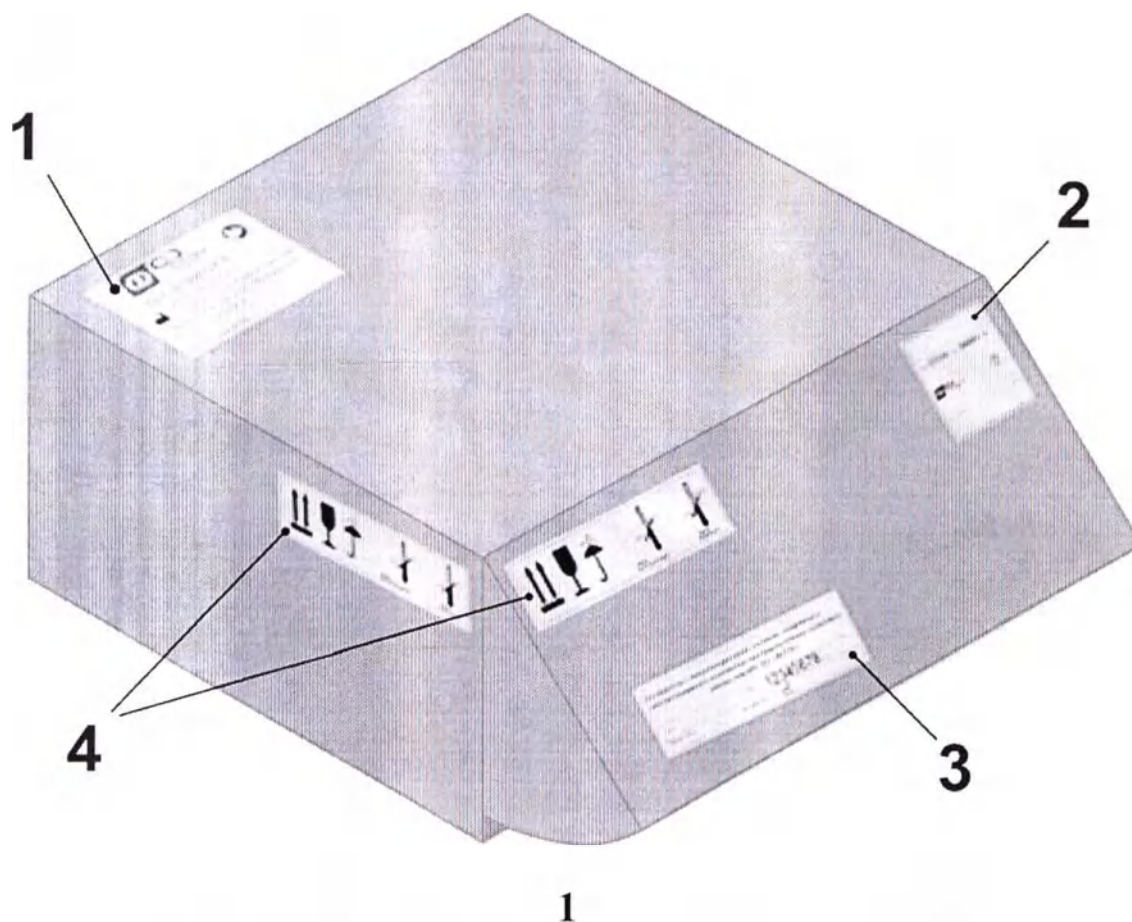

Адрес отправителя:



ООО "ФОТЕК"

620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, литер А

<https://fotek.ru>


2

REF	
Регистрационное удостоверение: № _____ от _____	
	
	

3

Инсуффлятор эндоскопический для желудочно-кишечного тракта «ФОТЕК» ШГИД.941625.001ТУ			
РУ № _____		от _____	
REF		SN	
Место/Месм _____ / _____		Вес брутто _____	

4

				
Условия транспортирования			Условия хранения	

Прошито и пронумеровано 5
(нет) листов.

Директор ООО "ФОТЕК"
_____ А.В.Малеев

М.П.

