

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «МиниМед»



В.Р. Азбукин


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50–038–29508133–2022»**

2024г.

С К2ЭДТА (с пластмассовой крышкой) 0,25 мл



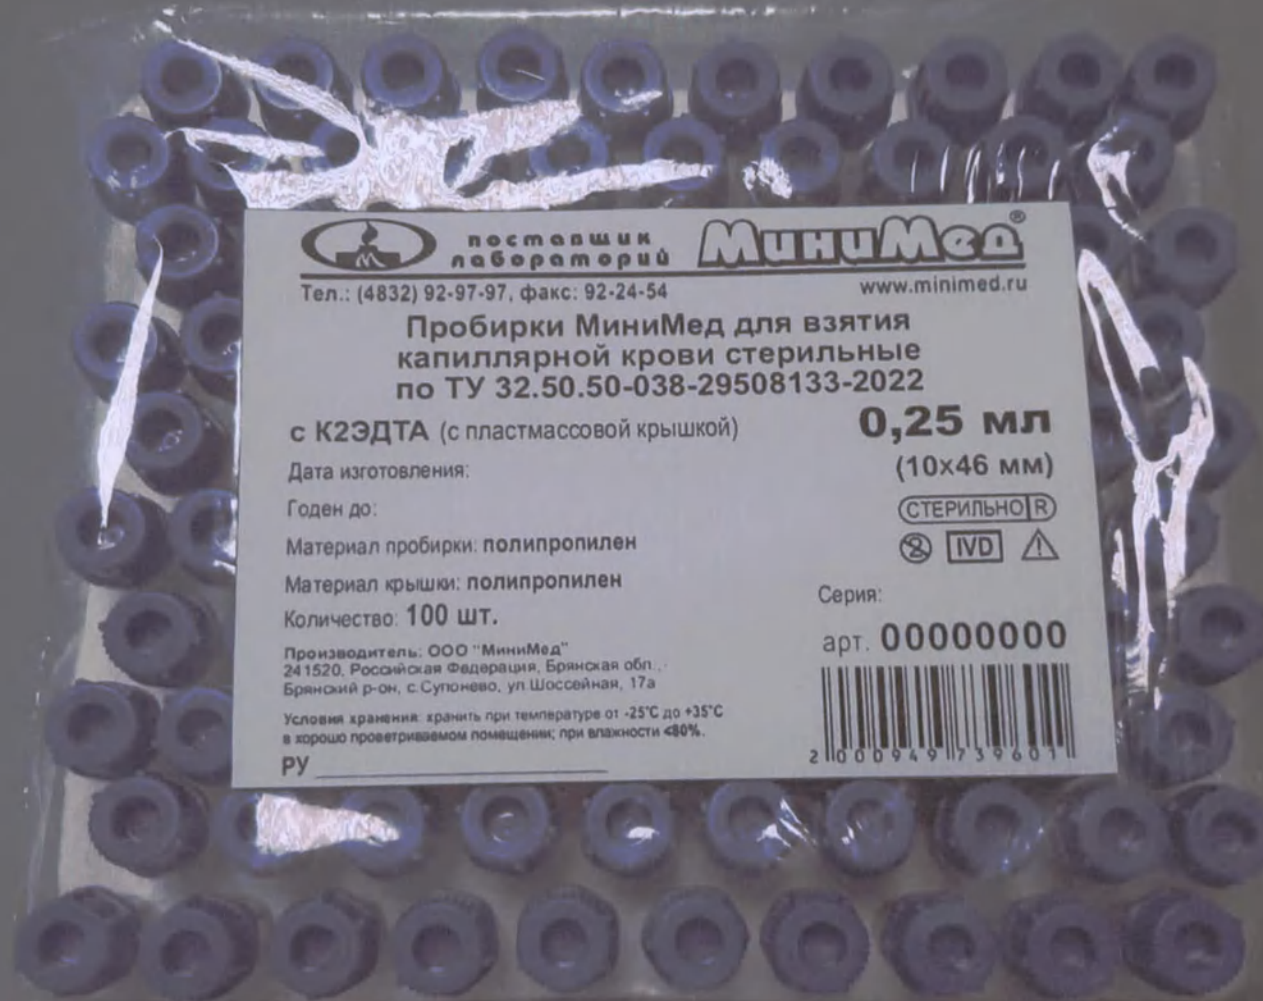

поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с К2ЭДТА (с пластмассовой крышкой)

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x46 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

⊗ IVD ⚠

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.


Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.

ру





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с пластмассовой крышечкой)

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x46 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал крышки: полипропилен

Количество: 50 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Суличи, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в герметично закрытых блистерах при влажности 65%

РУ



2 000094 973960 1

С К2ЭДТА (с пластмассовой крышкой) 0,5 мл








Федеральный научный центр биомедицинских наук
МиниМед
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru
Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022
 с КЭЗДА (с пластмассовой крышечкой) **0,5 мл**
 Дата изготовления (10x46 мм)
 Годен до **СТЕРИЛЬНО**
 Материал пробирки: полипропилен 
 Материал крышки: полипропилен 
 Количество: 50 шт.
 Производитель: ООО "МиниМед"
 241520, Республика Татарстан, Бирский обл.
 Бирский р-он, с.Султаново, ул.Школьная 17а
 Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
 в закрытой упаковке; влажность: при влажности 60%
 ру

Серия
 арт. 000000000


С КЗЭДТА (с пластмассовой крышкой) 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с пластмассовой крышкой)

0,25 мл

(10x46 мм)

Дата изготовления:

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

Q IVD A

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.
Брянский р-он, с. Супоньево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности 40%



РУ



С КЗЭДТА (с пластмассовой крышкой) 0,5 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с пластмассовой крышкой)

0,5 мл
(10x46 мм)

Дата изготовления:

СТЕРИЛЬНО

Годен до:

IVD

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 00000000


Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.
Брянский р-он, с Супонеево, ул.Шоосейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%

РУ



С К2ЭДТА (с резиновой пробкой) 0,25 мл

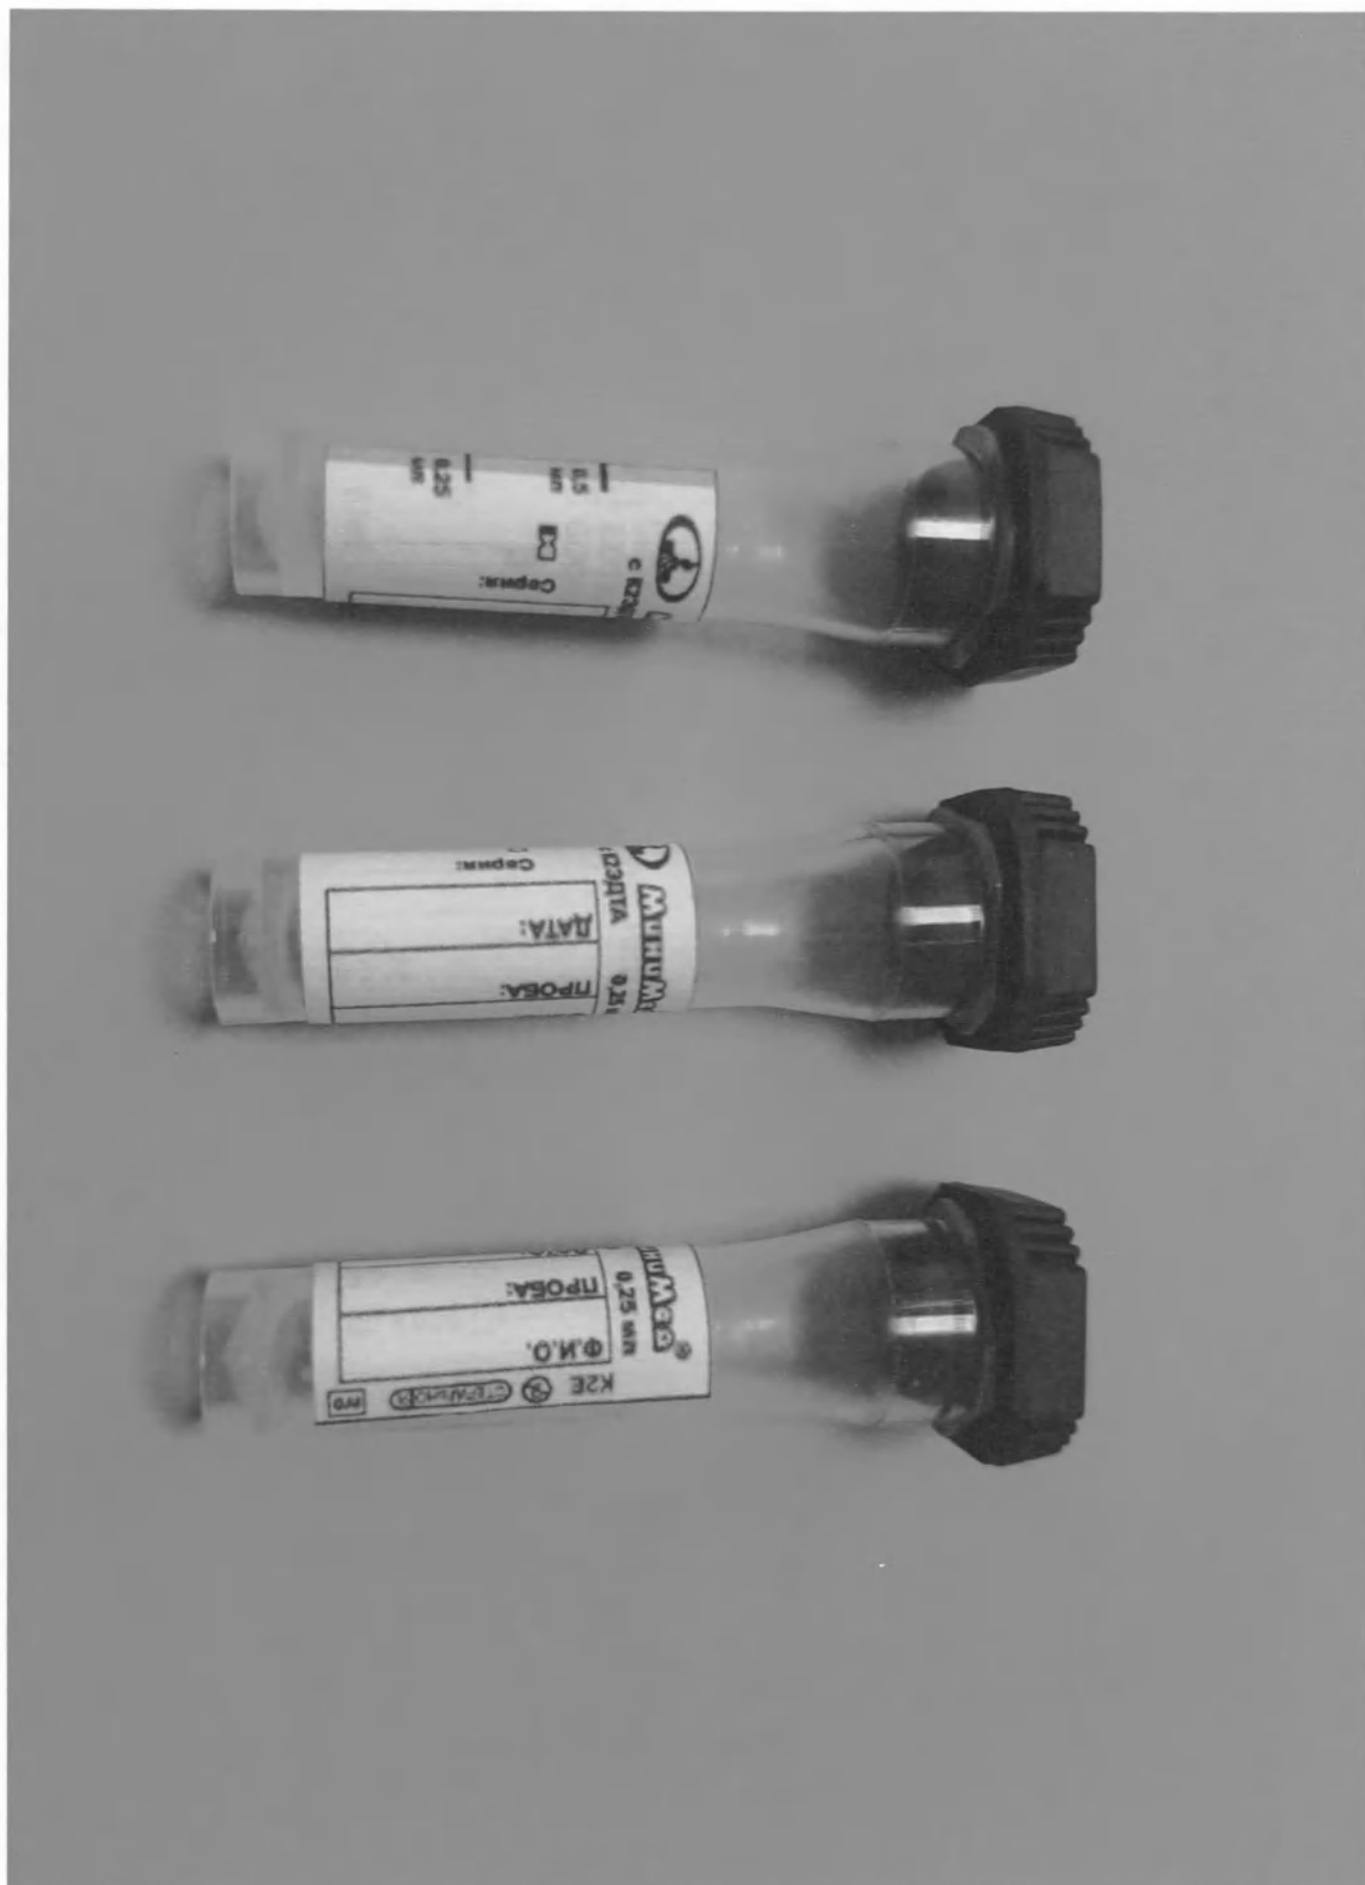



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой)

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годеи до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.

РУ



поставщик
лабораторий**МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой)

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО

Материал пробирки: полипропилен

ISO

Материал пробки: резина

Количество: **50 шт.**

Серия:

арт. **00000000**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Россия, Брянская область,
Брянский район, с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в упаковке. Влажность воздуха не превышать 60%.

ру



С К2ЭДТА (с резиновой пробкой) 0,5 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой)

0,5 мл


Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен



Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.

РУ



2 000949 739601



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой)

0,5 мл

(10x44 мм)

Дата изготовления:

СТЕРИЛЬНО

Годен до:

IVD

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 50 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Суличи, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от +5°C до +35°C
в упаковке при относительной влажности не более 65%



РУ

С КЗЭДТА (с резиновой пробкой) 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой)

0,25 мл

Дата изготовления:


(10x44 мм)

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробки: резина



Количество: 100 шт.

Серия:

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

арт. 000000000

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.



ру

поставщик
лабораторий**МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой)

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО

Материал пробирок: полипропилен

IVD

Материал пробки: резина

Количество: 50 шт.

Серия:

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Рязанская Федерация, Брянский обл.
Брянский р-он с. Сулово, ул. Шоссейная, 17а


арт. 00000000

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в герметичной упаковке, при влажности не более 40%



РУ

С КЗЭДТА (с резиновой пробкой) 0,5 мл

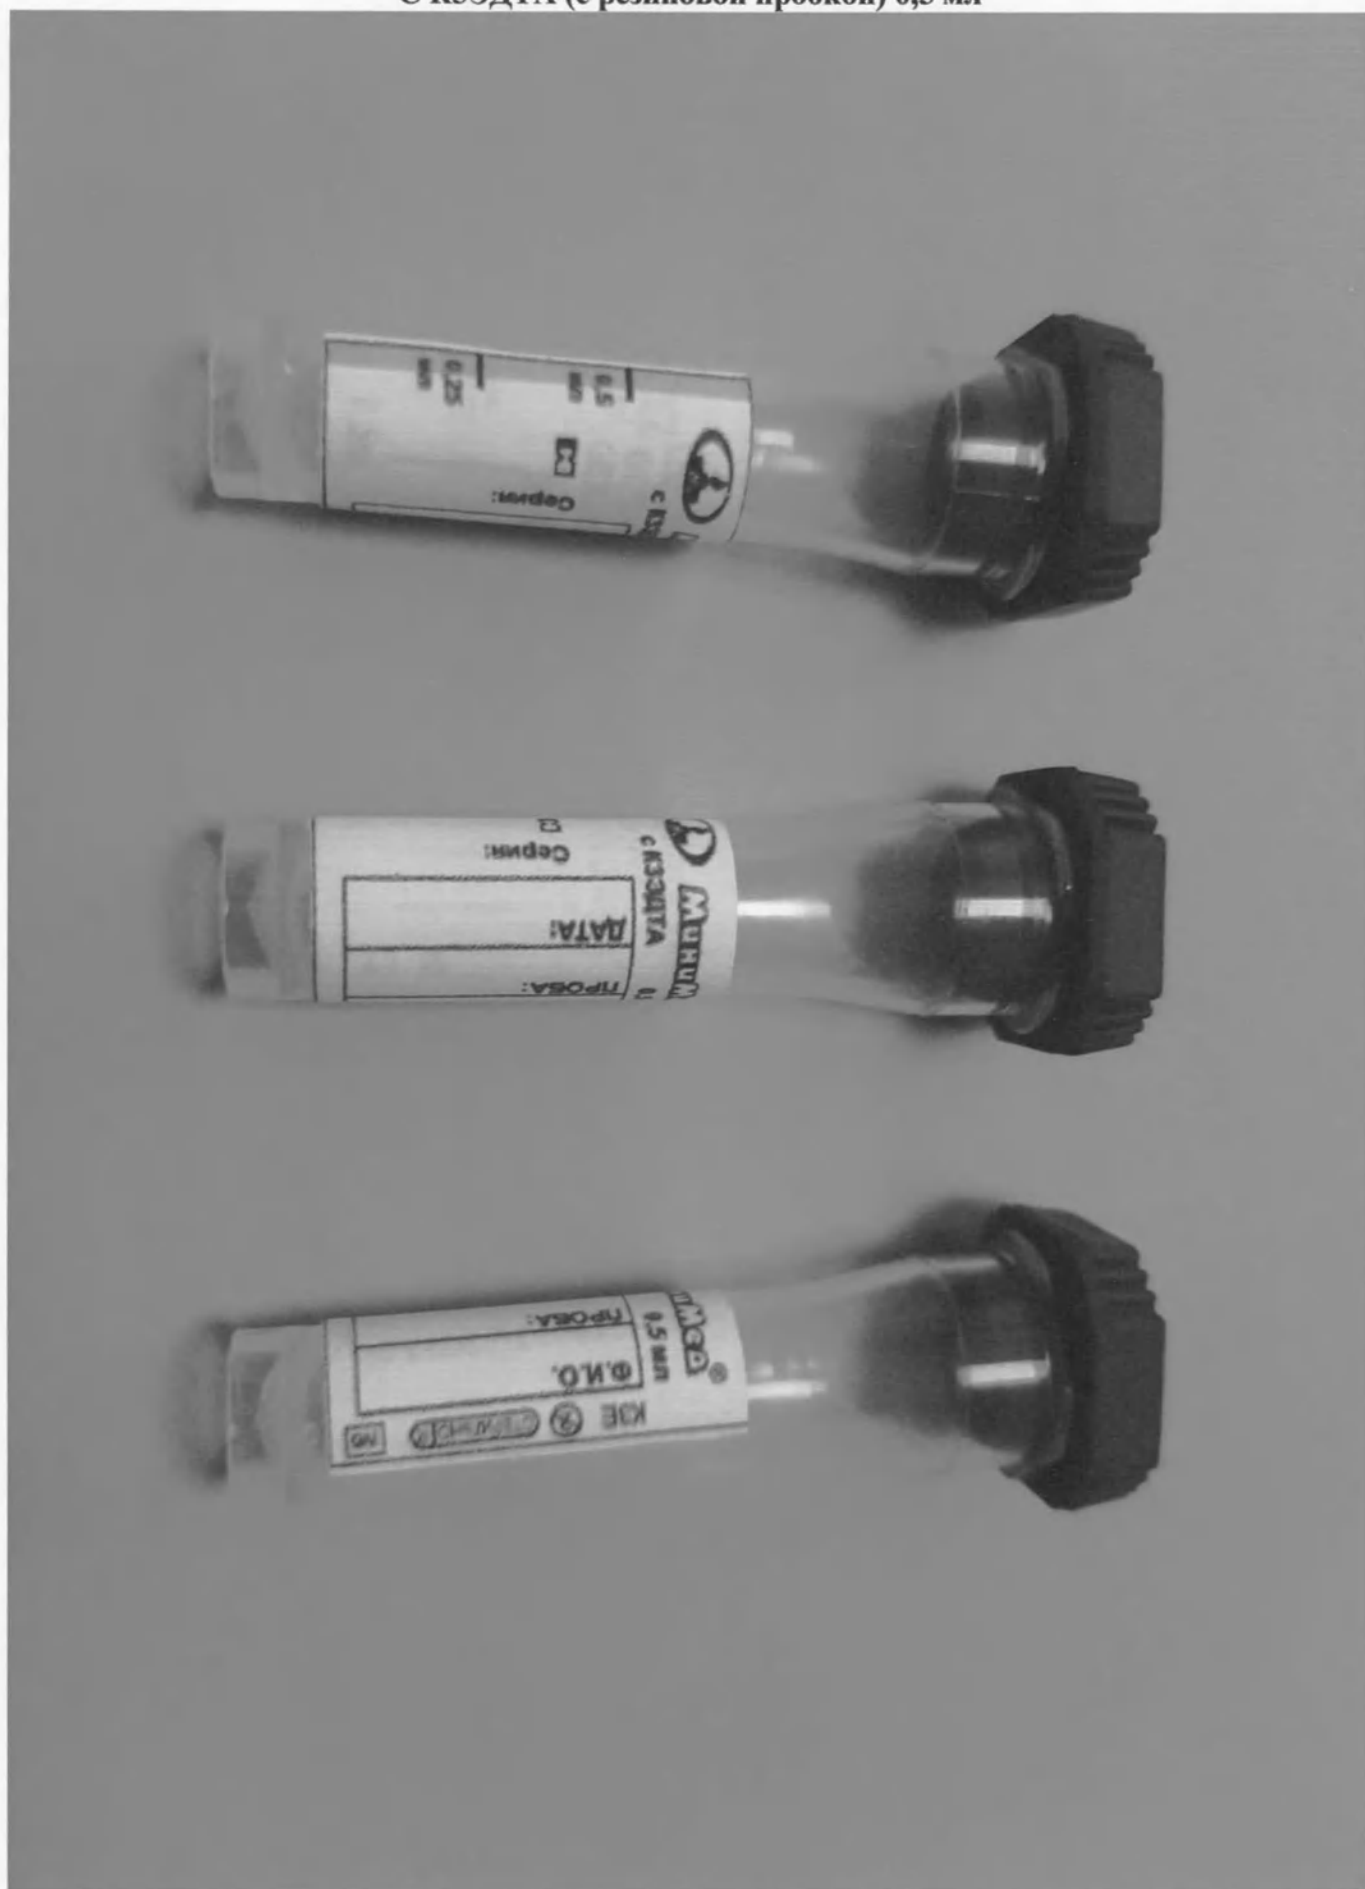



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой)

0,5 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Серия:


арт. 000000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.

РУ



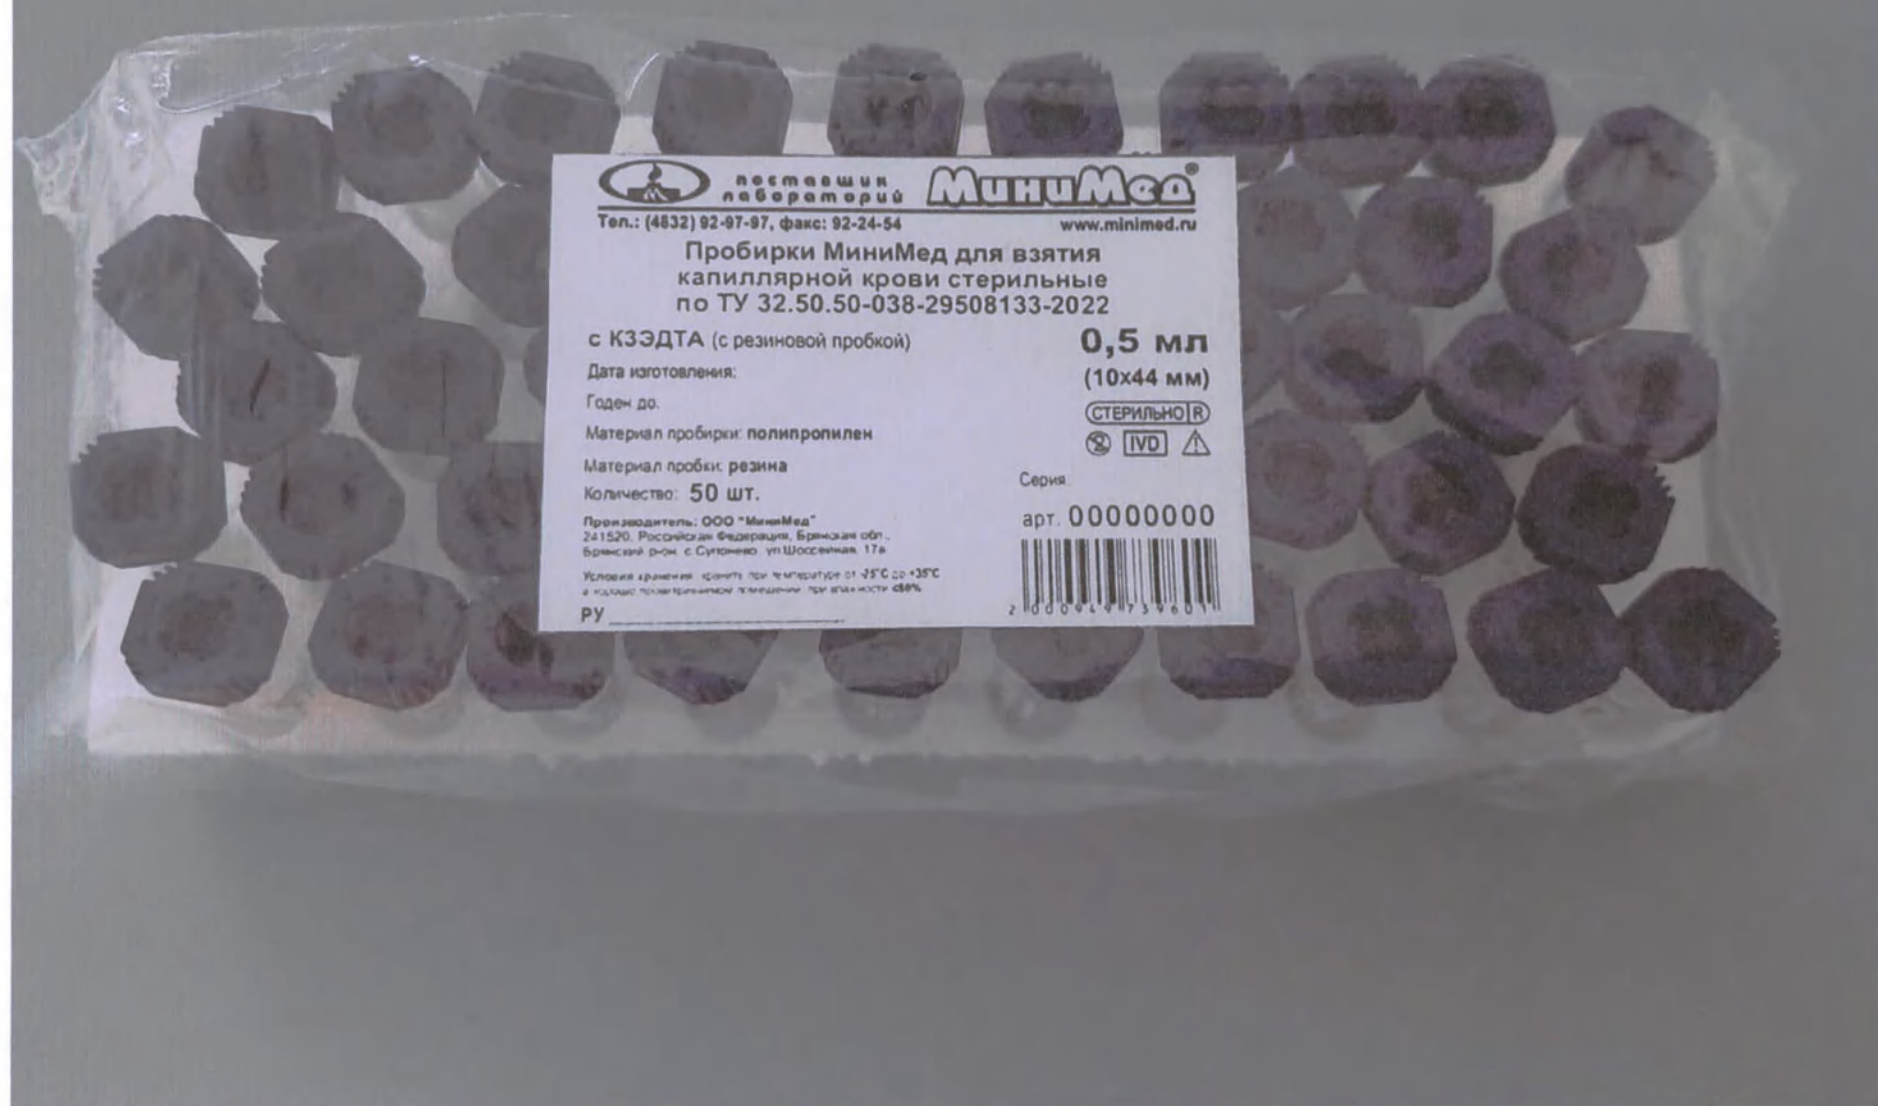

С К2ЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром) 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 00000000


Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с Супонеево, ул Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%

РУ



2 000949 739601



С К2ЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром) 0,5 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

www.minimed.ru

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

0,5 мл

(10x44 мм)

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

РУ


СТЕРИЛЬНО R

⊗ IVD ⚠

Серия:

арт. 000000000

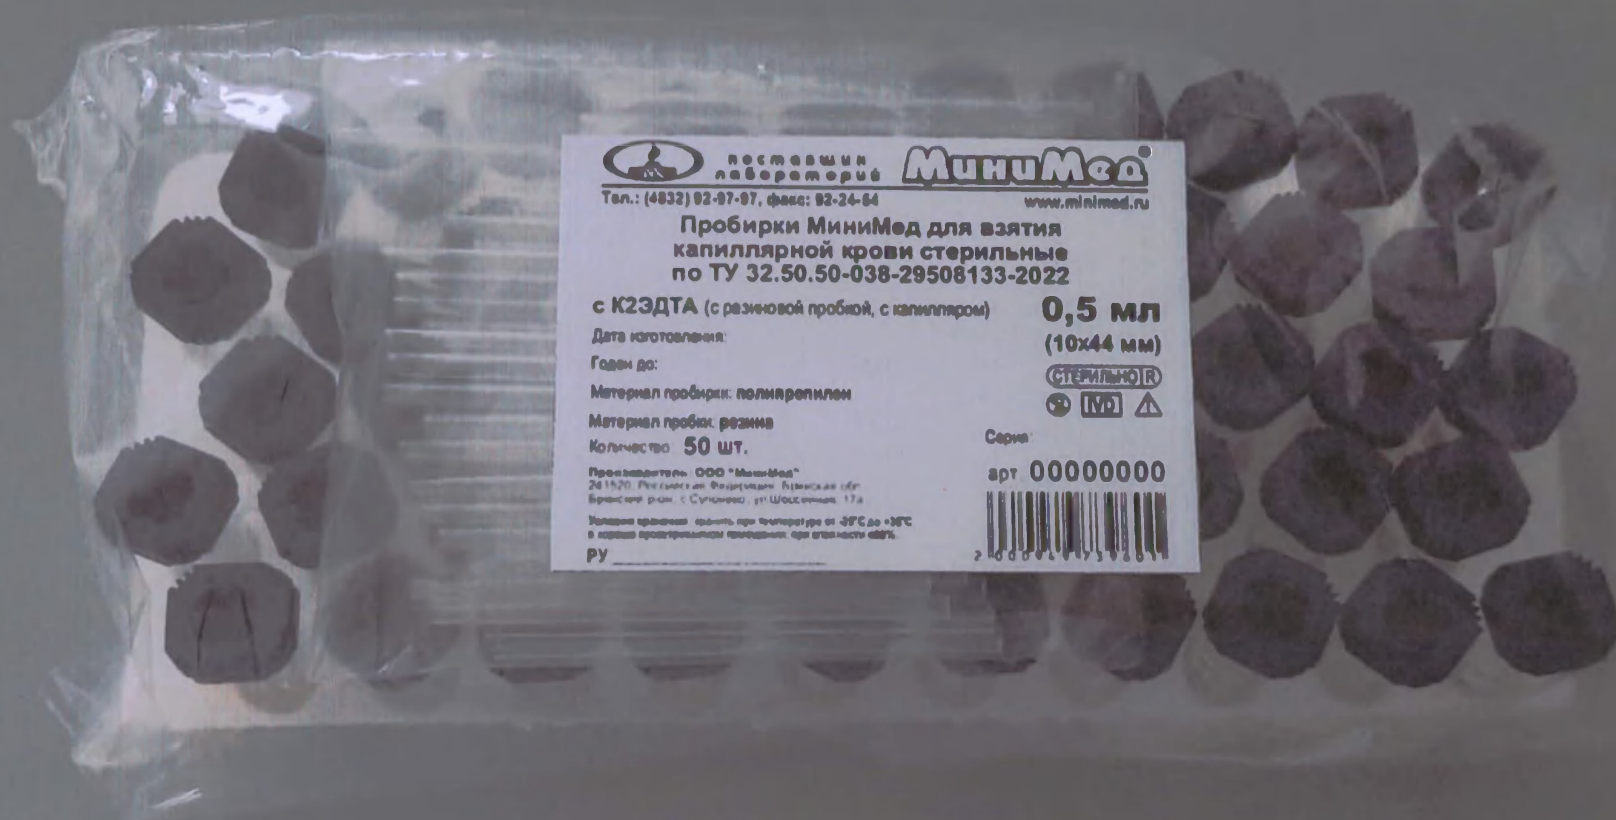

поставщик
лабораторий**МиниМед**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-84

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

0,5 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал пробки: резина

Серия

Количество **50 шт.**арт **00000000**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Республика Татарстан, Бирский район,
Бирский район, с. Сугоньское, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -20°C до +25°C
в герметично закрытой упаковке при влажности 60%.

ру



С КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром) 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал пробки: резина

Количество: **100 шт.**

Серия:


арт. **00000000**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.

РУ



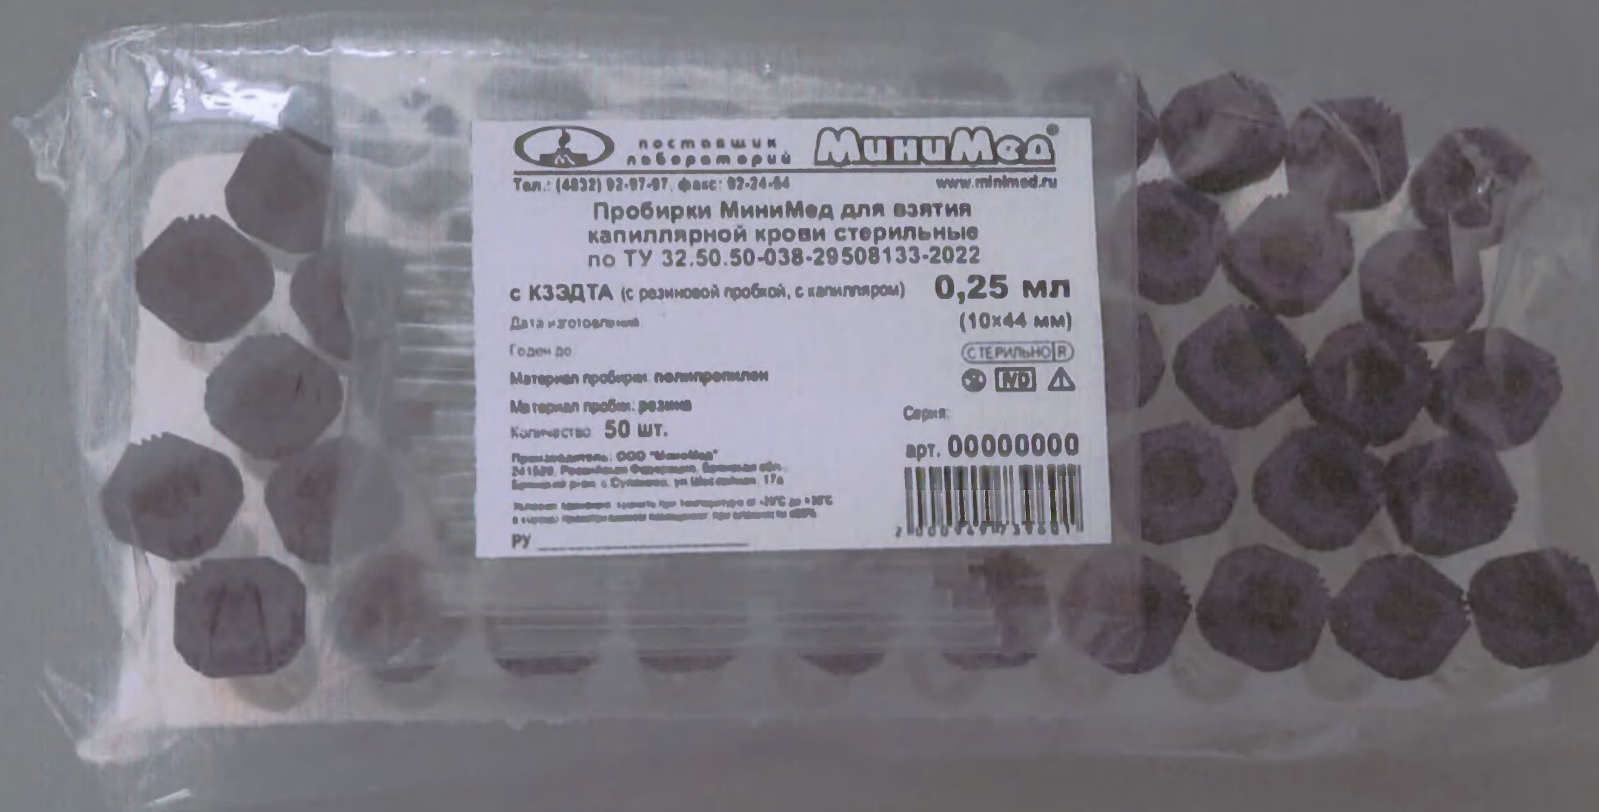

поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-64

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

0,25 мл

Дата изготовления

(10x44 мм)

Годен до

СТЕРИЛЬНО

Материал пробирки: полипропилен

MD

Материал пробки: резина

Количество **50 шт.**

Серия:


арт. **00000000**


Производитель: ООО "МиниМед"
241500, Республика Татарстан, Бугульминский район,
Бугульминский район, с. Сулейманово, ул. Мухоморова, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -10°C до +10°C
в герметичной упаковке. Срок годности по КЗЭДТА
РУ



С КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром) 0,5 мл

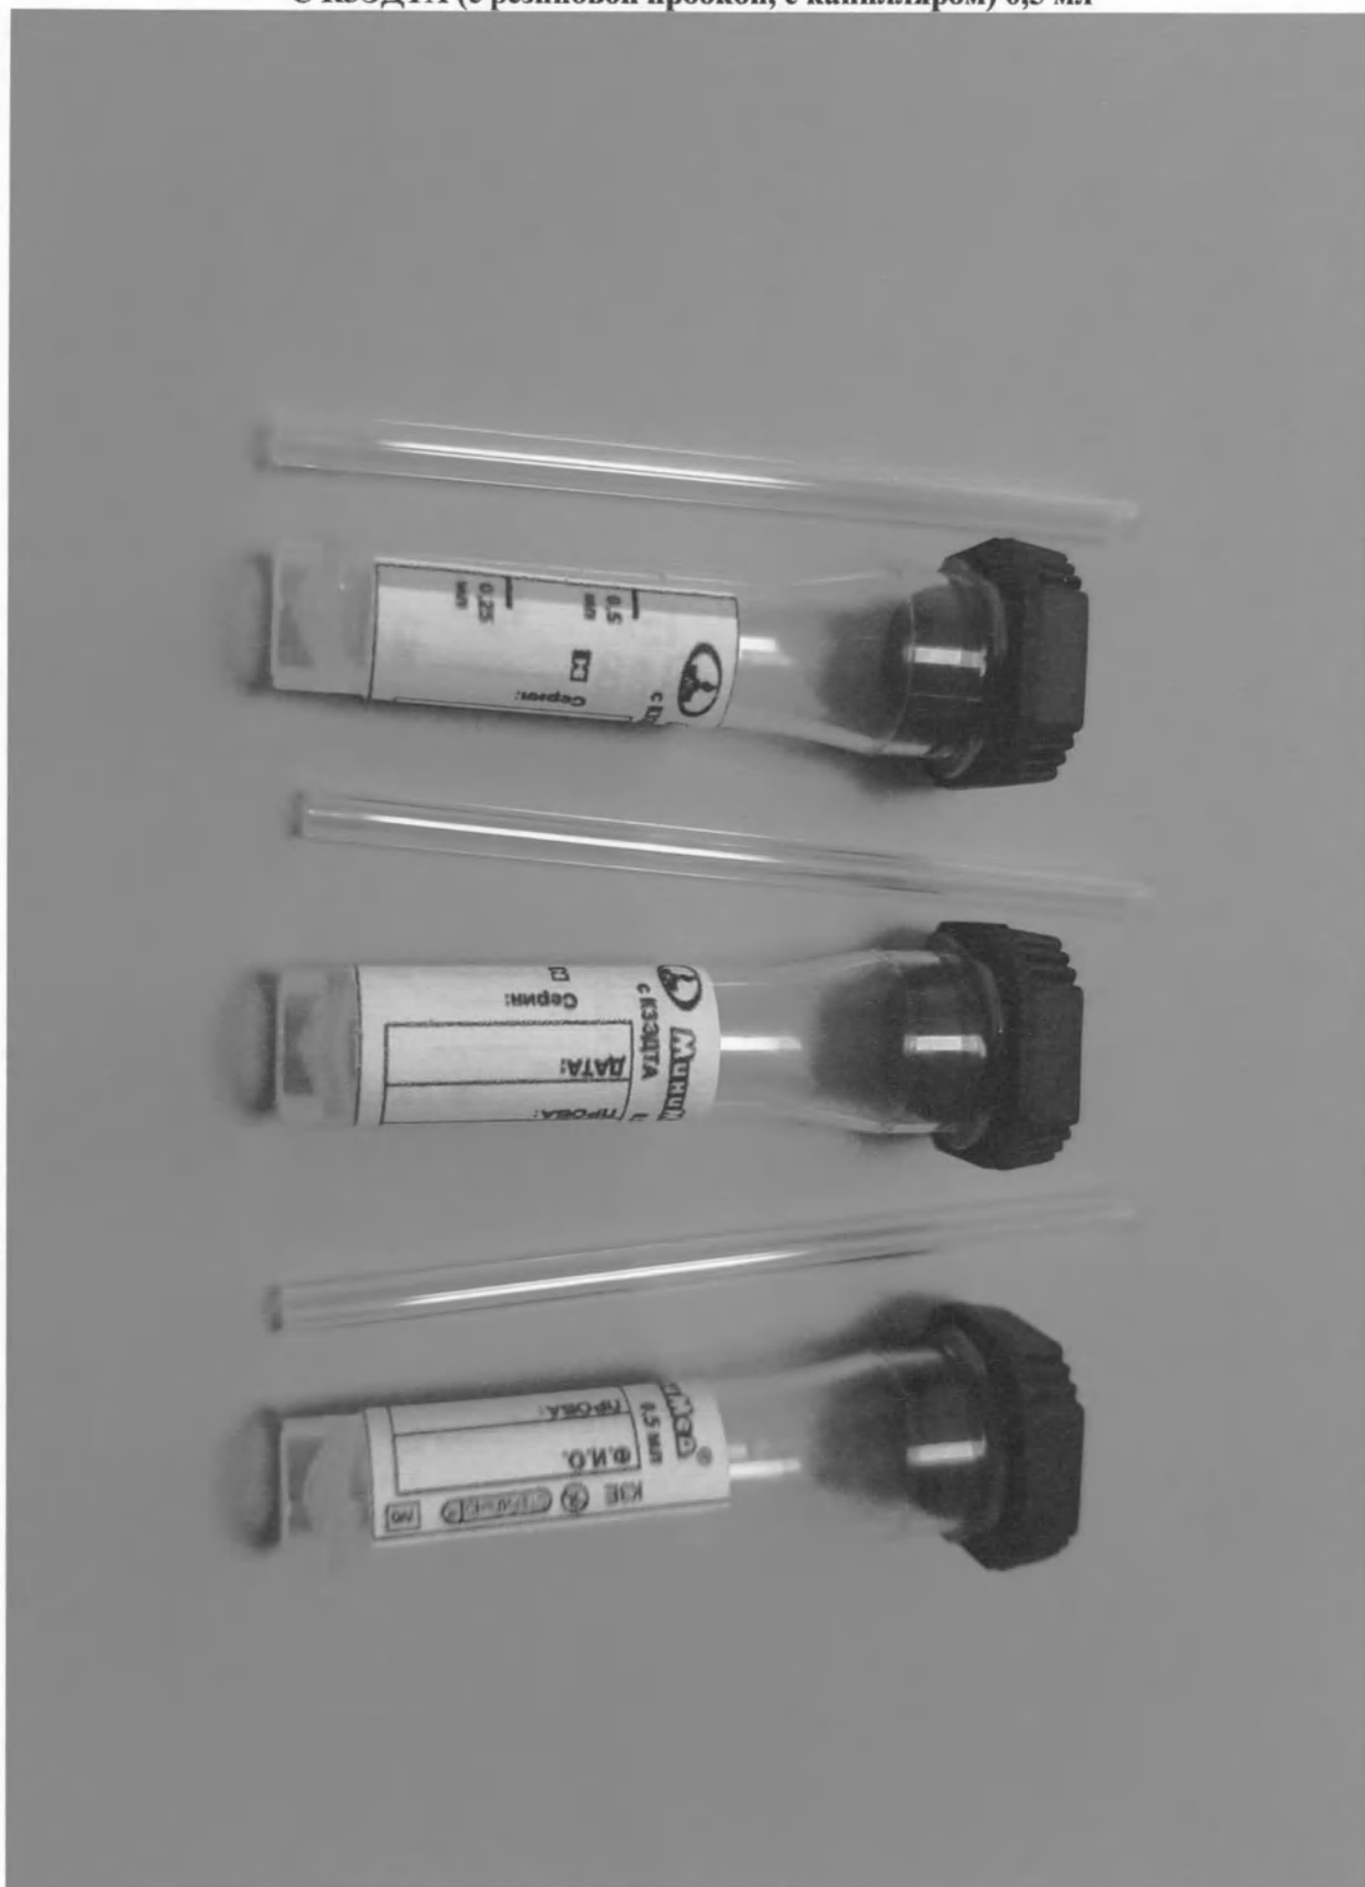



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

0,5 мл

Дата изготовления:

(10x44 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Серия:


арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%

РУ





С лития гепарином 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с лития гепарином

0,25 мл


Дата изготовления:

(10x46 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО

Материал пробирки: полипропилен



Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Серия:


арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супоньево, ул. Шосейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%


ру



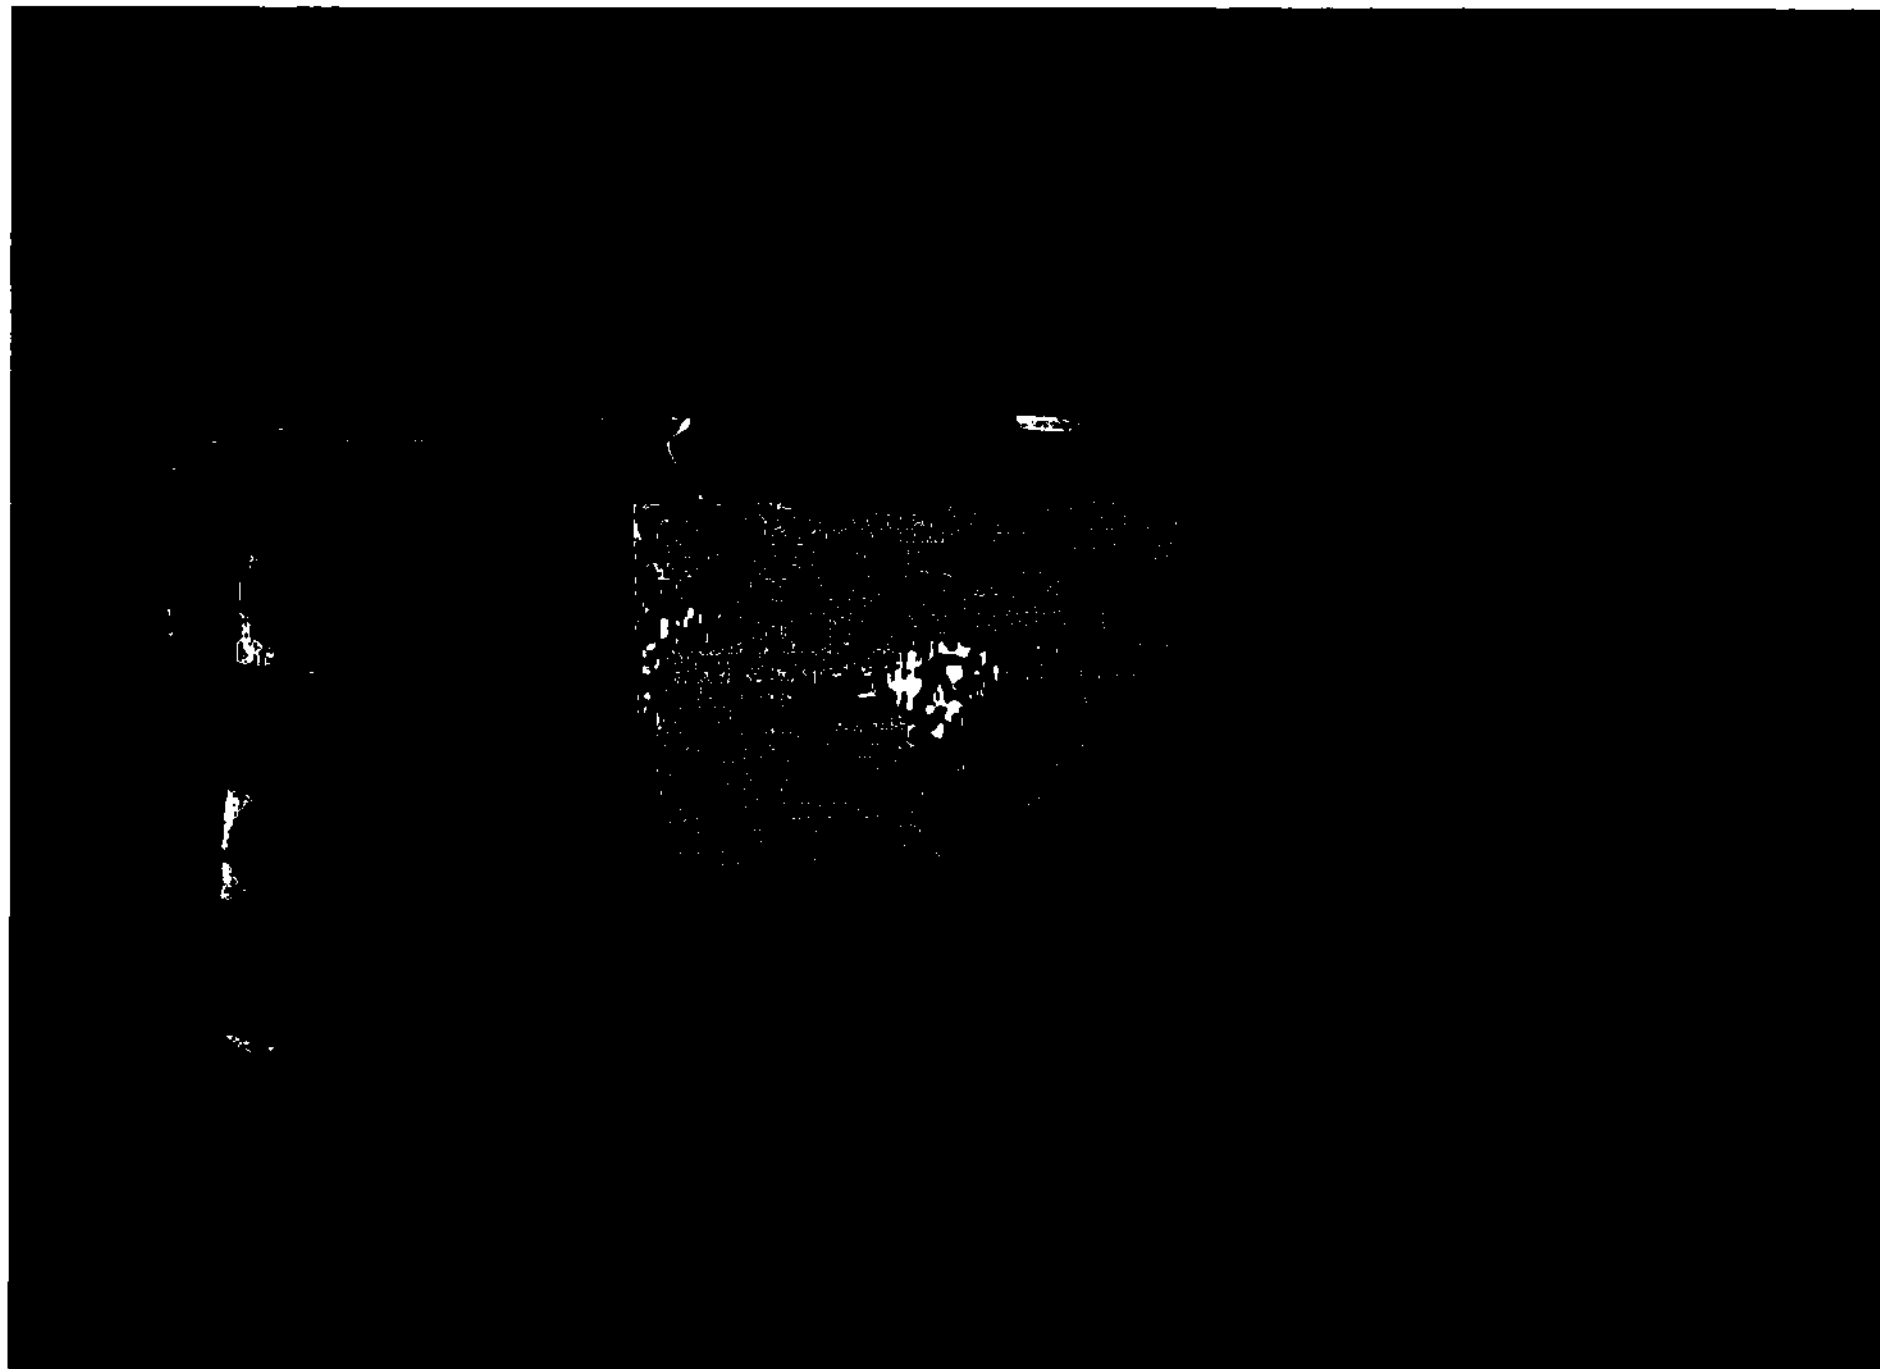


С лития гепарином 0,5 мл







С натрия гепарином 0,25 мл

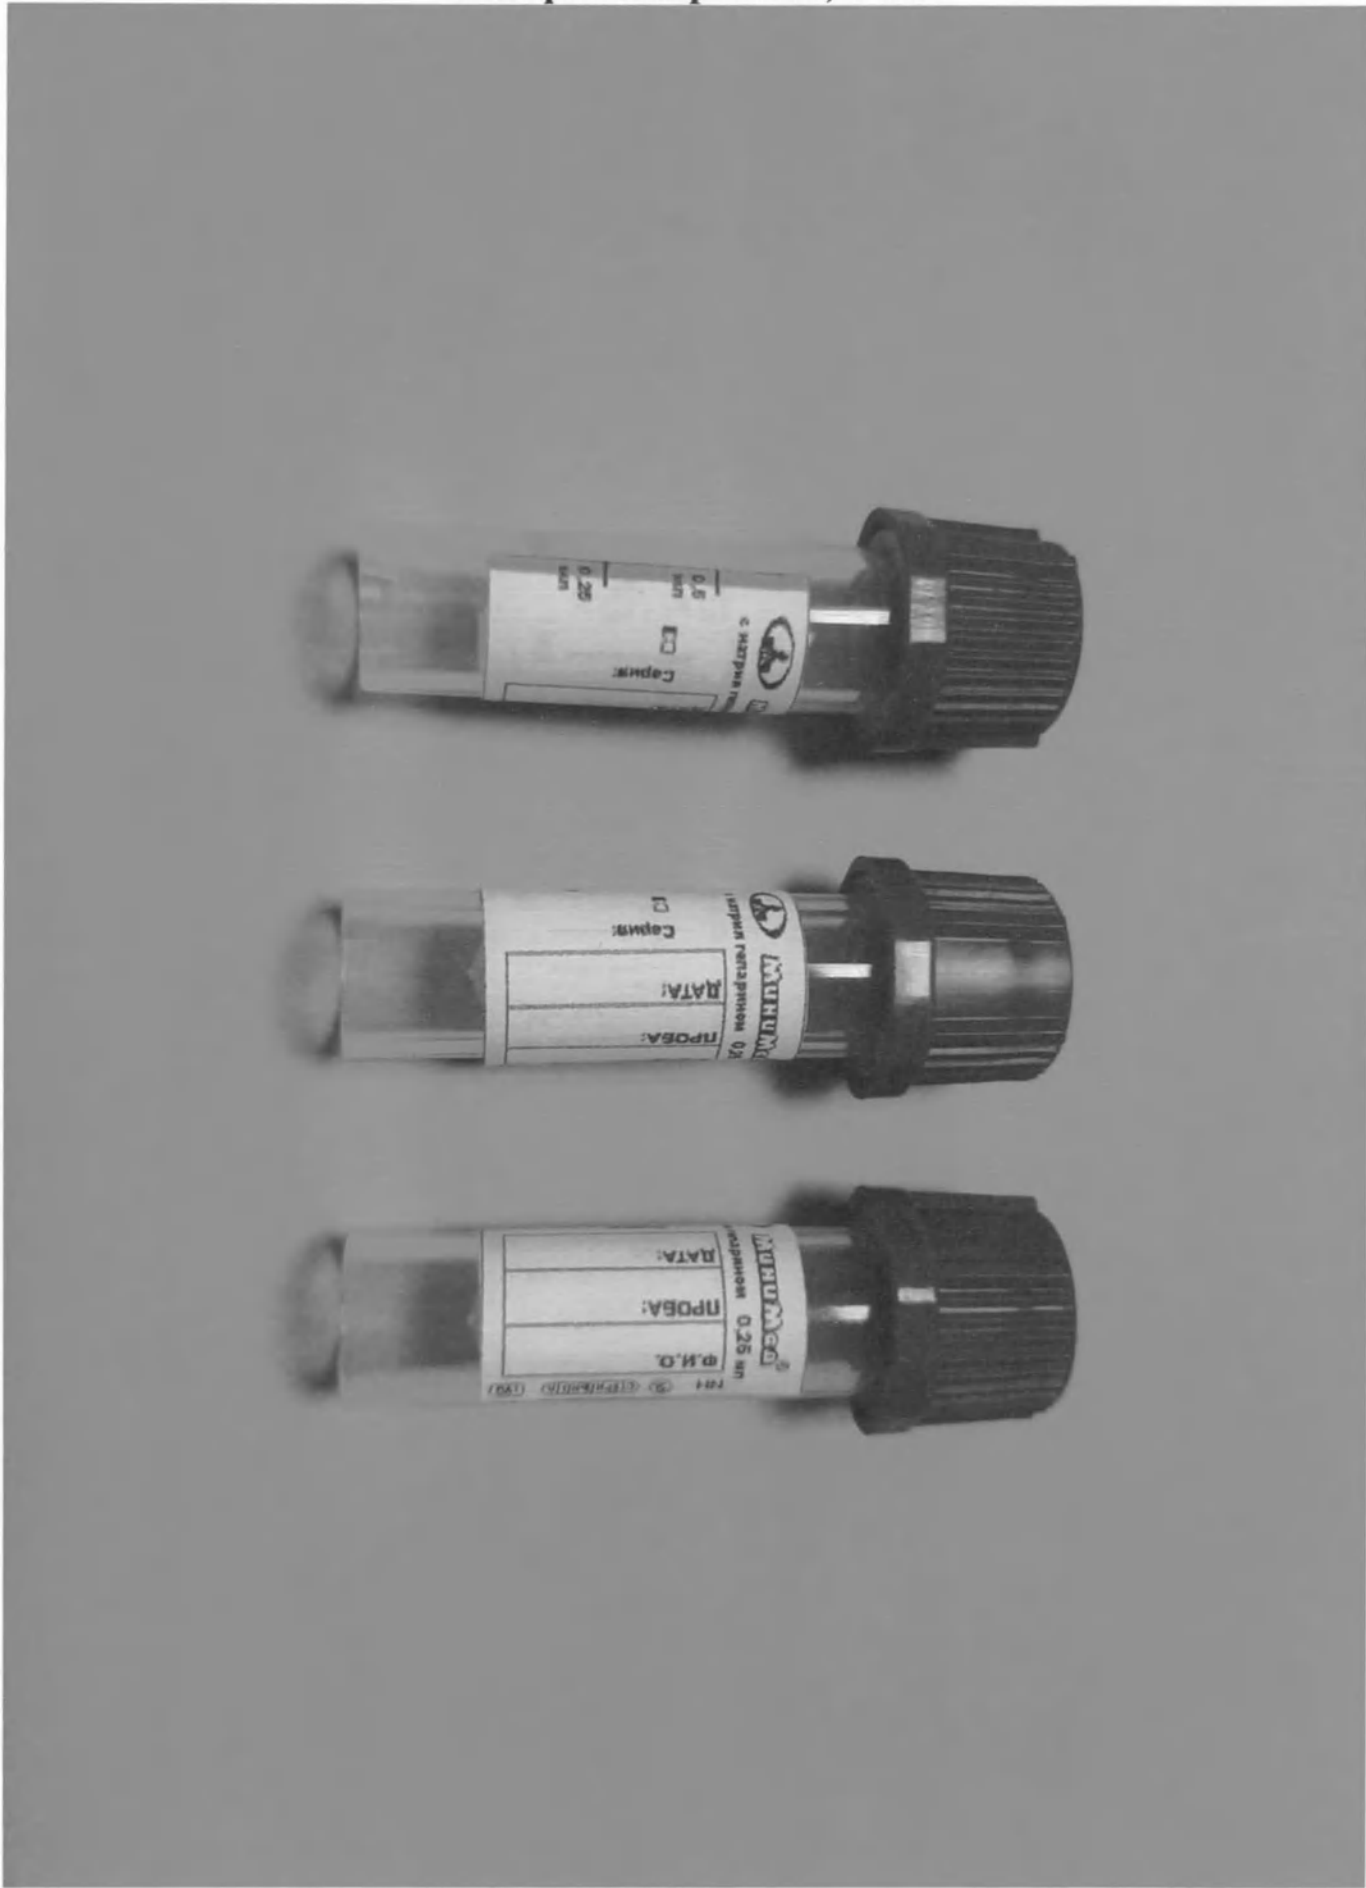

поставщик
лабораторий**МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с натрия гепарином

0,25 мл


Дата изготовления:

(10x46 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен



Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Серия:

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Сулоново, ул.Шосейная, 17а

арт. 00000000

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.





С натрия гепарином 0,5 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с натрия гепарином

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.
Брянский р-он, с. Сутокино, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении при влажности 40-60%

РУ

0,5 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО


IVD

Серия:

арт. 000000000



2 000040 023060 10

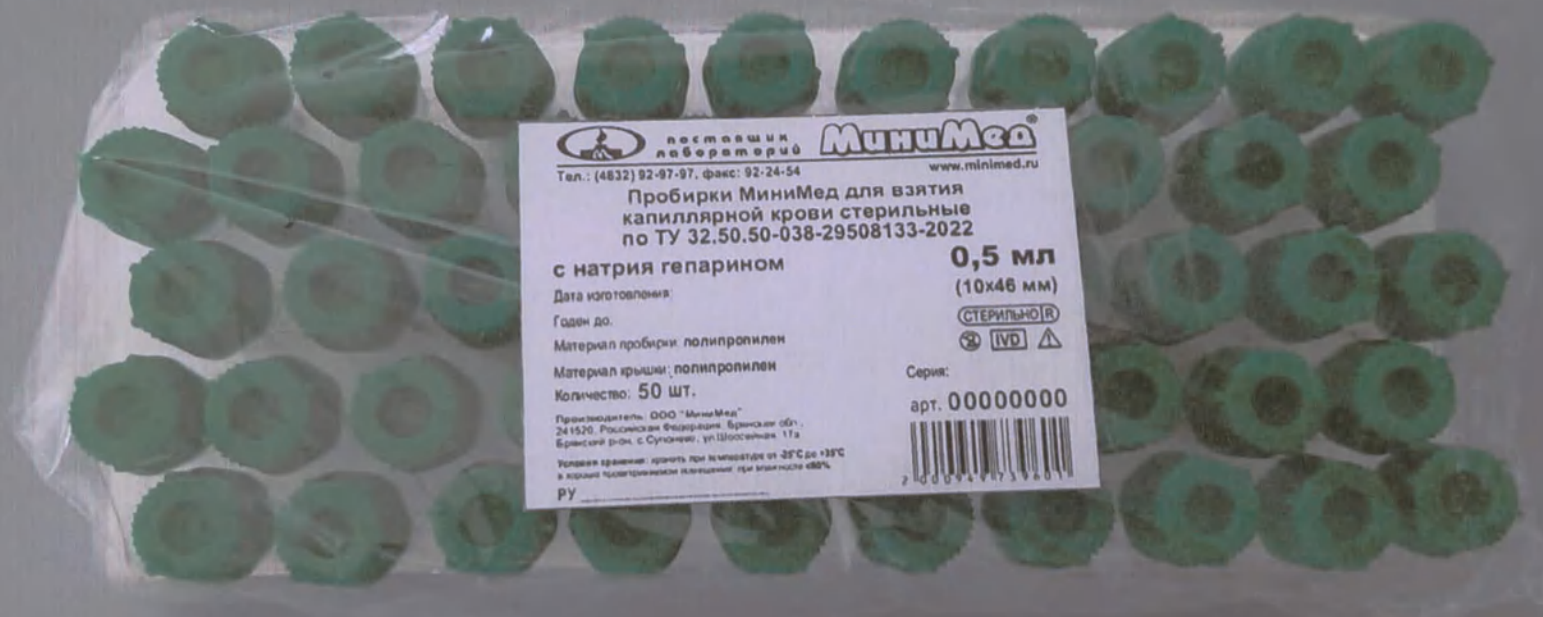

постоянная
лаборатория

МиниМед

www.minimed.ru

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с натрия гепарином

0,5 мл
(10x46 мм)

Дата изготовления:

СТЕРИЛЬНО

Годен до:

IVD

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 50 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сулжичи, ул. Школьная, 11а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в закрытой упаковке; влажность: при влажности 60%
ру



Без наполнителя 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

без наполнителя

0,25 мл


Дата изготовления:

(10x46 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО R

Материал пробирки: полипропилен



Материал крышки: полипропилен

Количество: **100 шт.**

Серия:

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

арт. **000000000**

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.



ру _____



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

без наполнителя

0,25 мл

Дата изготовления:

(10x46 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО

Материал пробирок: полипропилен

IVD

Материал крышки: полипропилен

Количество: 50 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский район, с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в закрытой упаковке; при влажности 45-60%.

ру



Без наполнителя 0,5 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

www.minimed.ru

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

без наполнителя

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: **100 шт.**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а


Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%.

РУ _____

0,5 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R



Серия:

арт. **000000000**



2 000949 173960 1

поставщик
лабораторий**МиниМед®**

Тел.: (4632) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

без наполнителя

0,5 мл

Дата изготовления:

(10x46 мм)

Годен до:

СТЕРИЛЬНО

Материал пробирки: полипропилен

IVD

Материал крышки: полипропилен

Количество: **50 шт.**

Серия:

арт. **00000000**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонь, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности 60%

РУ



С активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

www.minimed.ru

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с активатором свертывания

Активатор: сухие кристаллы кремнезема

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: **100 шт.**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шосейная, 17а


Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности <80%.

РУ _____

0,25 мл


(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R



Серия:

арт. 000000000

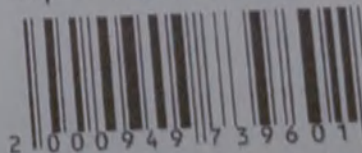

2 000949 173960 1



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с активатором свертывания

0,25 мл

Активатор: сухие кристаллы кремнезема

(10x46 мм)

Дата изготовления:

СТЕРИЛЬНО

Годен до:

IVD

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 50 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сухинино, ул. Шоссейная, 17а


Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности не выше 60%.

РУ



С активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 0,5 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

www.minimed.ru

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с активатором свертывания

0,5 мл


Активатор: сухие кристаллы кремнезема

(10x46 мм)

Дата изготовления:

СТЕРИЛЬНО R

Годен до:



Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Серия:


Количество: **100 шт.**

арт. **000000000**

Производитель: ООО "МиниМед"

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении при влажности <80%

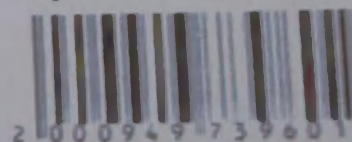

РУ _____



С активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 0,25 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

**с активатором свертывания
и разделительным гелем**

Активатор: сухие кристаллы кремнезема

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: **100 шт.**

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности <80%.

РУ

0,25 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Серия:

арт. **00000000**



С активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 0,5 мл





поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с активатором свертывания
и разделительным гелем

Активатор: сухие кристаллы кремнезема

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: **100 шт.**

Производитель: ООО "МиниМед"

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности <80%.

РУ

0,5 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Серия:

арт. 00000000





Транспортная упаковка





поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супоневое, ул. Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭДТА (с пластмассовой крышкой)

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изготовления: _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%.

РУ

0,25 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО

IVD

Годен до: _____

арт. 00000000




Директор ООО «МиниМед»
Азбукин В.Р.



Образцы этикеток медицинского изделия
Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022.

Этикетки на пробирку

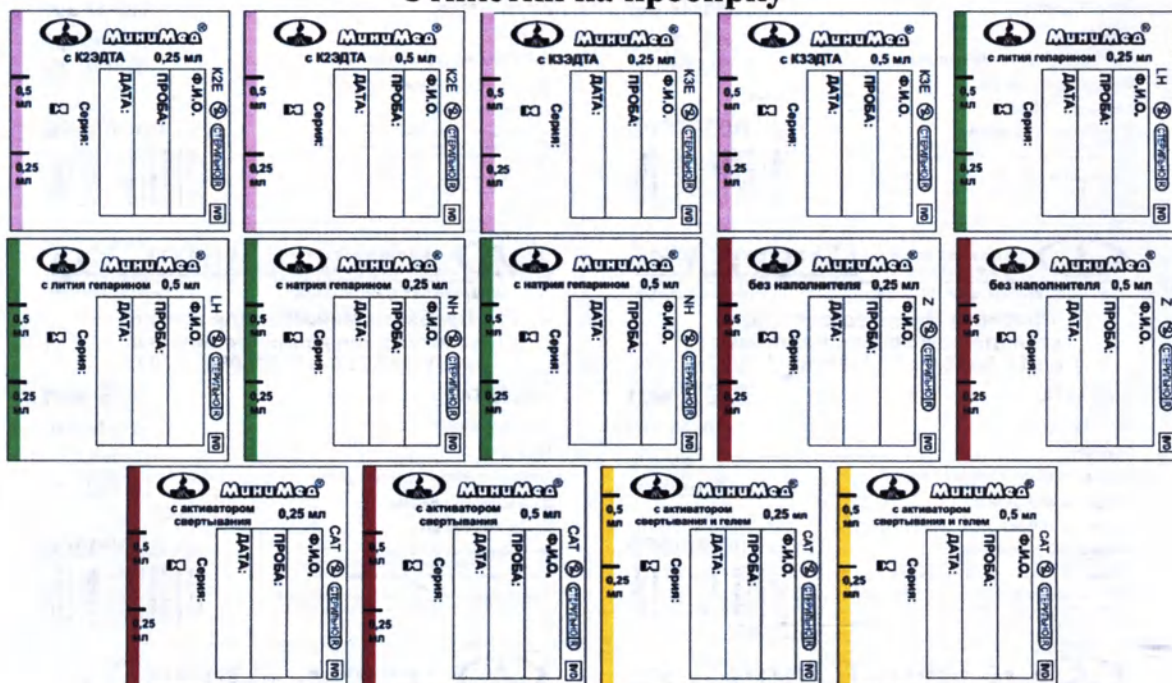

Этикетки групповой упаковки

поставщик лабораторий **МиниМед®**
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с пластмассовой крышечкой) 0,25 мл
 Дата изготовления: (10x46 мм)
 Годен до: **СТЕРИЛЬНО R**
 Материал пробирки: полипропилен
 Материал крышки: полипропилен
 Количество: 100 шт.
 Серия: арт. 00000000
 Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <80%.
 РУ

поставщик лабораторий **МиниМед®**
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с пластмассовой крышечкой) 0,5 мл
 Дата изготовления: (10x46 мм)
 Годен до: **СТЕРИЛЬНО R**
 Материал пробирки: полипропилен
 Материал крышки: полипропилен
 Количество: 100 шт.
 Серия: арт. 00000000
 Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <80%.
 РУ

поставщик лабораторий **МиниМед®**
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с пластмассовой крышечкой) 0,25 мл
 Дата изготовления: (10x46 мм)
 Годен до: **СТЕРИЛЬНО R**
 Материал пробирки: полипропилен
 Материал крышки: полипропилен
 Количество: 100 шт.
 Серия: арт. 00000000
 Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <80%.
 РУ

поставщик лабораторий **МиниМед®**
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с пластмассовой крышечкой) 0,5 мл
 Дата изготовления: (10x46 мм)
 Годен до: **СТЕРИЛЬНО R**
 Материал пробирки: полипропилен
 Материал крышки: полипропилен
 Количество: 100 шт.
 Серия: арт. 00000000
 Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <80%.
 РУ



лабораторий

МиниМед

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЭЗДТА (с резиновой пробкой)

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Бринский обл.,
Бринский р-он, с.Султоноево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <65%

0,25 мл

(10х44 мм)

СТЕРИЛЬНО





Серия:

арт. 00000000



2 000949 139601



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭДТА (с резиновой пробкой)

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сухожее, ул.Шоссейная, 17А

Условия хранения: хранить при температуре от -25°С до +35°С
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%.

ру

0,5 мл
(10х44 мм)

СТЕРИЛЬНО

⊗ IVD ⚠

Серия:


арт. 00000000



2 000949 336011



лаборатория
МиниМед



Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗДТА (с резиновой пробкой)

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сутюново, ул. Цосоевская, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <85%

0,25 мл

(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО





Серия:

арт. 00000000



2 000949 139601

 **вспомогательные
лабораторий** **МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой)

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Сумоново, ул.Шоссейная, 17А

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности **≤95%**

0,5 мл
(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО

 **IVD** 

Серия:

арт. 00000000



2 400094 9735601

 **поставщик
лабораторий** **МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с К2ЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром) 0,25 мл

Дата изготовления: (10х44 мм)

Годен до: **СТЕРИЛЬНО**

Материал пробирки: полипропилен   

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сутюново, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +25°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <60%.

ру


2 000094 013960 1

 **постоянный
лабораторий** **МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с К2ЭДТА (с резиновой пробой, с капилляром) **0,5 мл**

Дата изготовления: **(10x44 мм)**

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Серия:

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Алтай обл.,
Берлинский р-н, с. Сугоноево, ул. Шоссейная, 17Б

арт. 000000000

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности «до 90%»

ру



2 000949 139601

 **постоянные
лаборатории** **МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром) 0,25 мл

Дата изготовления: (10х44 мм)

Годен до: **СТЕРИЛЬНО**

Материал пробирок: полипропилен **NO**

Материал пробки: резина **⚠**

Количество: 100 шт.

Серия: арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Бринская обл.,
Бринский р-он, с. Супунево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°С до +30°С
в закрытом непрозрачном упаковке; при влажности <80%.

РУ



2 0000949173601



**поставщик
лабораторий**

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробой, с капилляром)

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с.Сукновато, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от +5°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <65%.

0,5 мл

(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО





Серия:

арт. 00000000



2 000949 739601



**поставщик
лабораторий**

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирики МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с лития гепарином

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Бринский обл.,
Бринский р-он, с. Сунцово, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении. При влажности **≤80%**

0,25 мл


(10х46 мм)

СТЕРИЛЬНО

⊗ IVD ⊕

Серия:

арт. 000000000



2 1000949136011

 **поставщик
лабораторий** **МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с лития гепарином **0,5 мл**
(10х46 мм)

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 00000000

Производитель: ООО "МиниМед",
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-н, с.Сунючево, ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности $\leq 80\%$.



2 000949 739601



**вспомогательные
лаборатории**

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с натрием гепарином

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сутояно, ул. Школьная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности ≤80%

0,25 мл

(10х46 мм)

СТЕРИЛЬНО

⊗ **ND** ⚠

Серия:

арт. 00000000



2 000949 736001

 поставщик
лабораторий **МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с натрия гепарином

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Серия:

арт. 000000000

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.
Брянский район, с. Сухиничи, д. 111/13, линия 11А

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности 60%



ру



Федеральный научный центр
биомедицинских исследований

МиниМед

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

без наполнителя

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сутово, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности ≤80%

0,25 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО

⊗
ND
⚠

Серия:


арт. 00000000



2 1000949173601



**поставщик
лабораторий**



МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

без наполнителя

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"

121520, Рос.сис.сд.и Федерация, Бр.инск. обл.
Бр.инск. р-он, с.Сулговецо ул.Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от +5°C до +35°C
в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <60%.

0,5 мл

(10х46 мм)

СТЕРИЛЬНО





Серия:

арт. 00000000





**поставщик
лабораторий**

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с активатором свертывания

Активатор: сухие кристаллы кремнезема
Дата изготовления:
Годен до:

0,25 мл

(10х46 мм)

СТЕРИЛЬНО

⊗ IVD ⊕

Материал пробики: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Суконново, ул. Шоссейная, 17а

Серия: **арт. 000000000**

Условия хранения: хранить при температуре от -25°С до +25°С
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности <80%

ру



2 100949 175303 1

 **постоянный
лабораторий** **МиниМед®**

Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с активатором свертывания

Активатор: сухие кристаллы кремнезема
Дата изготовления:
Годен до:
Материал пробирки: полипропилен
Материал крышки: полипропилен
Количество: 100 шт.

Производитель: ООО "МиниМед"
241520, Российская Федерация, Брянская обл.,
Брянский р-он, с. Сулоноево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°С до +35°С
в хорошо проветриваемом помещении; при влажности <80%


0,5 мл
(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО   

Серия: арт. 000000000



2 000949 739601



Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с активатором свертывания
и разделительным гелем

Активатор: сухие кристаллы кремнезема

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,

Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C

в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <80%

РУ

0,25 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Серия:

арт. 00000000



2 000949 739601



Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с активатором свертывания
и разделительным гелем

Активатор: сухие кристаллы кремнезема

Дата изготовления:

Годен до:

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 100 шт.

Производитель: ООО «МиниМед»

241520, Российская Федерация, Брянская обл.,

Брянский р-он, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а

Условия хранения: хранить при температуре от -25°C до +35°C

в хорошо проветриваемом помещении, при влажности <80%

РУ

0,5 мл

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Серия:

арт. 00000000



2 000949 739601

Этикетки транспортной тары



241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с пластмассовой крышкой)

0,25 мл

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью

воздуха менее 80%. Транспортировать при t от

-25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%.

РУ

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Годен до:

арт. 00000000



2 000949 739601



241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с пластмассовой крышкой)

0,5 мл

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью

воздуха менее 80%. Транспортировать при t от

-25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%.

РУ

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Годен до:

арт. 00000000



2 000949 739601



241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с пластмассовой крышкой)

0,25 мл

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью

воздуха менее 80%. Транспортировать при t от

-25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%.

РУ

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R


IVD

Годен до:

арт. 00000000



2 000949 739601



241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с пластмассовой крышкой)

0,5 мл

Материал пробирки: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью

воздуха менее 80%. Транспортировать при t от

-25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%.

РУ

(10x46 мм)

СТЕРИЛЬНО R


IVD

Годен до:

арт. 00000000



2 000949 739601



241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с резиновой пробкой)

0,25 мл

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью

воздуха менее 80%. Транспортировать при t от

-25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%.

РУ

(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Годен до:

арт. 00000000



2 000949 739601



241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54

www.minimed.ru

**Пробирки МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с резиновой пробкой)

0,5 мл

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью

воздуха менее 80%. Транспортировать при t от

-25 до +35°C, влажностью воздуха менее 80%.

РУ

(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО R

IVD

Годен до:

арт. 00000000



2 000949 739601



постоянный
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
 капиллярной крови стерильные
 по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЭЗДА (с резиновой пробкой)

Материал пробирик: **полипропилен**

Материал пробки: **резина**

Количество: **3000 шт.** (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°С, влажность воздуха менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°С, влажность воздуха менее 80%.

ру

0,25 мл
(10х44 мм)

СТЕРИЛЬНО

☒ IVD ☒

Годен до: _____

арт. **00000000**



2 10009491739601



поставляющий
лаборатории

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные

по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой)

Материал пробирки: **полипропилен**

Материал пробки: **резина**

Количество: **3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)**

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°C, влажностью воздуха не менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°C, влажностью воздуха не менее 80%.

ру

0,5 мл


(10х44 мм)

СТЕРИЛЬНО!

☒ IVD ⚠

Годен до: _____

арт. **00000000**



2 00009491939601



постоянные
лаборатории

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супоньево, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные**
 по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

Материал пробирик: полипропилен

Материал пробки: резина

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить: следует при t от -25 до +35°C, влажность воздуха менее 80%. Транспортировать: при t от -25 до +35°C, влажность воздуха менее 80%.

РУ

0,25 мл
(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО





Годен до: _____

арт. 00000000



2 000969 336011



постоянный
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирки МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 50.50-038-29508133-2022

с КЭ2ДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

Материал пробирки: полипропилен

Материал пробки: **резина**

Количество: **3000 шт.** (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: **ООО «МиниМед»**

Хранить следует при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%.

ру

0,5 мл

(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО (R)





Годен до: _____

арт. **00000000**



2 0009991759001



**постоянные
лаборатории**

МиниМед®

241520, Р.Ф. Брянская обл., Брянский р-н, с. Супоньево, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022**

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

Материал пробирик: **полипропилен**

Материал пробок: **резина**

Количество: **3000 шт.** (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°С, влажность воздуха менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°С, влажность воздуха менее 80%.

0,25 мл

(10x44 мм)

СТЕРИЛЬНО





Годен до: _____

арт. 00000000





поставщик
лабораторий

МиниМед®

241250, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирики МиниМед для взятия капиллярной крови стерильные по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с КЗЭДТА (с резиновой пробкой, с капилляром)

Материал пробирки: **полипропилен**

Материал пробки: **резина**

Количество: **3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)**

Серия (партия) №: _____ Дата изгот.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%.

ру

0,5 мл

(10х44 мм)

СТЕРИЛЬНО





Годен до: _____

арт. **00000000**



2 000940 759601



**постоянный
лабораторий**

МиниМед®

241520, Р.Ф. Брянская обл., Брянский р-н, с. Супоньево, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

**Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные**
 по ТУ 32.50.038-29508133-2022

с лития гепарином

Материал пробирик: полипропилен

Материал крышки: полипропилен

Количество: 3000 шт. (30 уп. по 100 шт.)

Серия (партия) № _____ Дата изгот. _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%.

РУ

0,25 мл
(10х46 мм)

СТЕРИЛЬНО





Годен до: _____

арт. 00000000





поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, Рф. Брянская обл. Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
 Тел.: (4832) 92-97-97, факс: 92-24-54 www.minimed.ru

Пробирики МиниМед для взятия
капиллярной крови стерильные
по ТУ 32.50.50-038-29508133-2022

с лития гепарином

Материал пробирок: полипропилен
 Материал крышки: полипропилен
 Количество: 3000 шт / 30 уп по 100 шт)

Серия (партия) № _____ Дата изгот. _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки _____ кг

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%. Транспортировать при t от -25 до +35°С, влажность воздуха не менее 80%.

РВ

0,5 мл

(10х46 мм)

СТЕРИЛЬНО

IVD
!

Годен до: _____

арт. 00000000



