

Фотографии медицинского изделия
«АНАЛИЗАТОР КОАГУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ CS-1600 с
принадлежностями» производства SYSMEX CORPORATION
(СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН), Япония



Рис.1 АНАЛИЗАТОР КОАГУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ CS-1600



Рис.2 1 Руководство по эксплуатации "Основы работы с прибором"

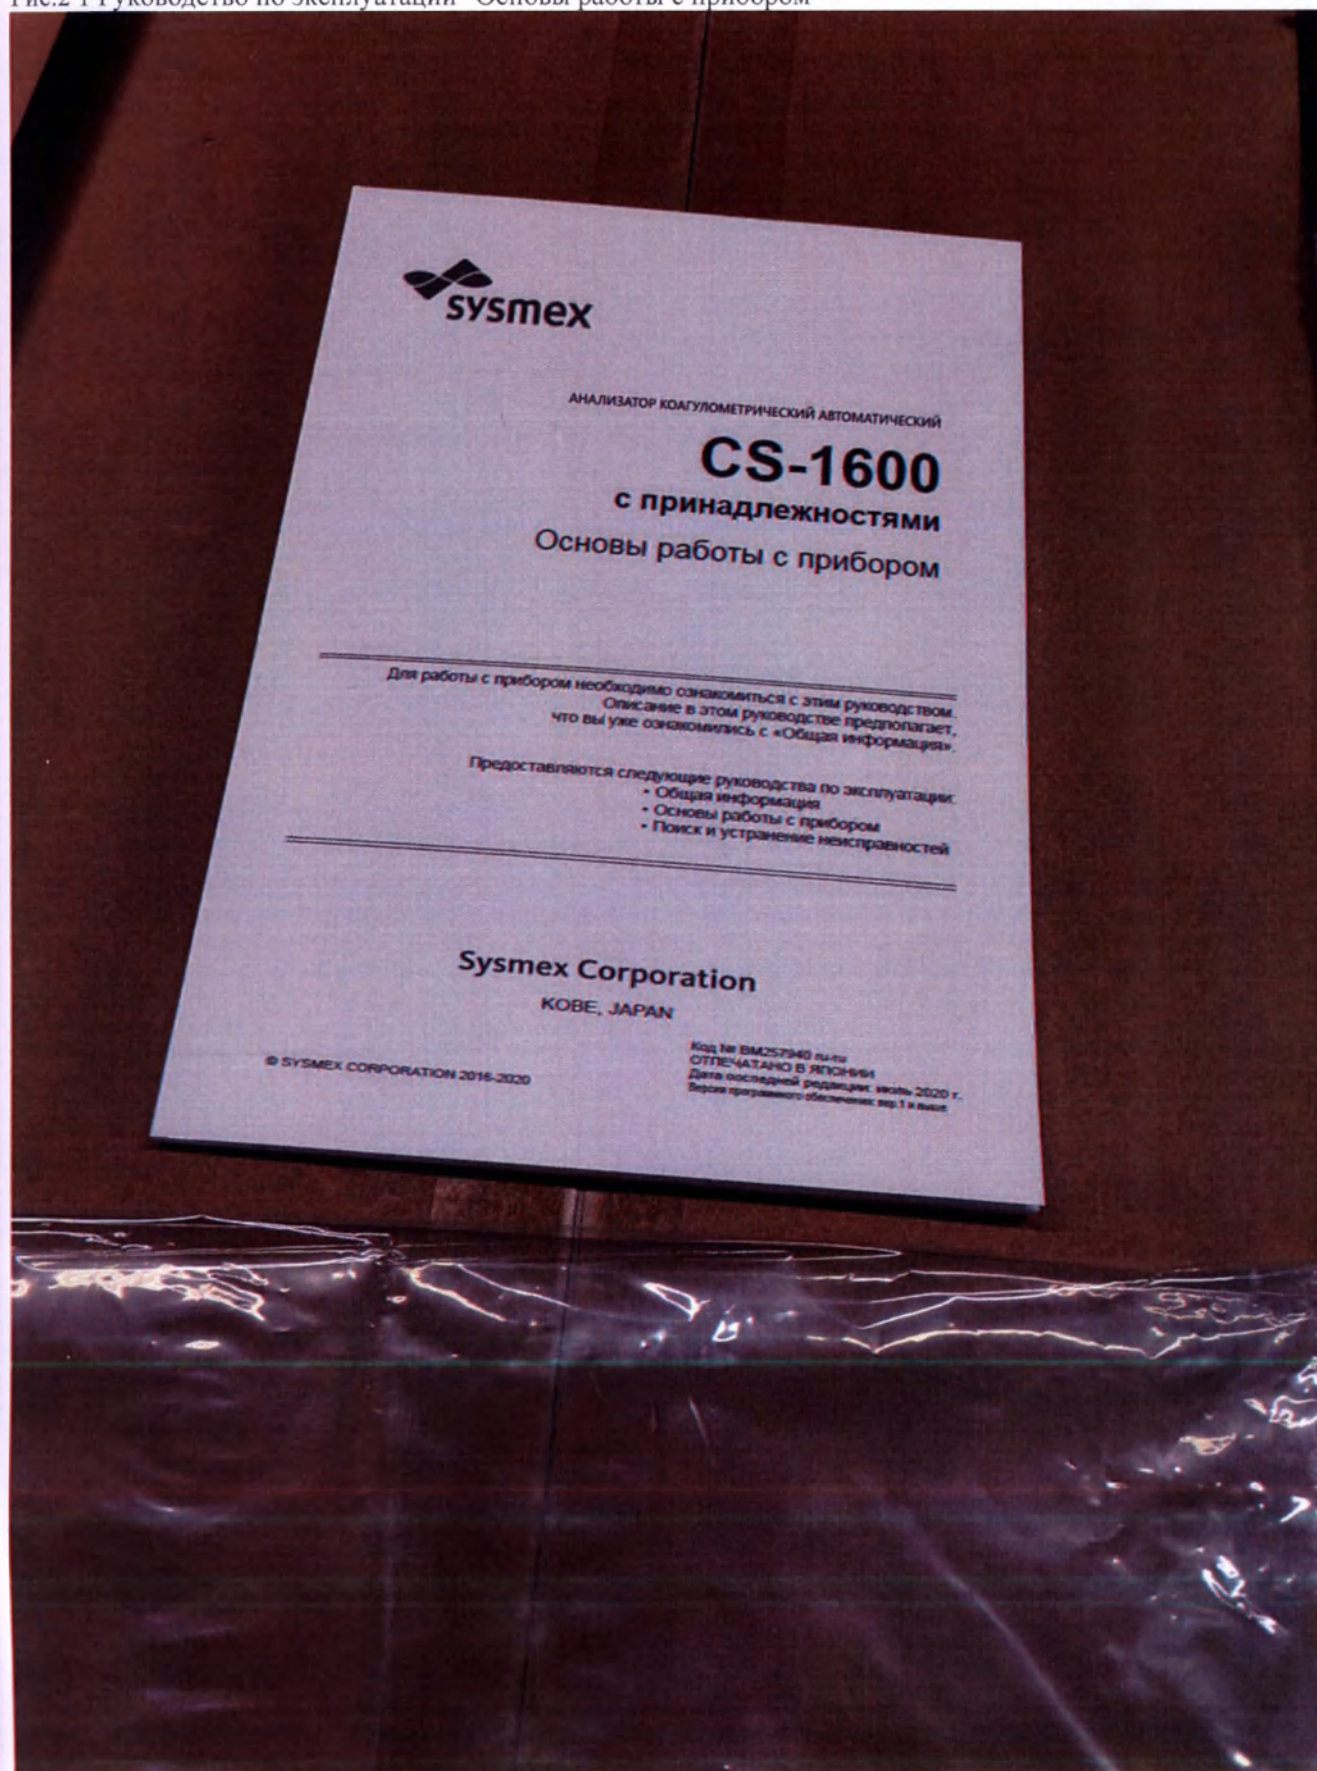


Рис.2.2 Руководство по эксплуатации "Поиск и устранение неисправностей"

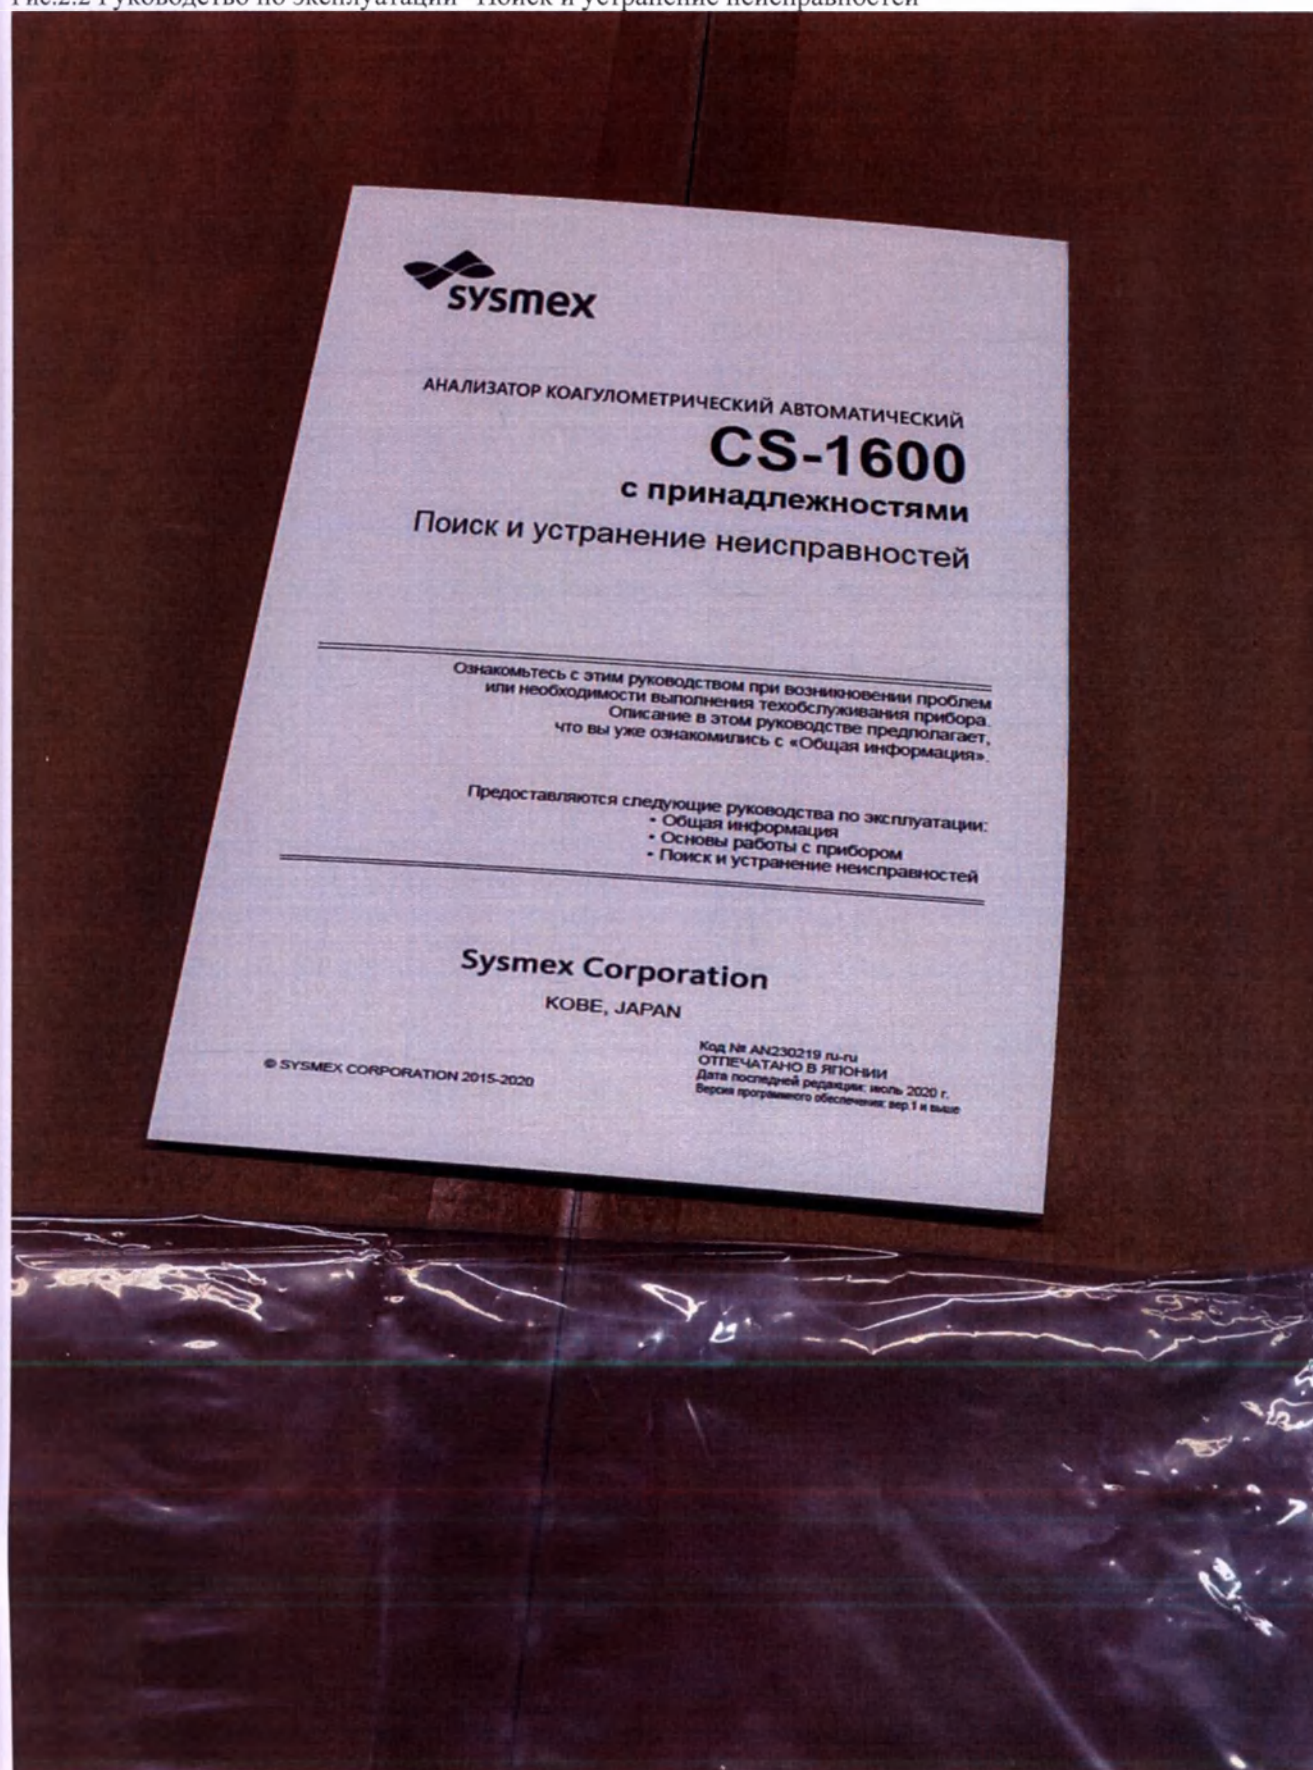


Рис.2.3 Руководство по эксплуатации "Общая информация"



АНАЛИЗАТОР КОАГУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

CS-1600

с принадлежностями

Общая информация

Настоящее руководство содержит важную информацию по безопасности
и спецификации прибора.
Ознакомьтесь с этим руководством перед использованием прибора.

Предоставляются следующие руководства по эксплуатации:

- Общая информация
 - Основы работы с прибором
 - Поиск и устранение неисправностей
-

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN

© SYSMEX CORPORATION 2016-2020

Код № BP837199 ru-ru
ОТПЕЧАТАНО В ЯПОНИИ
Дата последней редакции: июль 2020 г.
Версия программного обеспечения: вер. 1 и выше

Рис.2.4 Кабель электропитания ТА-6Р(А) + ТА(А) Н05VV-F



Рис.2.5 Емкость М20 (промывочный резервуар), объем 20 л.



Рис.2.6 Штатив №240

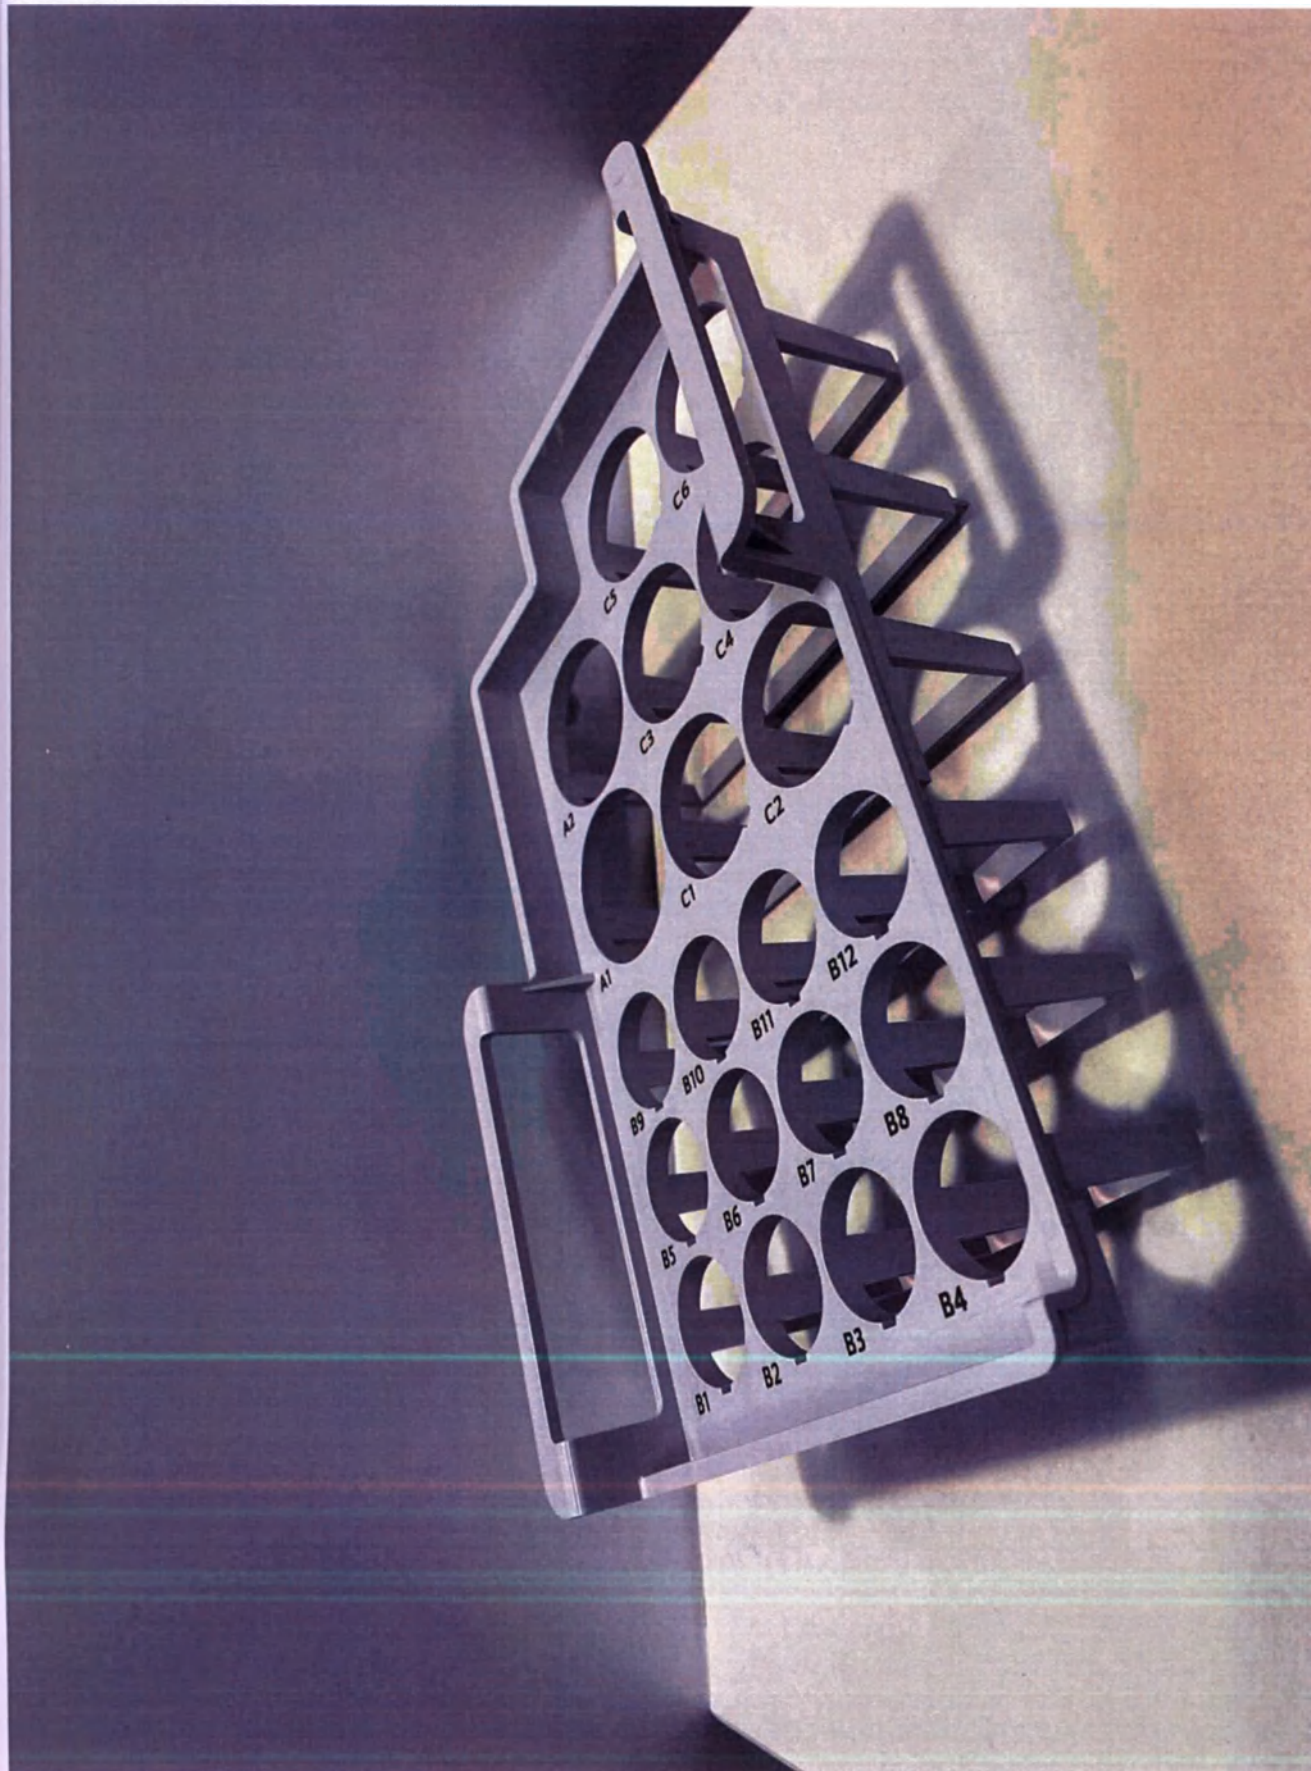


Рис.2.7 Штатив №241

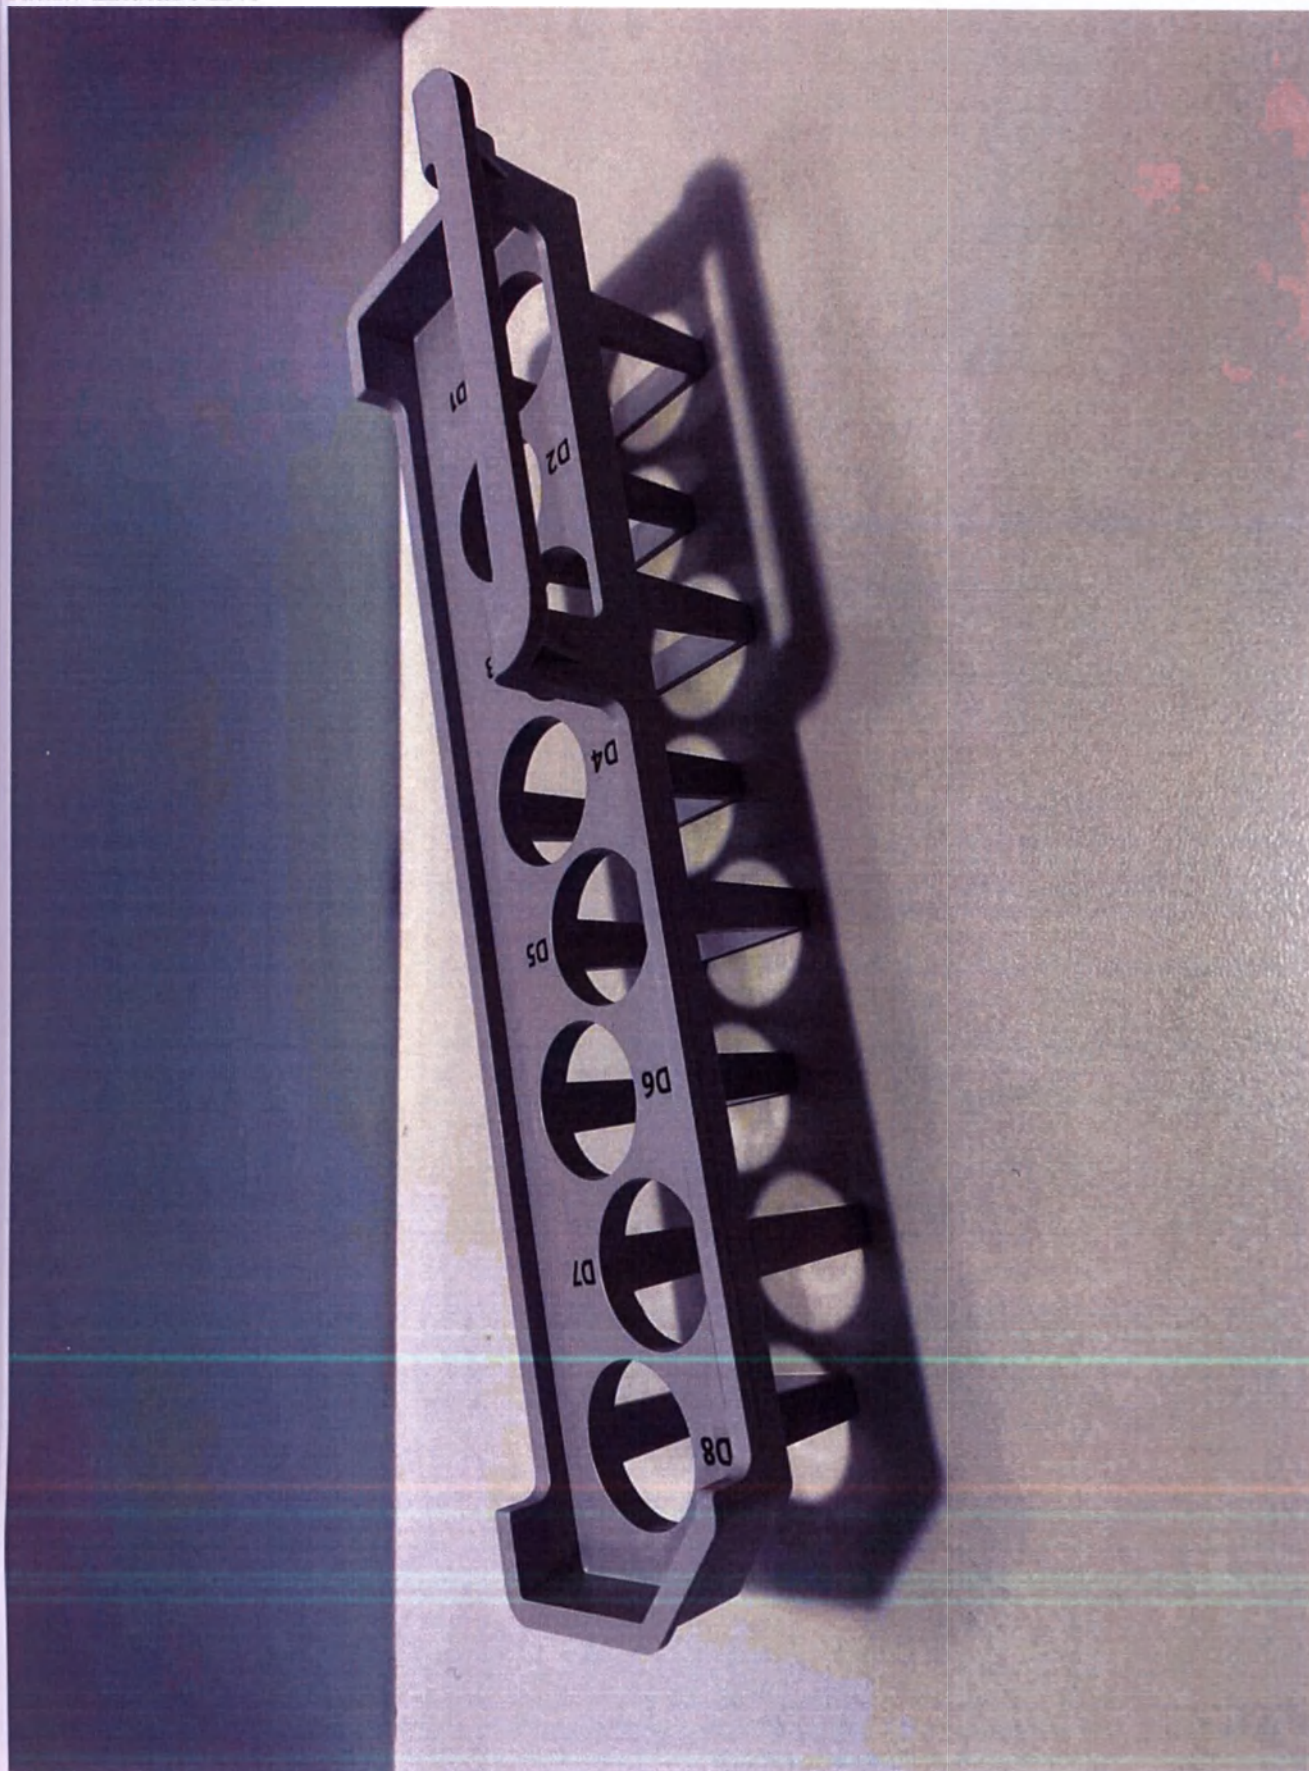


Рис.2.8 Мусорный контейнер №8

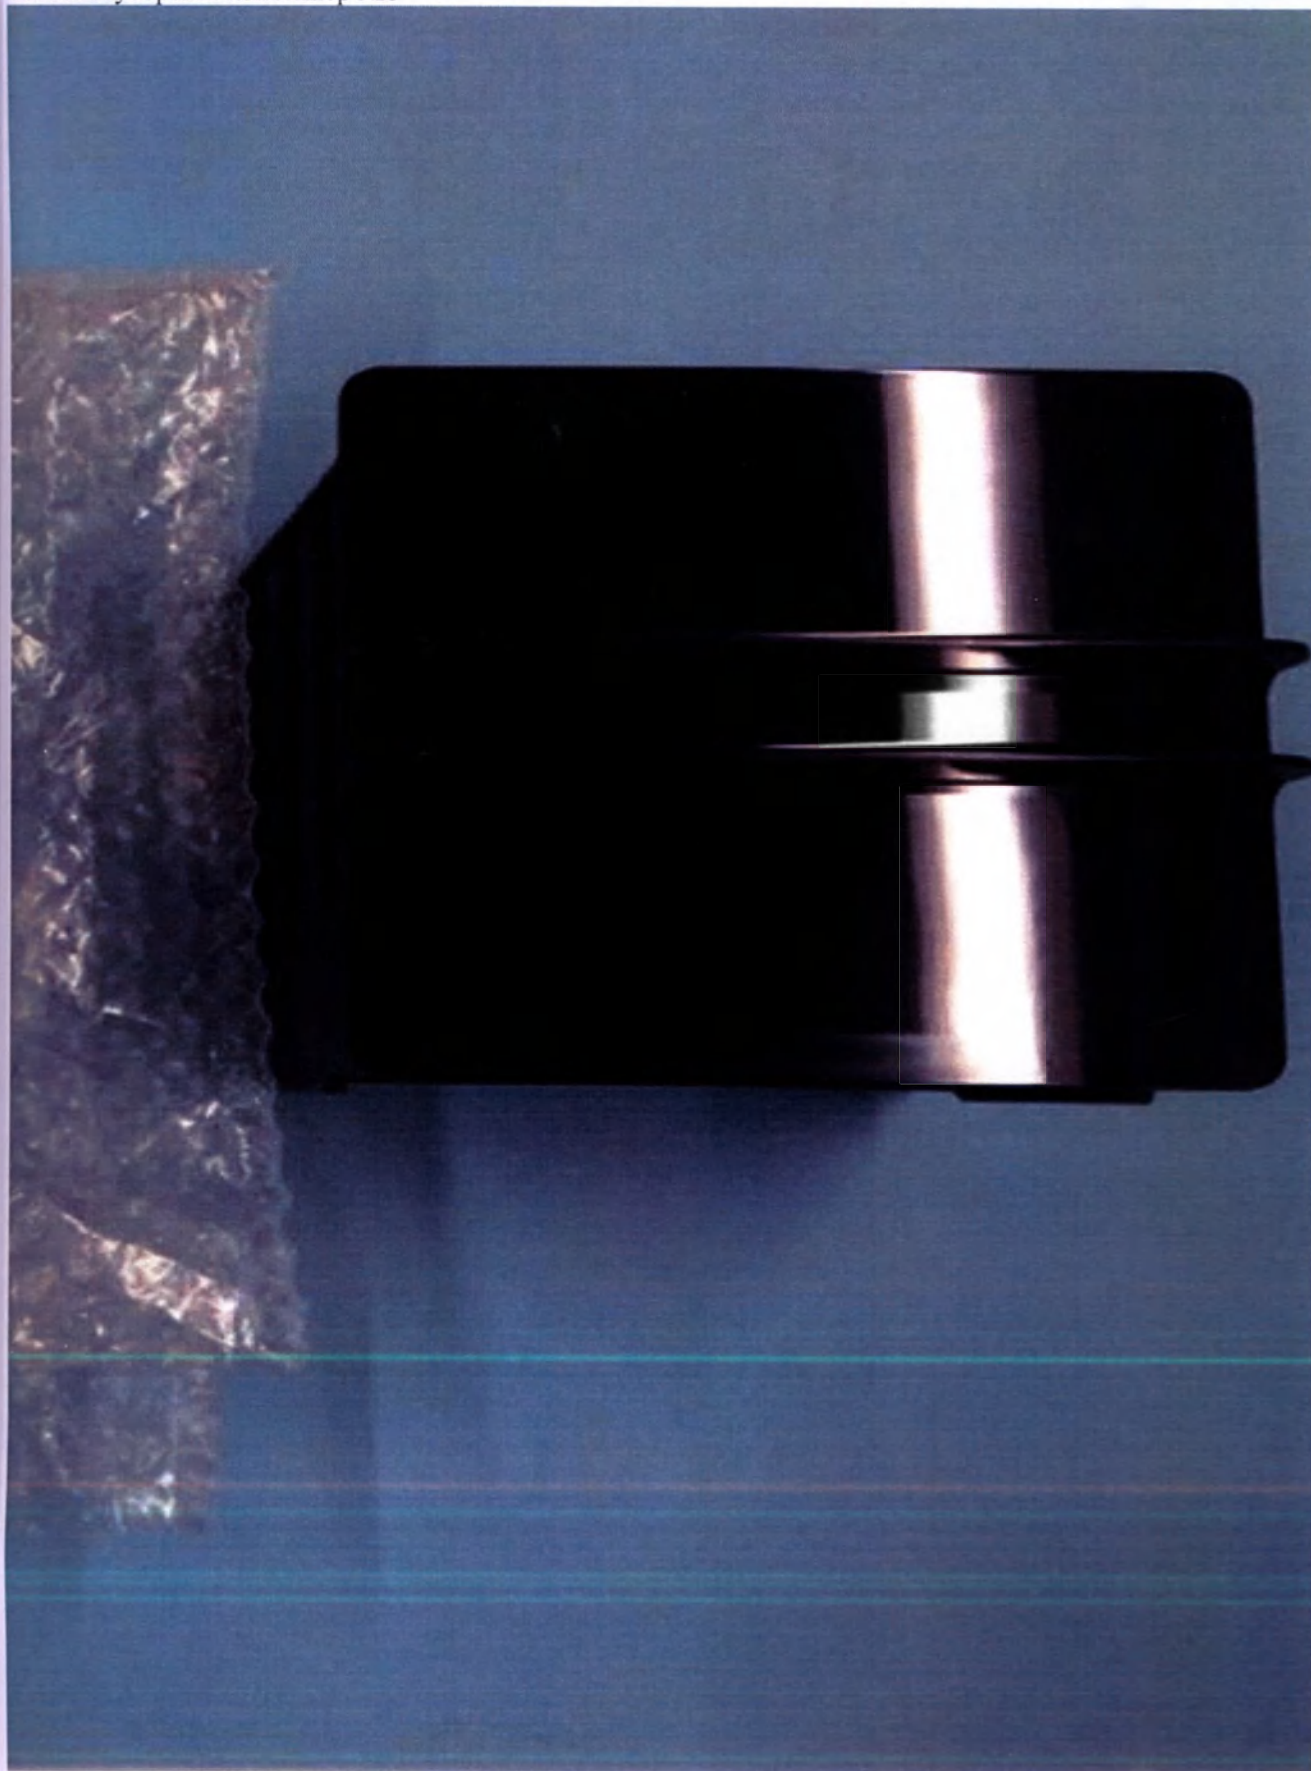


Рис.2.9 Держатель в сборе №258



Рис.2.10 Флакон SLD, 5 мл



Рис.2.11 Чашка для проб, 4 мл



Рис.2.12 Микрочашка SLD

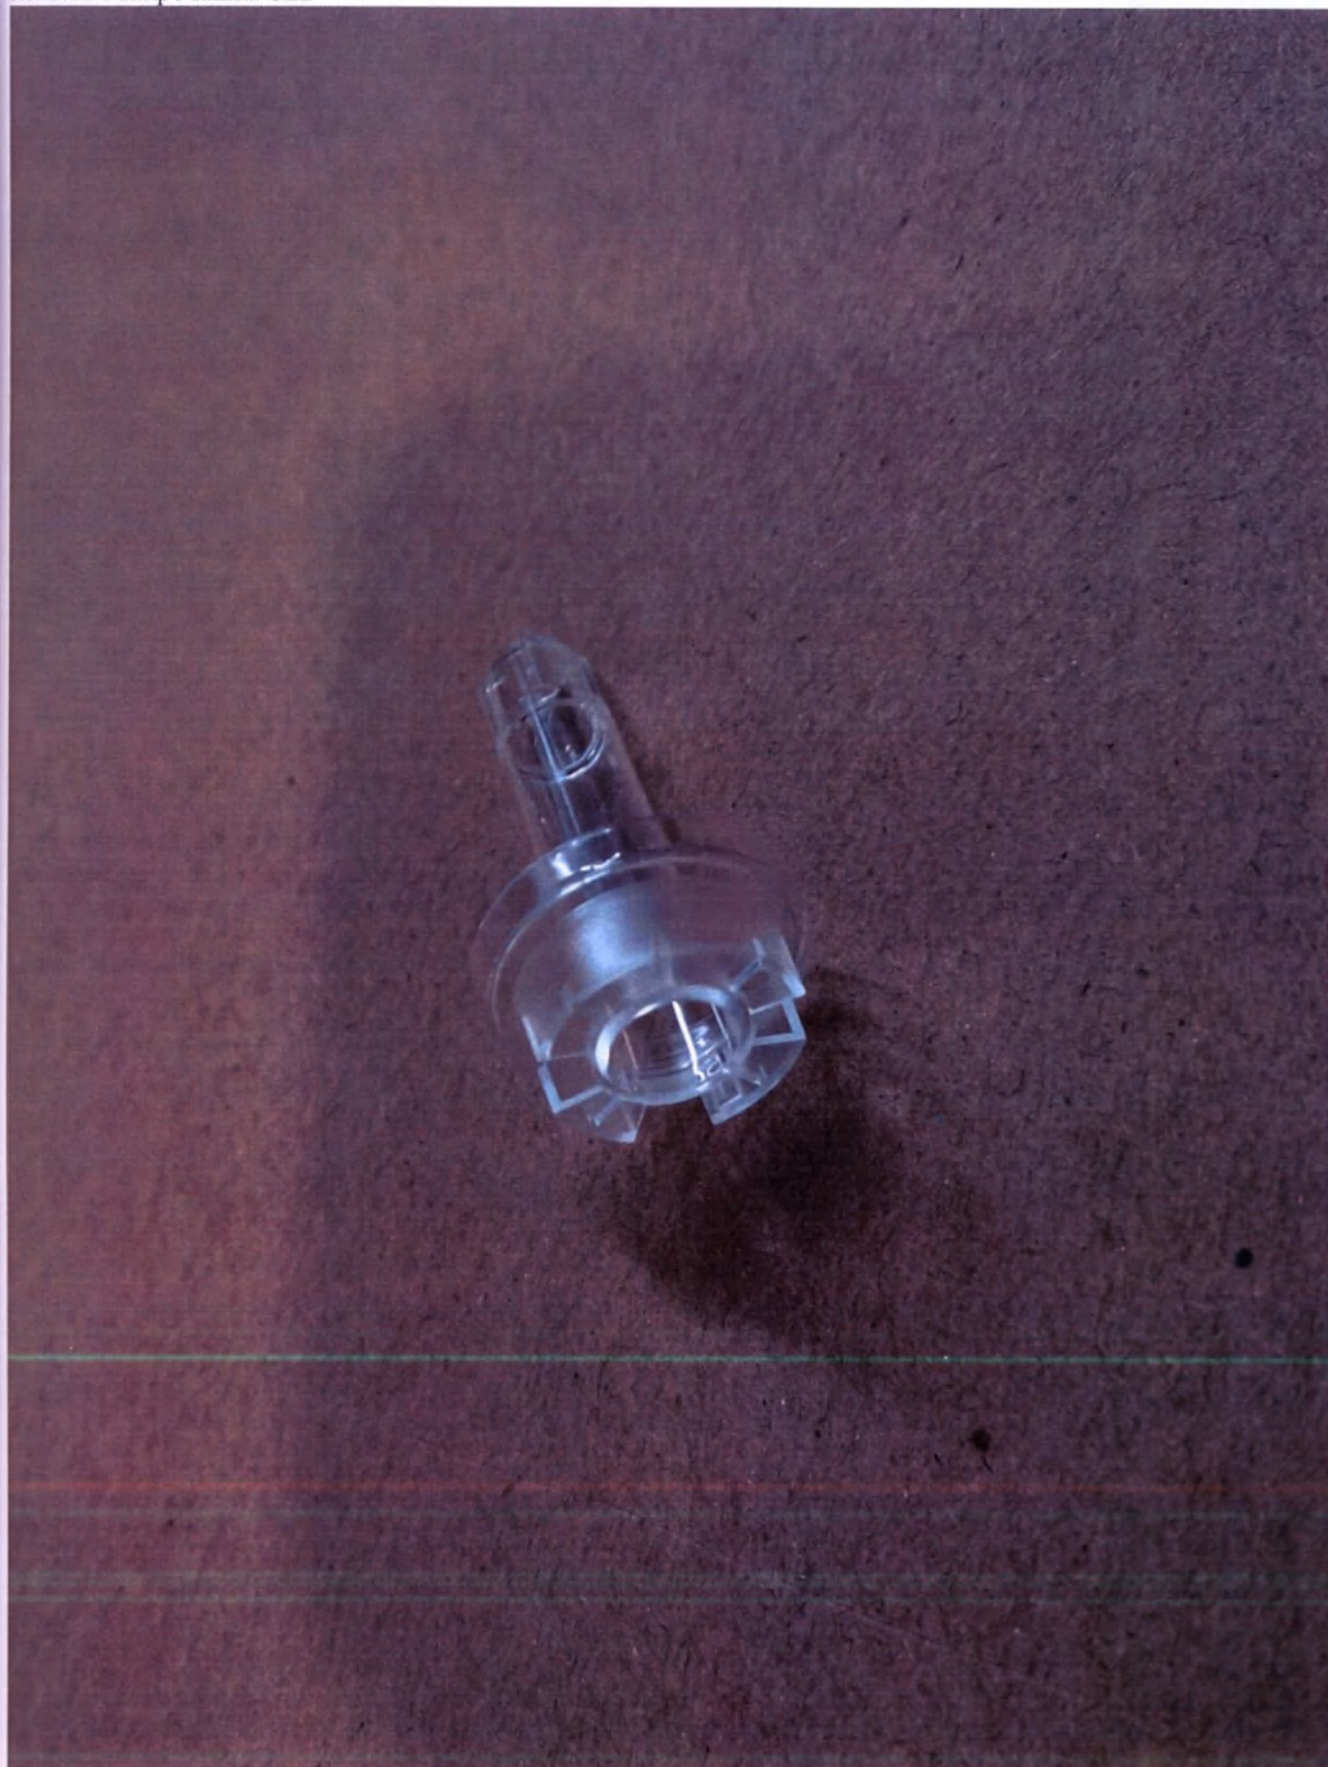


Рис.2.13 Галогеновая лампа JB12V24WF6/SSM

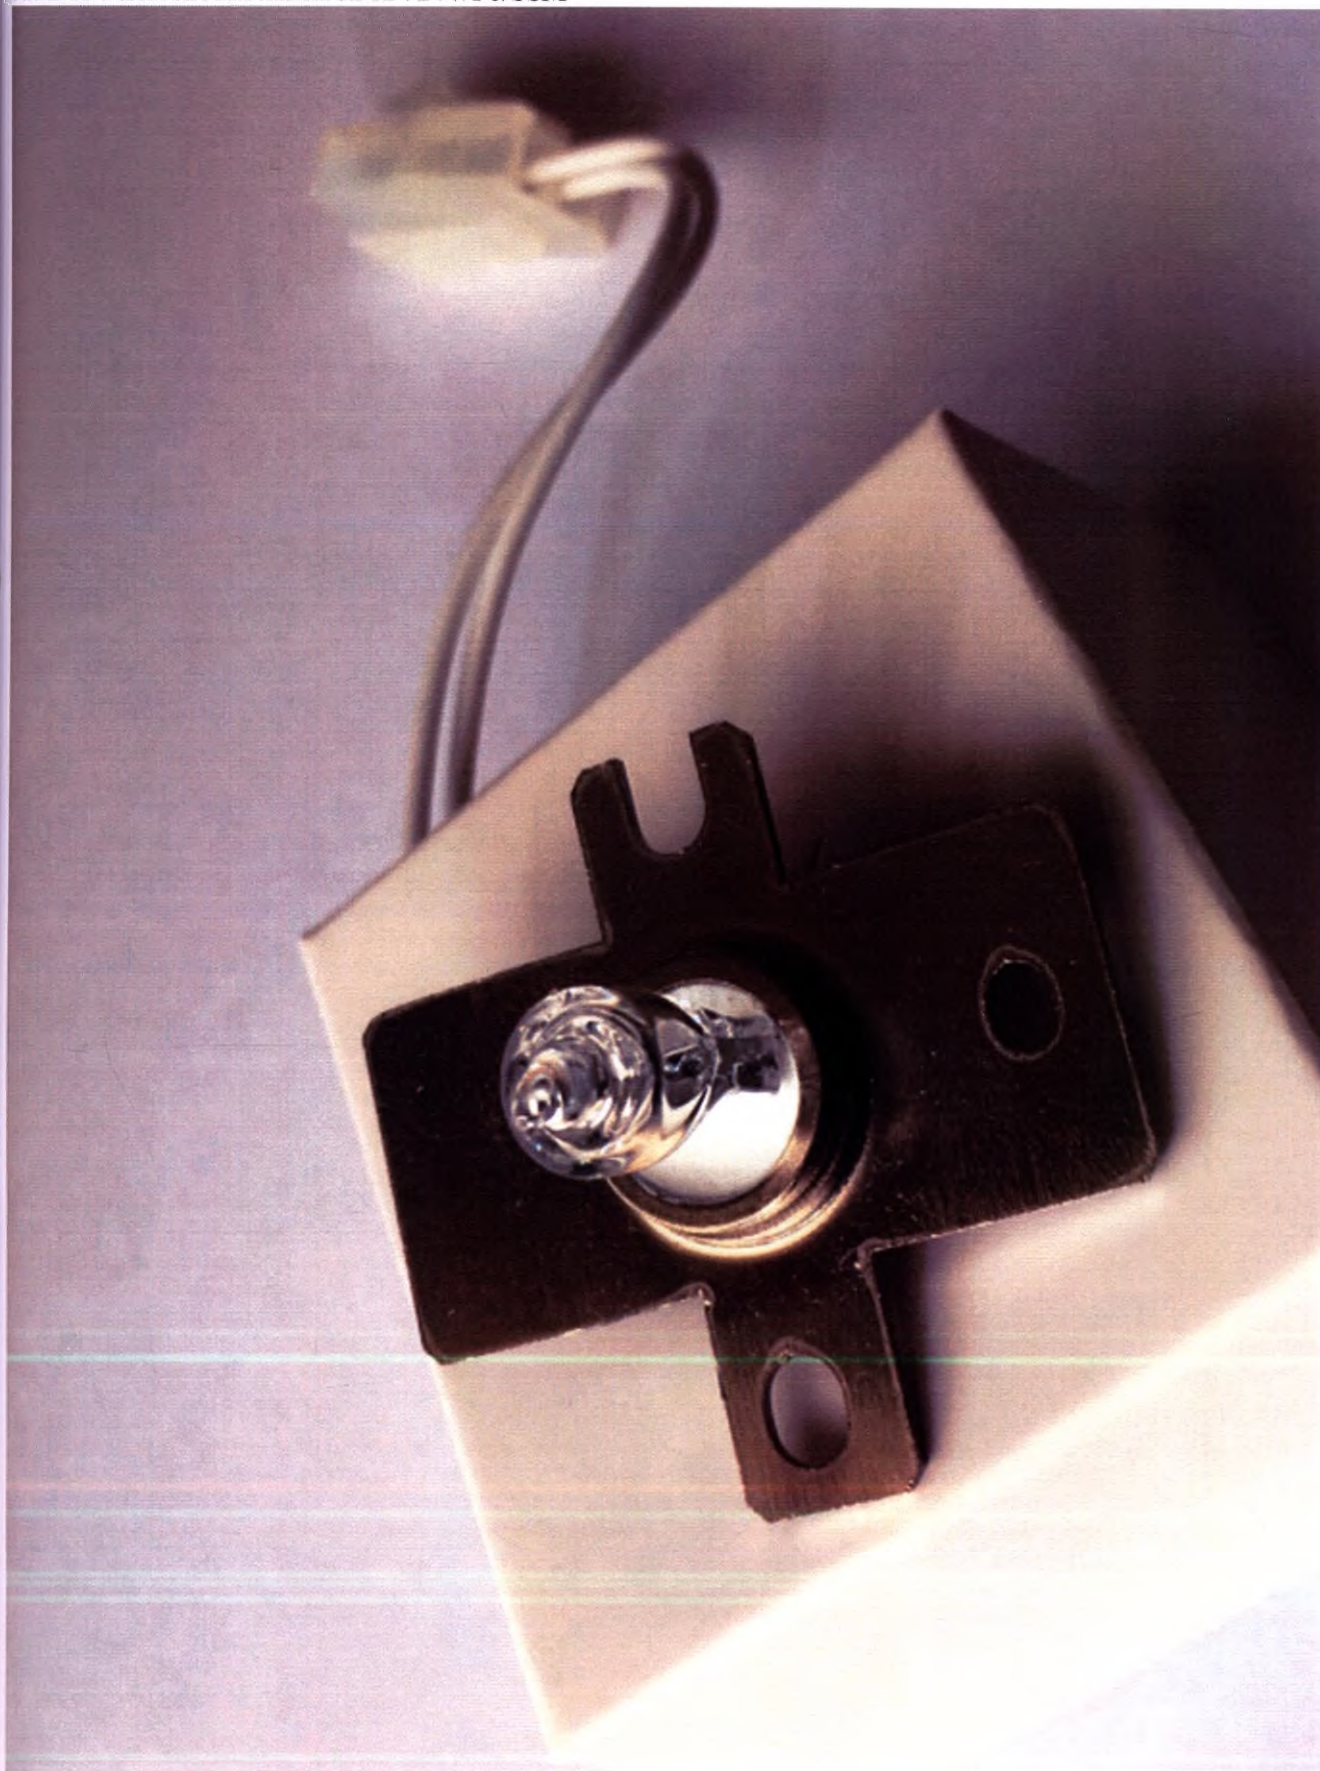


Рис.2.14 Держатель в сборе №255



Рис.2.15 Держатель в сборе №257



Рис.2.16 Предохранитель 50Т100Н

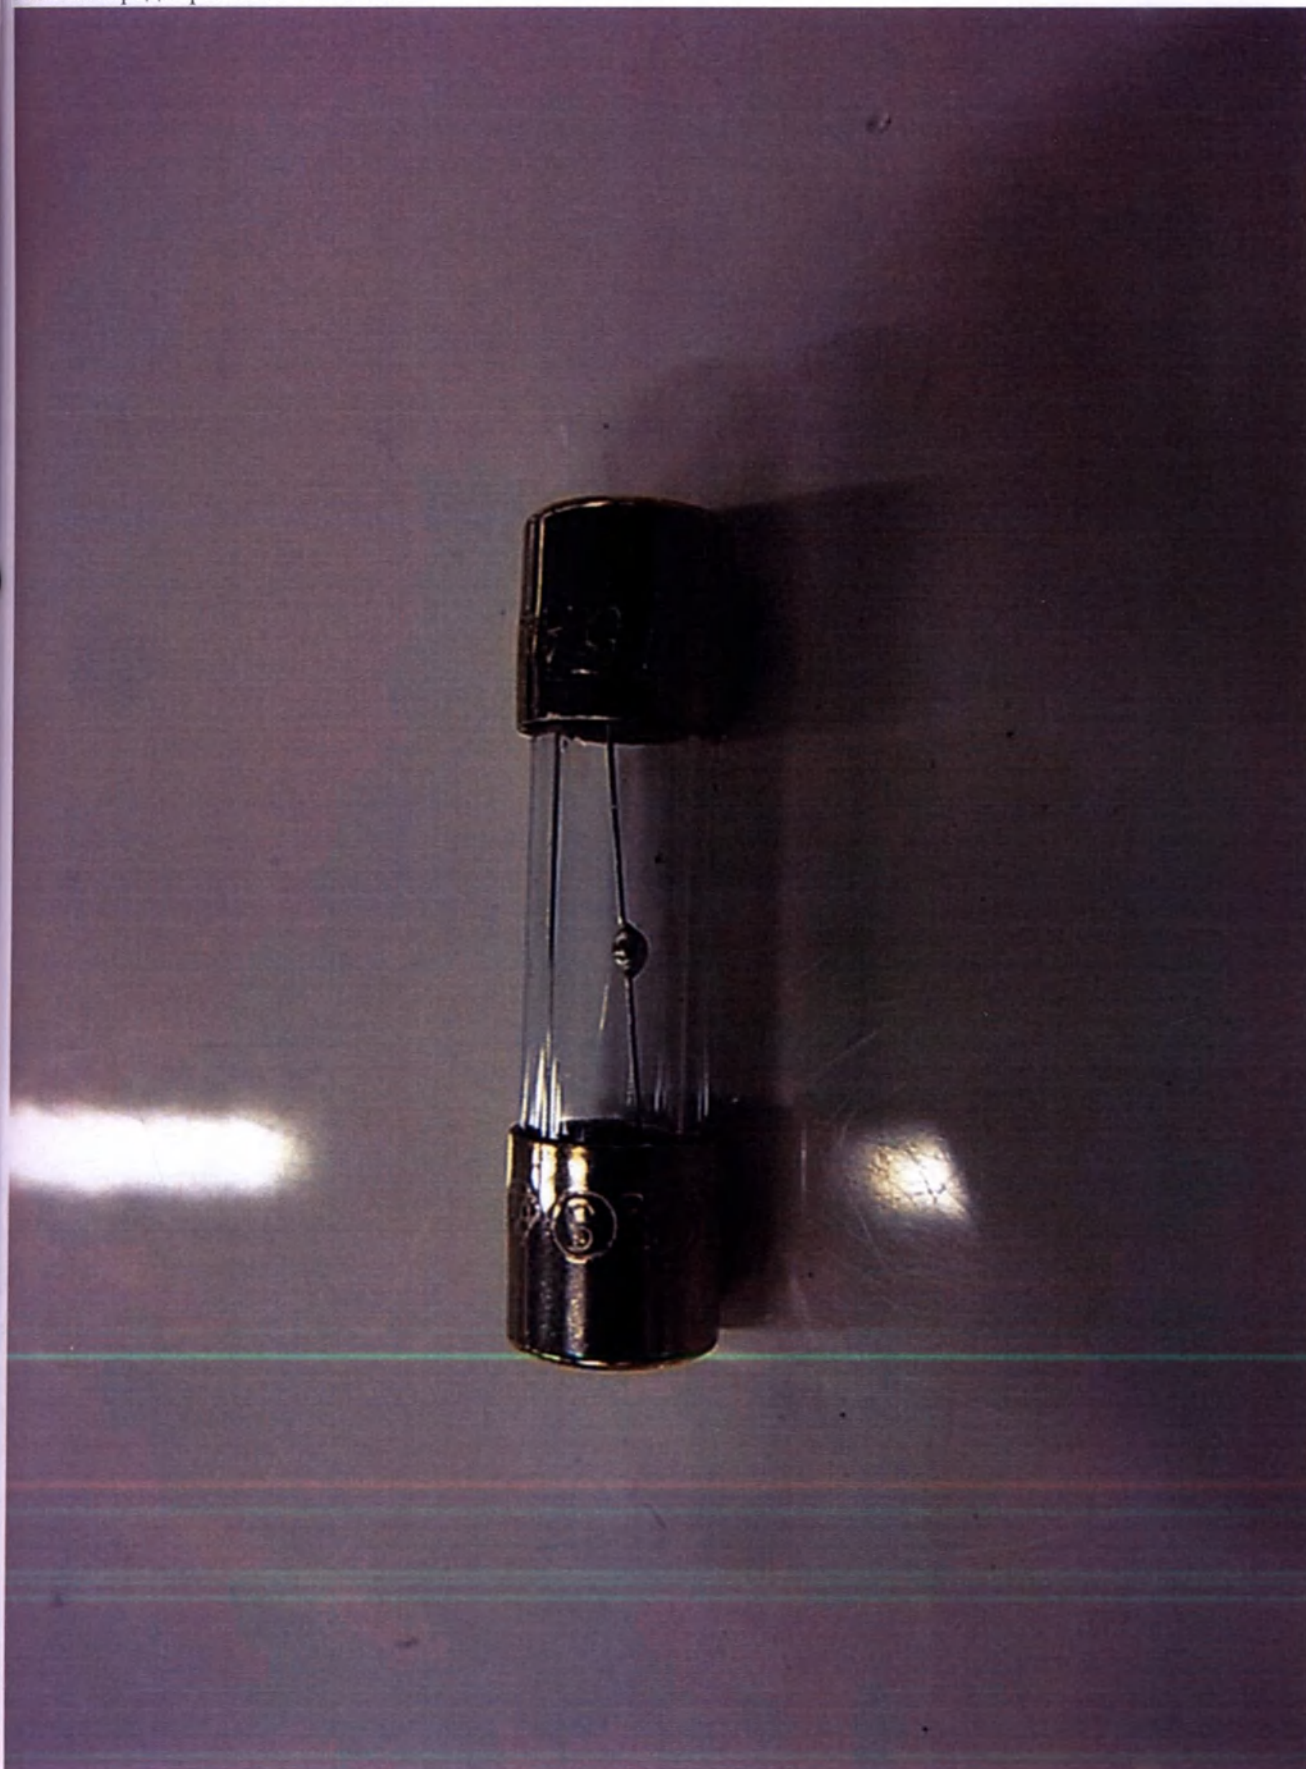


Рис.2.17 Силиконовая трубка 3х6.5, длина 5 м



Рис.2.18 Силиконовая трубка 6х4, длина 20 м



Рис.2.25 Адаптер №336



Рис.2.26 Держатель №89



Рис.2.27 Держатель №204



Рис.2.28 Планшет для проб

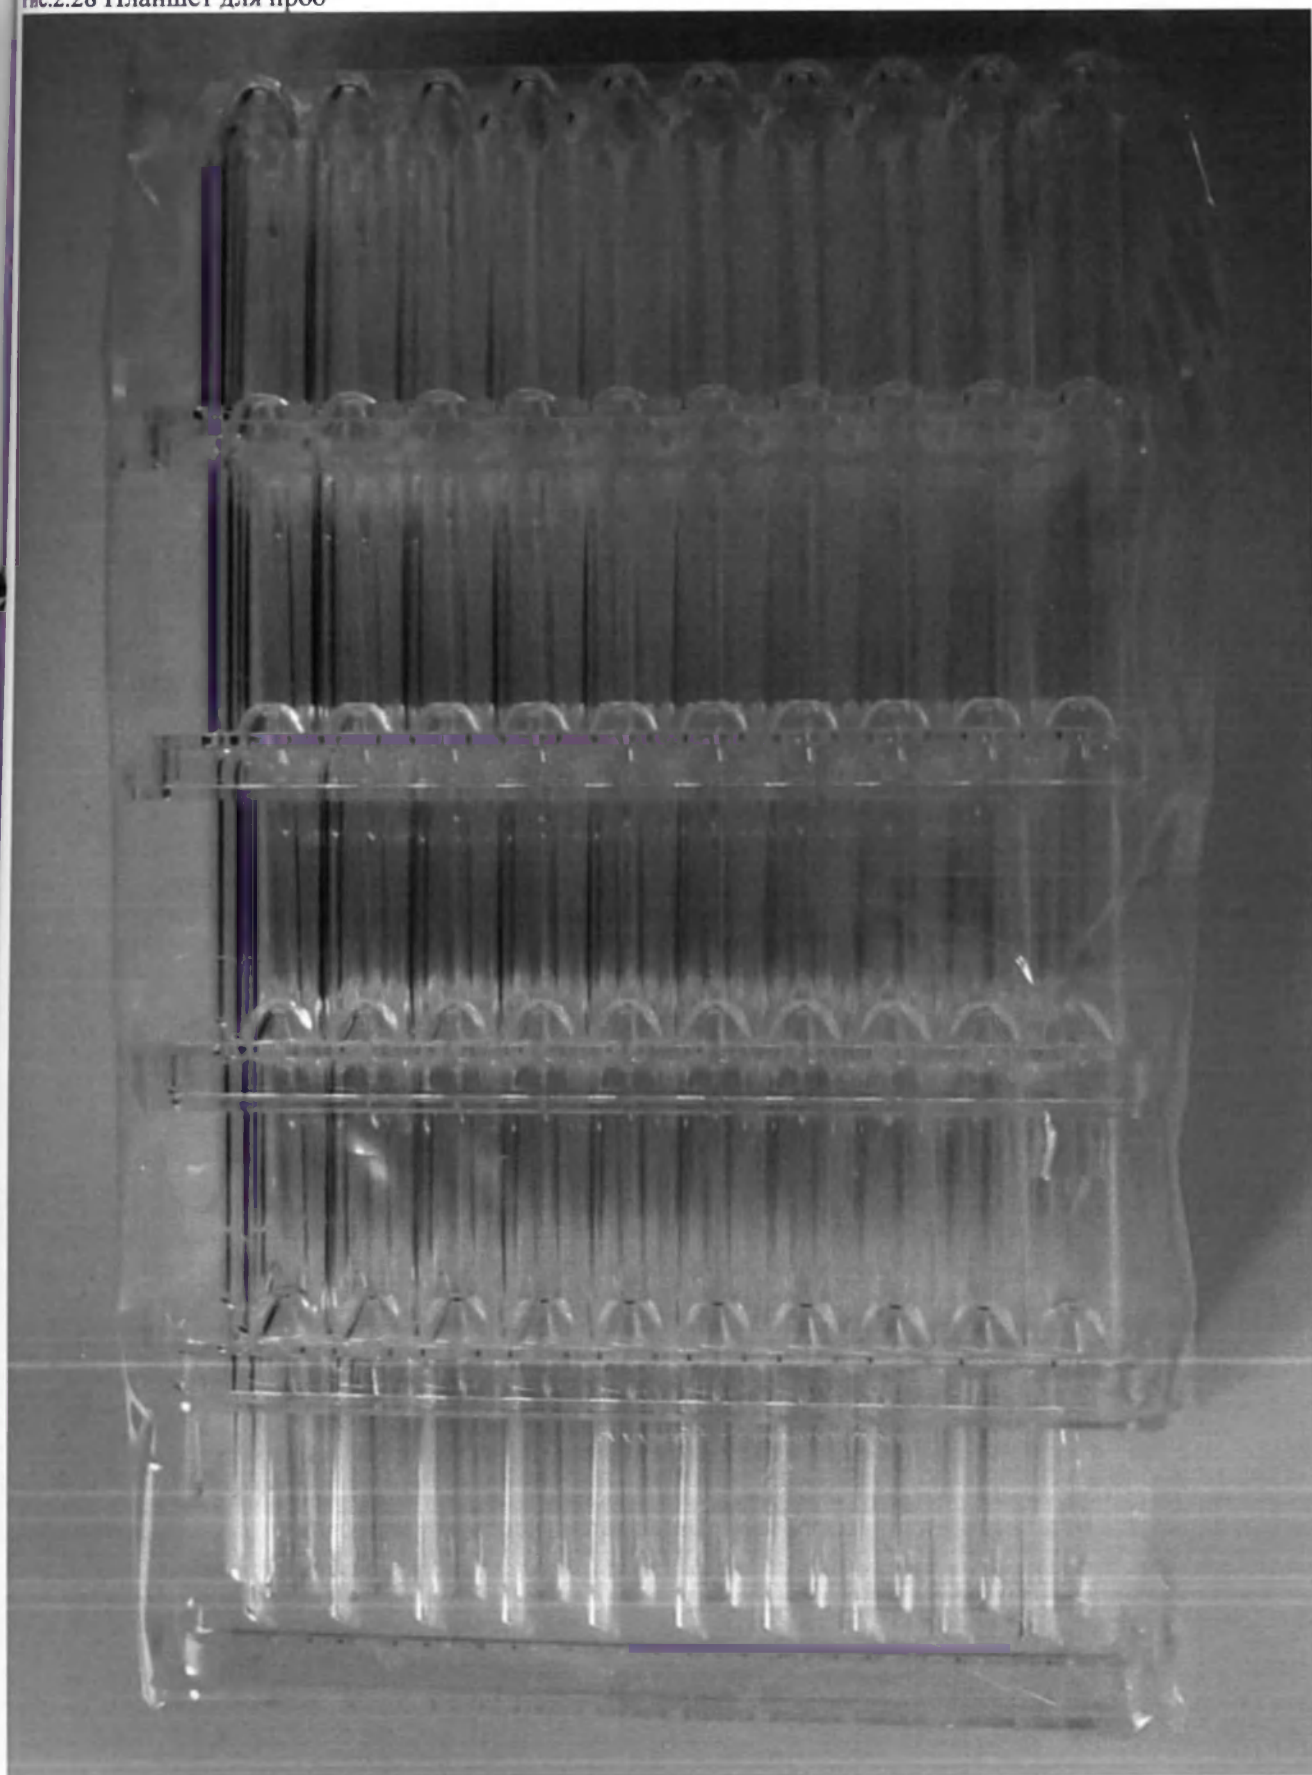


рис.3 Емкость для отходов №110





Рис.5 Держатель сканера штрих-кодов



Рис.6 Кабель соединительный для сканера штрих-кодов



Принадлежности:

Рис.1. Кювета SUC-400A



рис.2. Планшет для проб SAP – 400А

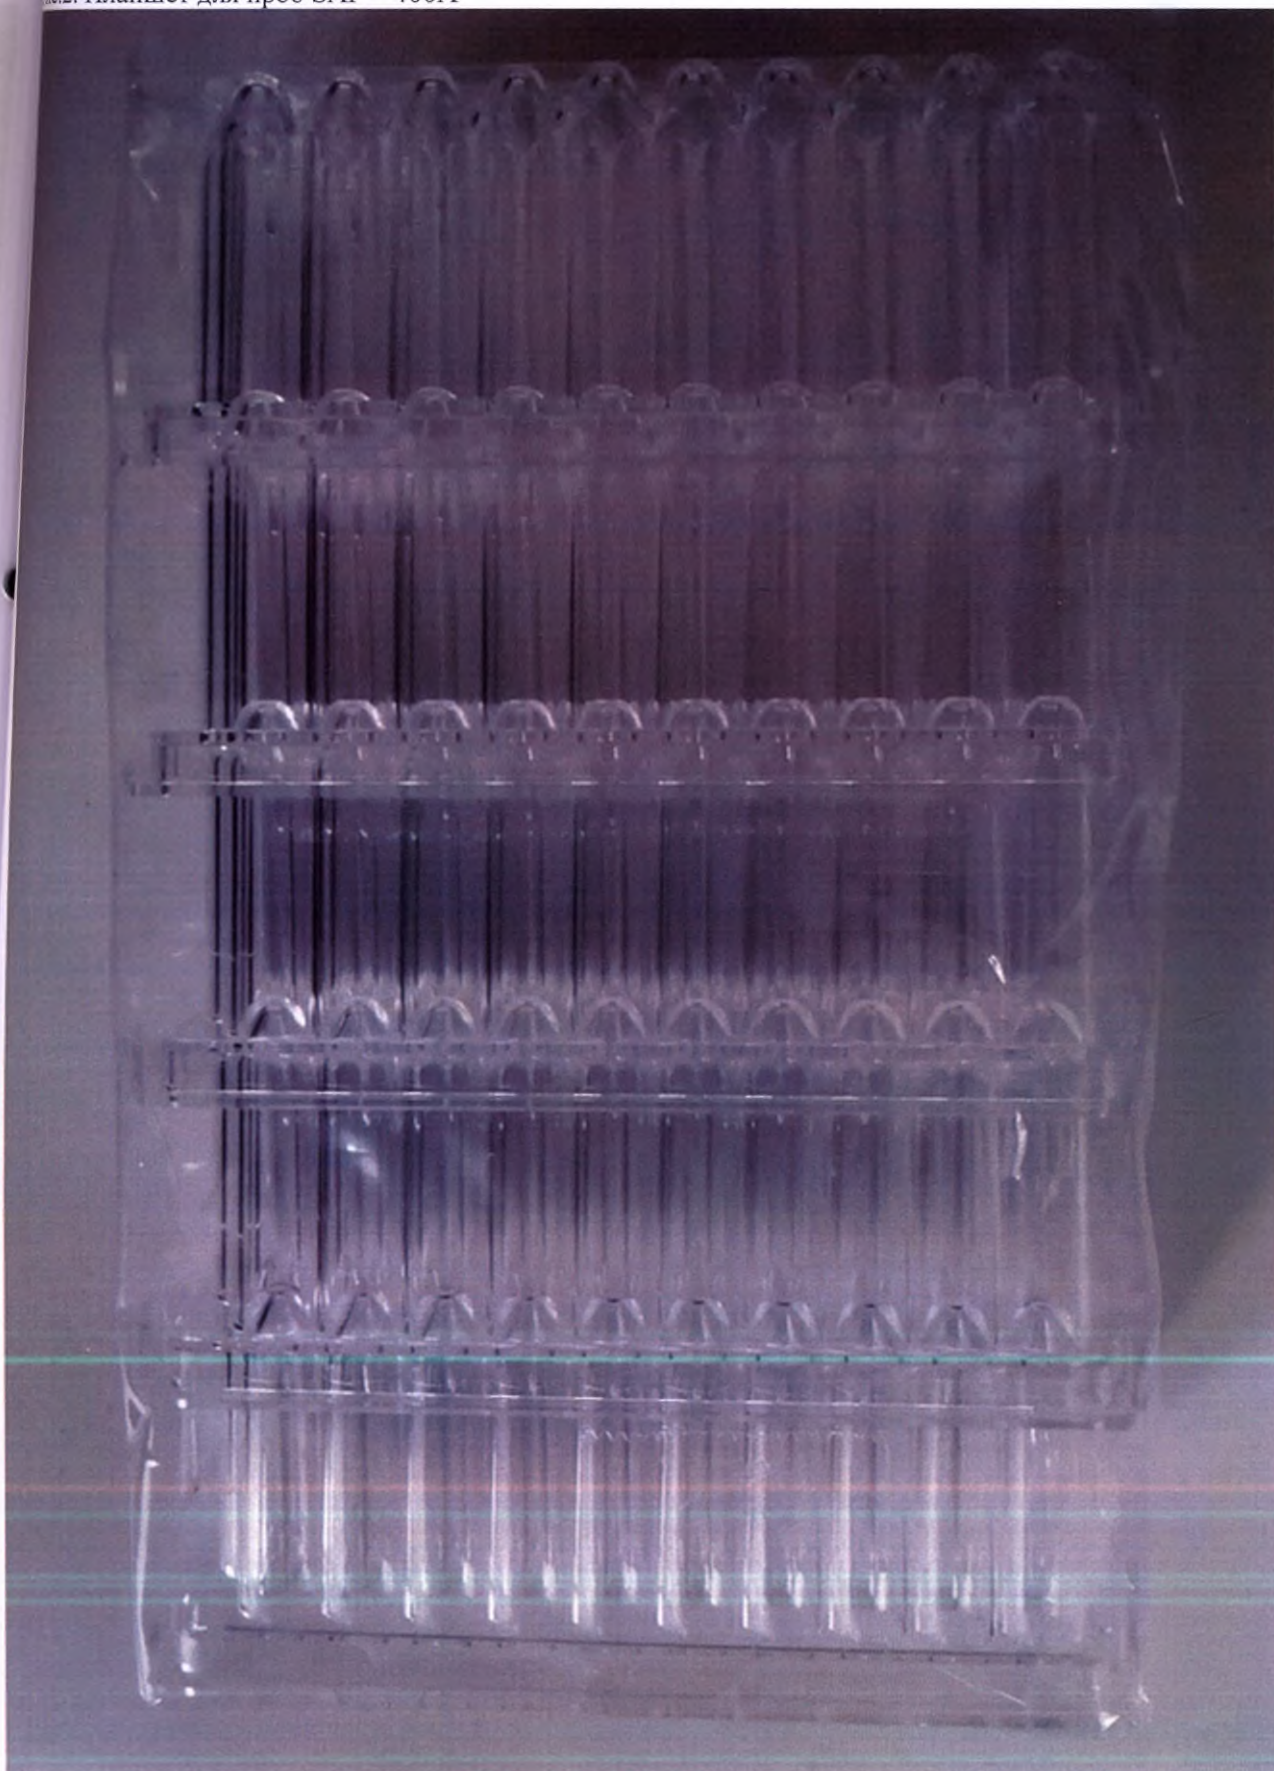


рис.3. Галогеновая лампа JB12V24WF6/SSM



рис.4. Предохранитель 250V-4A-N1



рис.5. Чашка для проб 4 мл



рис.6. Флакон SLD, 5 мл



рис.7. Микрочашка SLD

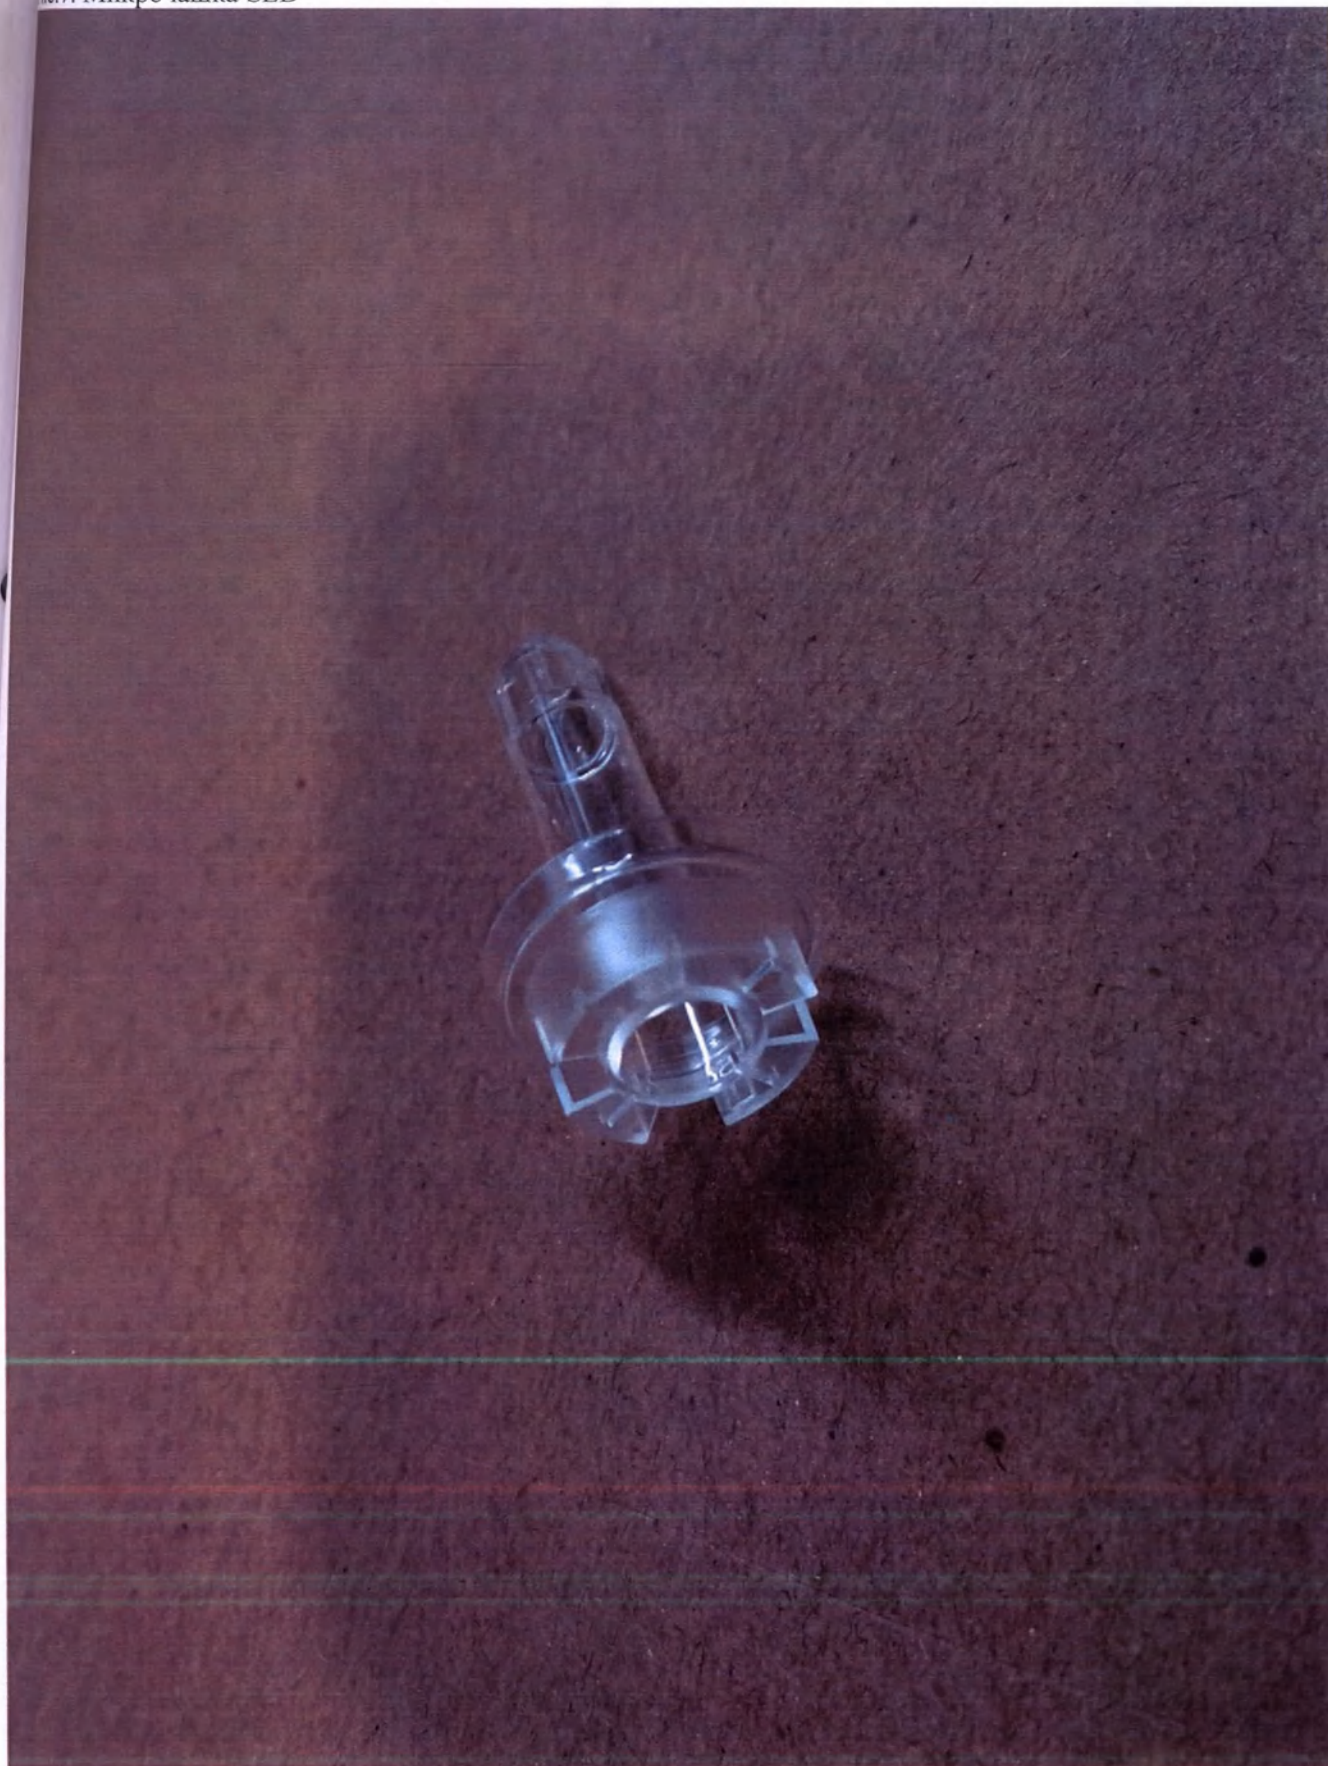


рис.8. Мешок для мусорного контейнера CS1

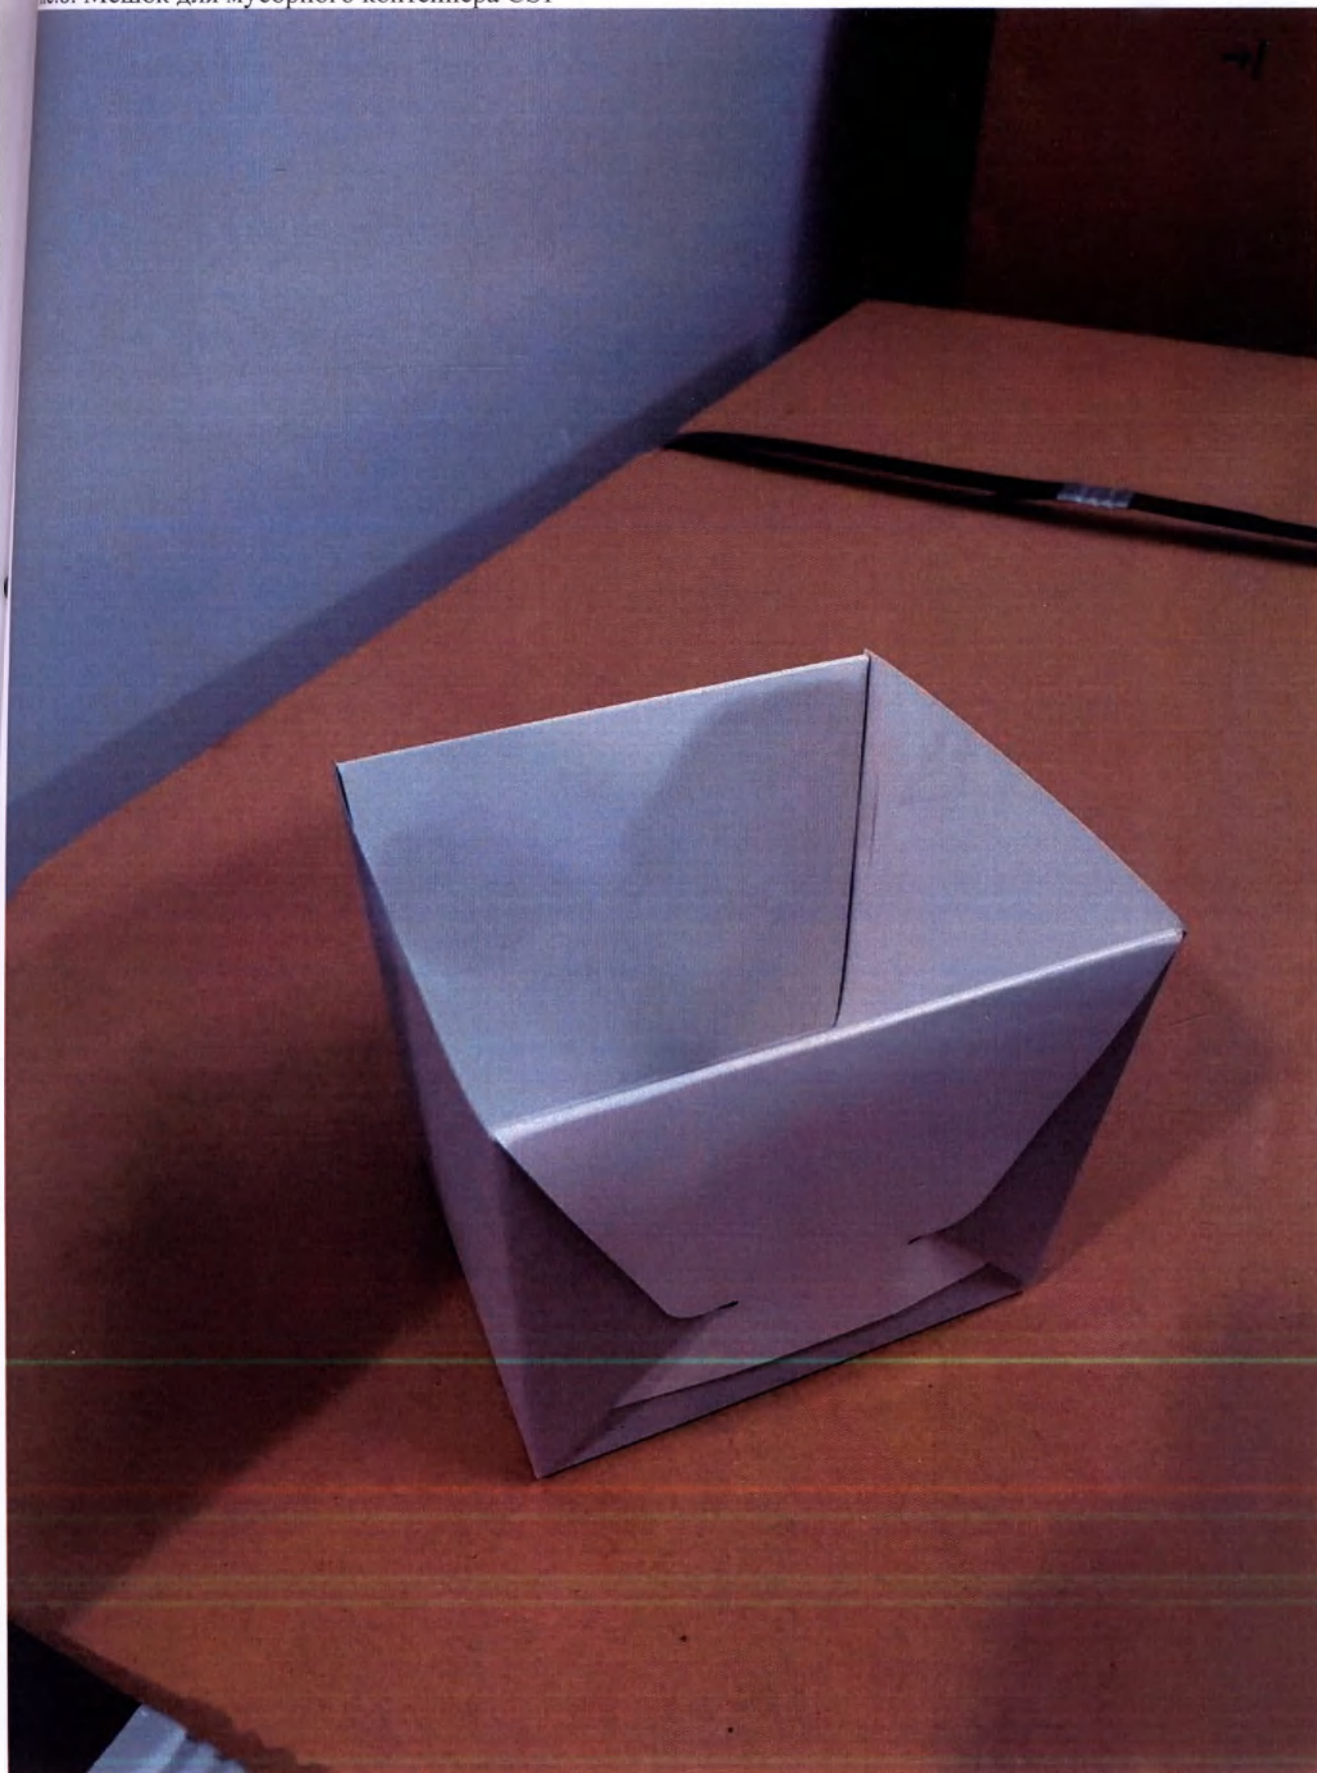


рис.9. Миничашка SLD (SLD-400A)



рис.10. Держатель для пробирок №113, диаметр 11 мм


Japan



рис.11. Держатель для пробирок №58, диаметр 14 мм



рис.12. Держатель для пробирок №59, диаметр 13 мм

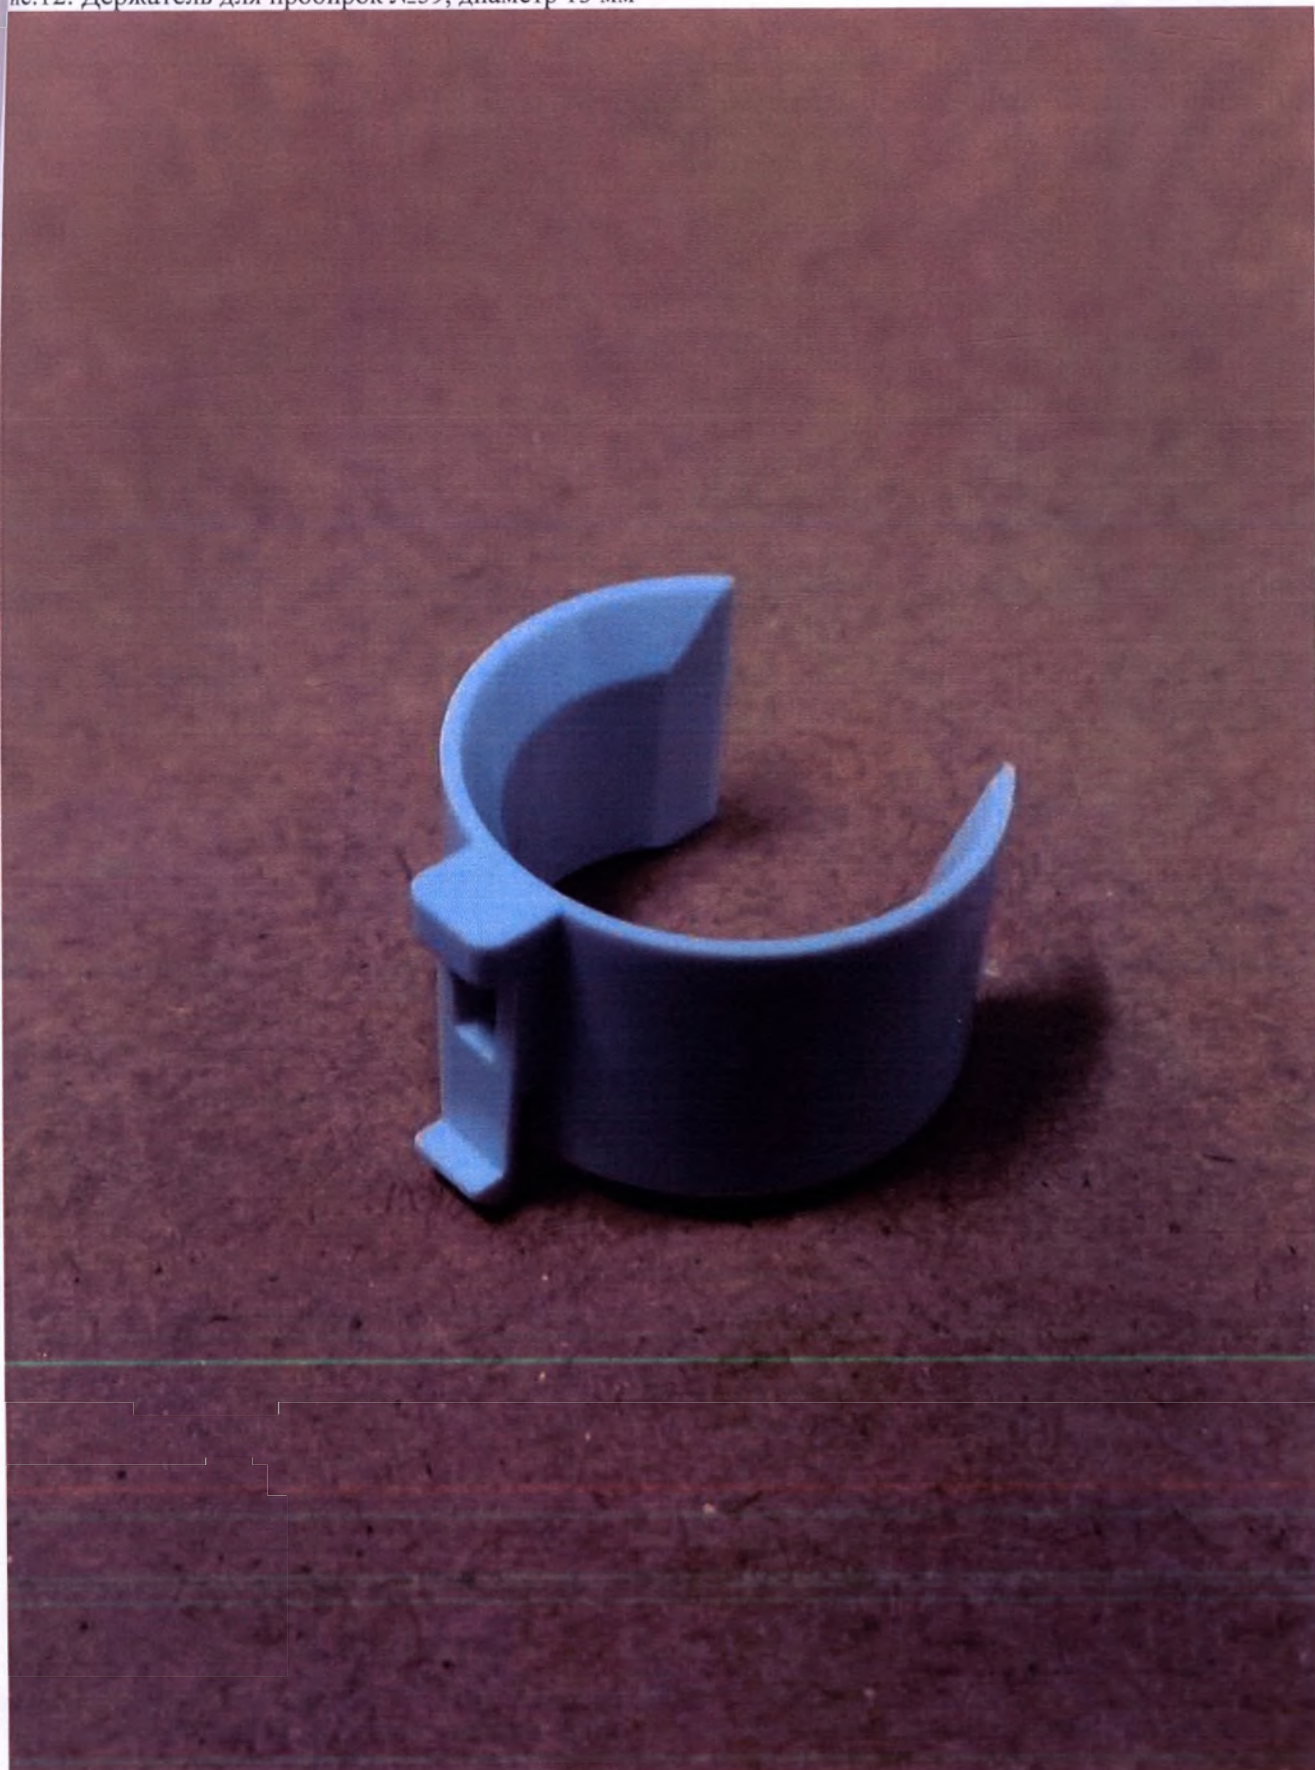

ПРОШИТО
И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
НА 47 ЛИСТАХ



Директор по корпоративным
реферованиям и
управлению «неавтоматическими»
ООО «Система РУС»
Винникова А.О.