

Фотографические изображения

**Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas с,
в различных вариантах исполнения**

2023

Вариант 1 (общий вид):

1. Sample Cleaner 1 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт
2. Инструкция по применению



Вариант 1:

1. Sample Cleaner 1 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт
2. Инструкция по применению

Маркировка картонной упаковки (лицевая сторона)

Sample Cleaner 1

cobas c systems

REF 05352991190

CONTENT
12 x 20 mL

SmpCln1

COBAS and COBAS C are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN

Made in Germany

IVD **CE**  15-25 °C


 

H290, H314, P280, P301+P330+P331,
P303+P361+P353, P304+P340+P310,
P305+P351+P338+P310, P390





 03

 dialog.roche.com  EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336

Маркировка картонной упаковки (боковая сторона)

Sample Cleaner 1

REF (240)05352991190

UDI 

LOT (10)00000000

 2000-01-31

 2000-01-01

GTIN (01)04015630926435

04 

Маркировка картонной упаковки (оборотная сторона)

For USA:

CONTENT
NaOH 1 mol/L

REF 05352991190



Rx Only

02 

Вариант 1:

1. Sample Cleaner 1 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт
2. Инструкция по применению

Маркировка бутылей



Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c, в различных вариантах исполнения:

Вариант 1:

1. Sample Cleaner 1 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт.
2. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4324 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.


E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 05352991190

Вариант 2:

1. Sample Cleaner 2 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт.
2. Инструкция по применению

Маркировка картонной упаковки (лицевая сторона)

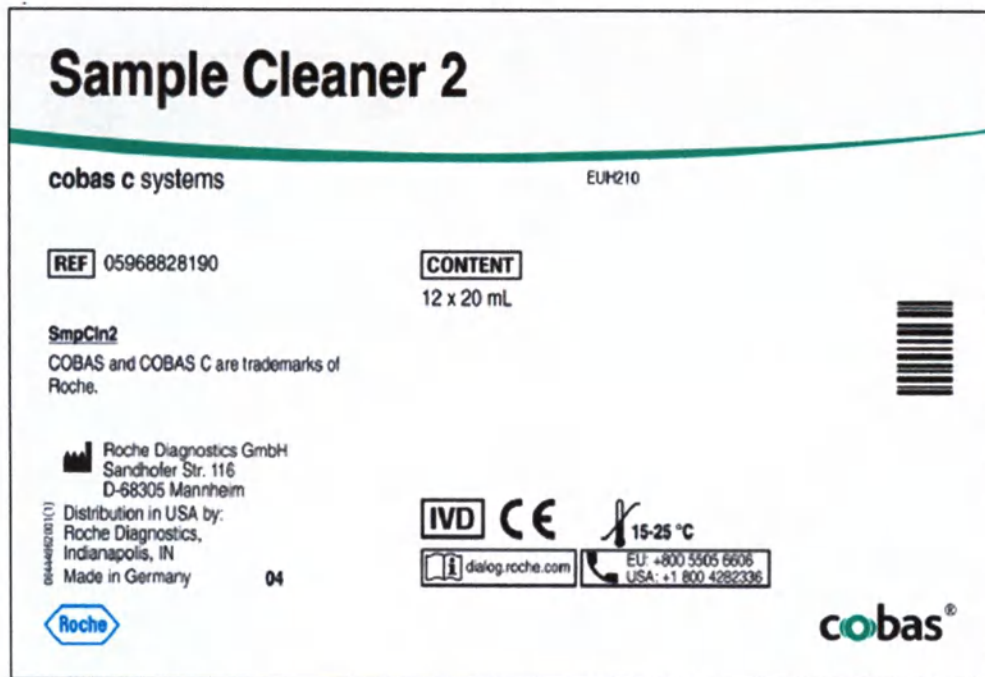


Маркировка картонной упаковки (боковая сторона)



Вариант 2:

1. Sample Cleaner 2 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт.
2. Инструкция по применению

Маркировка картонной упаковки (оборотная сторона)

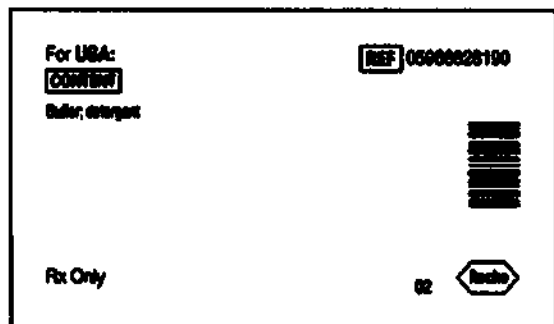

Маркировка бутылей



Вариант 2:

1. Sample Cleaner 2 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт.
2. Инструкция по применению

Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c, в различных вариантах исполнения:

Вариант 2:

1. Sample Cleaner 2 cobas c systems, флакон объемом 20 мл, 12 шт.
2. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4324 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 05968828190

Вариант 3:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 66 мл. (общий вид)



Вариант 3:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 66 мл.

Маркировка кассеты (лицевая и боковая сторона)

NAOHD
NAOHD
C

For USA: **CONTENT**
B+C: NaOH 1 mol/L;
detergent

LOT 00000000
2000-01-31

Detergent 1
cobas c systems
REF 04489241190
System-ID 07 6871 5
CONTENT 66 mL
15-25 °C **IVD**
 dialog.roche.com **CE**
COBAS C and COBAS
are trademarks of Roche.

H290, H314, P280,
P301+P330+P331,
P303+P361+P353,
P304+P340+P310,
P305+P351+P338+P310, P390



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

Made in Germany

cobas 09

Маркировка кассеты (штрих-код)



Ser.No. 00001 **NAOHD** 04489241 190 08

Маркировка кассеты (оборотная сторона)

NAOHD
REF (240)04489241190
For USA: Rx only

 2000-01-31
 2000-01-01

UDI



 For USA: Store upright

 EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336



LOT (10)00000000
GTIN (01)04015630920822

10

Вариант 3:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 66 мл.

Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c, в различных вариантах исполнения:

Вариант 3:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 66 мл

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4324 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 04489241190

Вариант 4:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 102 мл. (общий вид)

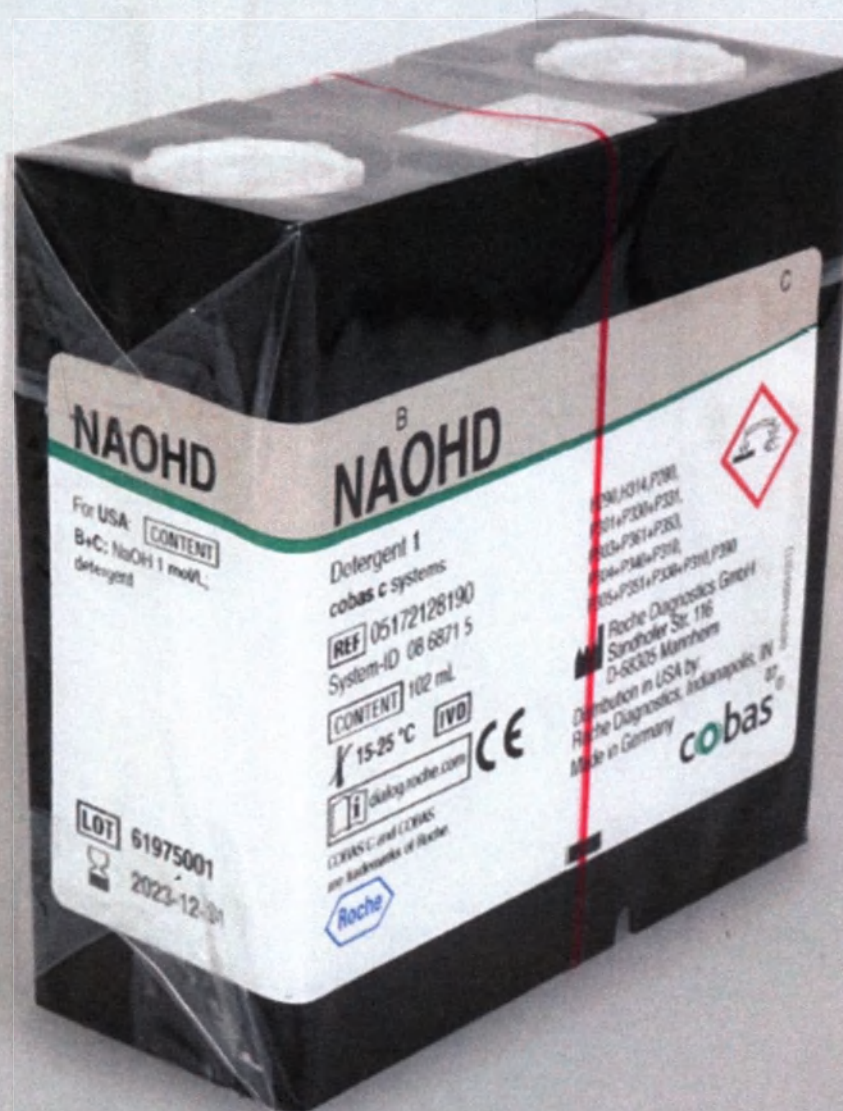

Вариант 4:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 102 мл.

Маркировка кассеты (лицевая и боковая сторона)

NAOHD		B	NAOHD	C
For USA: CONTENT B+C: NaOH 1 mol/L; detergent	Detergent 1 cobas c systems REF 05172128190 System-ID 08 6871 5 CONTENT 102 mL 15-25 °C IVD  dialog.roche.com COBAS C and COBAS are trademarks of Roche.		H290,H314,P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340+P310, P305+P351+P338+P310,P390  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Str. 116 D-68305 Mannheim Distribution in USA by: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN Made in Germany	 00731446/001 (01) 07
LOT 00000000  2000-01-31	 			

Маркировка кассеты (штрих-код)



Маркировка кассеты (оборотная сторона)

NAOHD	REF (240)05172128190	For USA: Rx only
	LOT (10)00000000  2000-01-31  2000-01-01	
 For USA: Store upright	UDI 	
 EU: +800 5505 6606 USA: +1 800 4282336	GTIN (01)04015630825230	
		06

Вариант 4:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 102 мл.

Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c, в различных вариантах исполнения:

Вариант 4:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 102 мл.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4324 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 05172128190

Вариант 5:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 123 мл. (общий вид)



Вариант 5:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 123 мл.

Маркировка кассеты (лицевая и боковая сторона)

NAOHD
B
NAOHD
C

For USA: **CONTENT**
B+C: NaOH 1 mol/L;
detergent

LOT 00000000
 2000-01-31

Detergent 1
cobas c systems
REF 08063451190
System-ID 29 0200 1
CONTENT 123 mL
 15-25 °C **IVD**
dialog.roche.com **CE**
COBAS C and COBAS
are trademarks of Roche.

H290,H314,P280,
P301+P330+P331,
P303+P361+P353,
P304+P340+P310,
P305+P351+P338+P310,P390

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

0678144001 (01)
03

Маркировка кассеты (штрих-код)



Маркировка кассеты (оборотная сторона)

NAOHD **REF** (240)08063451190

LOT (10)00000000
 2000-01-31
 2000-01-01

UDI

GTIN (01)07613336122761

For USA: Rx only

For USA: Store upright

EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336

For USA: Rx only

03

Вариант 5:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 123 мл.

Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c, в различных вариантах исполнения:

Вариант 5:

1. NAOHD Detergent 1 cobas c systems, кассета объемом 123 мл.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4324 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 08063451190

Вариант 6:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 50 мл. (общий вид)



Вариант 6:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 50 мл.

Маркировка кассеты (лицевая и боковая сторона)

SMS

For USA: **CONTENT**
B+C: HCl 200 mmol/L

LOT 00000000
2000-01-31

B

SMS

Detergent 2
cobas c systems

REF 04489225190
System-ID 07 6872 3

CONTENT 50 mL

15-25 °C **IVD**

 dialog.roche.com

COBAS C and COBAS
are trademarks of Roche.



C

H290, P234, P390



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

Made in Germany

cobas

0678144/001 (01)

Маркировка кассеты (штрих-код)



Ser.No. 00001

SMS

04489225 190

05

Маркировка кассеты (оборотная сторона)

SMS

REF (240)04489225190

2000-01-31

2000-01-01

UDI



LOT (10)00000000

GTIN (01)04015630920815



For USA: Rx only

For USA: Store upright



08

Вариант 6:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 50 мл.

Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c, в различных вариантах исполнения

Вариант 6:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 50 мл.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4324 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 04489225190

Вариант 7:


1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 119 мл. (общий вид)

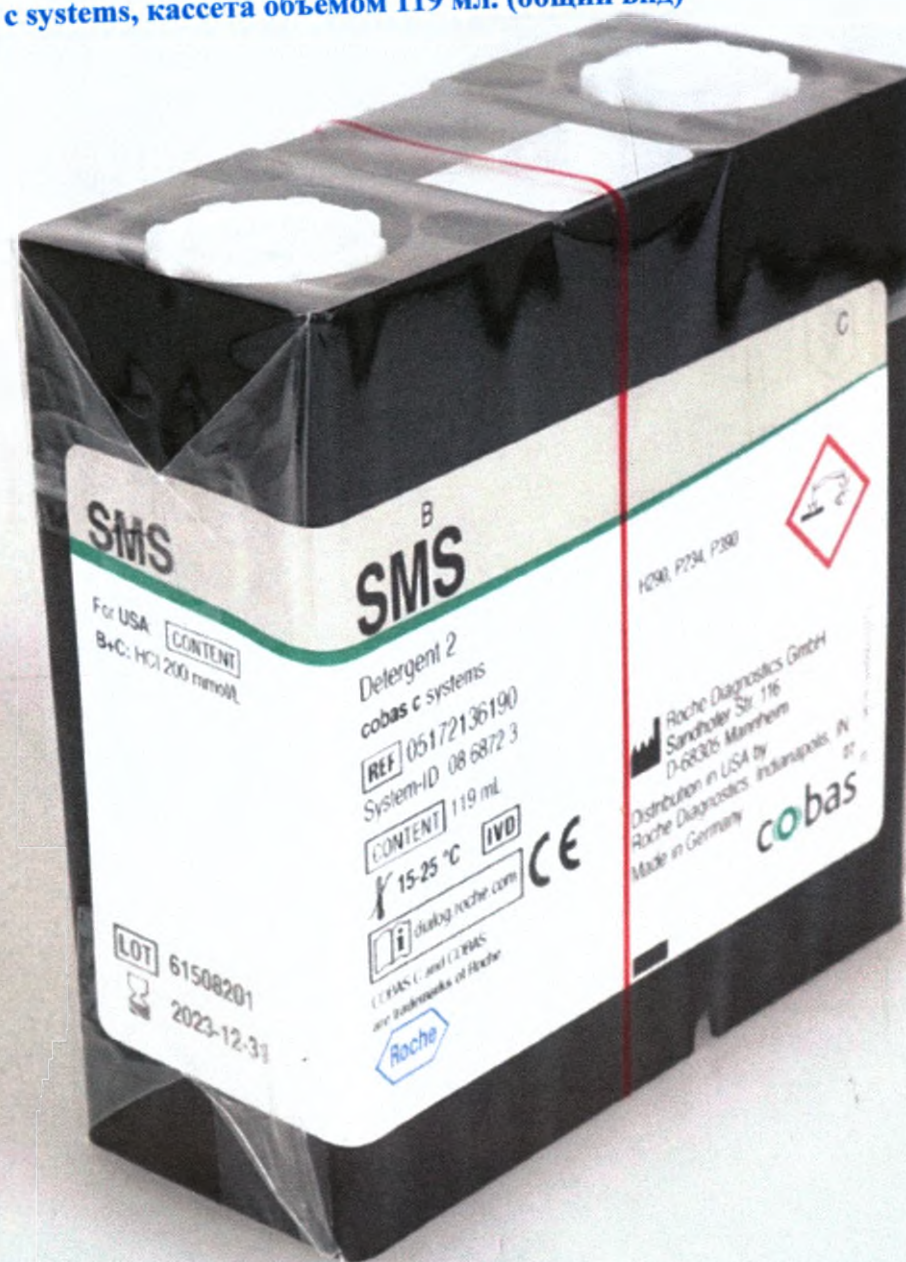

Вариант 7:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 119 мл.


Маркировка кассеты (лицевая и боковая сторона)

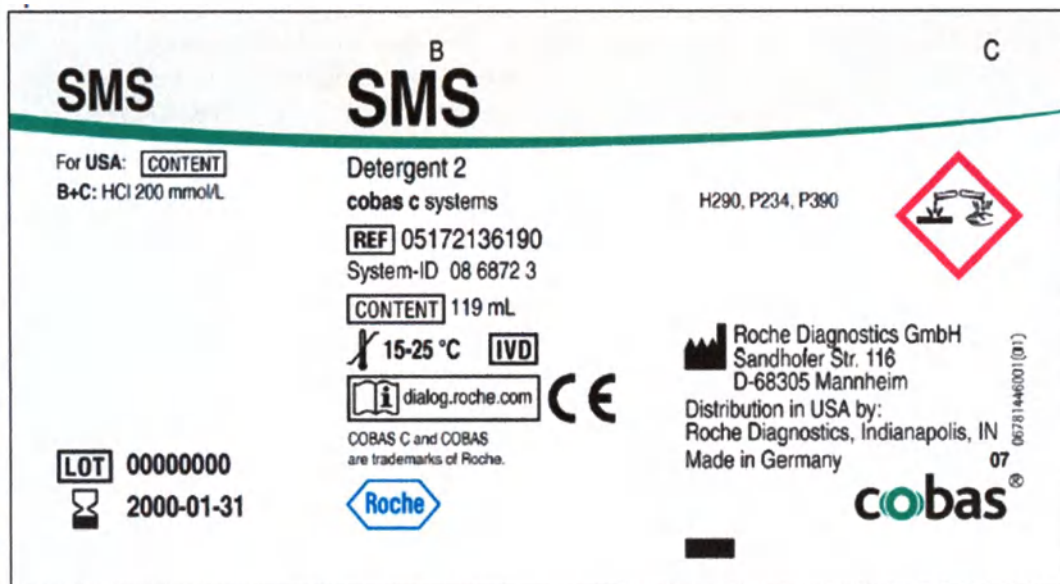

Маркировка кассеты (штрих-код)



Маркировка кассеты (оборотная сторона)

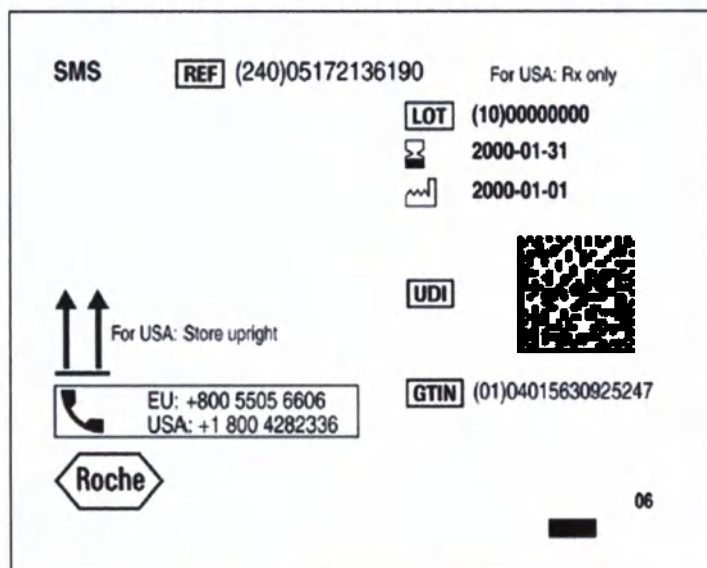

Вариант 7:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 119 мл.

Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c, в различных вариантах исполнения

Вариант 7:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 119 мл.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4324 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 05172136190

Вариант 8:


1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 123 мл. (общий вид)



Вариант 8:

1. SMS Detergent 2 cobas c systems, кассета объемом 123 мл.


Маркировка кассеты (лицевая и боковая сторона)

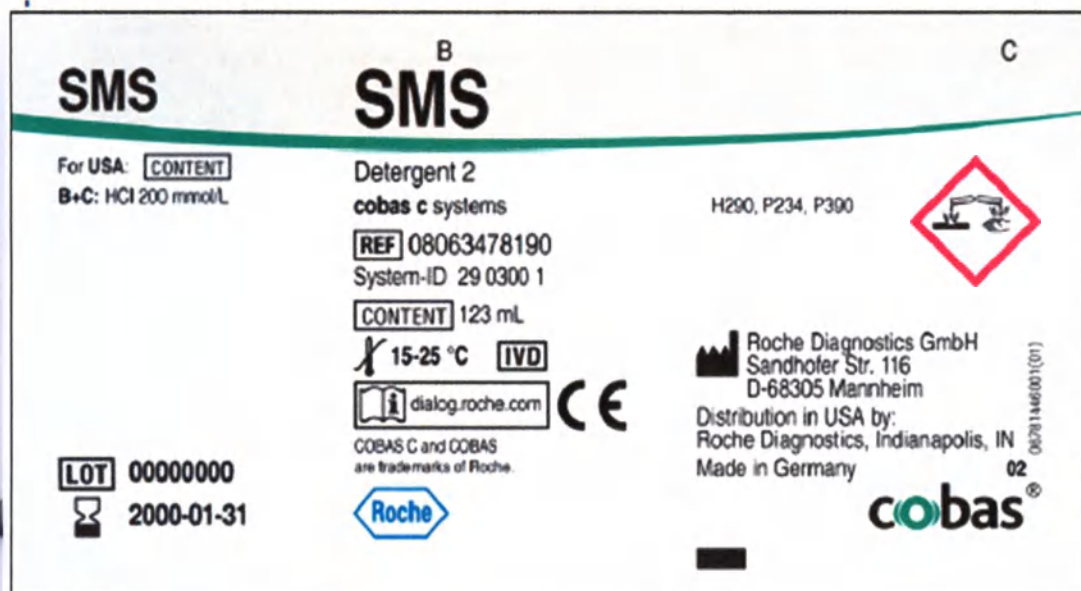

Маркировка кассеты (штрих-код)



Маркировка кассеты (оборотная сторона)

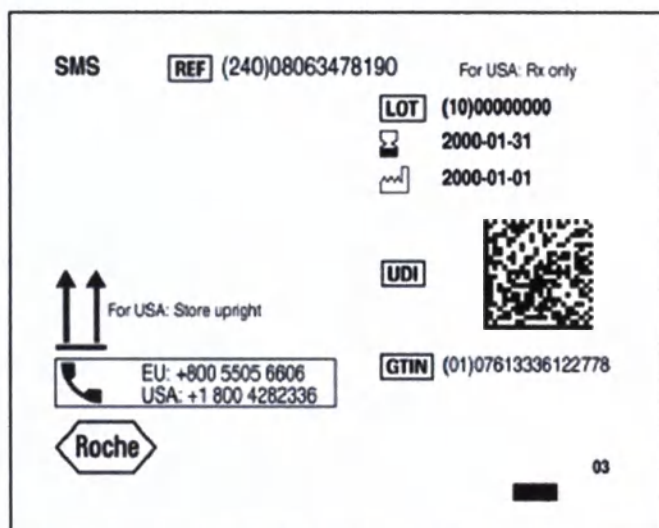

Вариант 8:

1. SMS Detergent 2 cobas с systems, кассета объемом 123 мл.

Макет маркировки на русском языке

Промывочные растворы для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas с, в различных вариантах исполнения

Вариант 8:

1. SMS Detergent 2 cobas с systems, кассета объемом 123 мл.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 08063478190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
25 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.