


Medtronic**ООО «Медтроник»**

Вн. тер. г., м.о. Пресненский
Пресненская наб., д.10
Башня С
9 эт., пом. III, ком.41
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медтроник»
Плясунова Е.В.



«26» февраля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника, варианты исполнения

CD HORIZON, CD HORIZON 4.75, CD HORIZON 5.5/6.0, CD HORIZON 4.75 CANNULATED, CD HORIZON 5.5/6.0 CANNULATED, CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0, CD HORIZON SOLERA 4.75 FENESTRATED, CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 FENESTRATED, CD HORIZON 5.5/6.0 FENESTRATED, INFINITY, UCSS, VERTEX, VERTEX SELECT MULTI-AXIAL

производства Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк. (Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.), США

Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника - Пример упаковки



Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника – Пример содержимого упаковки



Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35MM ROD (п. 1.1-1.12)

Варианты исполнения по п. 1.1-1.12 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35MM ROD, 6.5MM X 50MM»



Винт блокирующий HEX BREAK OFF SETSCREW 6.35MM (п. 1.13)



Винт блокирующий SETSCREW 6.35MM HEX 1/4 - 32 THREAD (п.1.14)



Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM ROD (п. 2.1-2.25)

Варианты исполнения по п. 2.1-2.25 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM ROD, 5.0MM X 35MM»



Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75MM ROD (п. 2.26-2.42)

Варианты исполнения по п. 2.26-2.42 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.


На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75MM ROD, 6.5MM X 50MM»



Винт транспедикулярный полиаксиальный редуционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM ROD (п. 2.43-2.61)

Варианты исполнения по п. 2.43-2.61 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.


На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный редуционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM ROD, 4.5MM X 40MM»

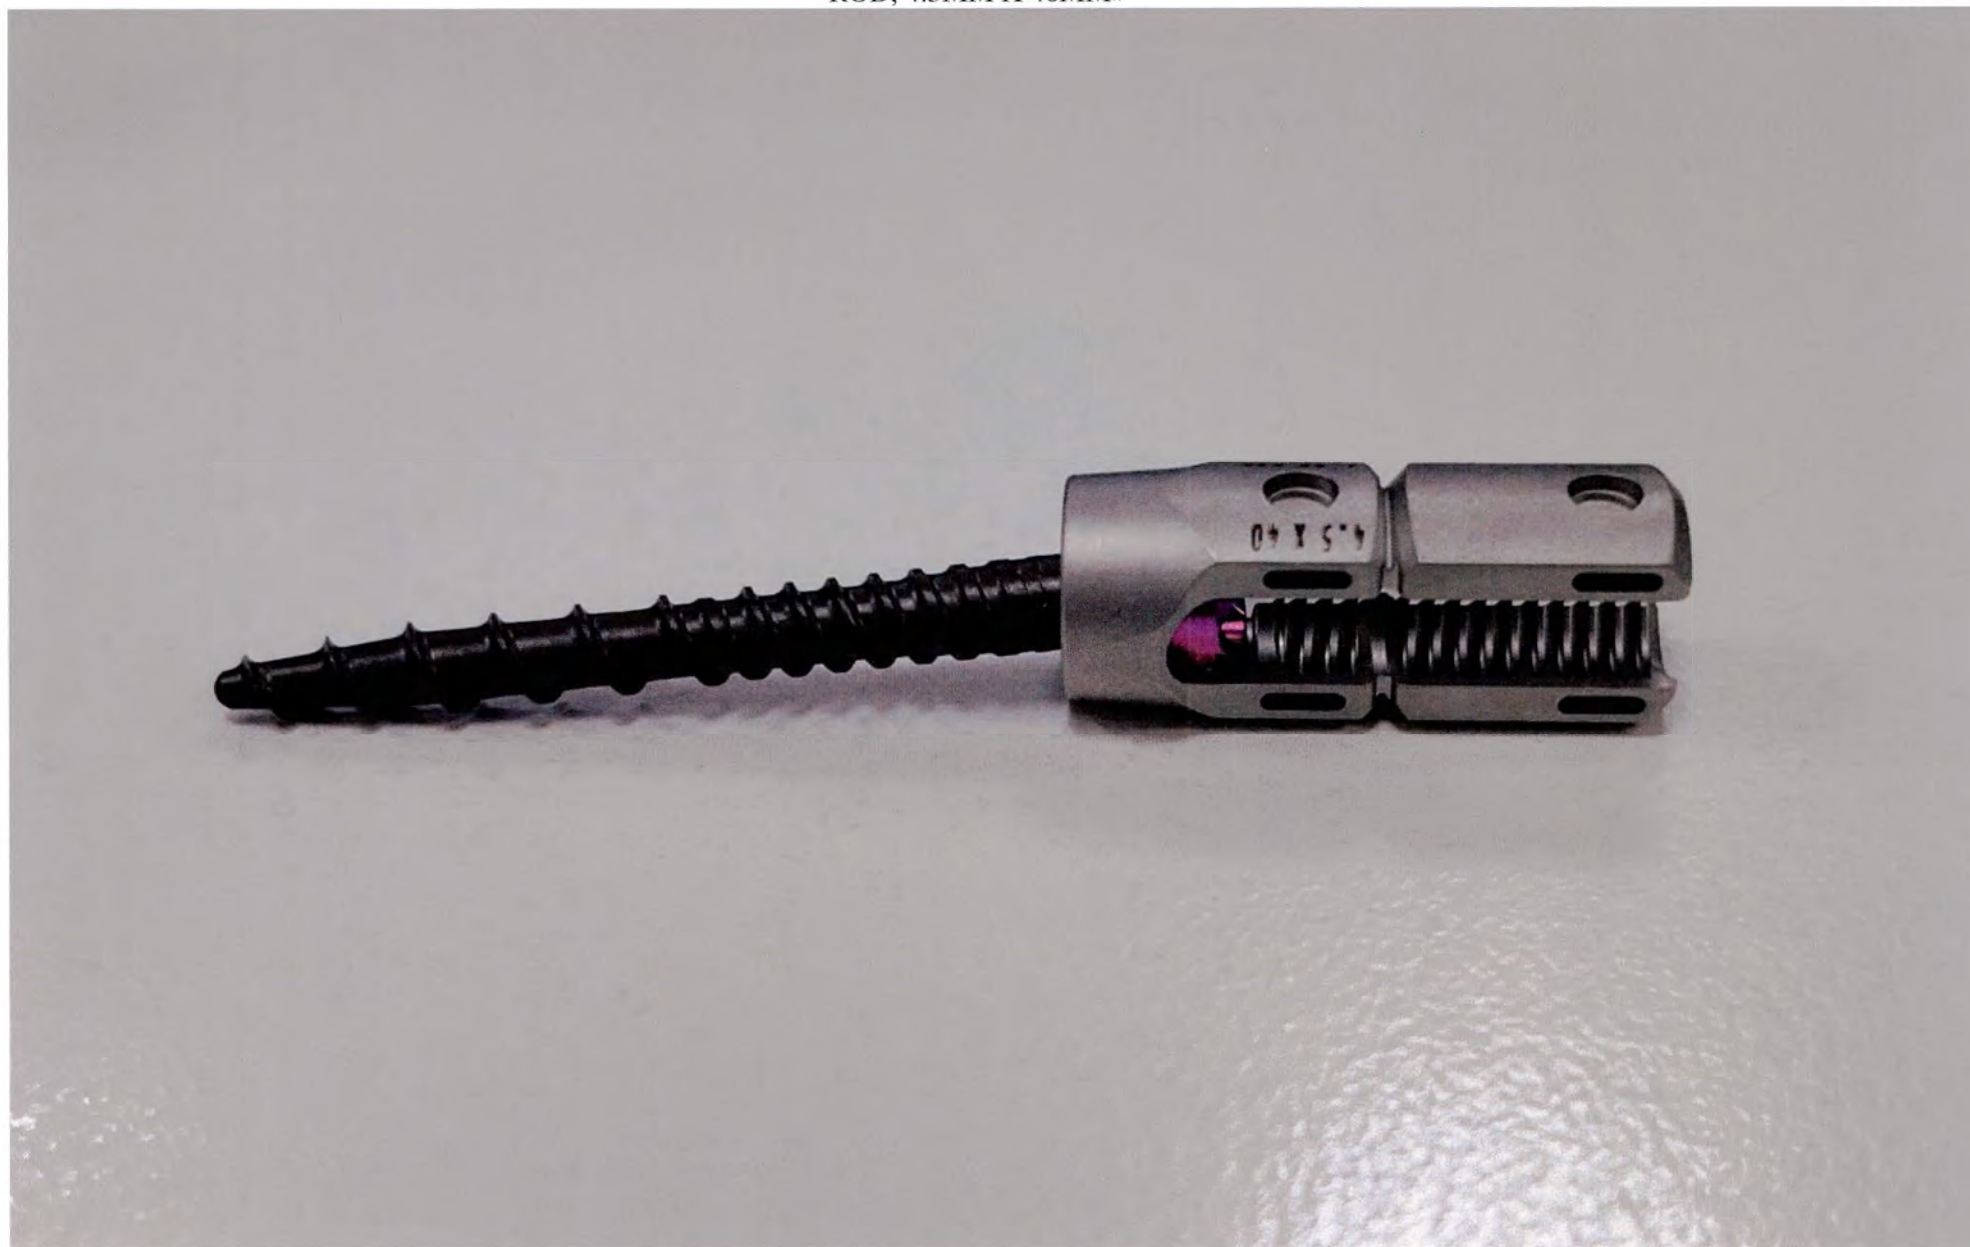

Винт блокирующий REDUCTION SETSCREW FOR 4.75MM RODS (п. 2.62)



Винт блокирующий NON-BREAK OFF SETSCREW FOR 4.75 MM ROD (п. 2.63)

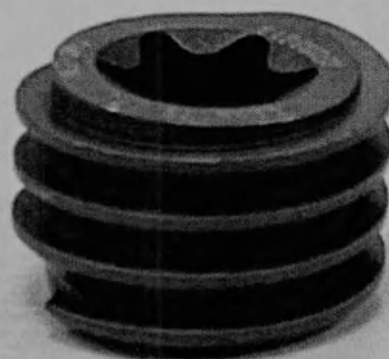

Винт блокирующий AUTO-BREAK OFF SETSCREW FOR 4.75MM ROD (п. 2.64)



Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 3.1-3.37)

Варианты исполнения по п. 3.1-3.37 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.


На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS, 5.5MM X 55MM»



Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 3.38-3.58)

Варианты исполнения по п. 3.38-3.58 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS, 7.5MM X 45MM»

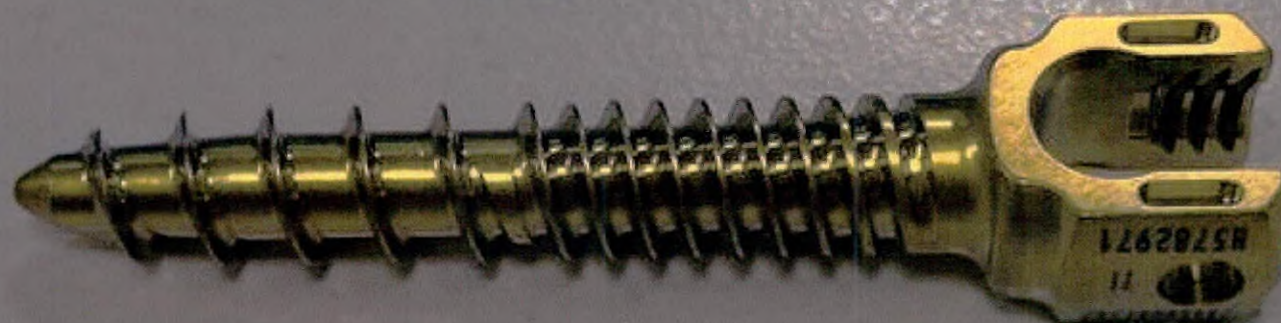

Винт транспедикулярный полиаксимальный редуцированный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 3.59-3.73)

Варианты исполнения по п. 3.59-3.73 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.


На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксимальный редуцированный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS, 5.5MM X 50MM»



Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 3.74-3.90)

Варианты исполнения по п. 3.74-3.90 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS, 5.5MM X 40MM»

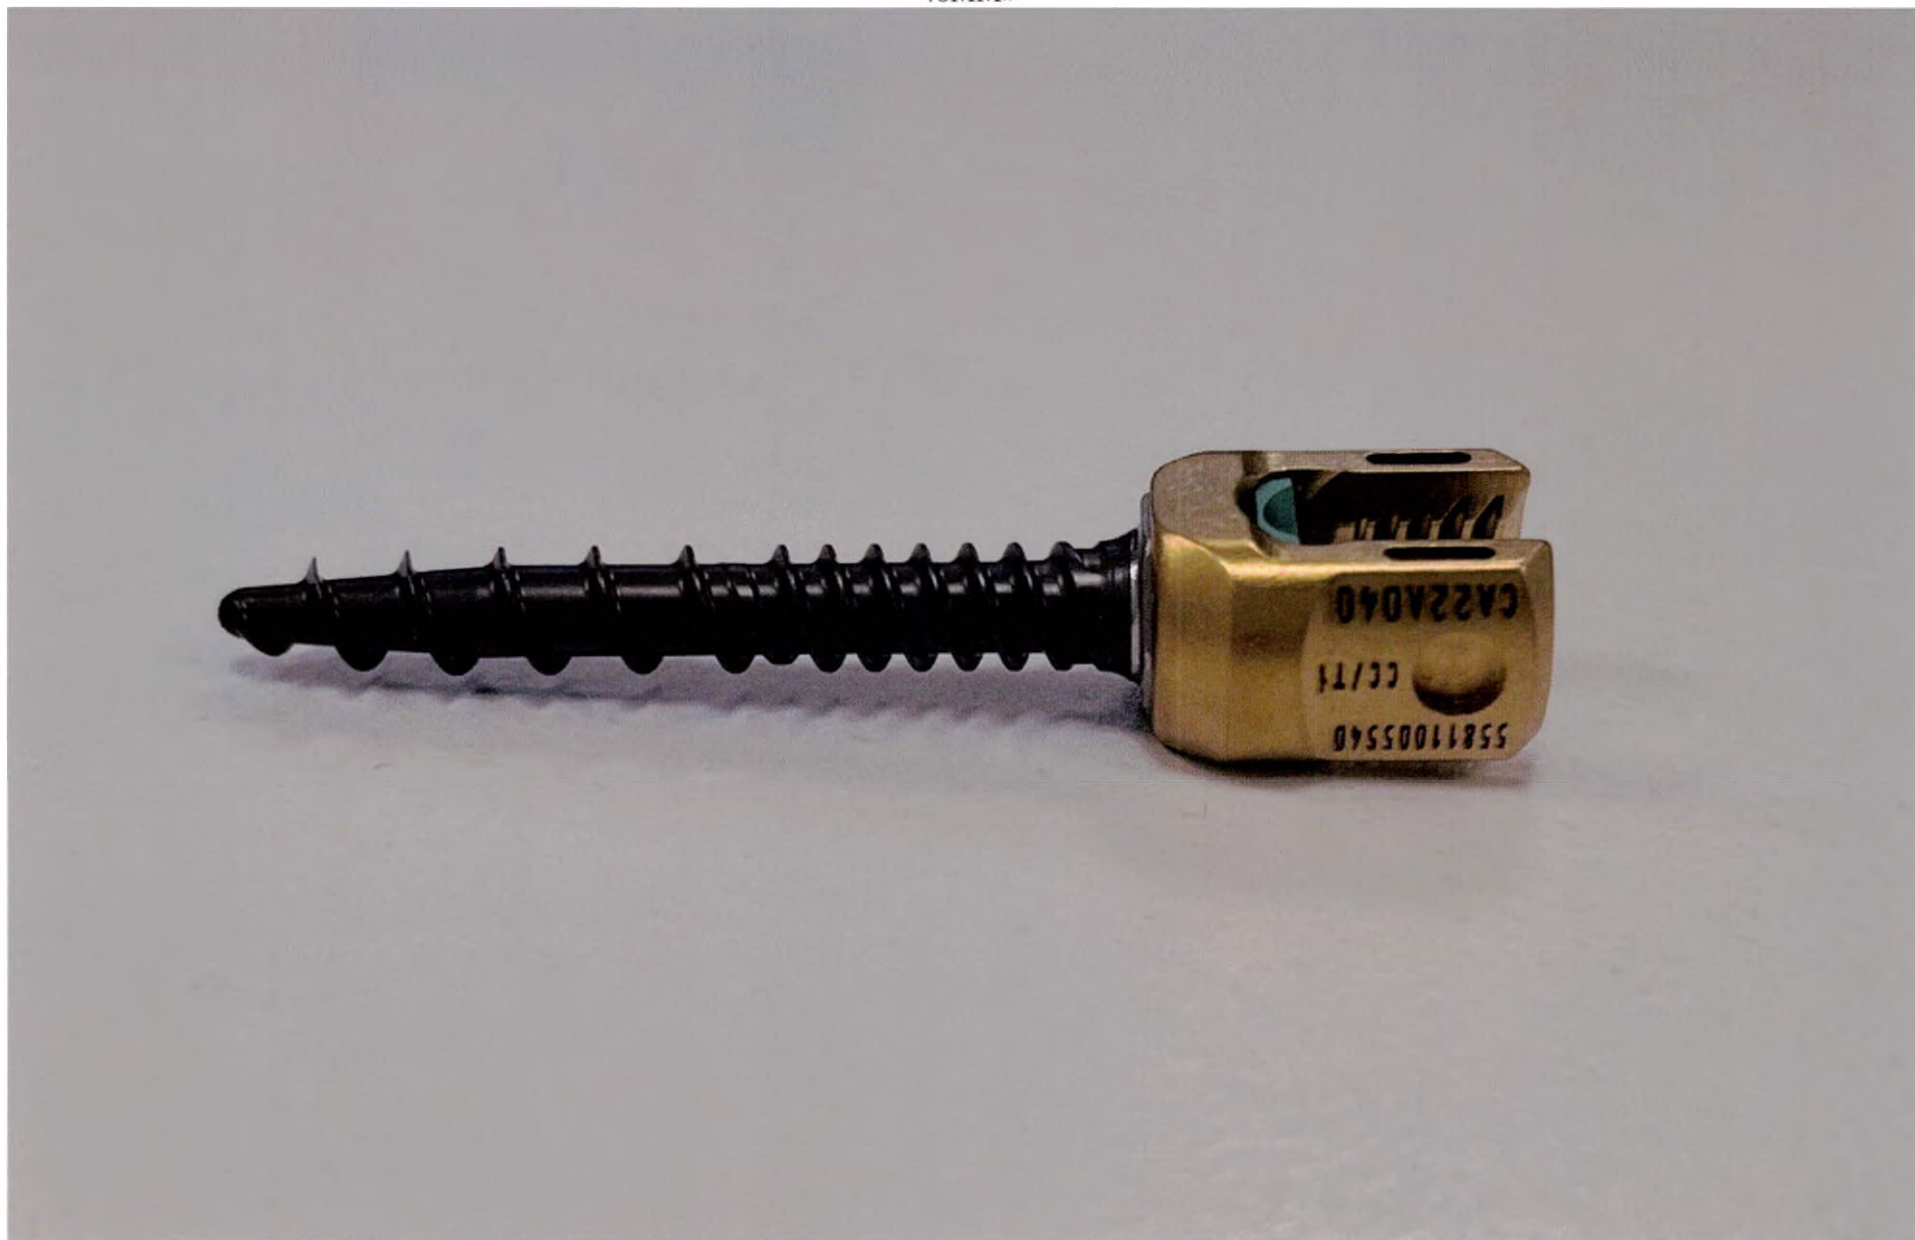

Винт блокирующий REDUCTION BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 3.91)



Винт блокирующий BREAKOFF SETSCREW 12 - 32 (п. 3.92)



Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 3.93)



Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM ROD (п. 4)

Варианты исполнения по п. 4 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM ROD, 5.5MM X 40MM»



Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 5.1-5.27)

Варианты исполнения по п. 5.1-5.27 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.


На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0MM RODS, 6.5MM X 45MM»



Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0MM RODS (п. 5.28-5.43)

Варианты исполнения по п. 5.28-5.43 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0MM RODS, 5.5MM X 40MM»

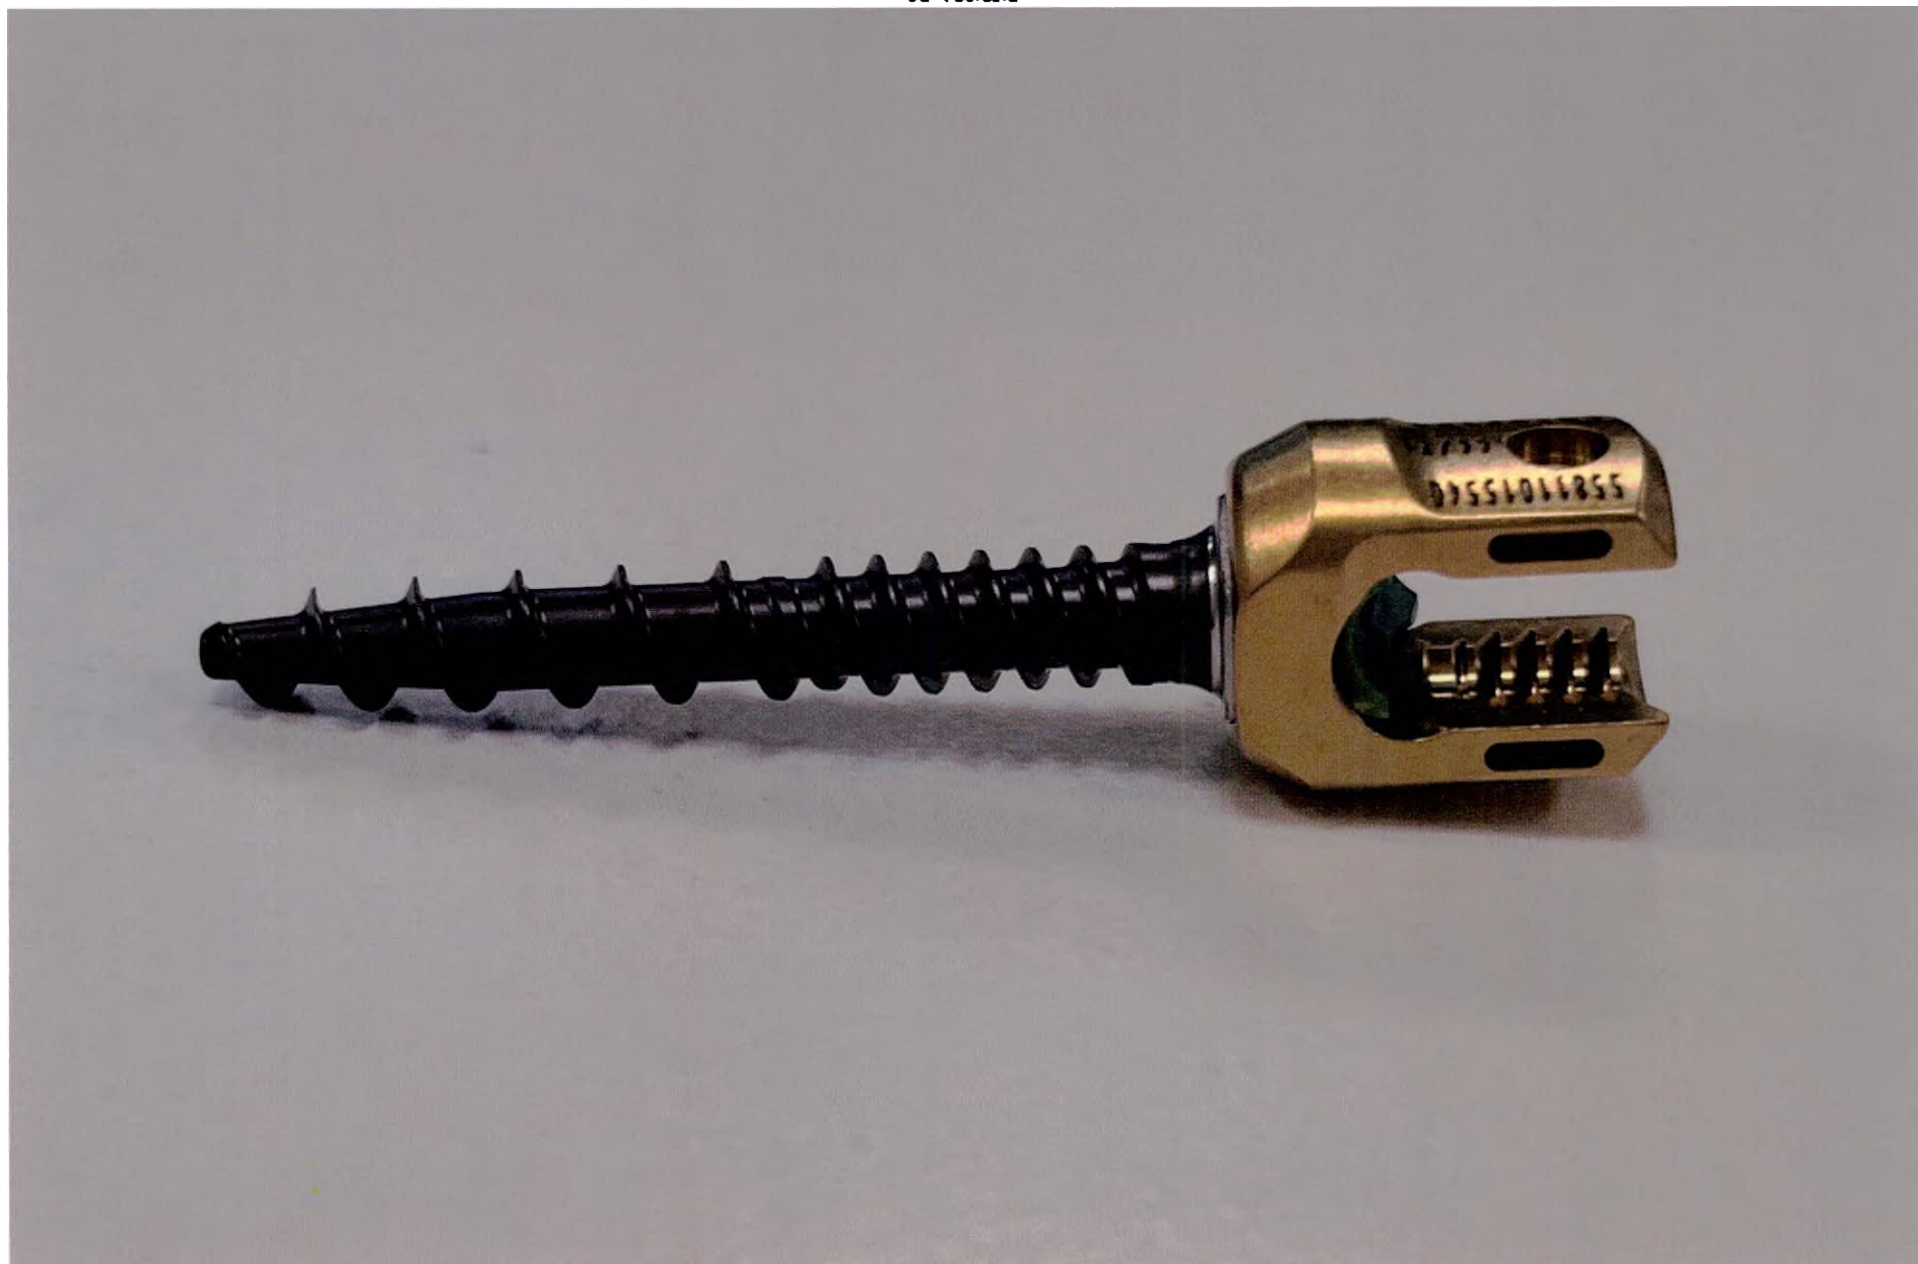


Винт блокирующий SEXTANT BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0MM ROD (п. 5.44)



Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0MM ROD (п. 6.1-6.13)

Варианты исполнения по п. 6.1-6.13 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0MM ROD, DIA 5.5MM X L 45MM»

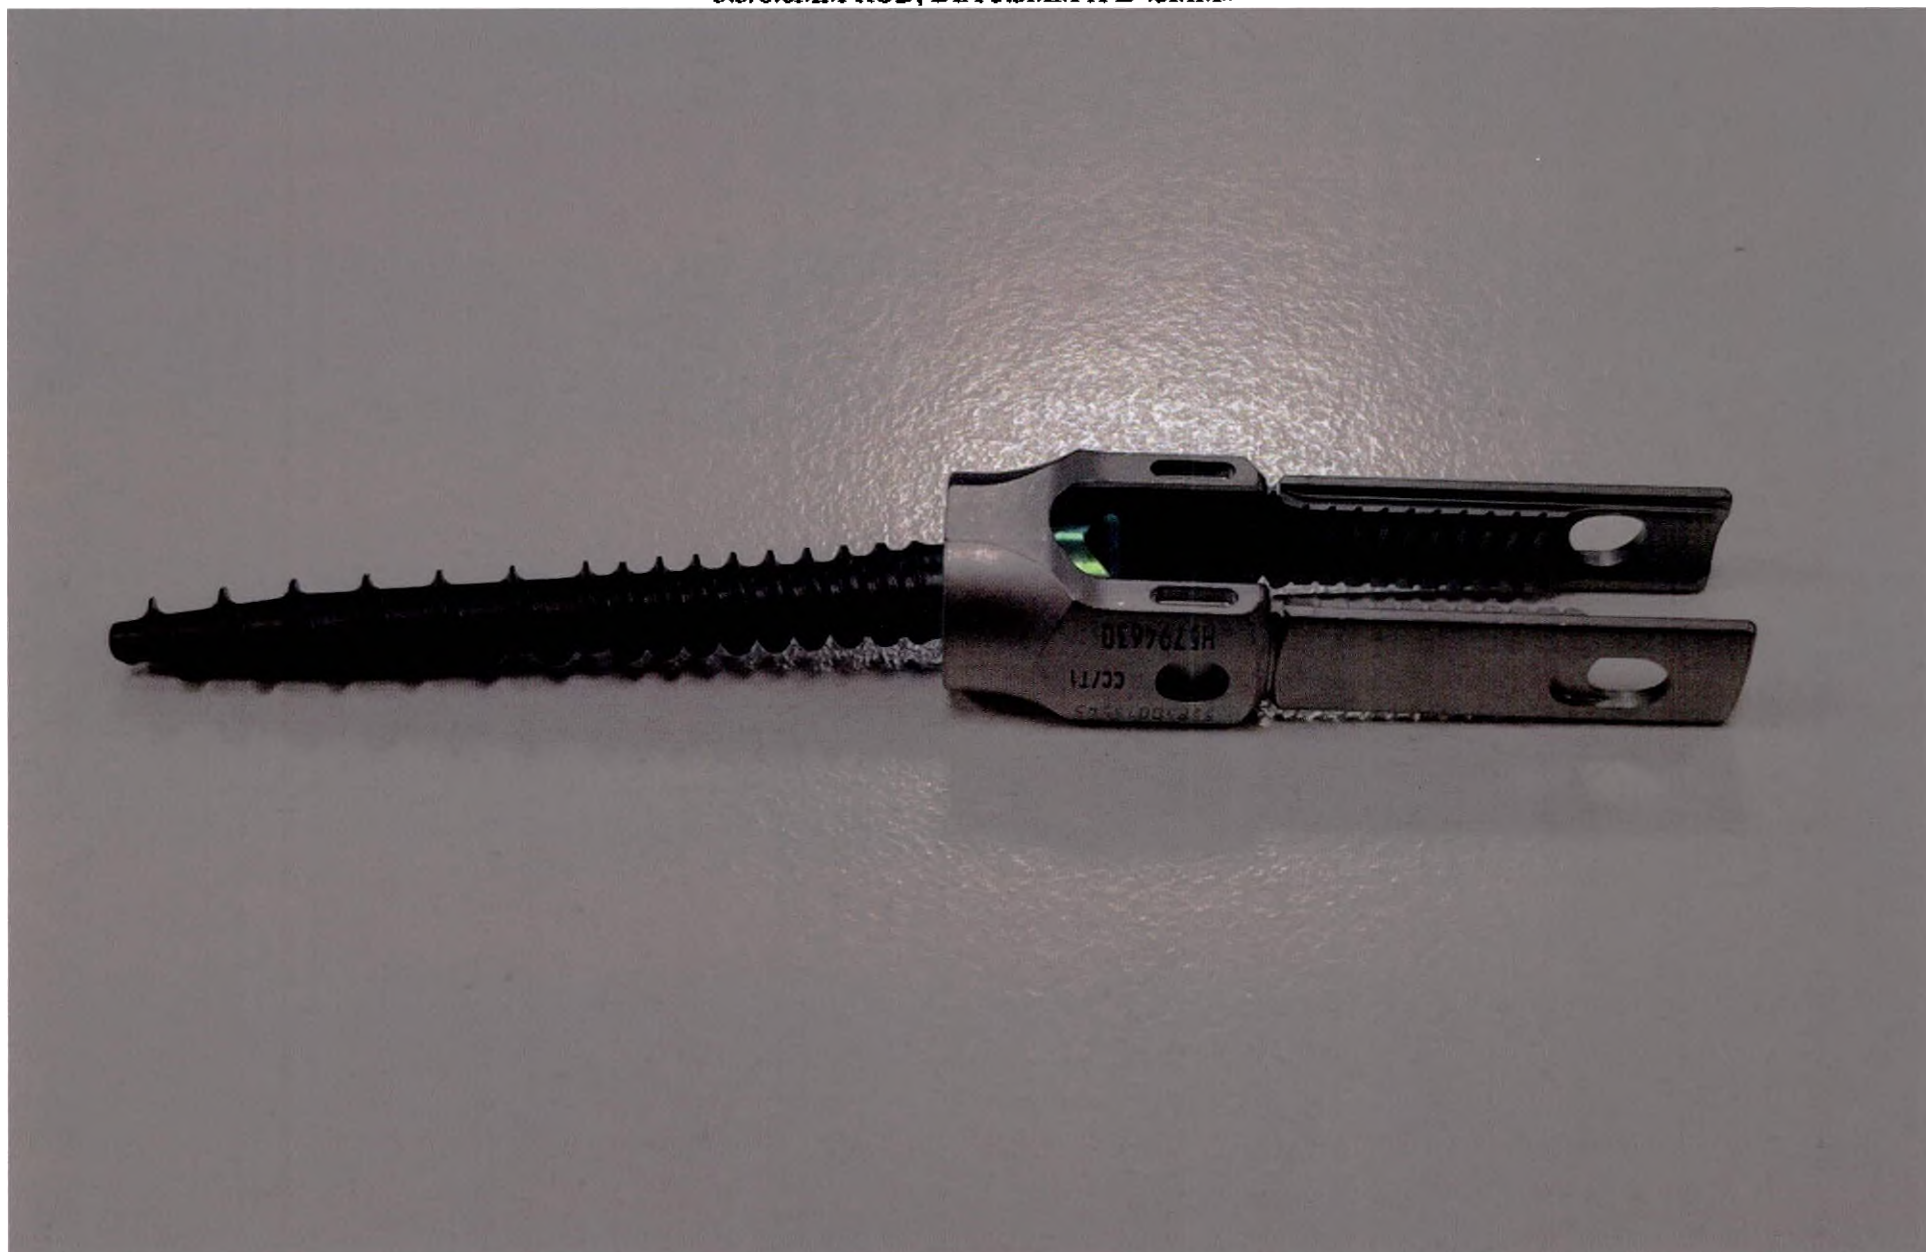

Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW DIA 5.5/6.0MM (п. 6.14)



Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD (п. 7)

Варианты исполнения по п. 7 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 6.5MM X 45MM»



Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 ROD (п. 8)

Варианты исполнения по п. 8 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 5.5MM X 45MM»



Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0MM ROD (п. 9)

Варианты исполнения по п. 9 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0MM ROD, 7.5MM X 50MM»



Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW (п. 10.1-10.31)

Варианты исполнения по п. 10.1-10.31 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5MM X 34MM»



Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW (п. 10.32-10.41)

Варианты исполнения по п. 10.32-10.41 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 4.0MM X 30MM»




Винт затылочный OC BONE SCREW (п. 10.42-10.51)

Варианты исполнения по п. 10.42-10.51 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт затылочный OC BONE SCREW 5.0MM X 14MM»



Винт блокирующий SET SCREW M6 (п. 10.52)



Винт блокирующий CLOSED CONNECTOR FLAT SET SCREW (п. 10.53)



Винт костный канолированный CANNULATED CORTICAL SCREW (п. 11.1–11.11)

Варианты исполнения по п. 11.1–11.11 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт костный канолированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0MM, L 30MM»



Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW (п. 11.12–11.19)

Варианты исполнения по п. 11.12–11.19 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0MM X 44MM»



Винт костный Винт костный ОС BONE SCREW (п. 12.1-12.10)


Варианты исполнения по п. 12.1-12.10 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт костный ОС BONE SCREW 4.5MM X 14MM»





Винт блокирующий CONNECTOR LOCKING SCREW M3.5X0.6 (п. 12.12)

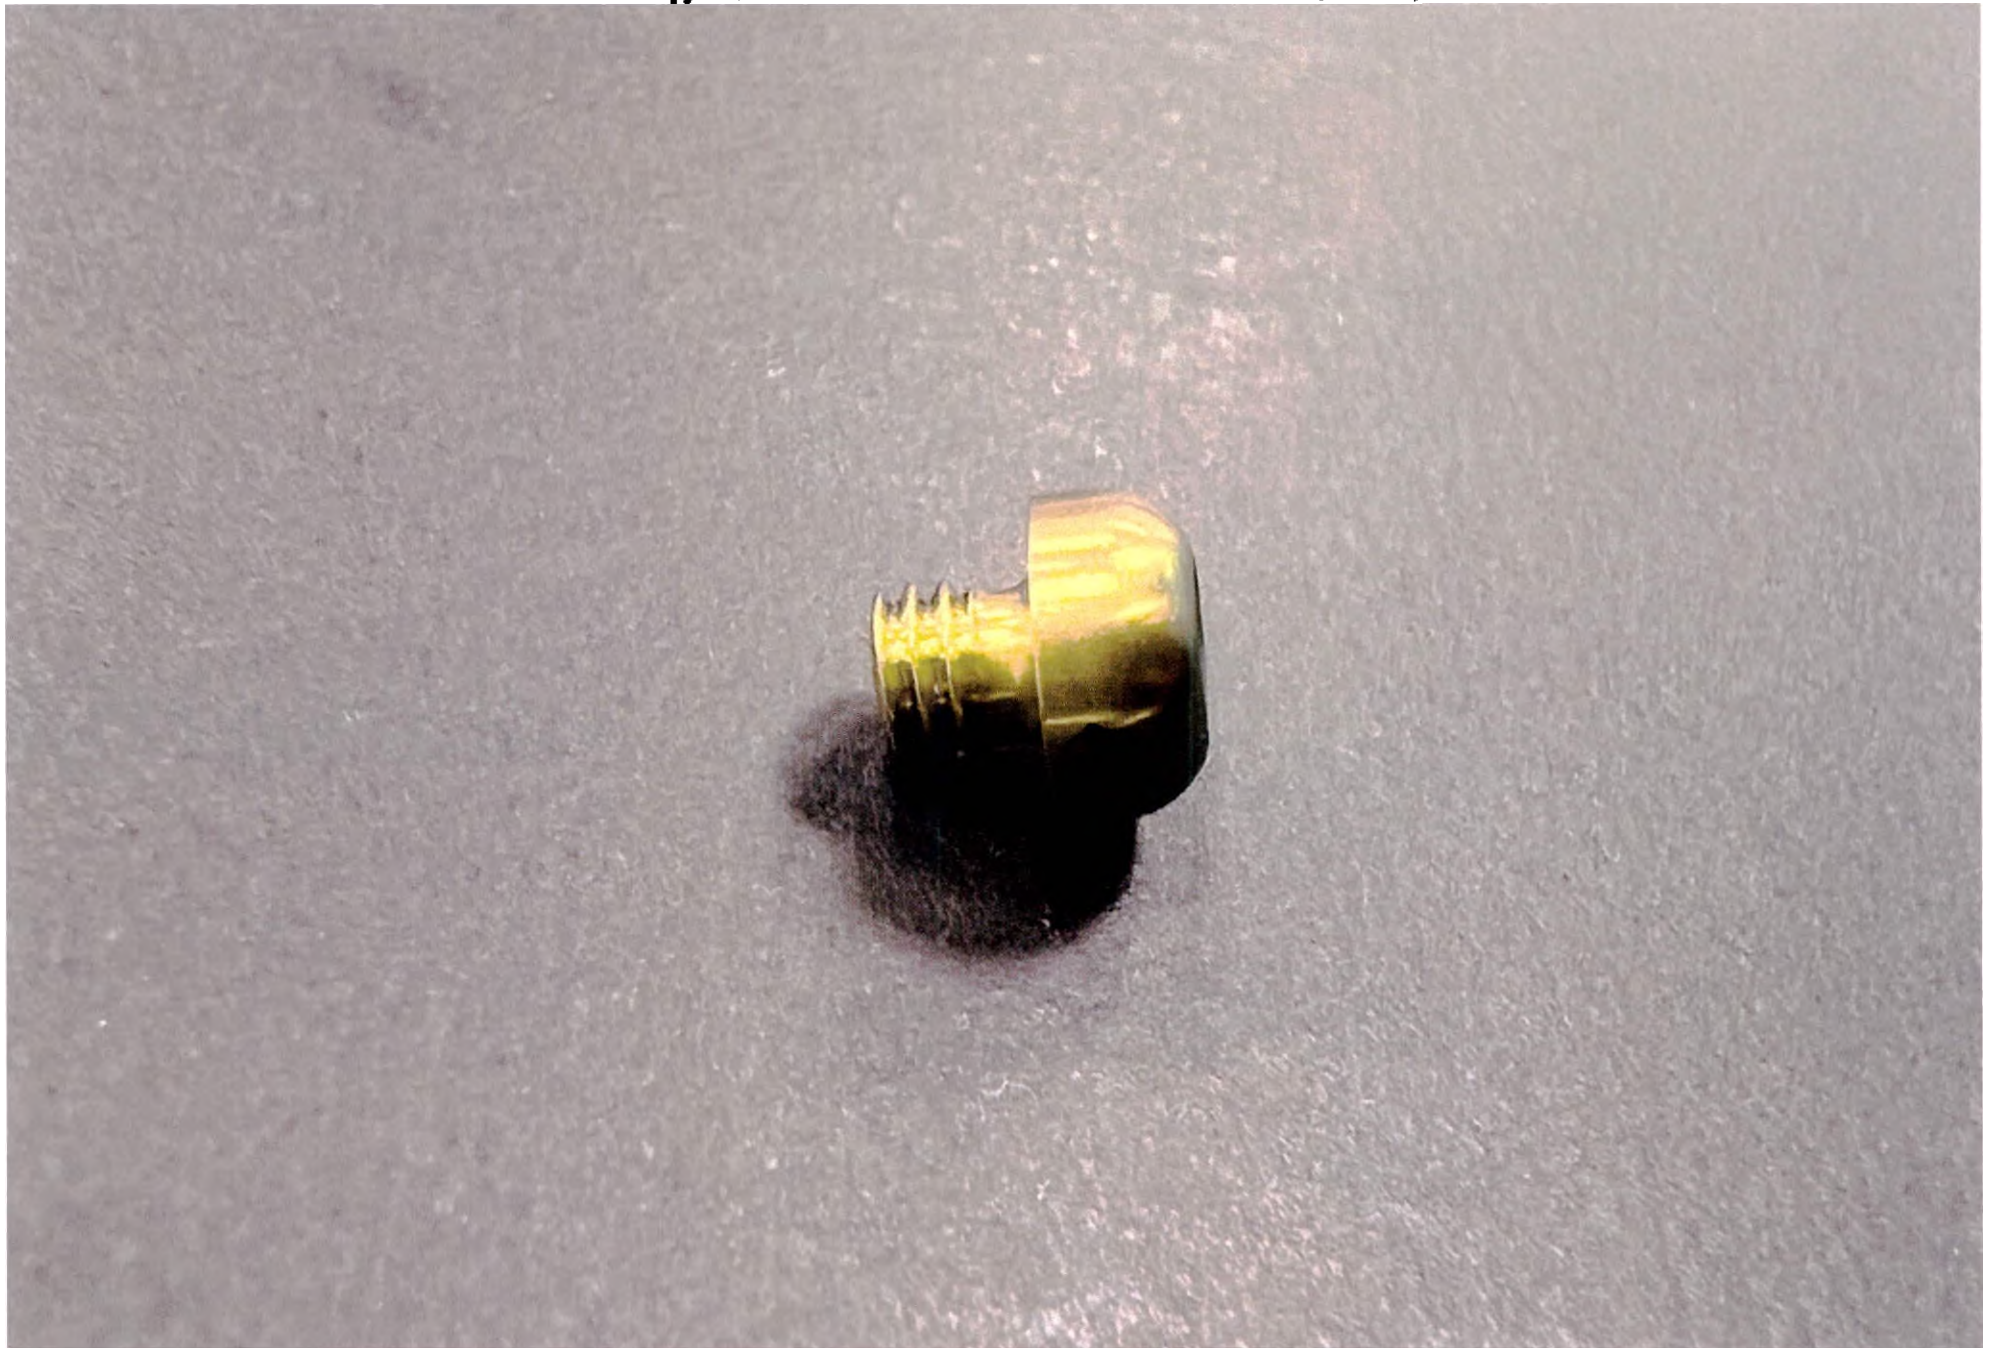


Винт блокирующий CROSSLINK SETSCREW (п. 12.13)



Винт блокирующий MAS CONNECTOR SET SCREW M6X1 (п. 12.14)



Винт блокирующий CONE CONNECTOR SETSCREW (п. 12.15)

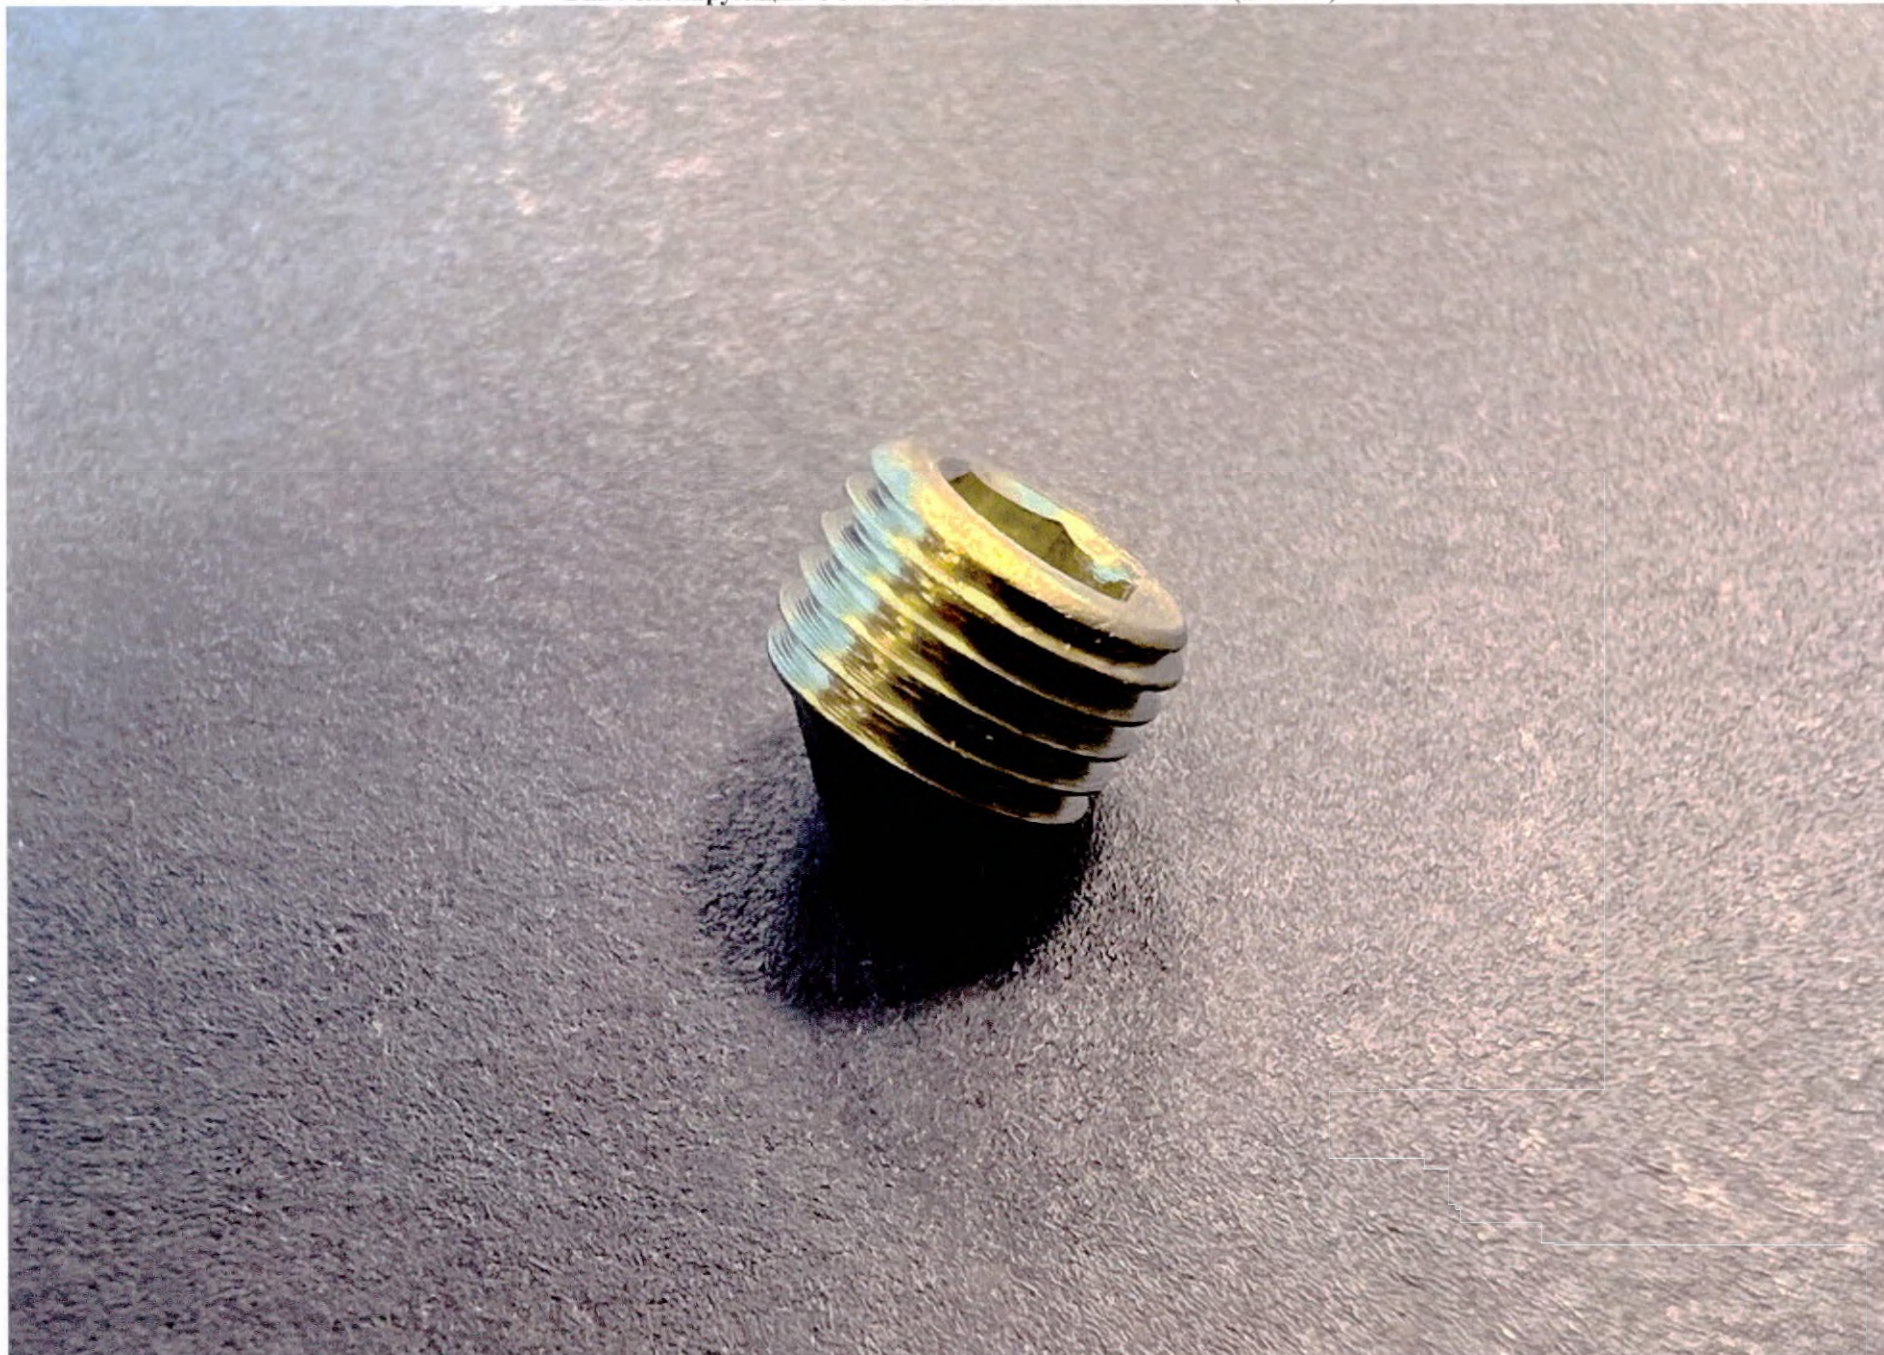

Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW (п. 13.1–13.32)

Варианты исполнения по п. 13.1–13.32 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW 3.5MM X 32MM»



Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED (п. 13.33–13.44)

Варианты исполнения по п. 13.33–13.44 Заявления имеют идентичный внешний вид, отличаются габаритными размерами.

На рисунке приведен вариант исполнения «Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 3.5MM X 24MM»



Винт блокирующий M6 SET SCREW (п. 13.45)



Пример стикера на медицинское изделие* «Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON: Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35MM ROD, 7.5MM X 80MM»:

	Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON: Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35MM ROD, 7.5MM X 80MM	
	Производитель: Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк., США, Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 1800 Pyramid Place, Memphis, TN 38132, USA	
	Страна происхождения: США	Код UPN
		Код CFN
	Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник» вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, этаж, 9, помещ. III, ком. 41, Тел: +7-495-580-73-77	
	Регистрационное Удостоверение № РЗН	от
	Дата изгот. / Серия / Годен	см. упаковку
	до:	
		см. инструкцию
		см. символы на упаковке

* Представлен стикер на примере варианта исполнения «Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON: Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35MM ROD, 7.5MM X 80MM». Стикеры для остальных вариантов исполнения имеют идентичный внешний вид и наполнение информацией.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»
45 листа(ов)

