

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

« 18 » 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-2022»

2023

лидкор

Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG

Калибратор инактивирован

8°C 2°C IVD			ProClin 300		
1,0 мл			LOT 20220801		
CAL 2			01.07.2023		
REF C88038G					

лидкор

Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG

8°C 2°C IVD			ProClin 300		
1,0 мл			LOT 20220801		
CAL 1			01.07.2023		
REF C88038G					

лидкор YHLO

Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgG

3,5мл	6,5мл	6,5мл	ProClin 300		
R 1	R 2	R 3	8°C		
LOT 20220801			01.07.2023		



лидкор

Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgG

Пароизоляционные
крышки - 4 шт.

LOT	20220801	IVD	
	01.07.2023		
REF	C88038G		

Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG




LOT 20220801 EXP 01.07.2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT 20220801 01.07.2023 REF C88038G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.
4. Пароизоляционные крышки – 8 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT 20220801 01.07.2023 REF C88038G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG


Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO

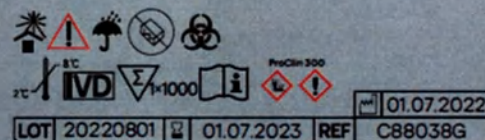


Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

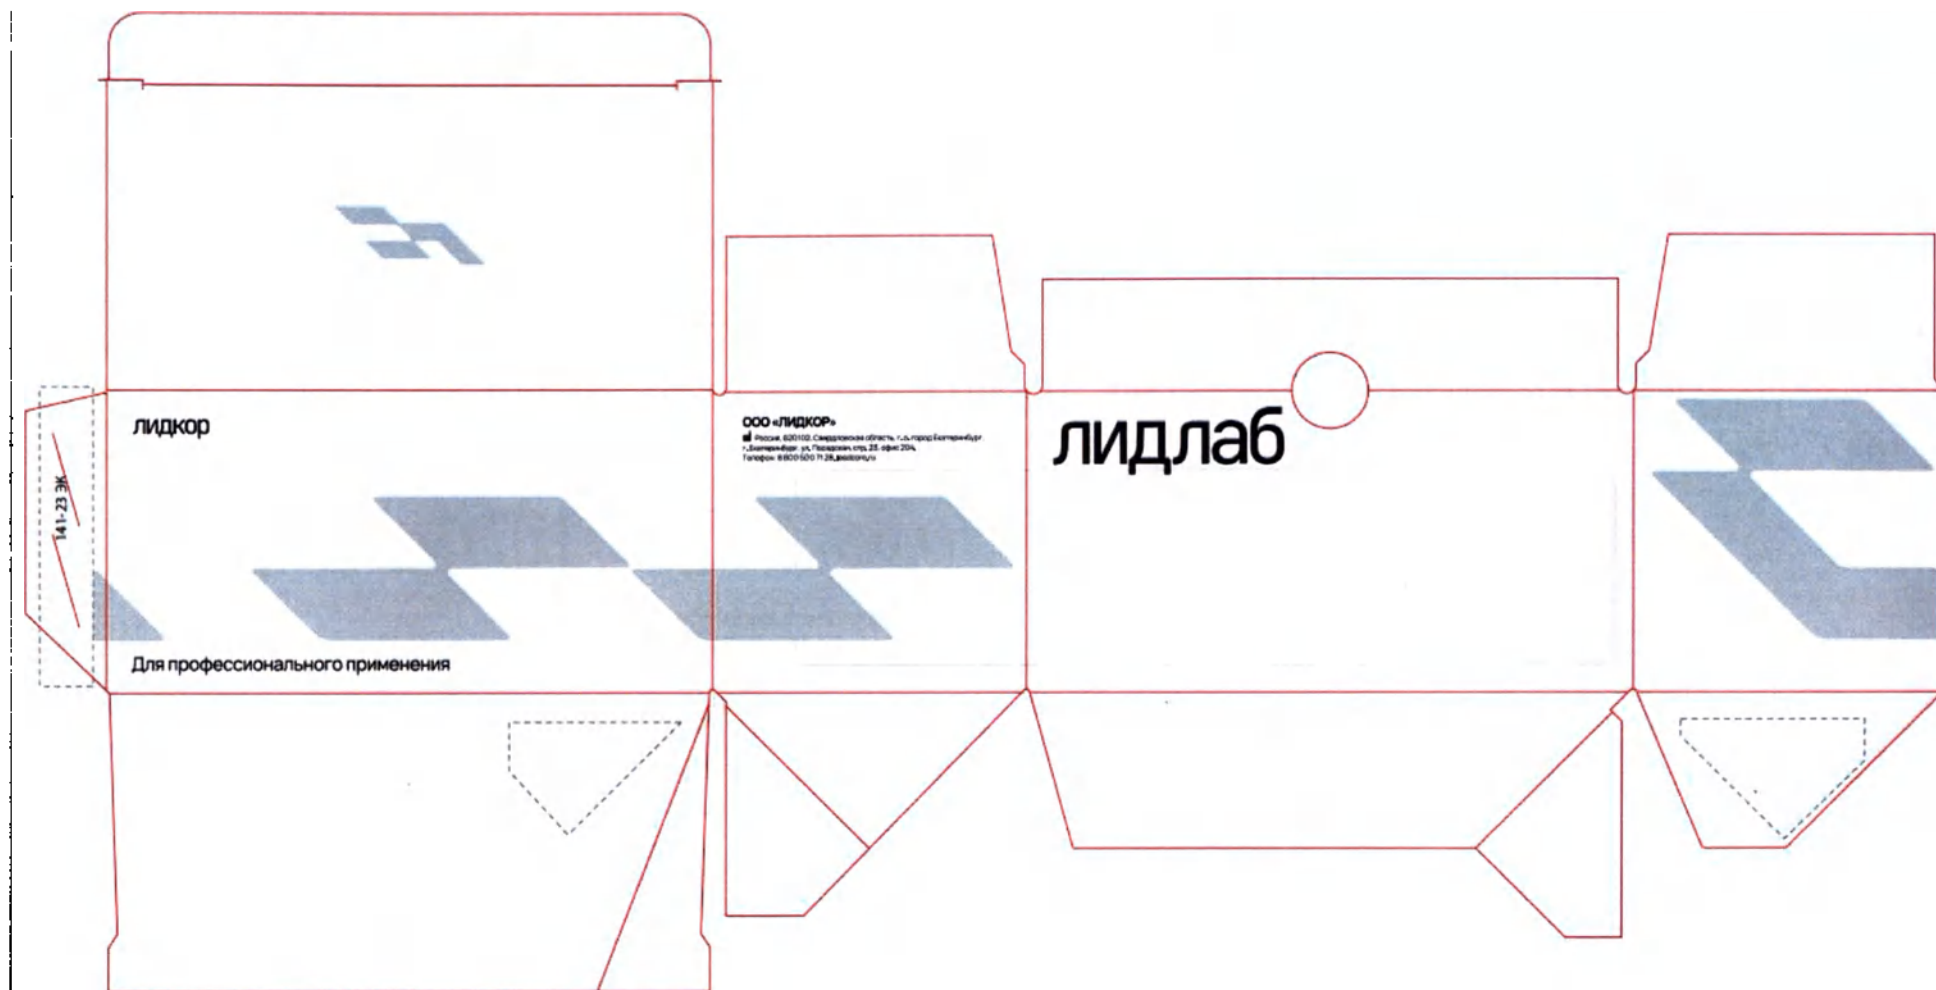

Макет транспортной маркировки

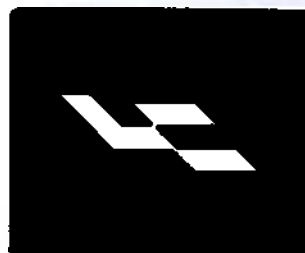

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2022
LOT	20220801		01.07.2023	REF	C88038G

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (Мень) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-2022»




2023

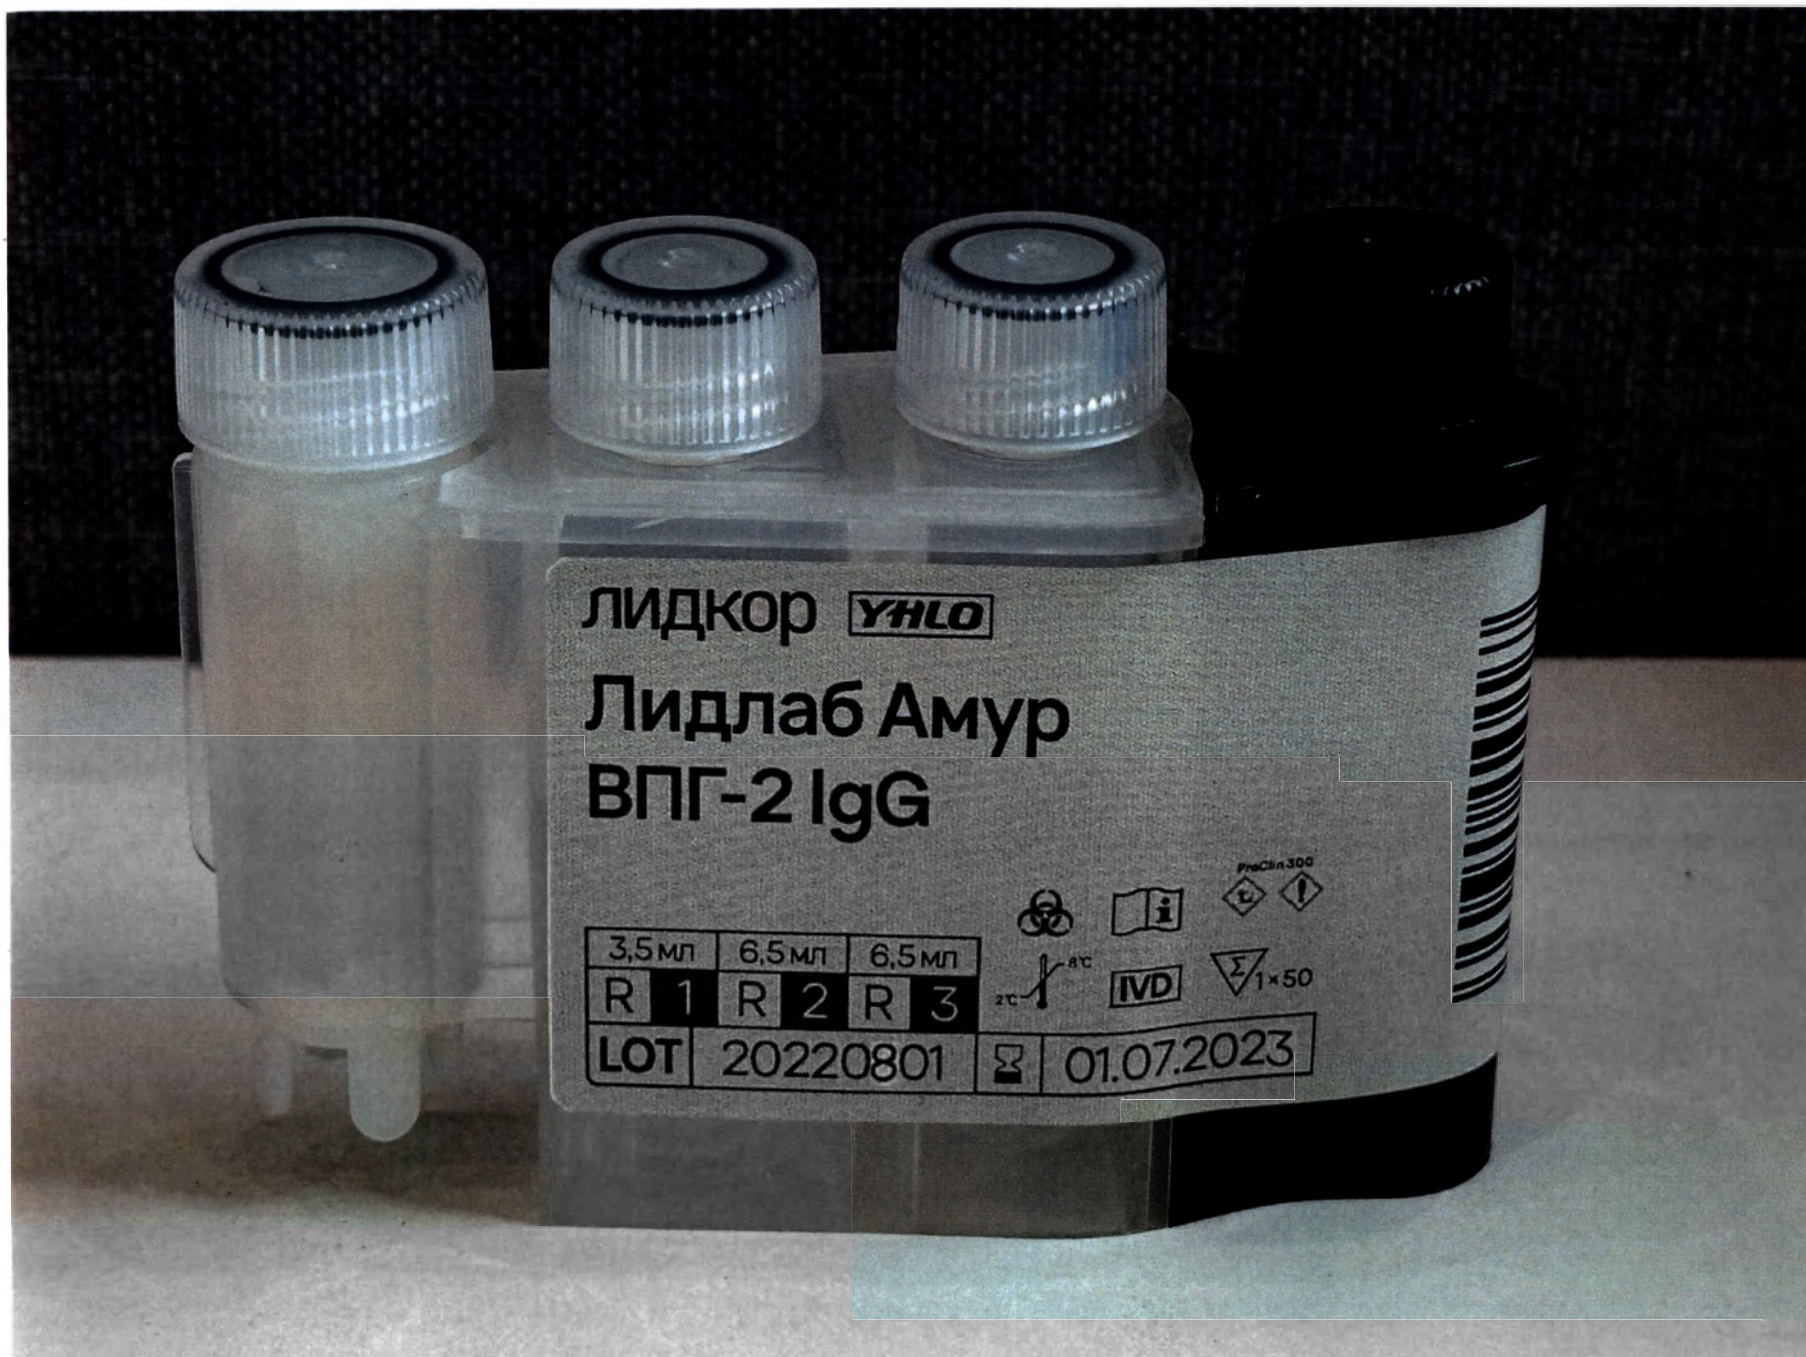

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2) 6,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3) 6,5 мл/уп.)

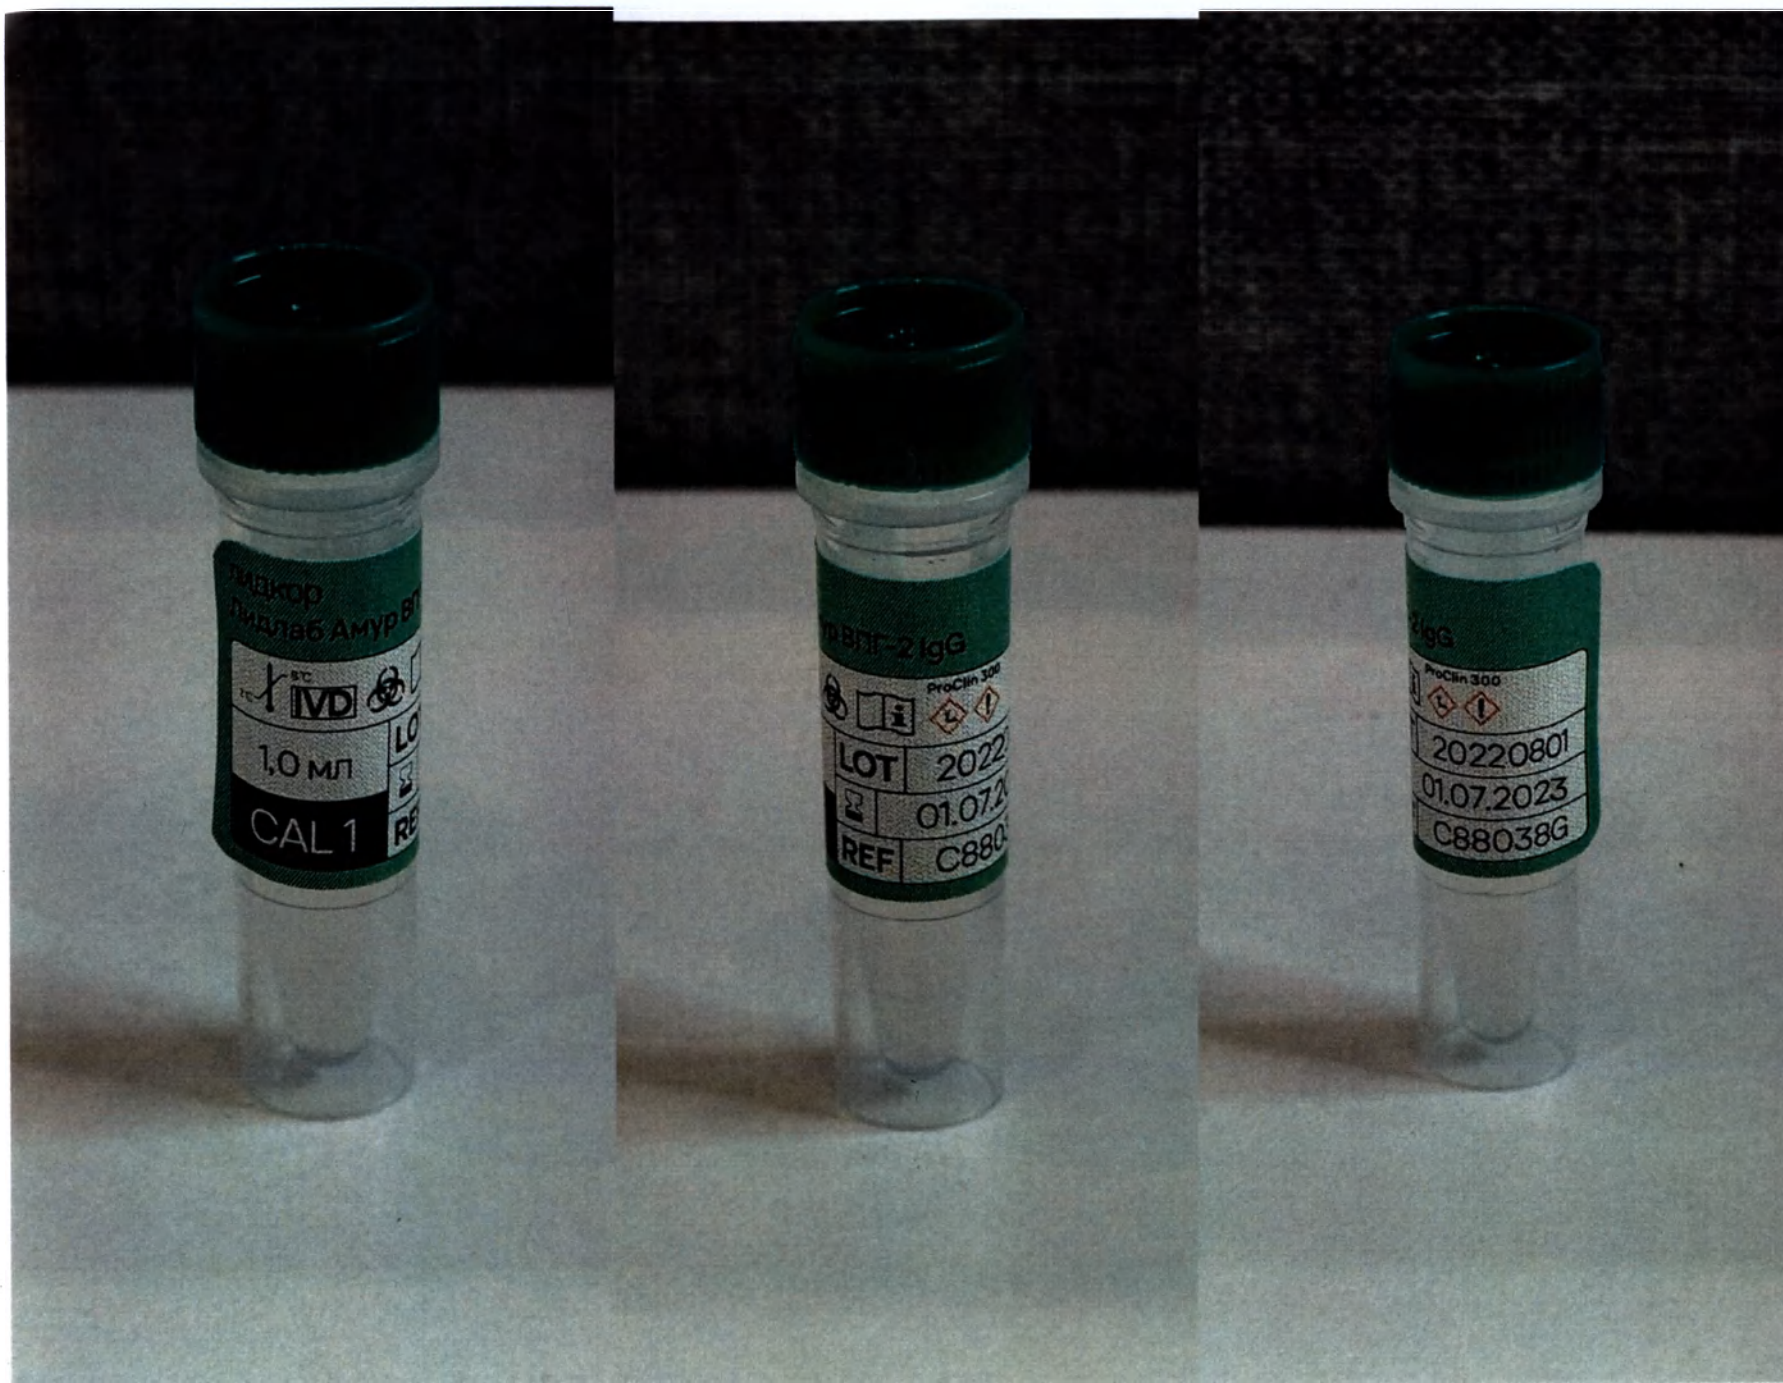

Калибратор 1 (CAL1)

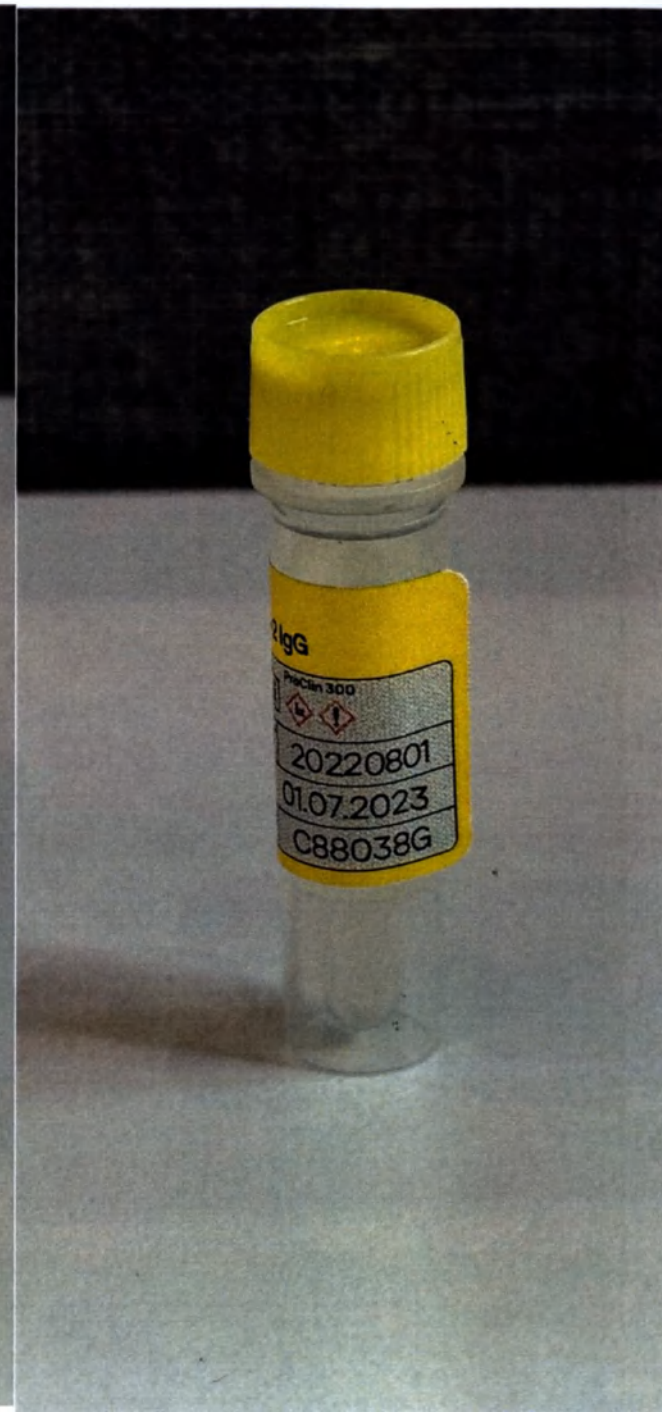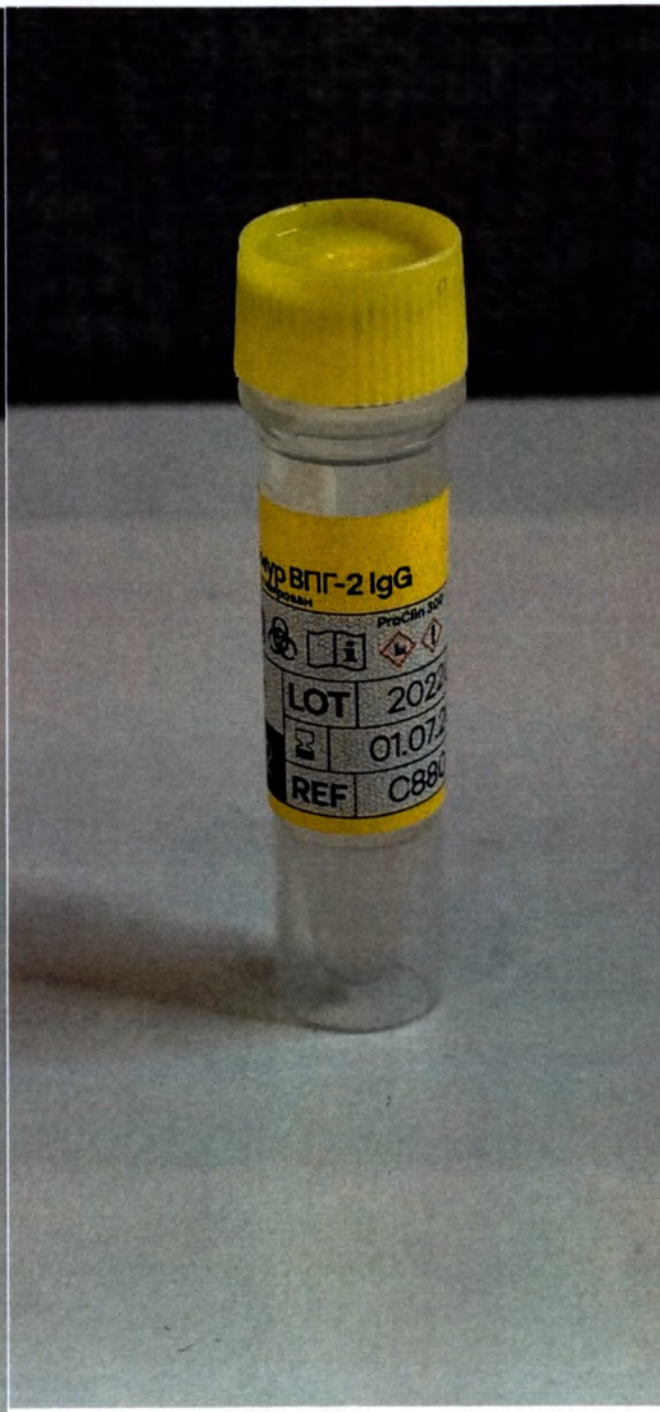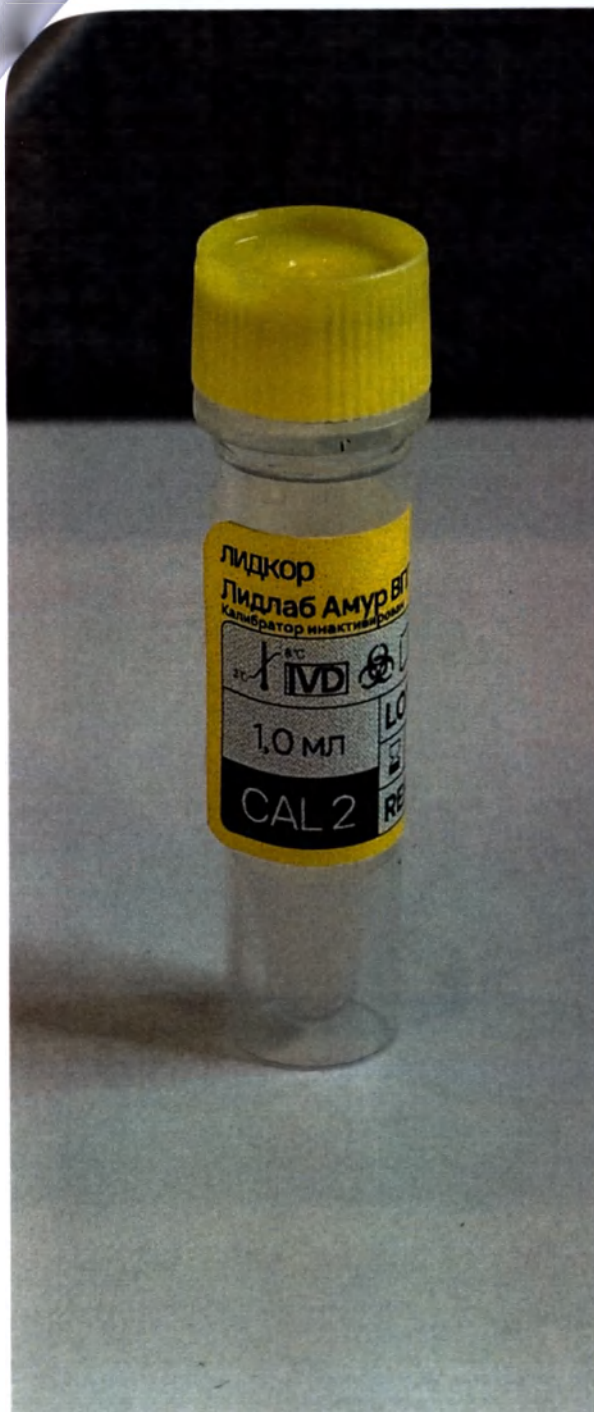



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для
качественного определения иммуноглобулинов
класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа
(ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к
ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 16
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона коробки)

лидкор

Для профессионального применения

лидлаб





**Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgG**
Набор реагентов на 200 тестов


YNLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент, парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6.5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6.5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.
6. Аналитический паспорт – 1 шт.



LOT 20220801 01.07.2023 REF C88038G 01.07.2022

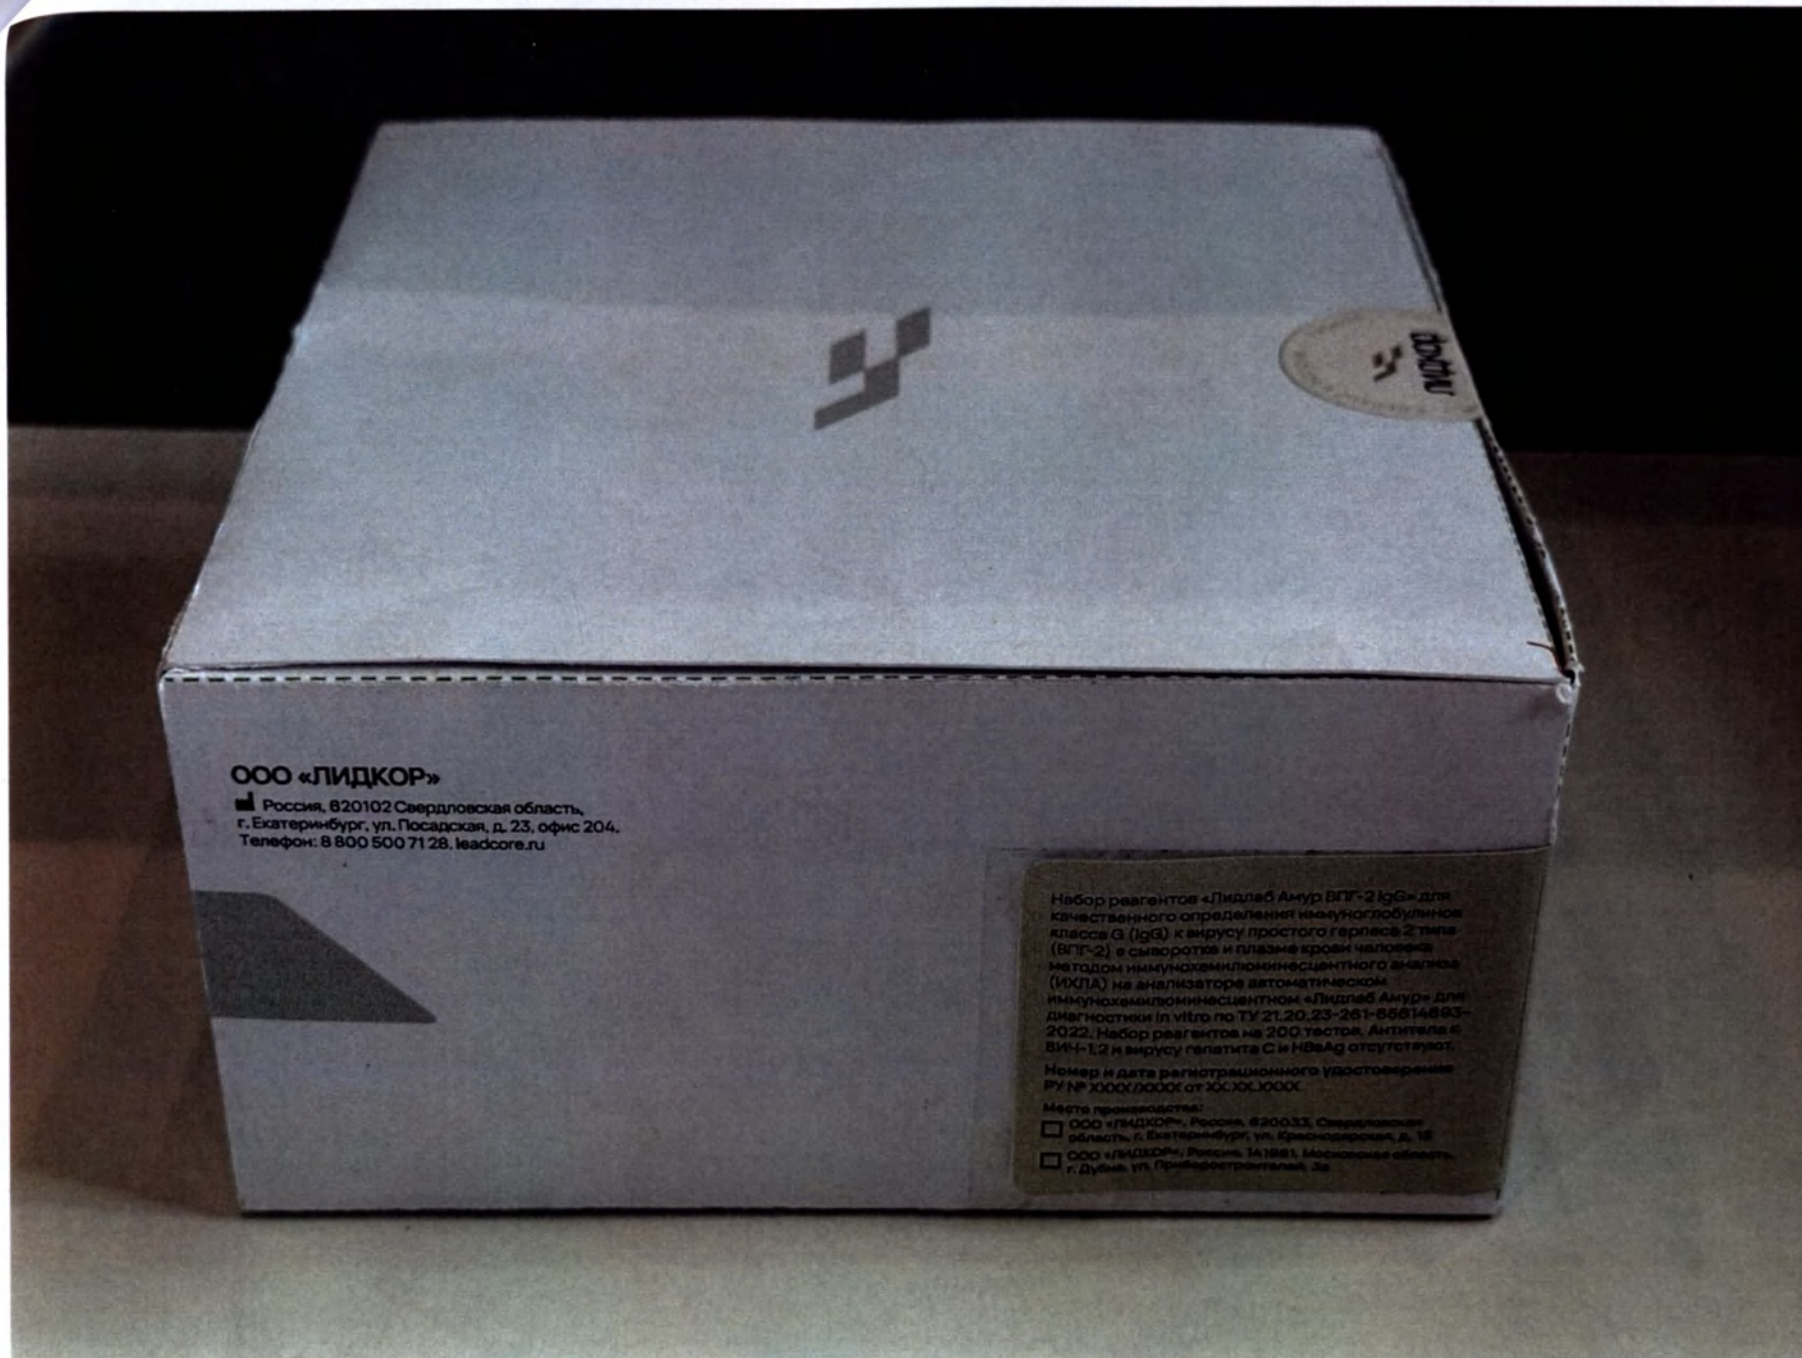

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102 Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 7128. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для
качественного определения иммуноглобулинов
класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа
(ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-261-65614893-
2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к
ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.
Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Места производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 18
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а


Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона коробки)



Набор реагентов на 500 тестов (другая сторона коробки)


лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG» для
качественной и количественной диагностики
инфекции С. difficile (Clostridium difficile) в фекалиях
с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА).
Содержит 1000 тестов. Срок годности 12 месяцев.
Сертификат соответствия № 01.07.2024. Рег. № 01.07.2024.
Исходный материал: Россия, 421000, Самарская область,
г. Самара, ул. Гагарина, д. 15.
Сайт: www.leadlab.ru. Контактный центр:
г. Дубна, ул. Гурьянова, д. 3а.



Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgG
Набор реагентов на 1000 тестов

UNILAB



Состав изделия

1. Микроплазма (в составе: реагент для качественной диагностики ВПГ-2).
2. Реагент (в составе: реагент для количественной диагностики ВПГ-2).
3. Калибратор 1 (CAL.1) 1,0 мл/флакон - 10 шт.
4. Калибратор 2 (CAL.2) 1,0 мл/флакон - 10 шт.
5. Пластиковые пробирки - 50 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Сертификат соответствия - 1 шт.

Набор реагентов на 1000 тестов



Набор реагентов на 1000 тестов (другая сторона коробки)



Варианты исполнения: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

лидкор

Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgG

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20220801



01.07.2023

REF C88038G




лидкор

Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgG

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20220801




01.07.2023

REF C88038G



Пароизоляционные крышки – 8 шт.

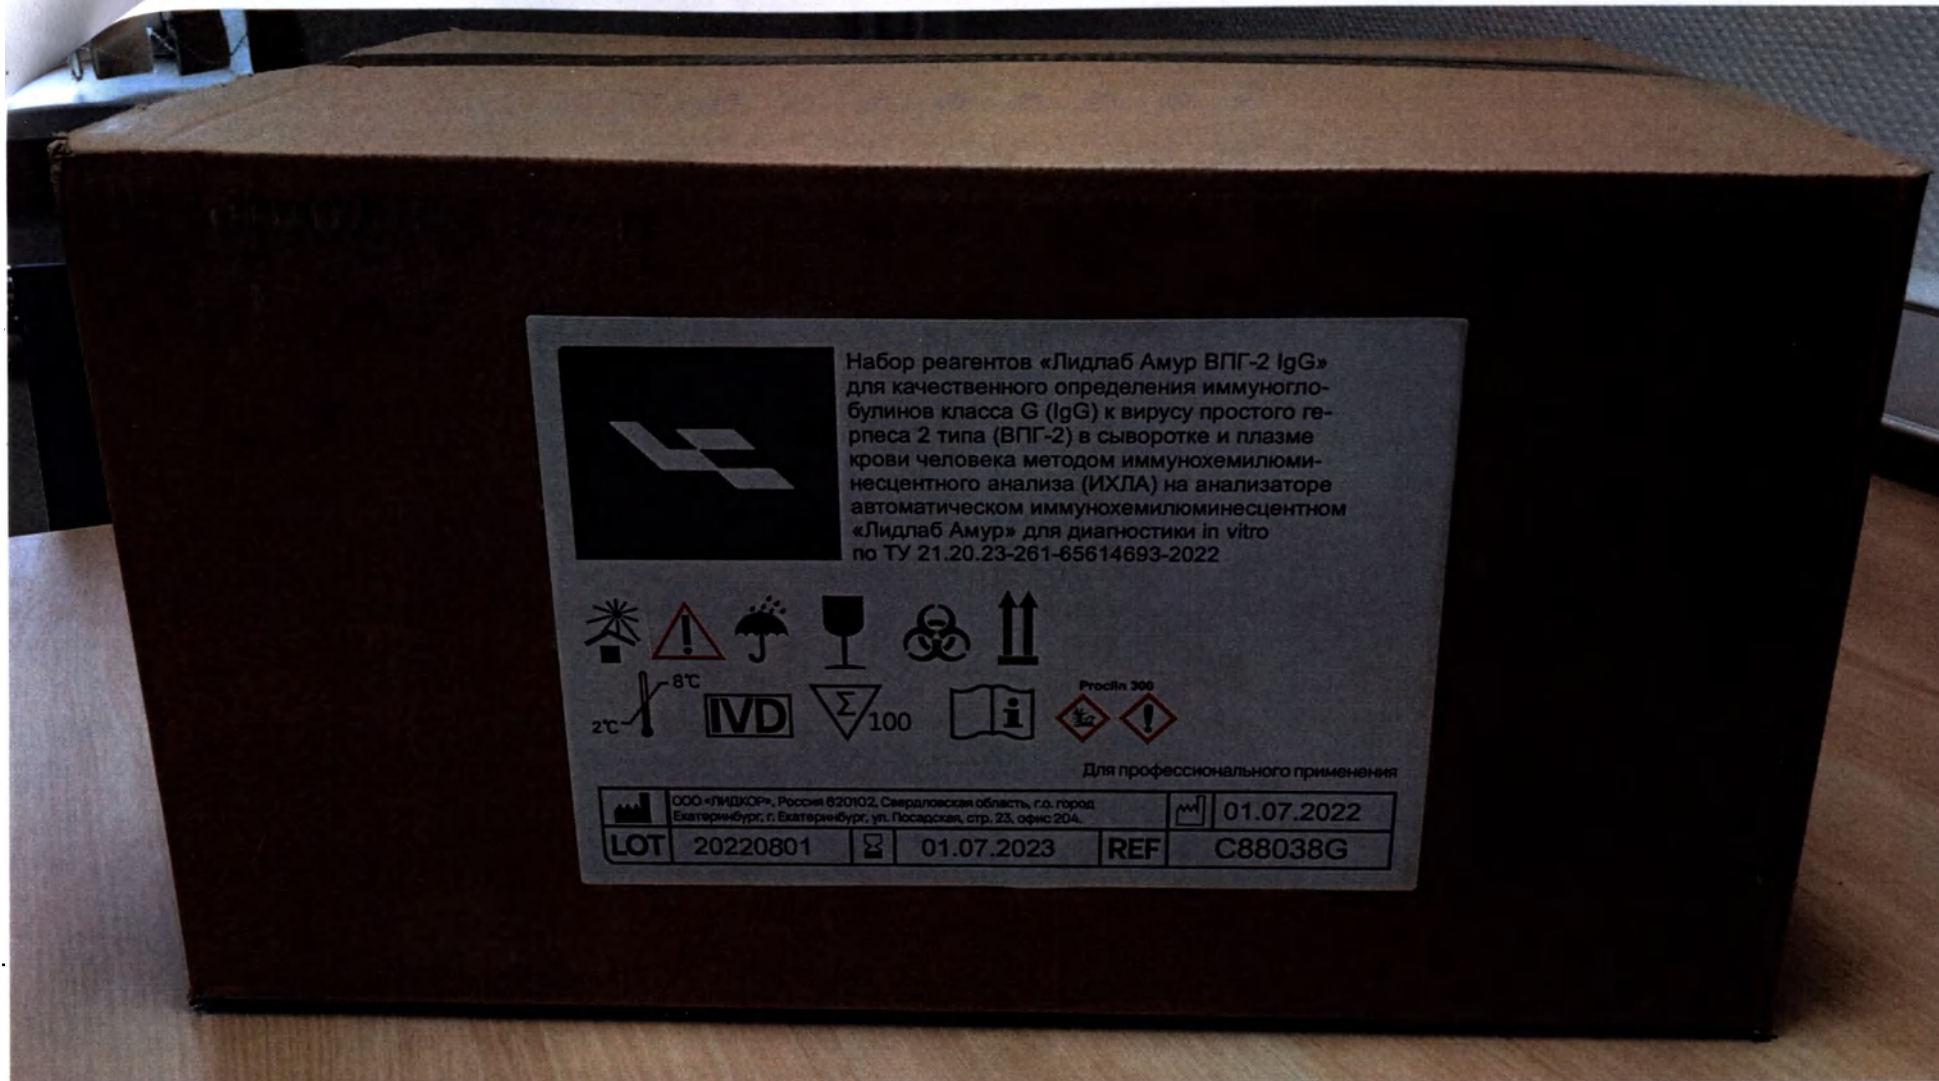

Транспортная тара

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

16 (Шестьнацать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

