«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «МЕДИНВЕСТ»

Писарев Д.А.
15.11.2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Термометр медицинский цифровой SMARTPLUS® в вариантах исполнения»

производства

WUXI MANOMETER INSTRUMENT CORPORATION (УСИ МАНОМЕТР ИНСТРУМЕНТ КОРПОРЕЙШН)

Адрес места производства медицинского изделия:

JOYTECH Healthcare Co.,Ltd
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100, Zhejiang, China (Китай)

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Термометр медицинский цифровой SMARTPLUS® DMT 4131

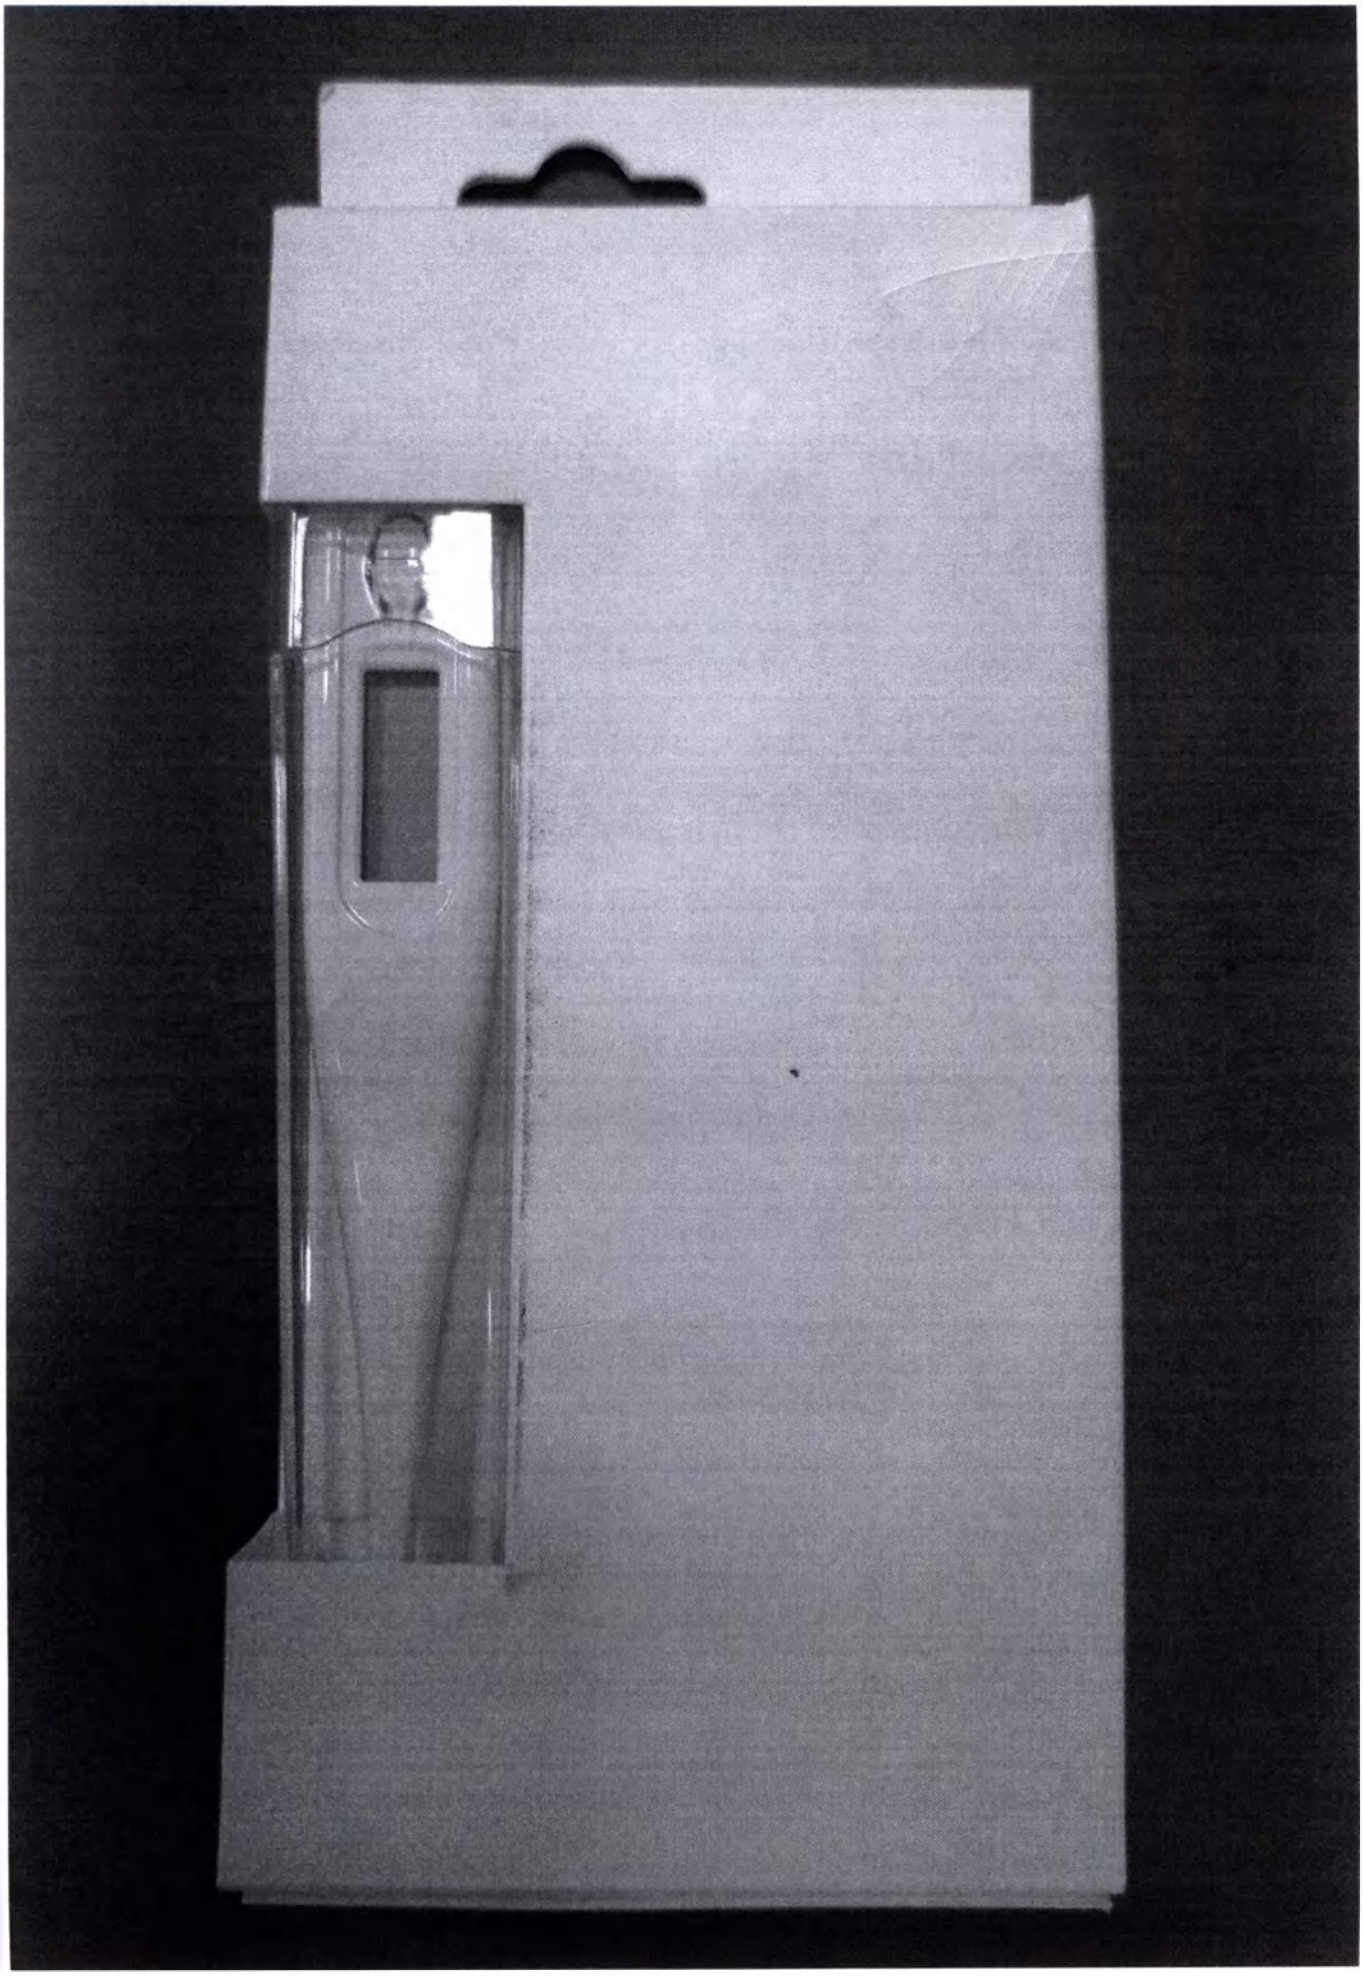

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Состав

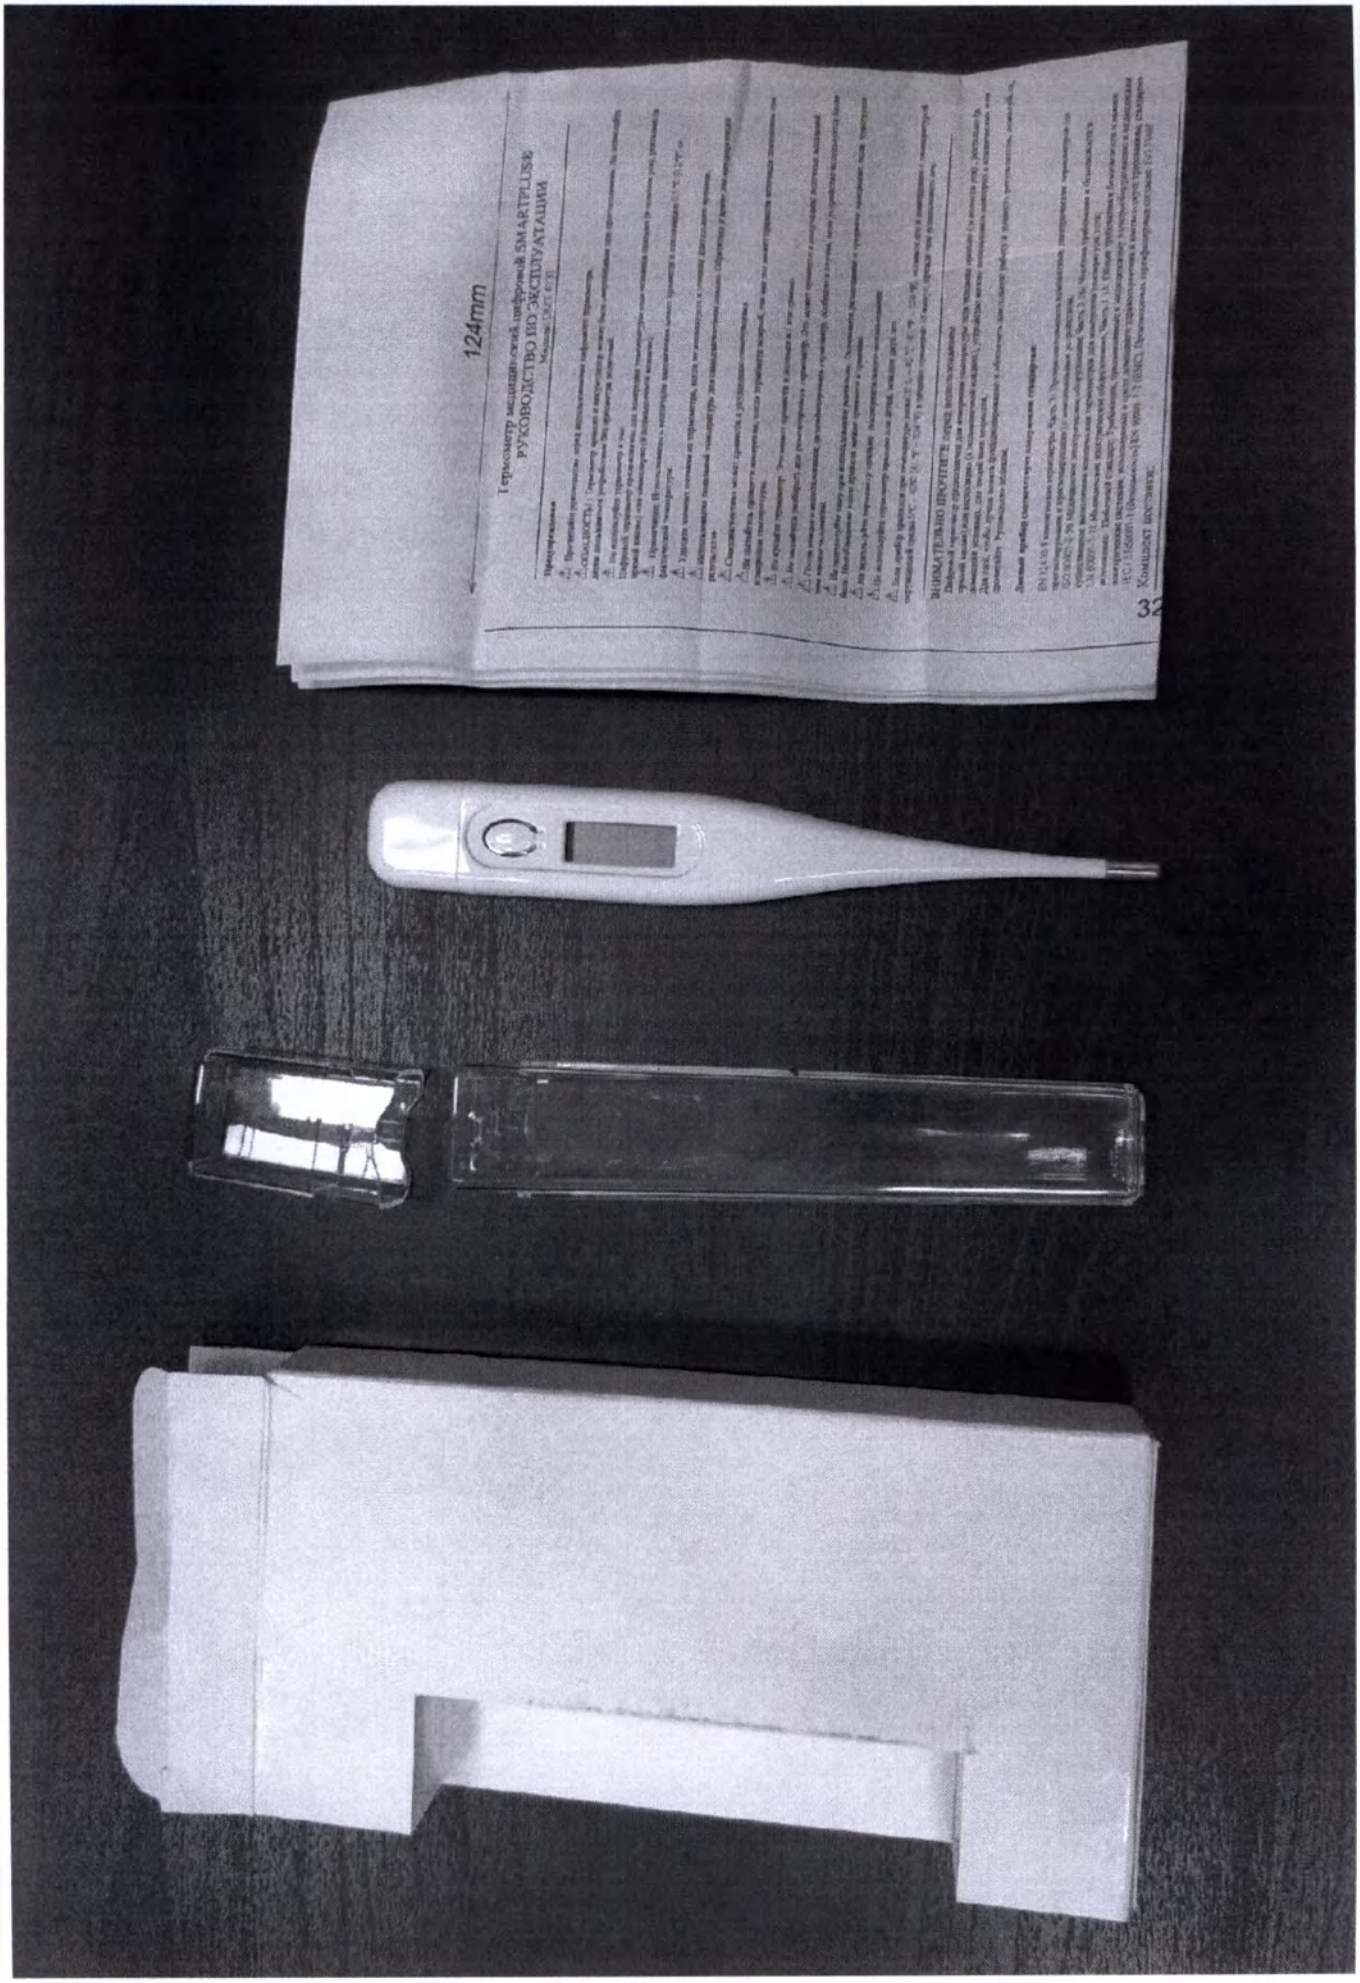

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский цифровой SMARTPLUS® DMT 4132

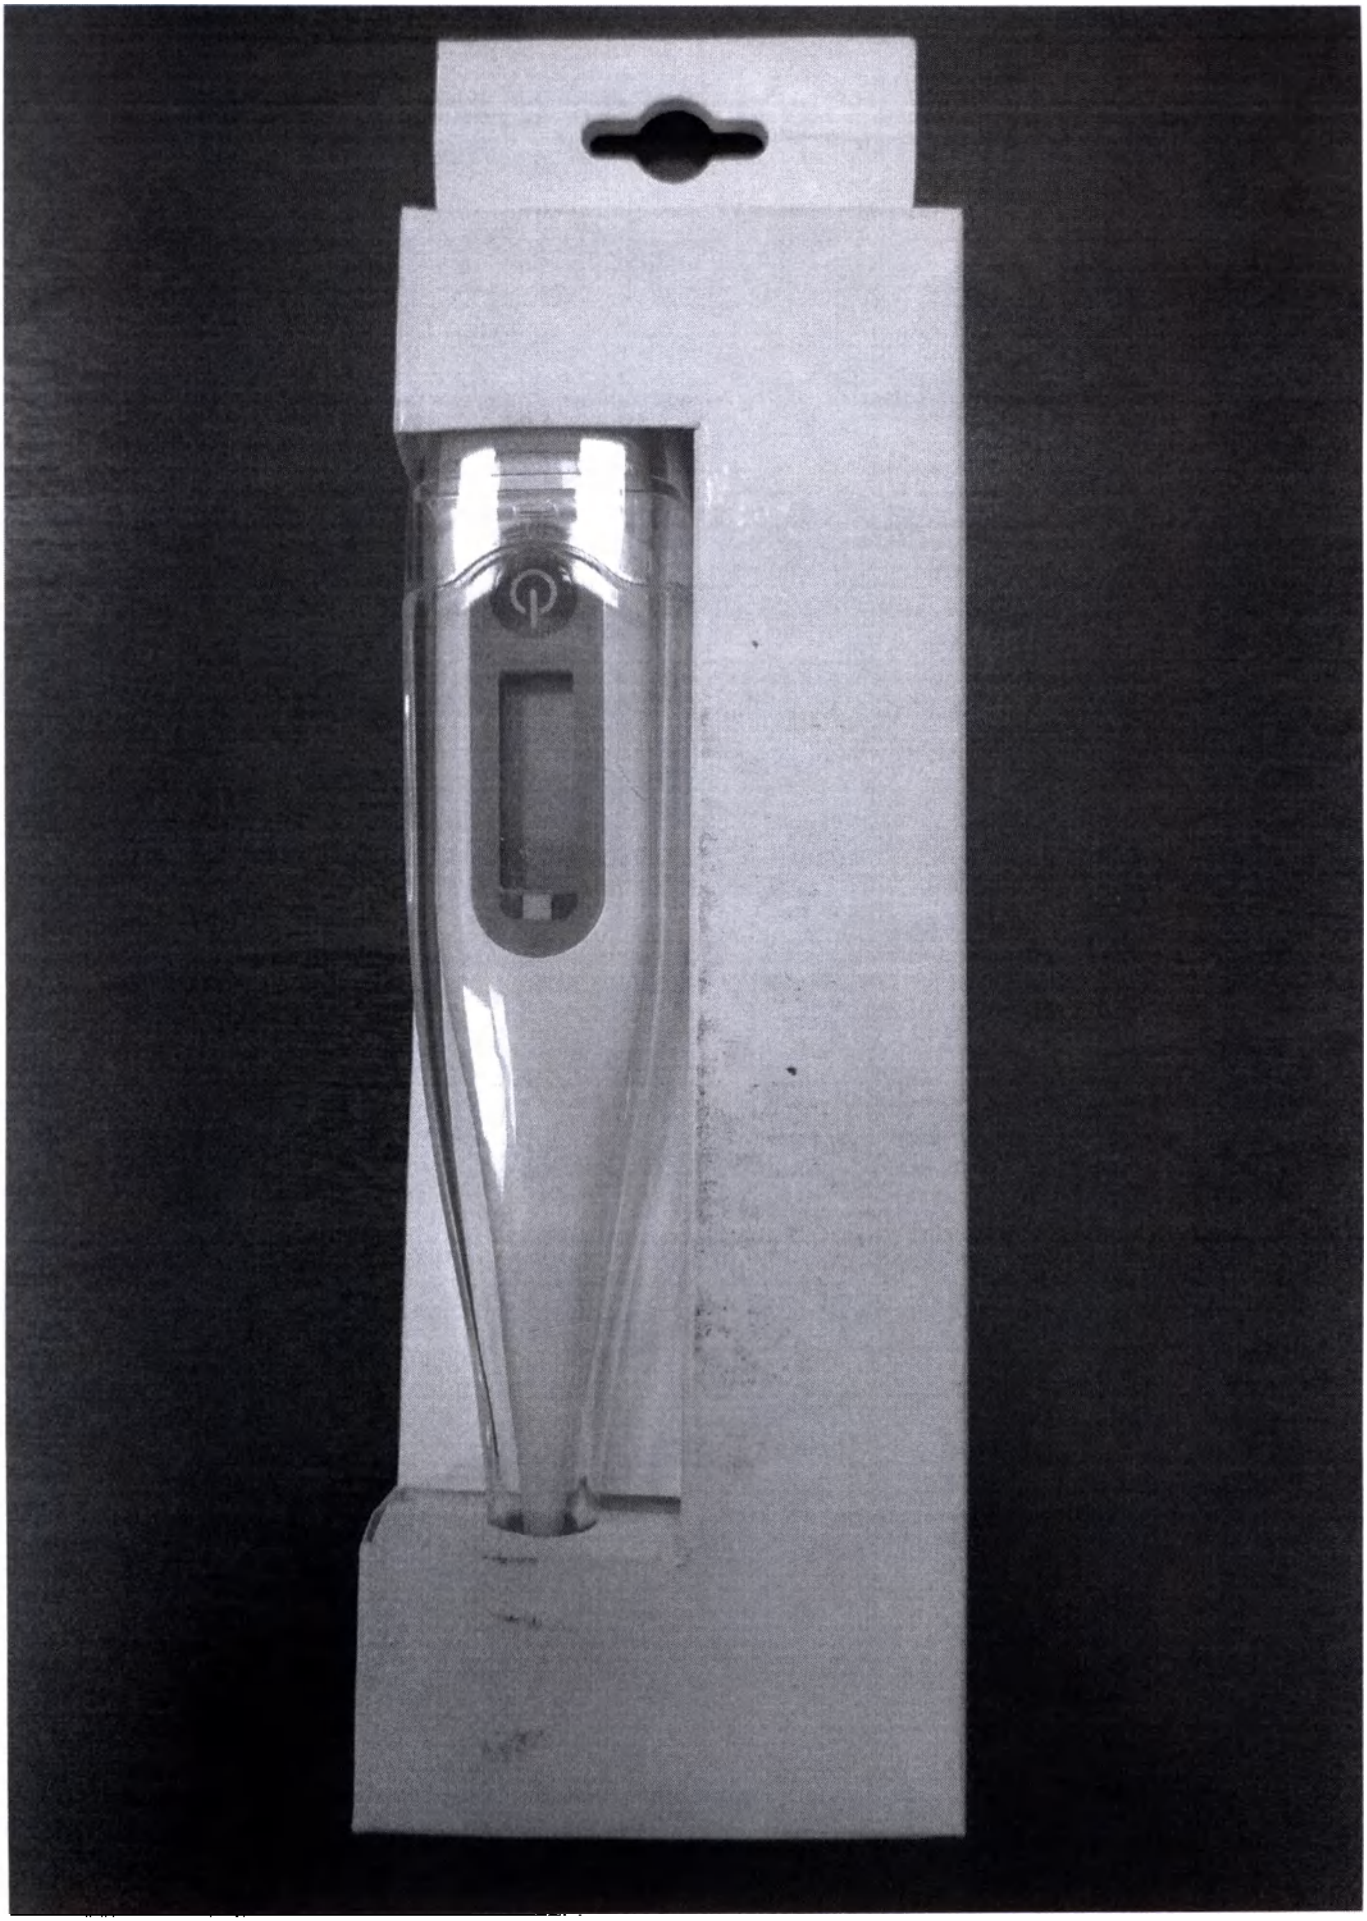

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Состав

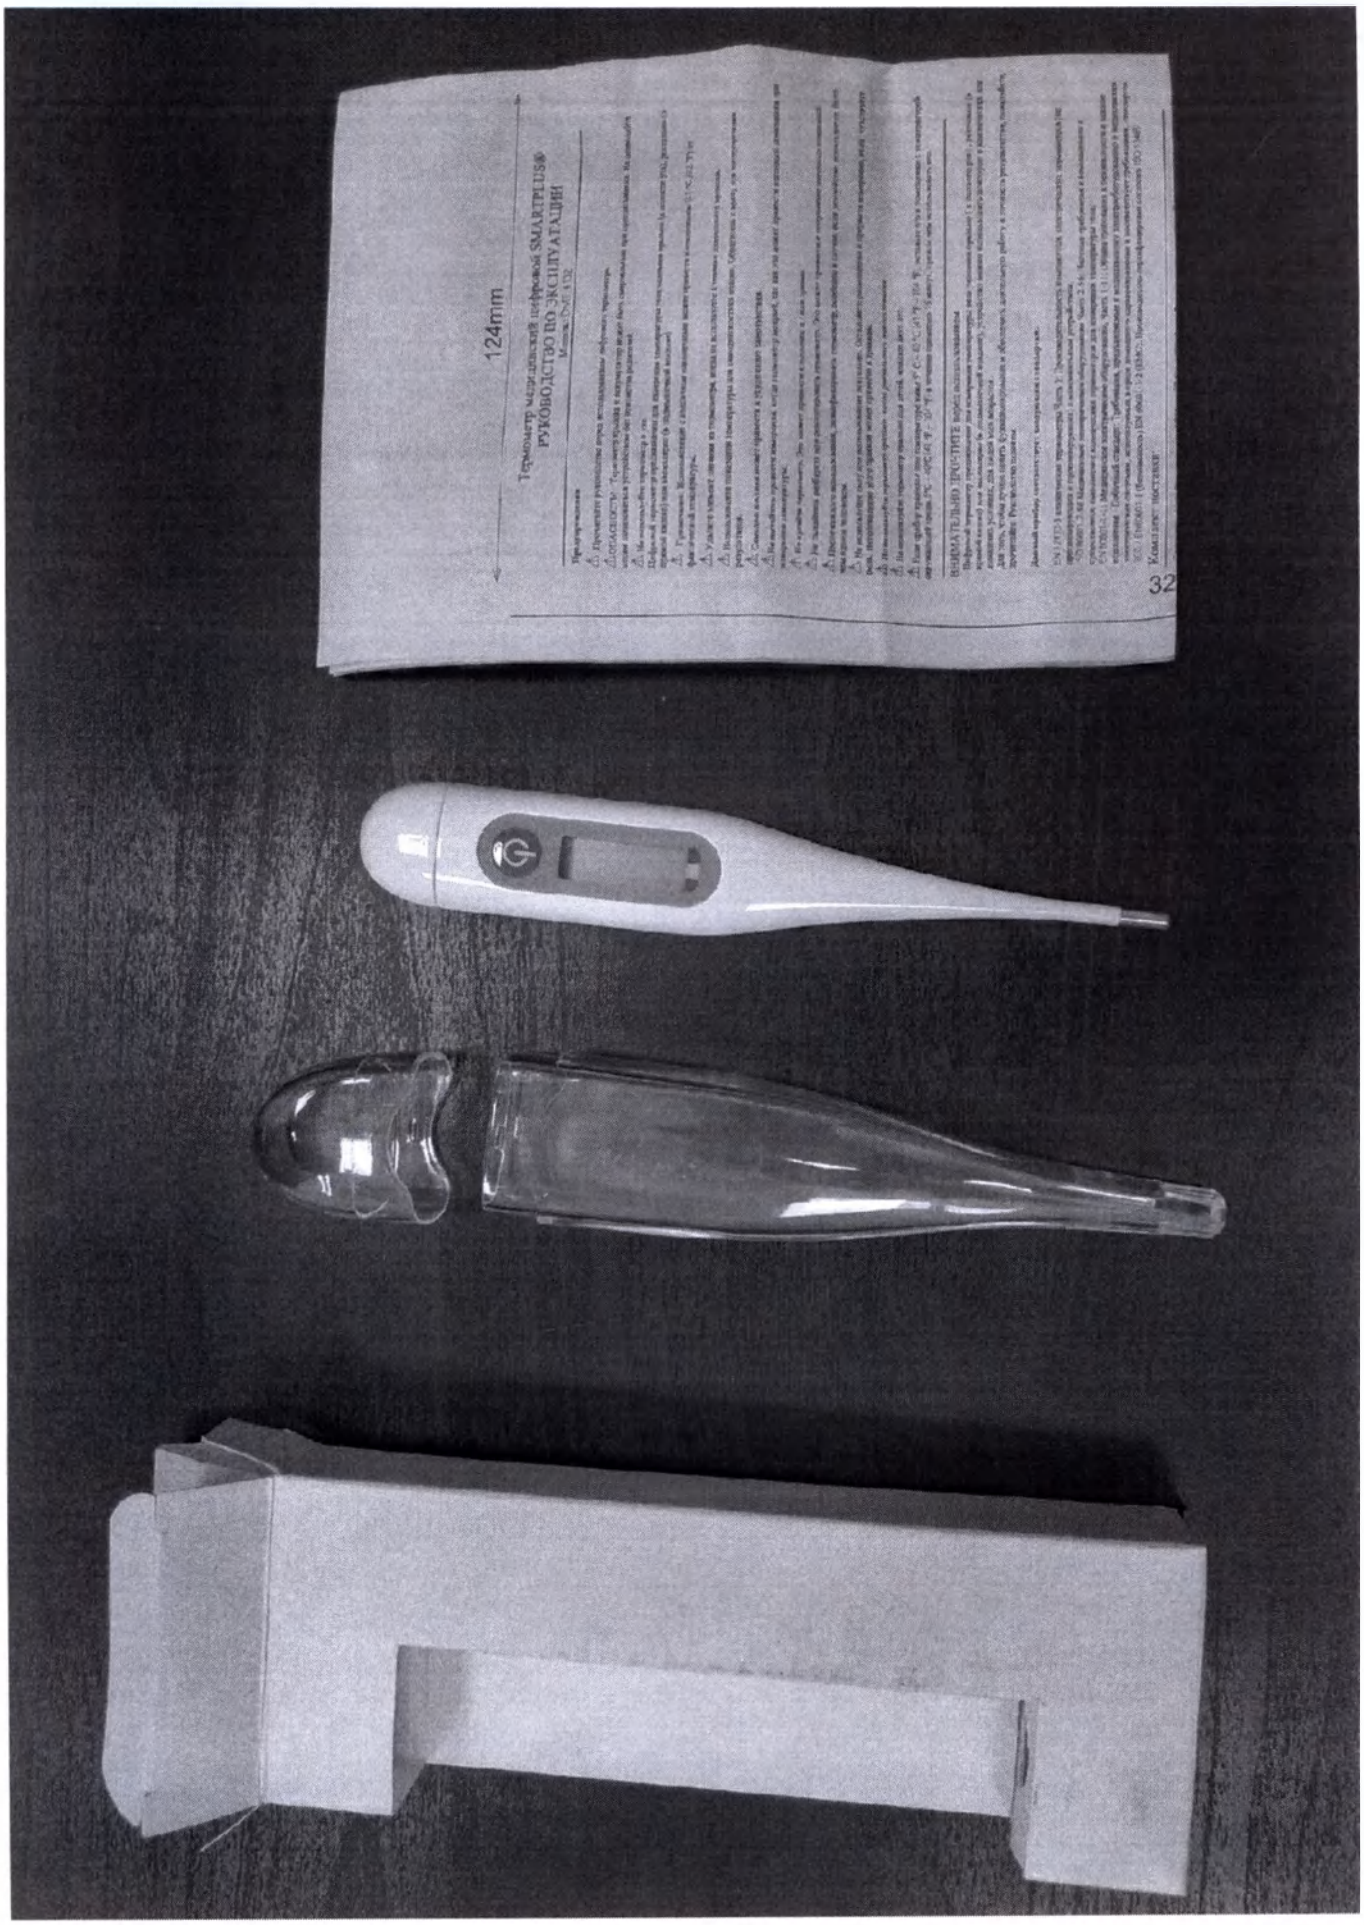

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский цифровой SMARTPLUS® DMT 4336

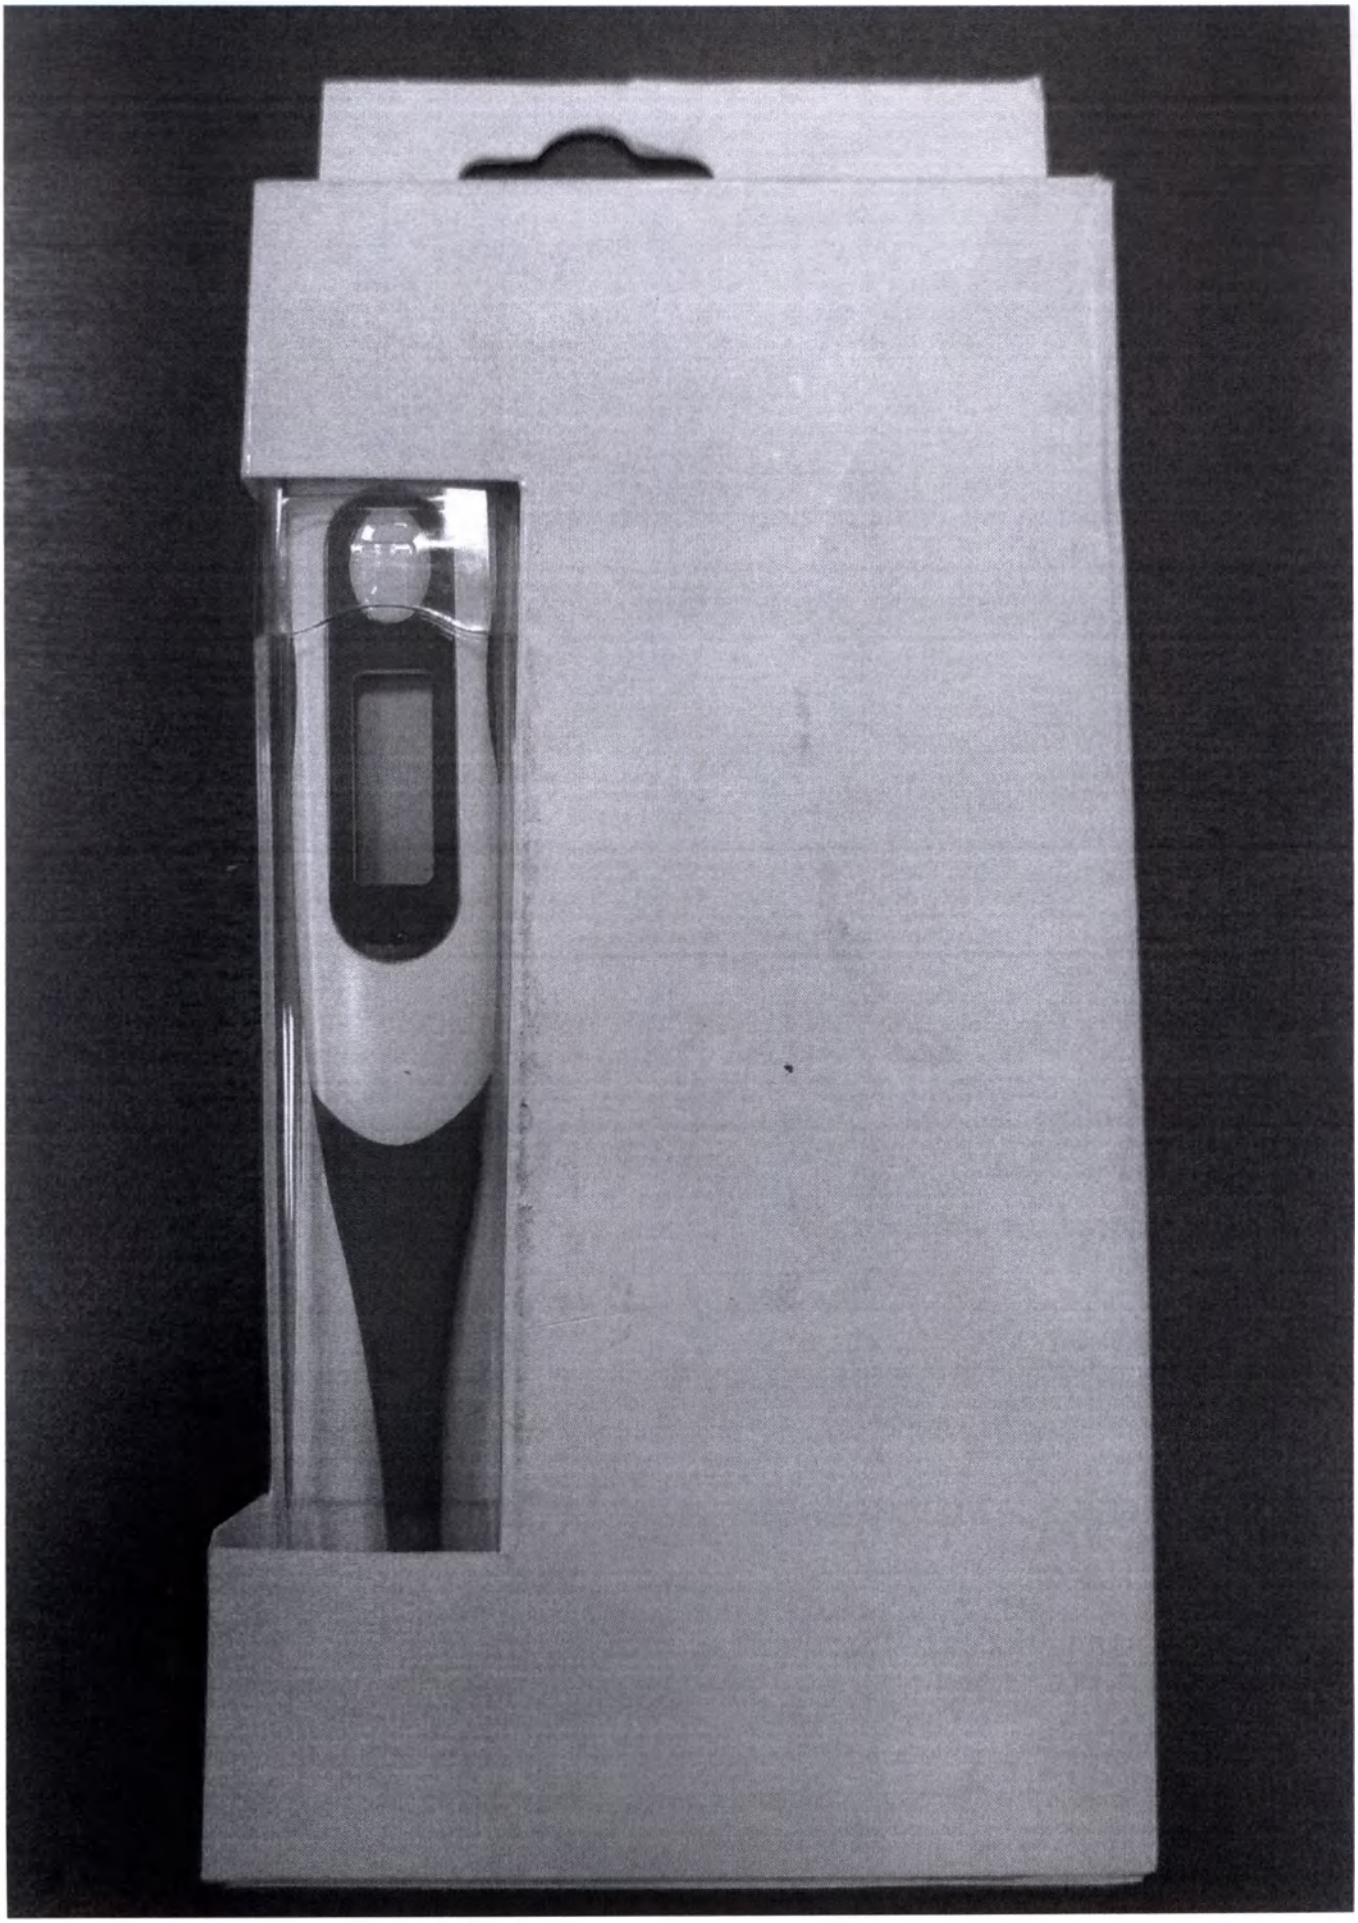

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Состав

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский цифровой SMARTPLUS® DMT 437 Cow

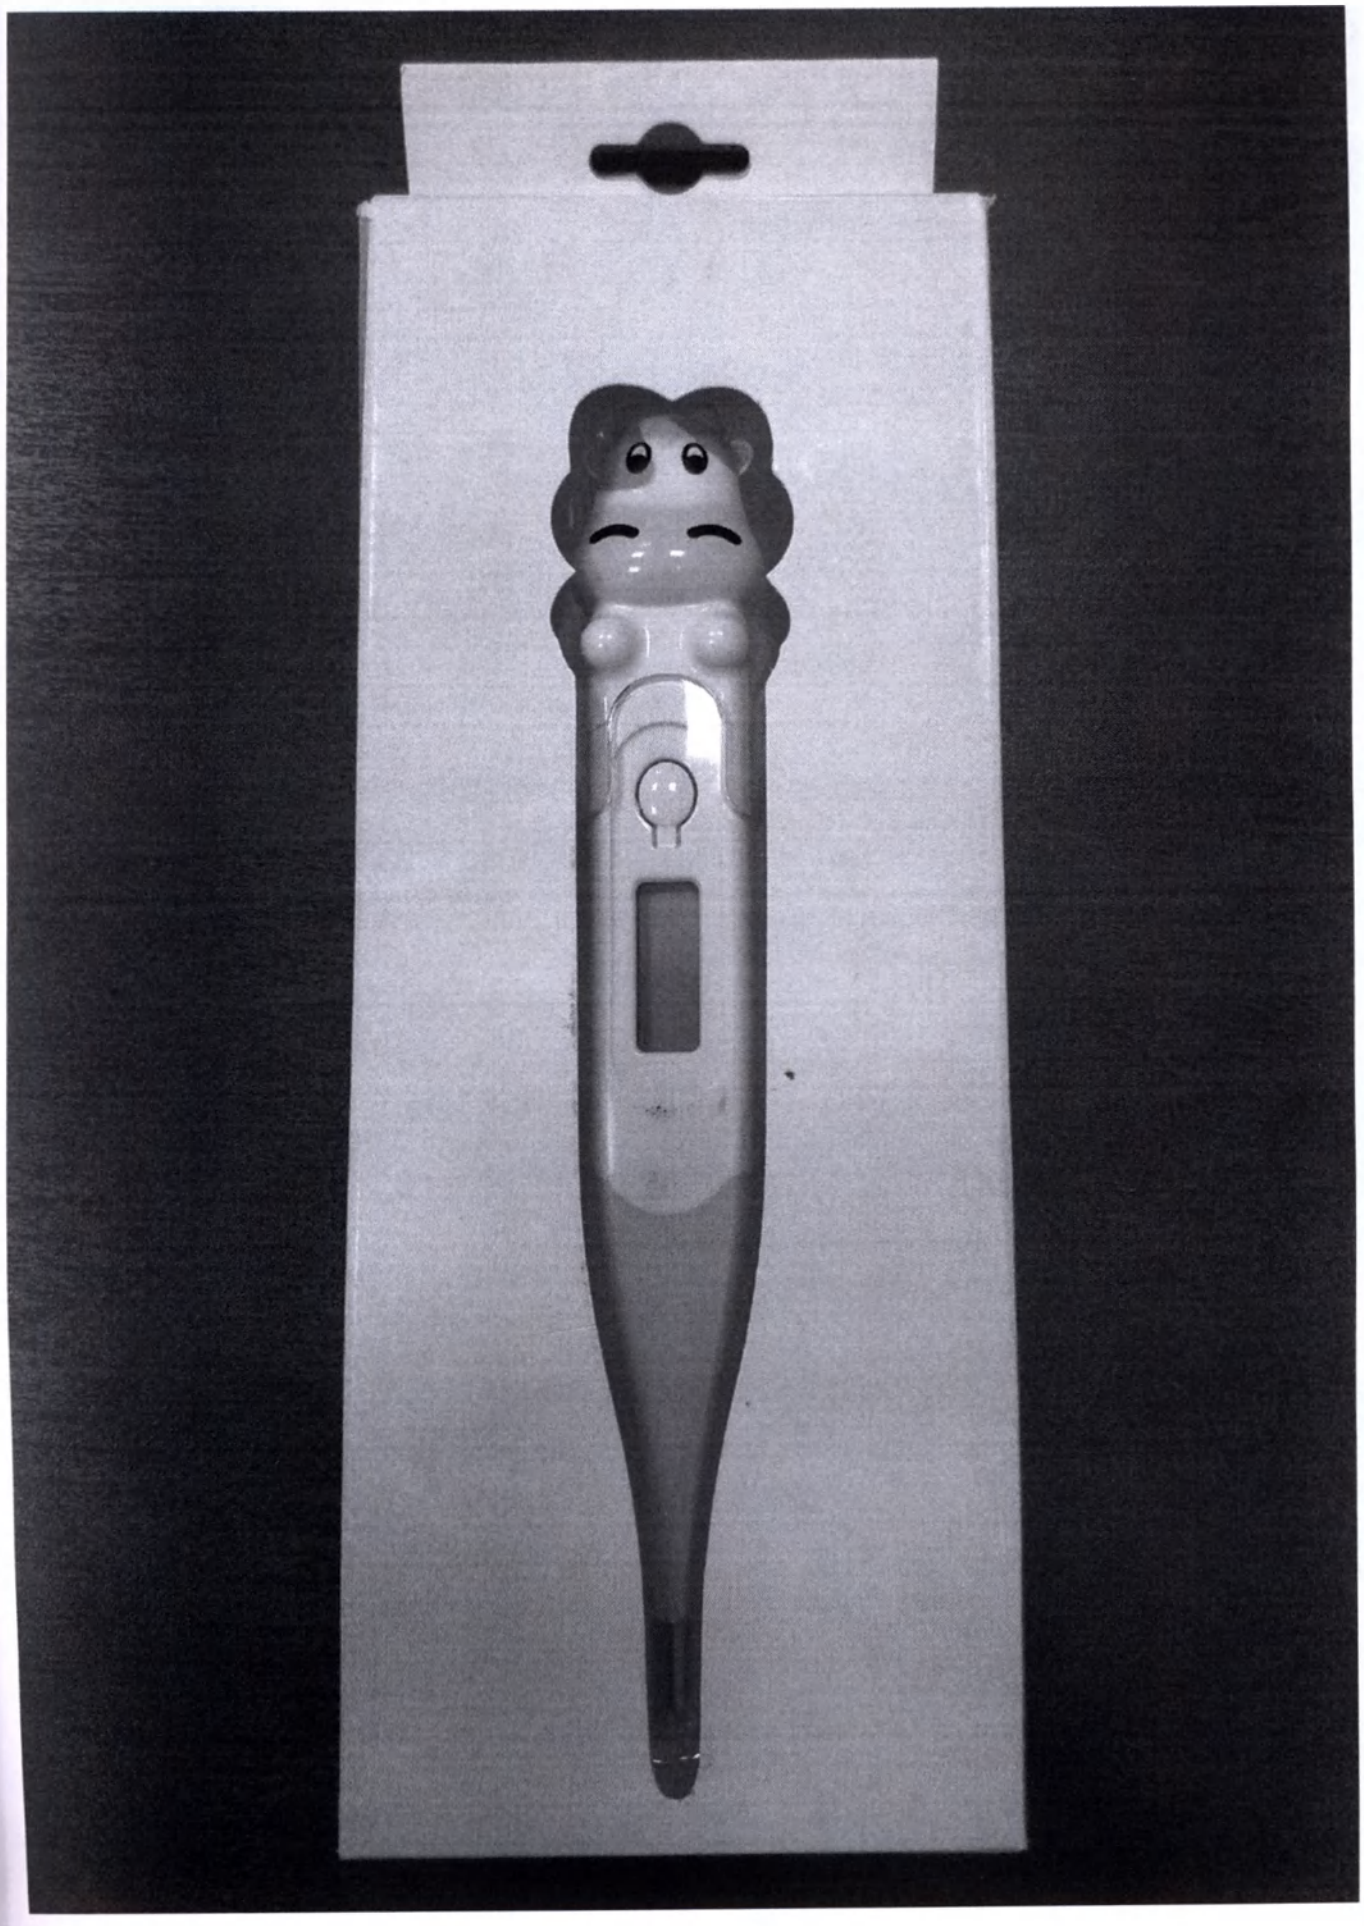

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Состав

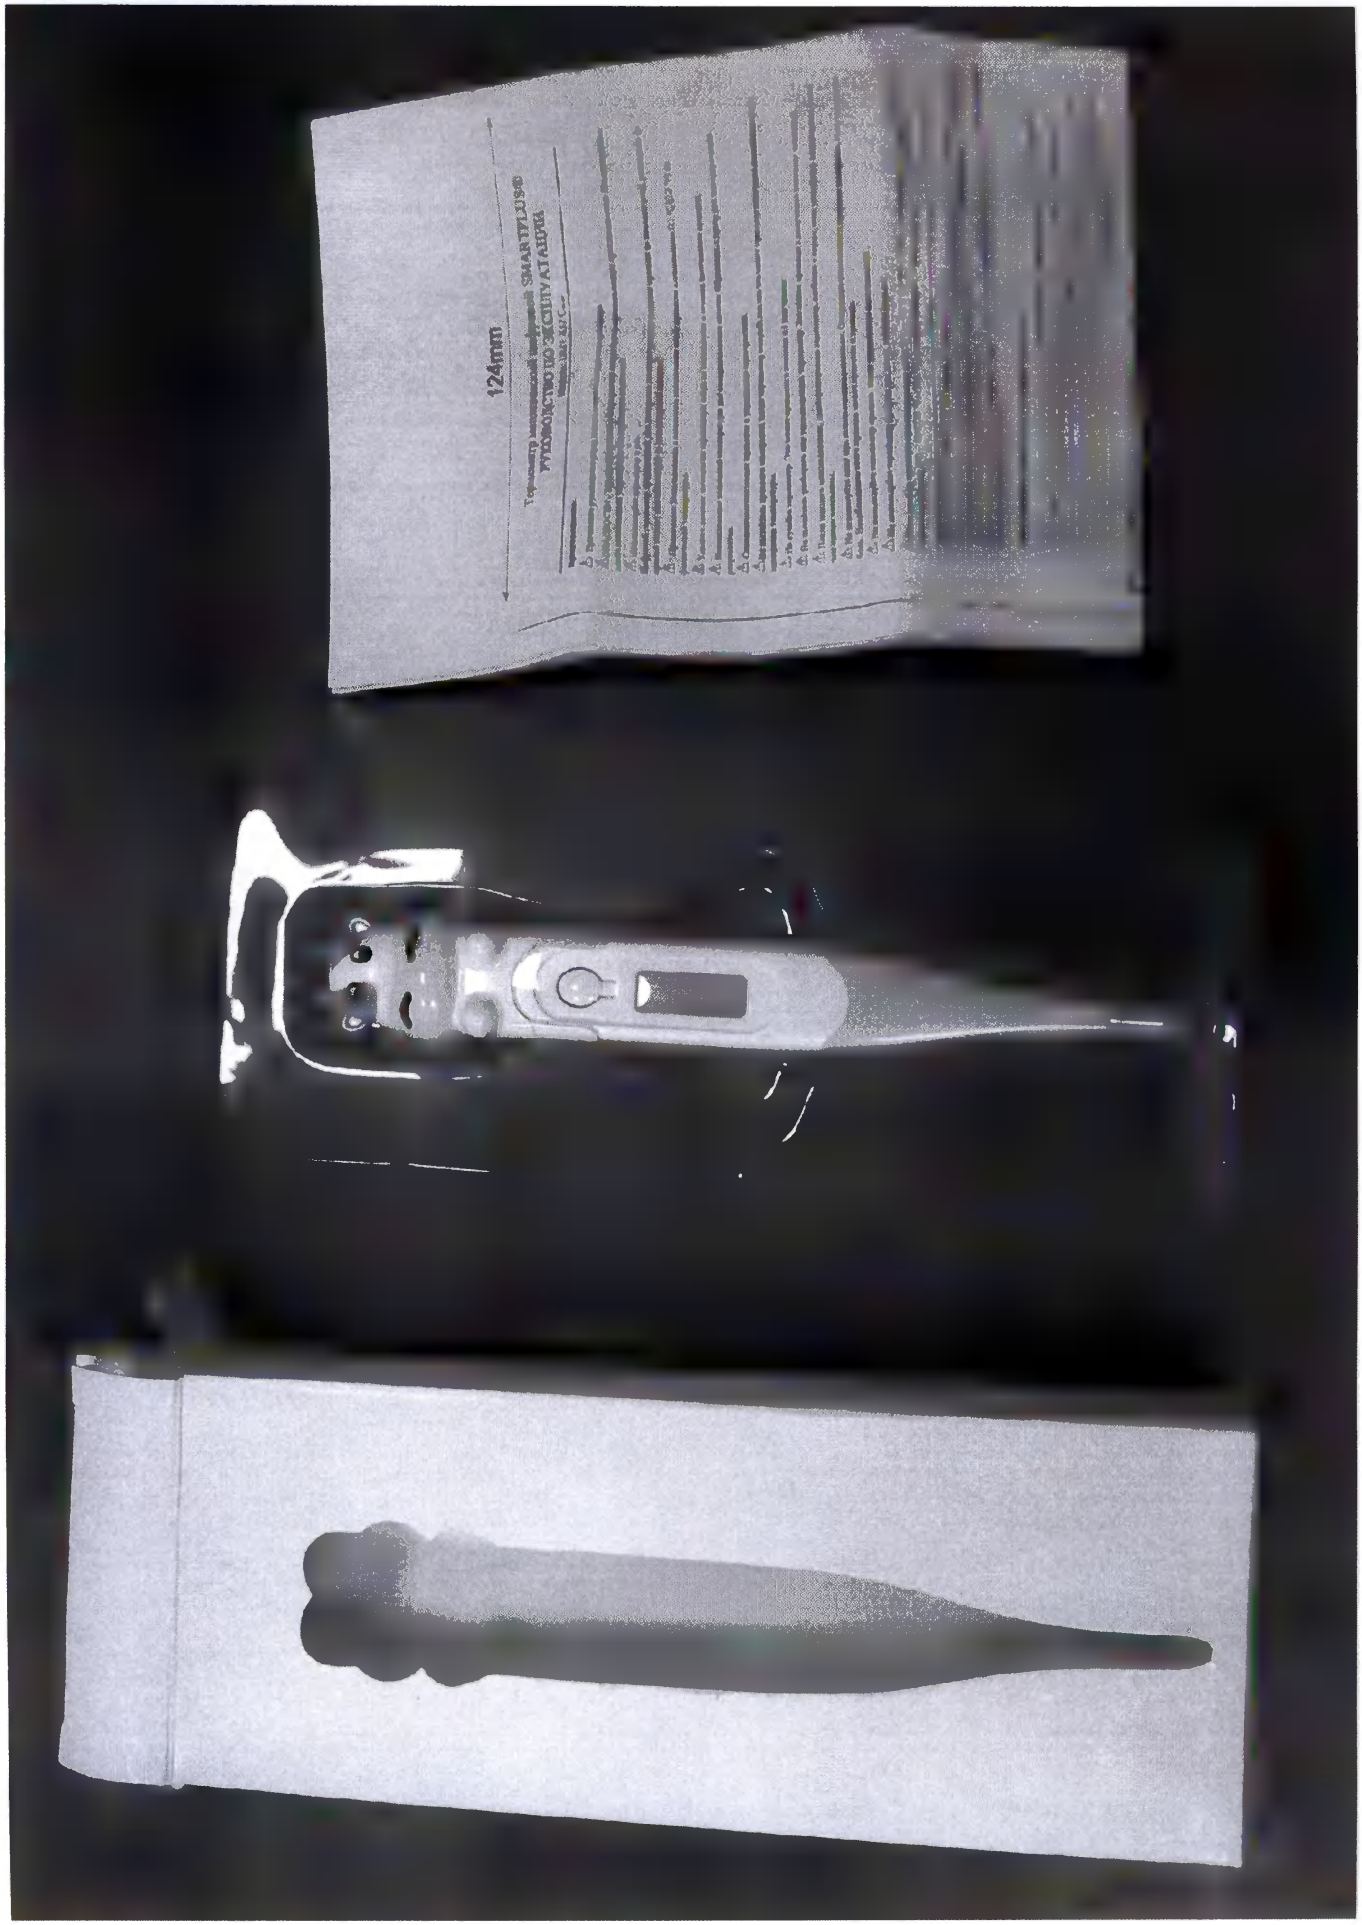

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский цифровой SMARTPLUS® DMT 437 Frog

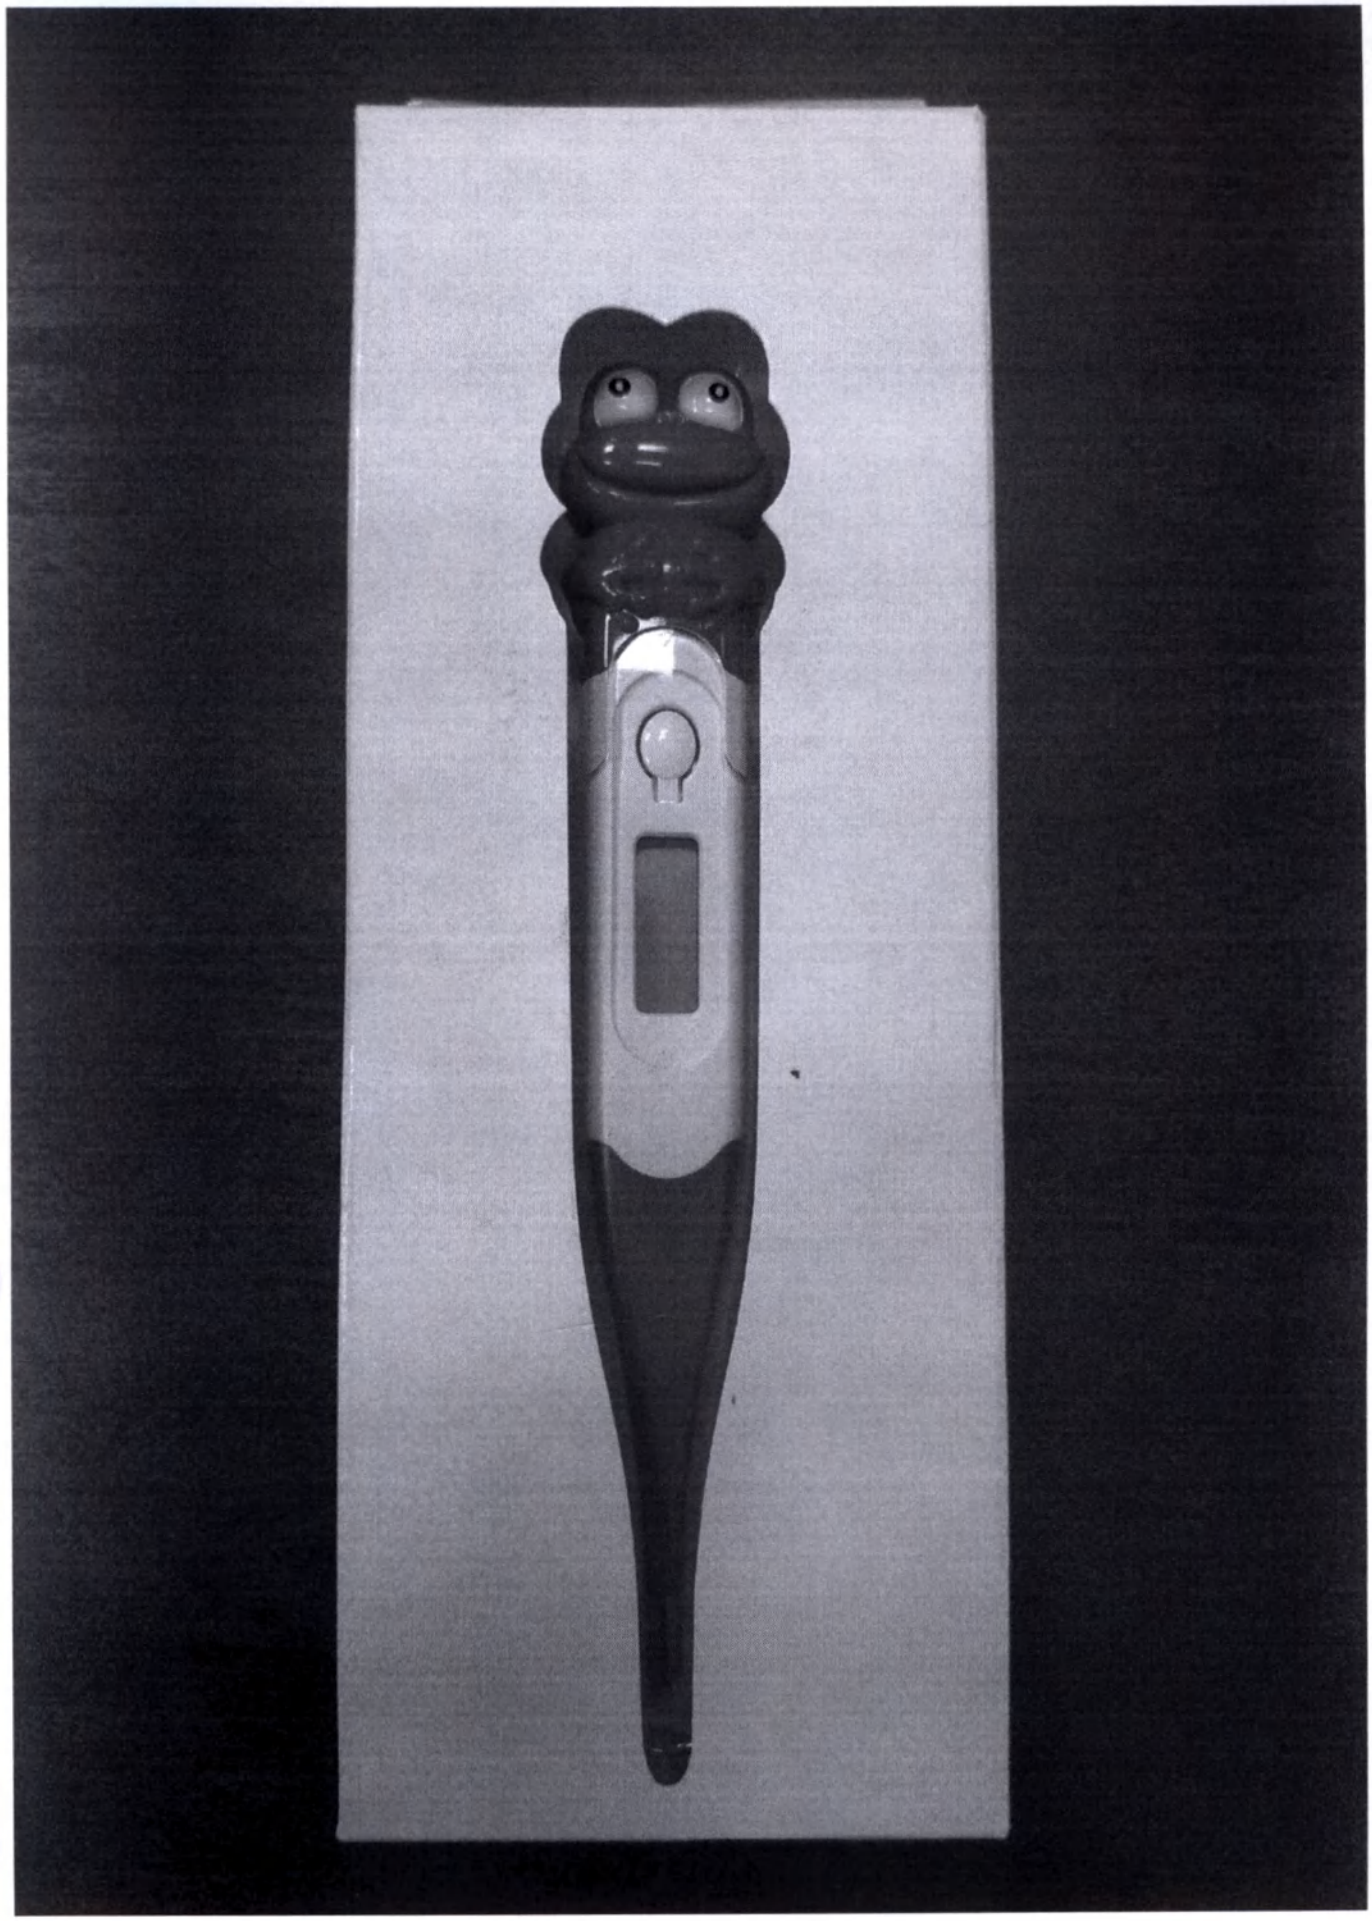

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Состав

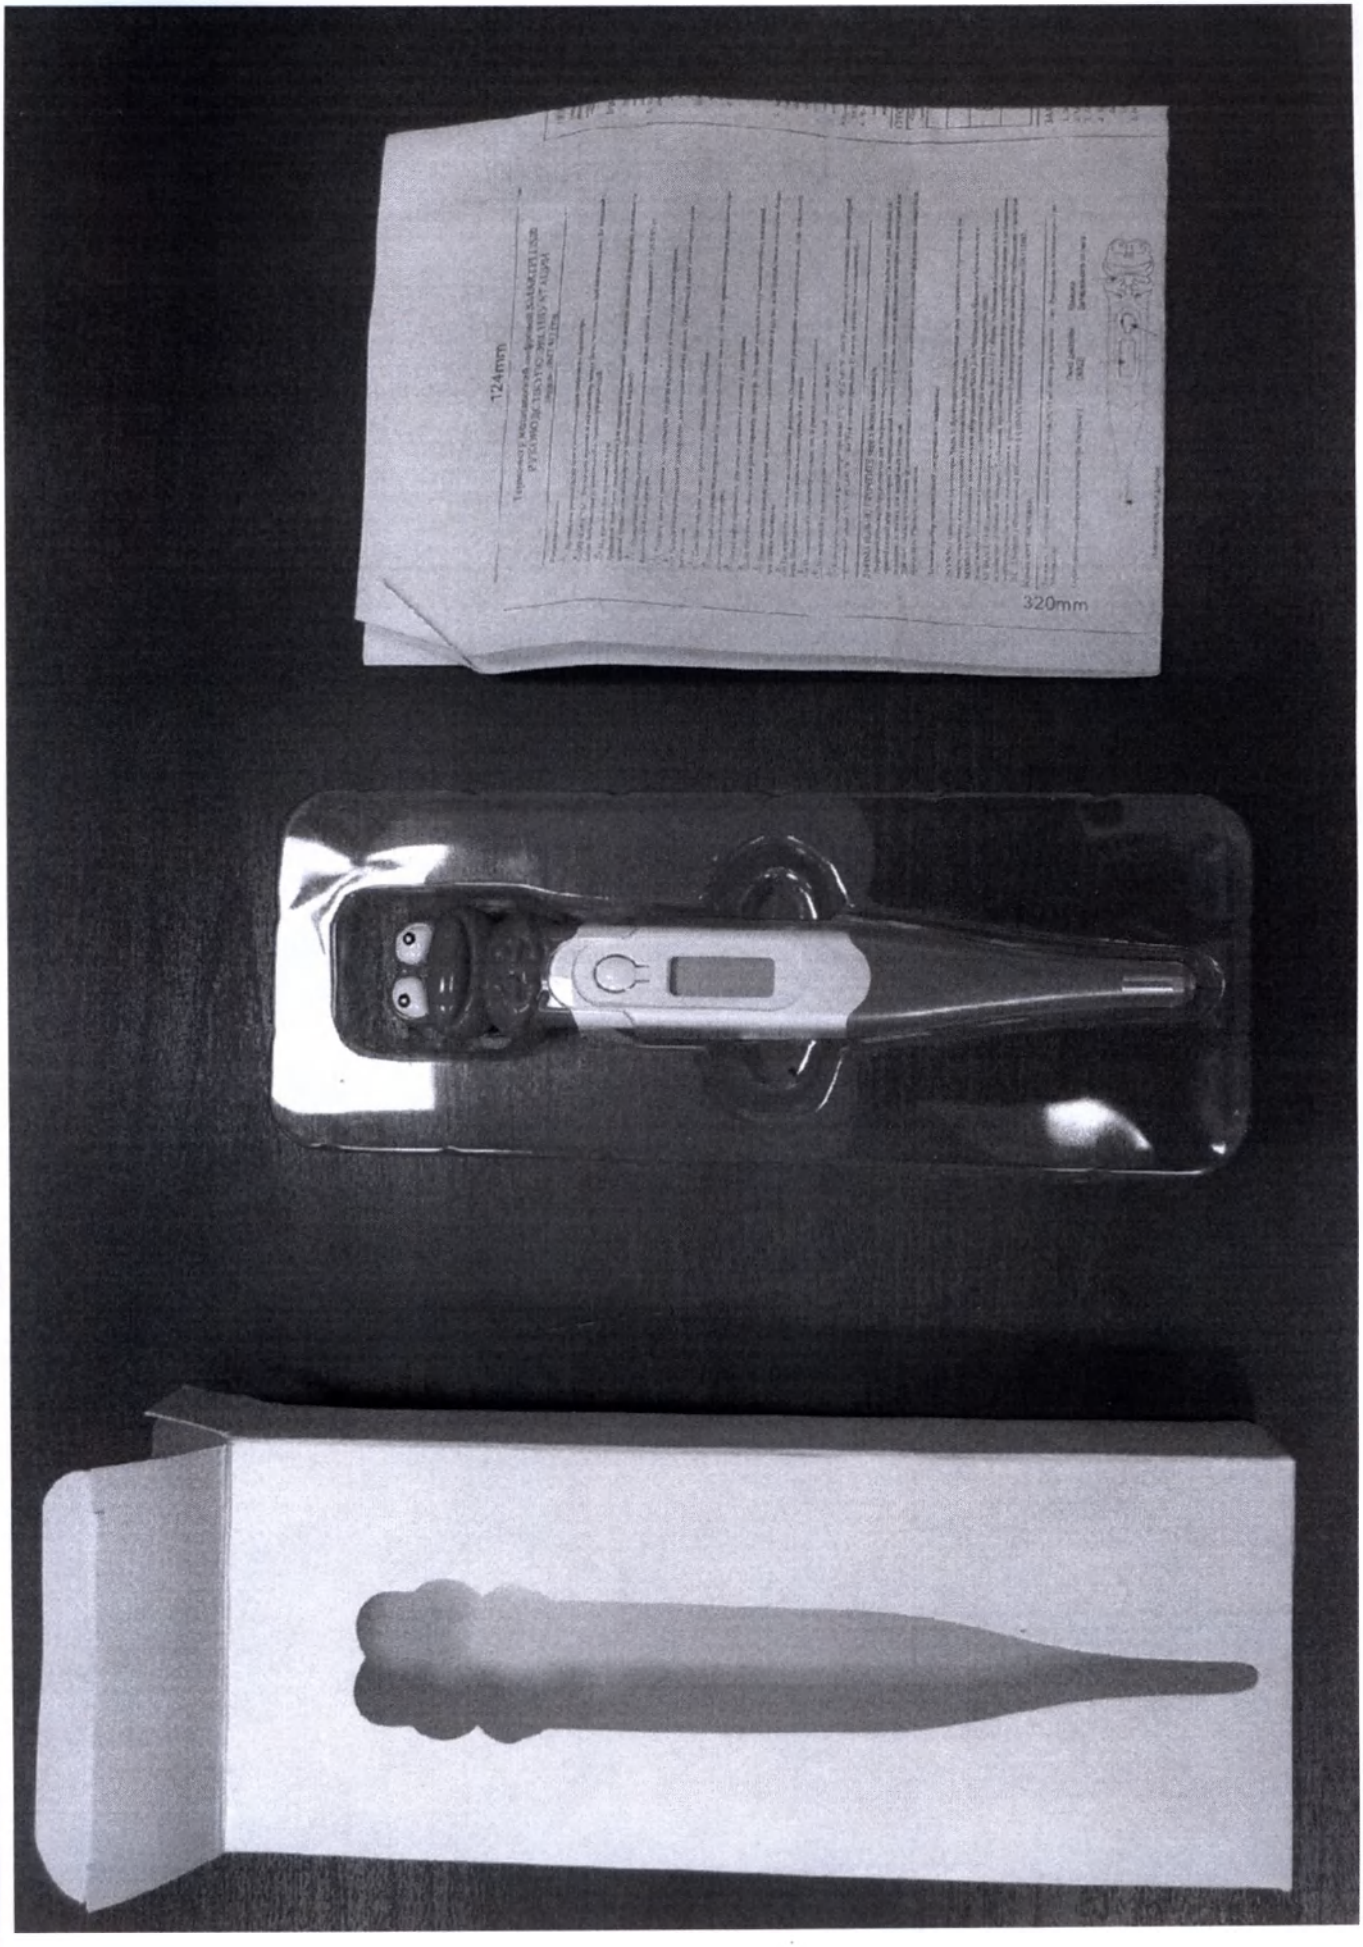

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Элемент питания LR41 или SR 41 или 392

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации

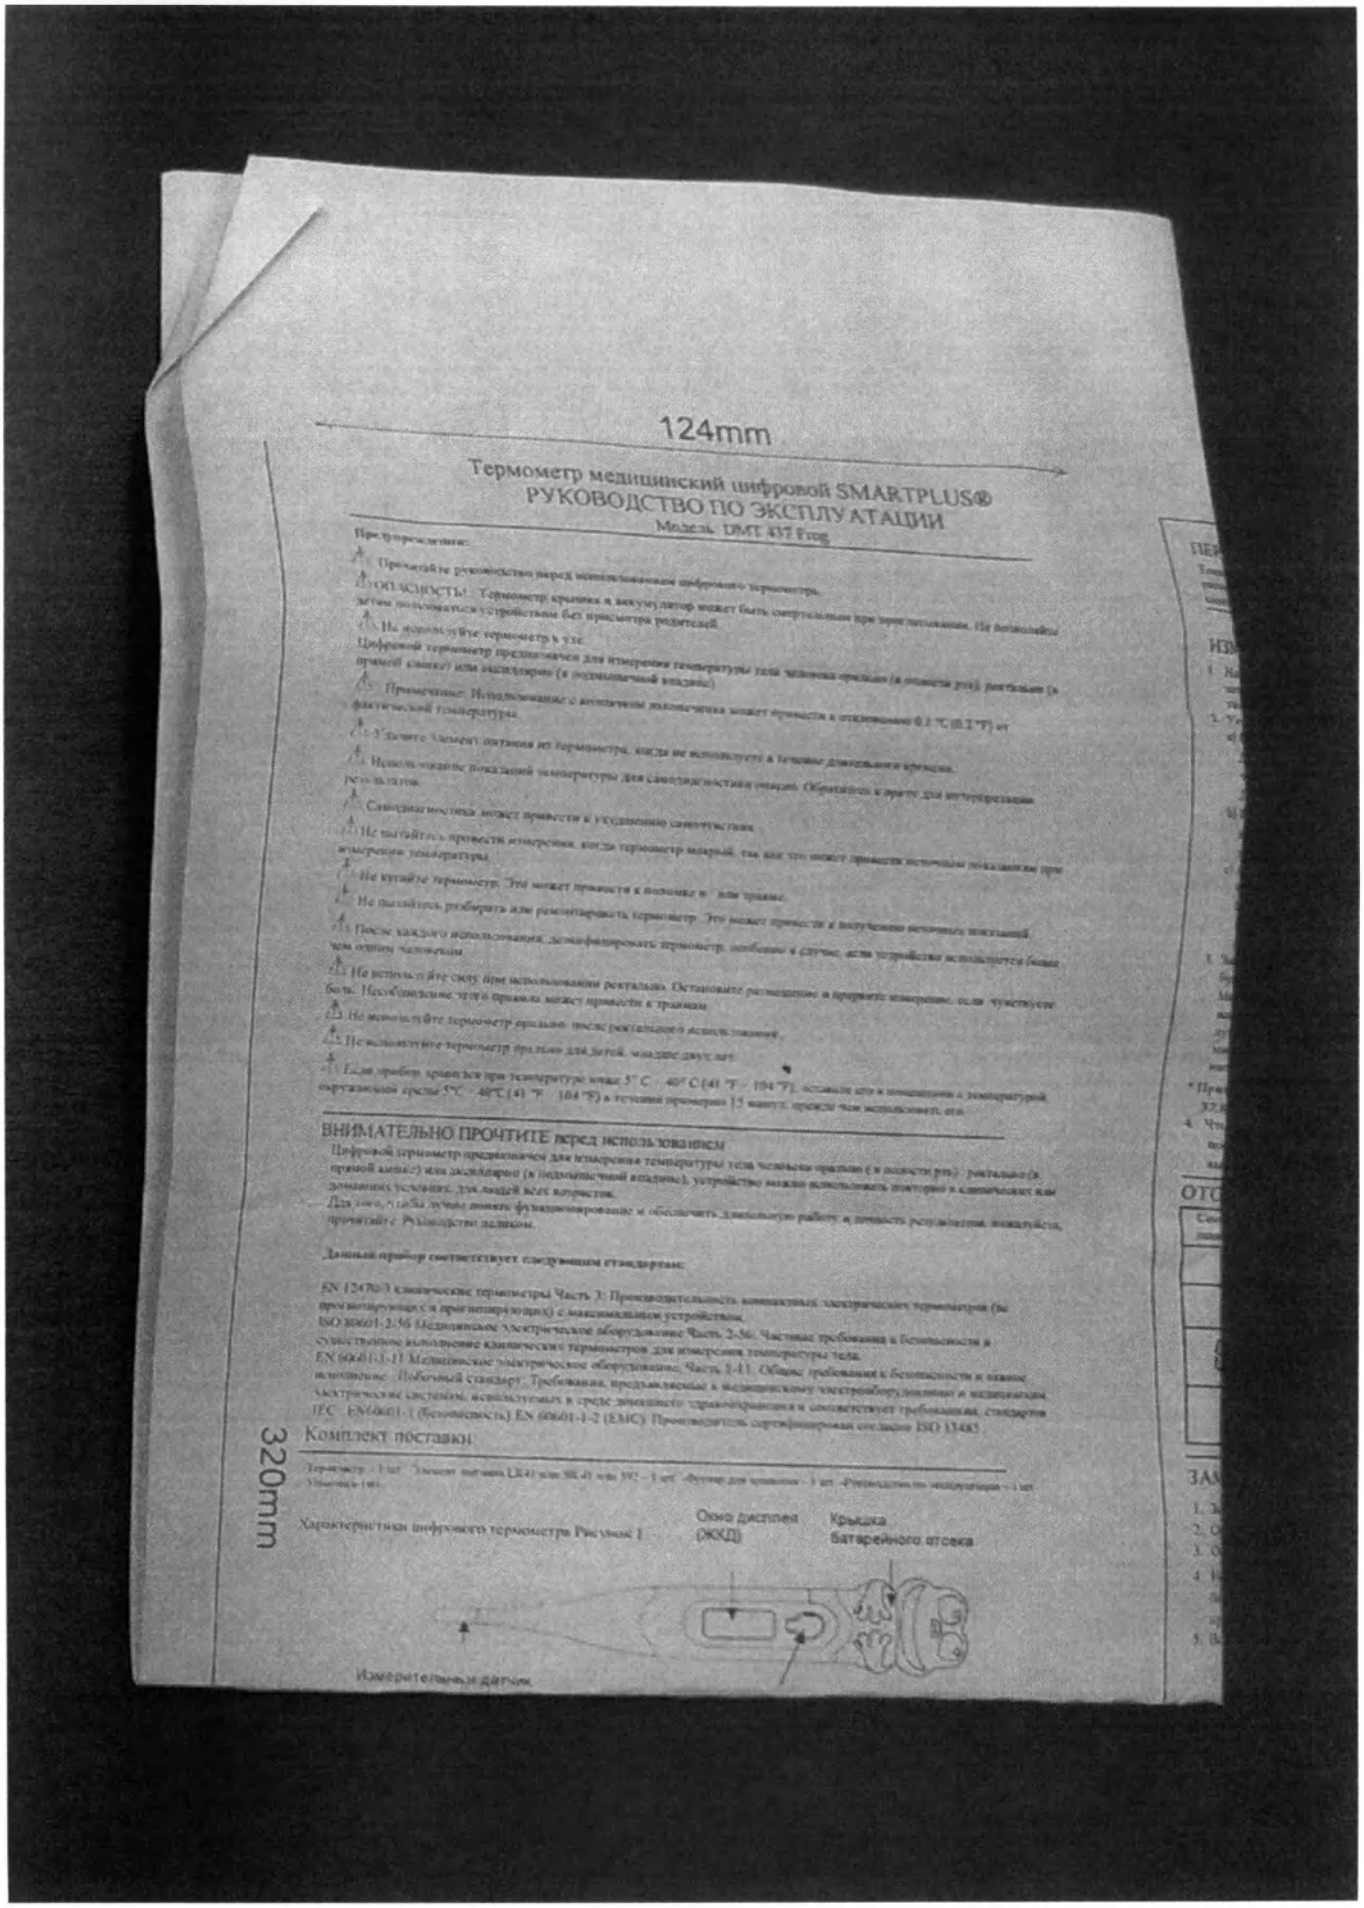

124mm

Термометр медицинский цифровой SMARTPLUS®
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель DMT 437 Frog

Предупреждения:

Прочитайте руководство перед использованием цифрового термометра.

ОСТОРОЖНОСТЬ! Термометр крышка и аккумулятор может быть смертельным при проглатывании. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра родителей.

Не используйте термометр в ухе.

Цифровой термометр предназначен для измерения температуры тела человека оральным (в полости рта), ректальным (в прямой кишке) или аксиллярном (в подмышечной впадине).

Примечание: Использование с аксиллярным положением может привести к отклонению 0.1 °C (0.2 °F) от фактической температуры.

Удалите элемент питания из термометра, когда не используете в течение длительного времени.

Используйте показаний температуры для самодиагностики опасно. Обратитесь к врачу для интерпретации результатов.

Самодиагностика может привести к усугублению самочувствия.

Не пытайтесь провести измерения, когда термометр мокрый, так как это может привести источнику показаниям при измерении температуры.

Не кусайте термометр. Это может привести к ожогам и / или травме.

Не пытайтесь разбирать или реминтировать термометр. Это может привести к получению неточных показаний.

После каждого использования, дезинфицировать термометр, особенно в случае, если устройство используется более чем одним человеком.

Не используйте силу при использовании ректально. Остановите размещение и прервите измерение, если чувствуете боль. Несоблюдение этого правила может привести к травмам.

Не используйте термометр оральной после ректального использования.

Не используйте термометр оральной для детей, младше двух лет.

Если прибор хранился при температуре ниже 5° C 40° C (41 °F 104 °F), оставьте его в помещении с температурой окружающей среды 5°C 40°C (41 °F 104 °F) в течение примерно 15 минут, прежде чем использовать его.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ перед использованием

Цифровой термометр предназначен для измерения температуры тела человека оральным (в полости рта) ректальным (в прямой кишке) или аксиллярном (в подмышечной впадине), устройство можно использовать повторно в клинических или домашних условиях, для людей всех возрастов.

Для того, чтобы точно понять функционирование и обеспечить длительную работу и точность результатов, пожалуйста, прочитайте Руководство полном.

Данный прибор соответствует следующим стандартам:

EN 12470-3 клинические термометры Часть 3: Производительность компактных электрических термометров (без прогнозирующих (или прогнозирующих) с максимальным устройством.

ISO 80601-2-56 Медицинское электрическое оборудование Часть 2-56: Частные требования к безопасности и существенное исполнение клинических термометров для измерения температуры тела.

EN 60601-1-11 Медицинское электрическое оборудование, Часть 1-11: Общие требования к безопасности и важное исполнение - Побочный стандарт: Требования, предъявляемые к медицинскому электрооборудованию и медицинским электрическим системам, используемых в среде домашнего здравоохранения и соответствует требованиям, стандартам IEC EN60601-1 (Безопасность) EN 60601-1-2 (EMC) Производитель сертифицирован согласно ISO 13485.

320mm

Комплект поставки:

Термометр – 1 шт. Элемент питания LR41 или SR41 или 392 – 1 шт. Футляр для хранения – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Упаковка – 1 шт.

Характеристики цифрового термометра Рисунок 1

Окно дисплея (ЖКД)

Крышка батарейного отсека

Измерительный датчик

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки на русском языке

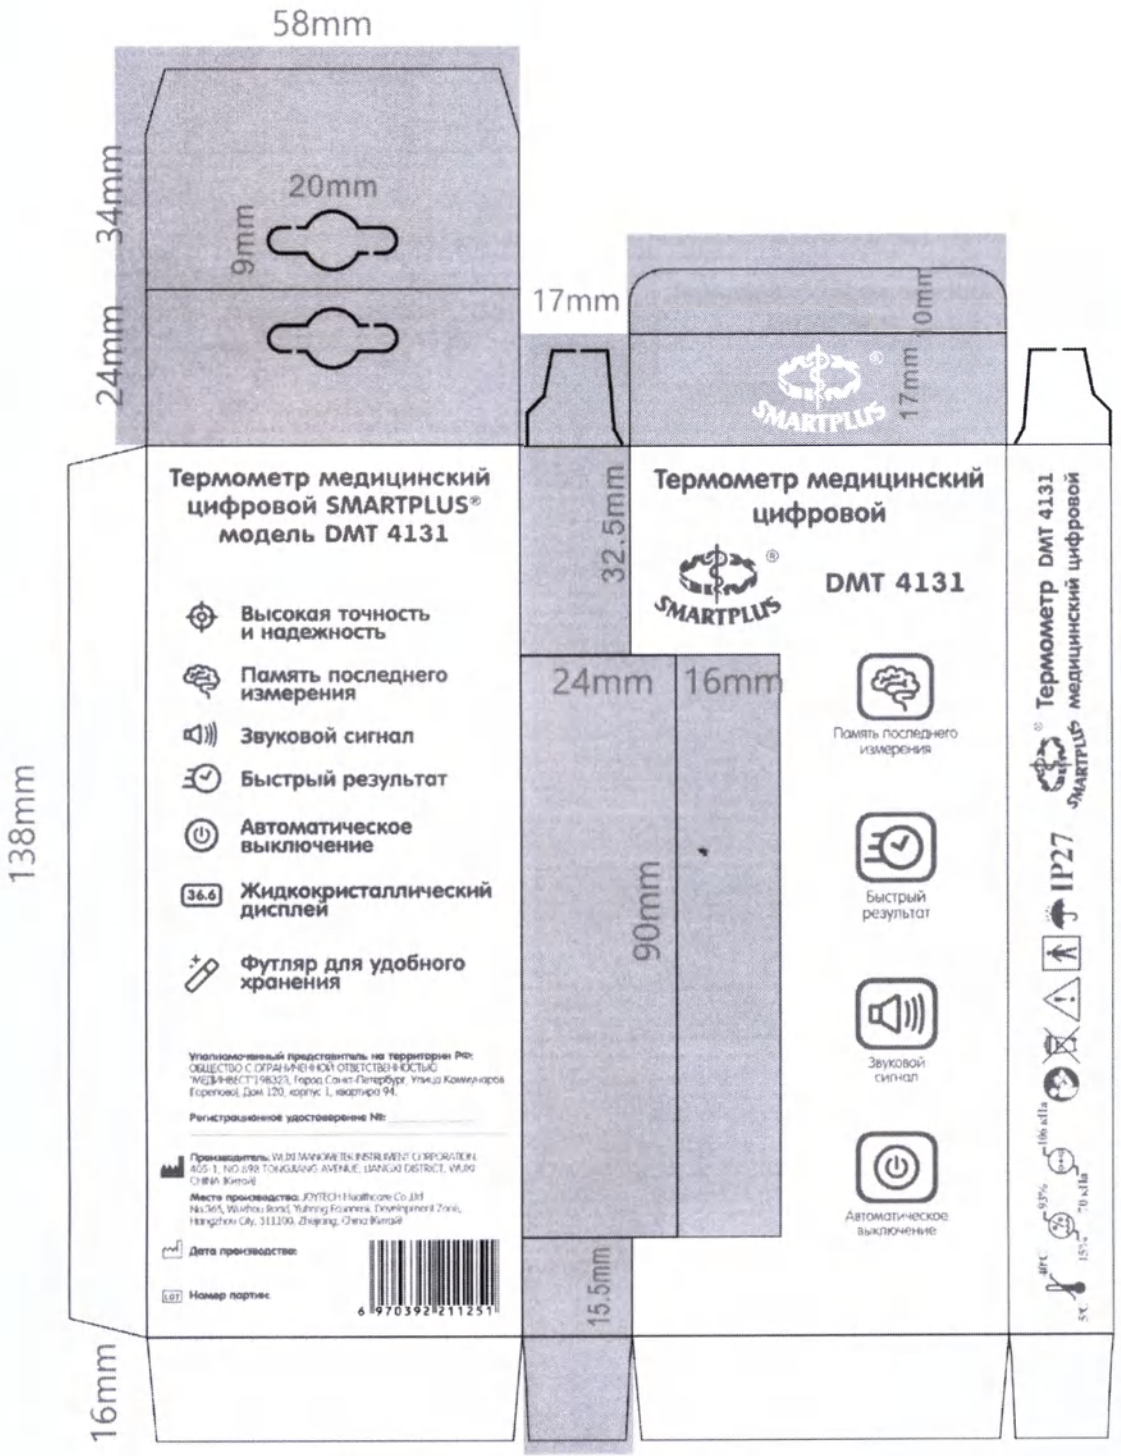

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

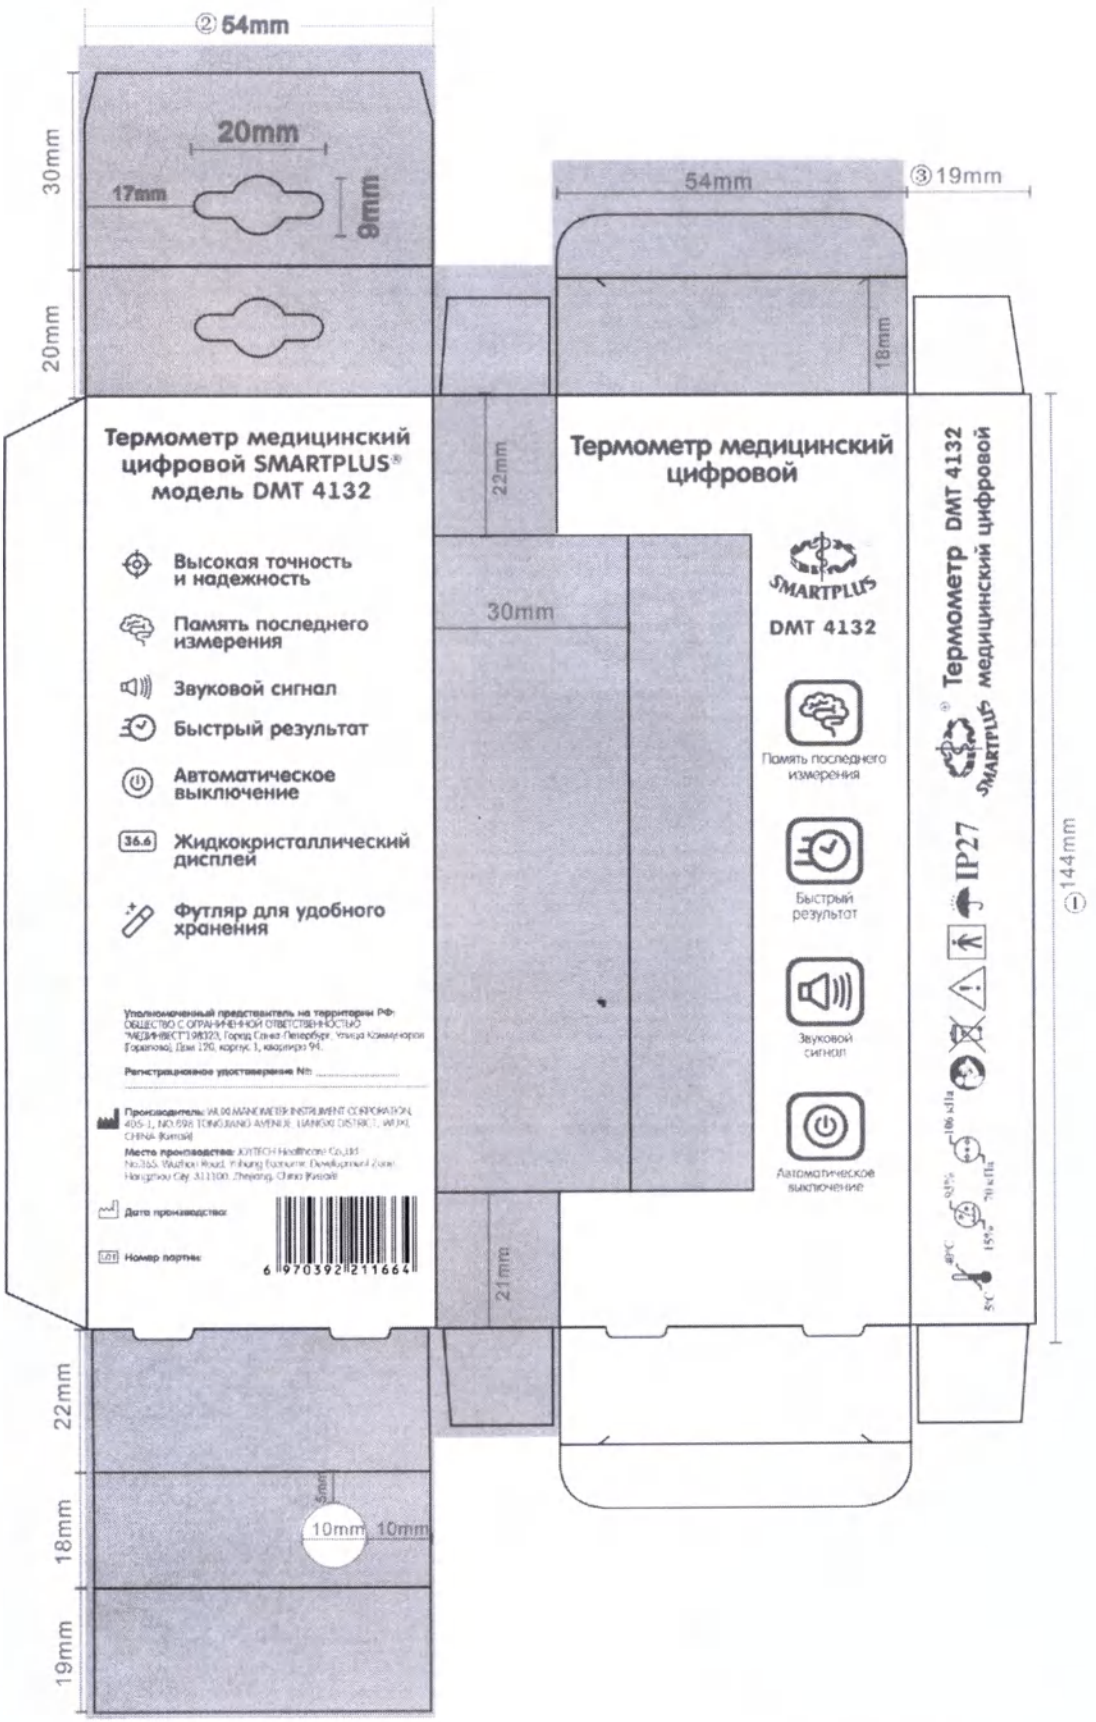

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

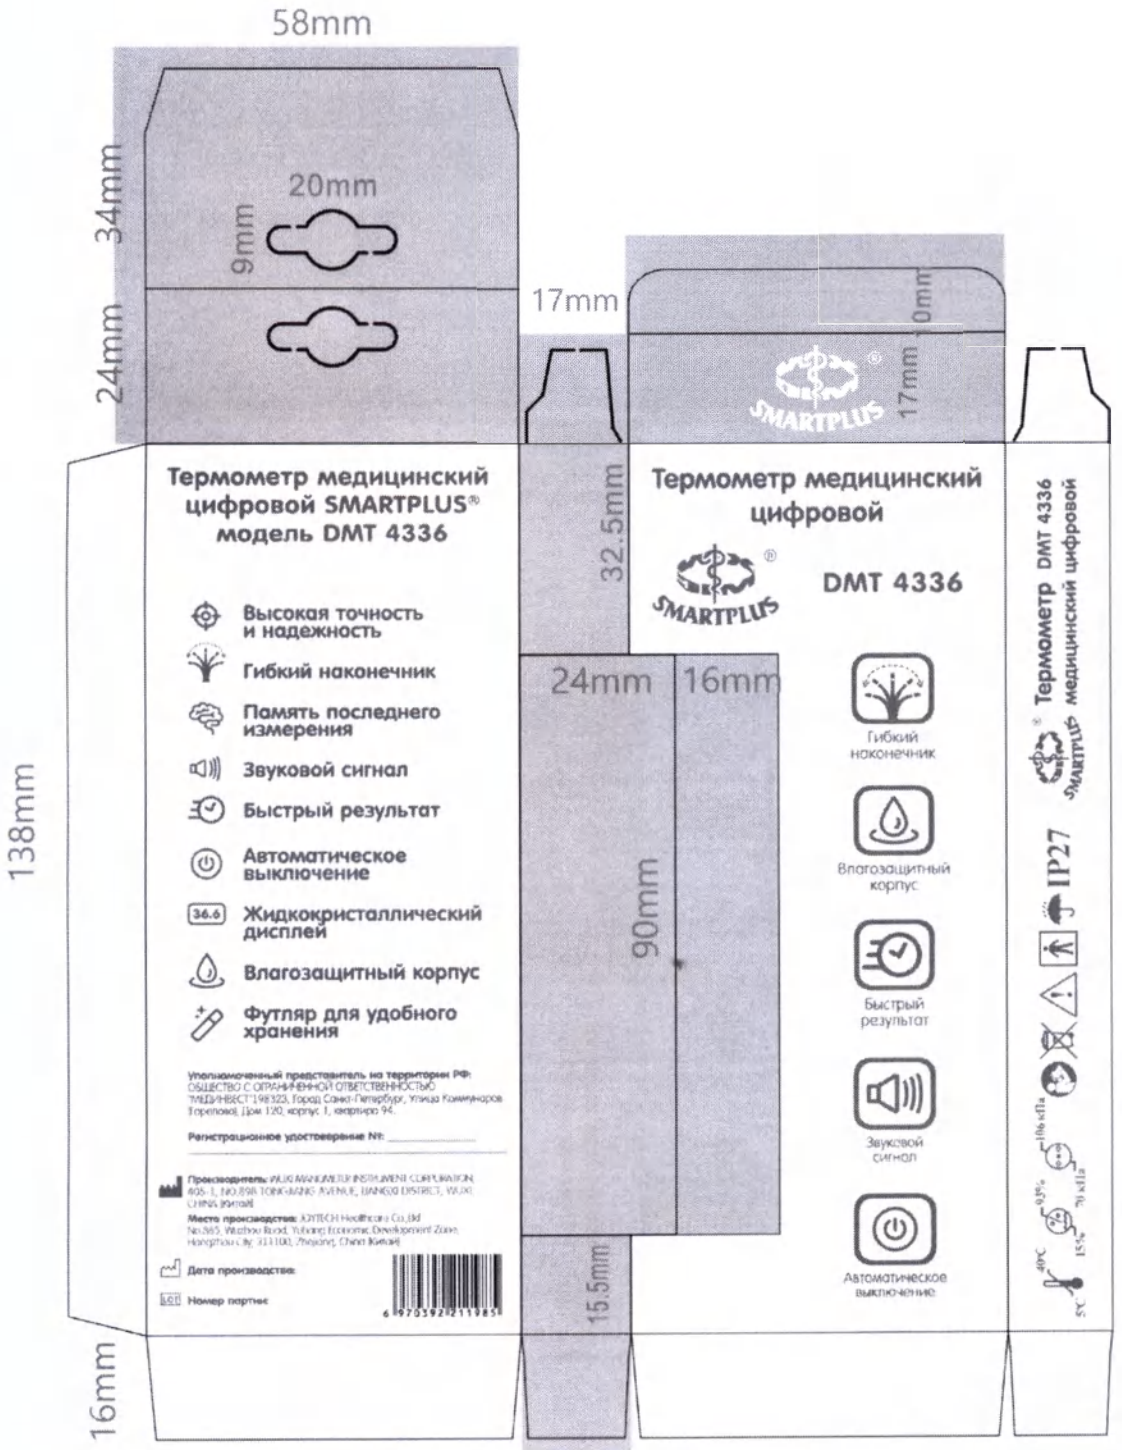

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Транспортная упаковка и маркировка

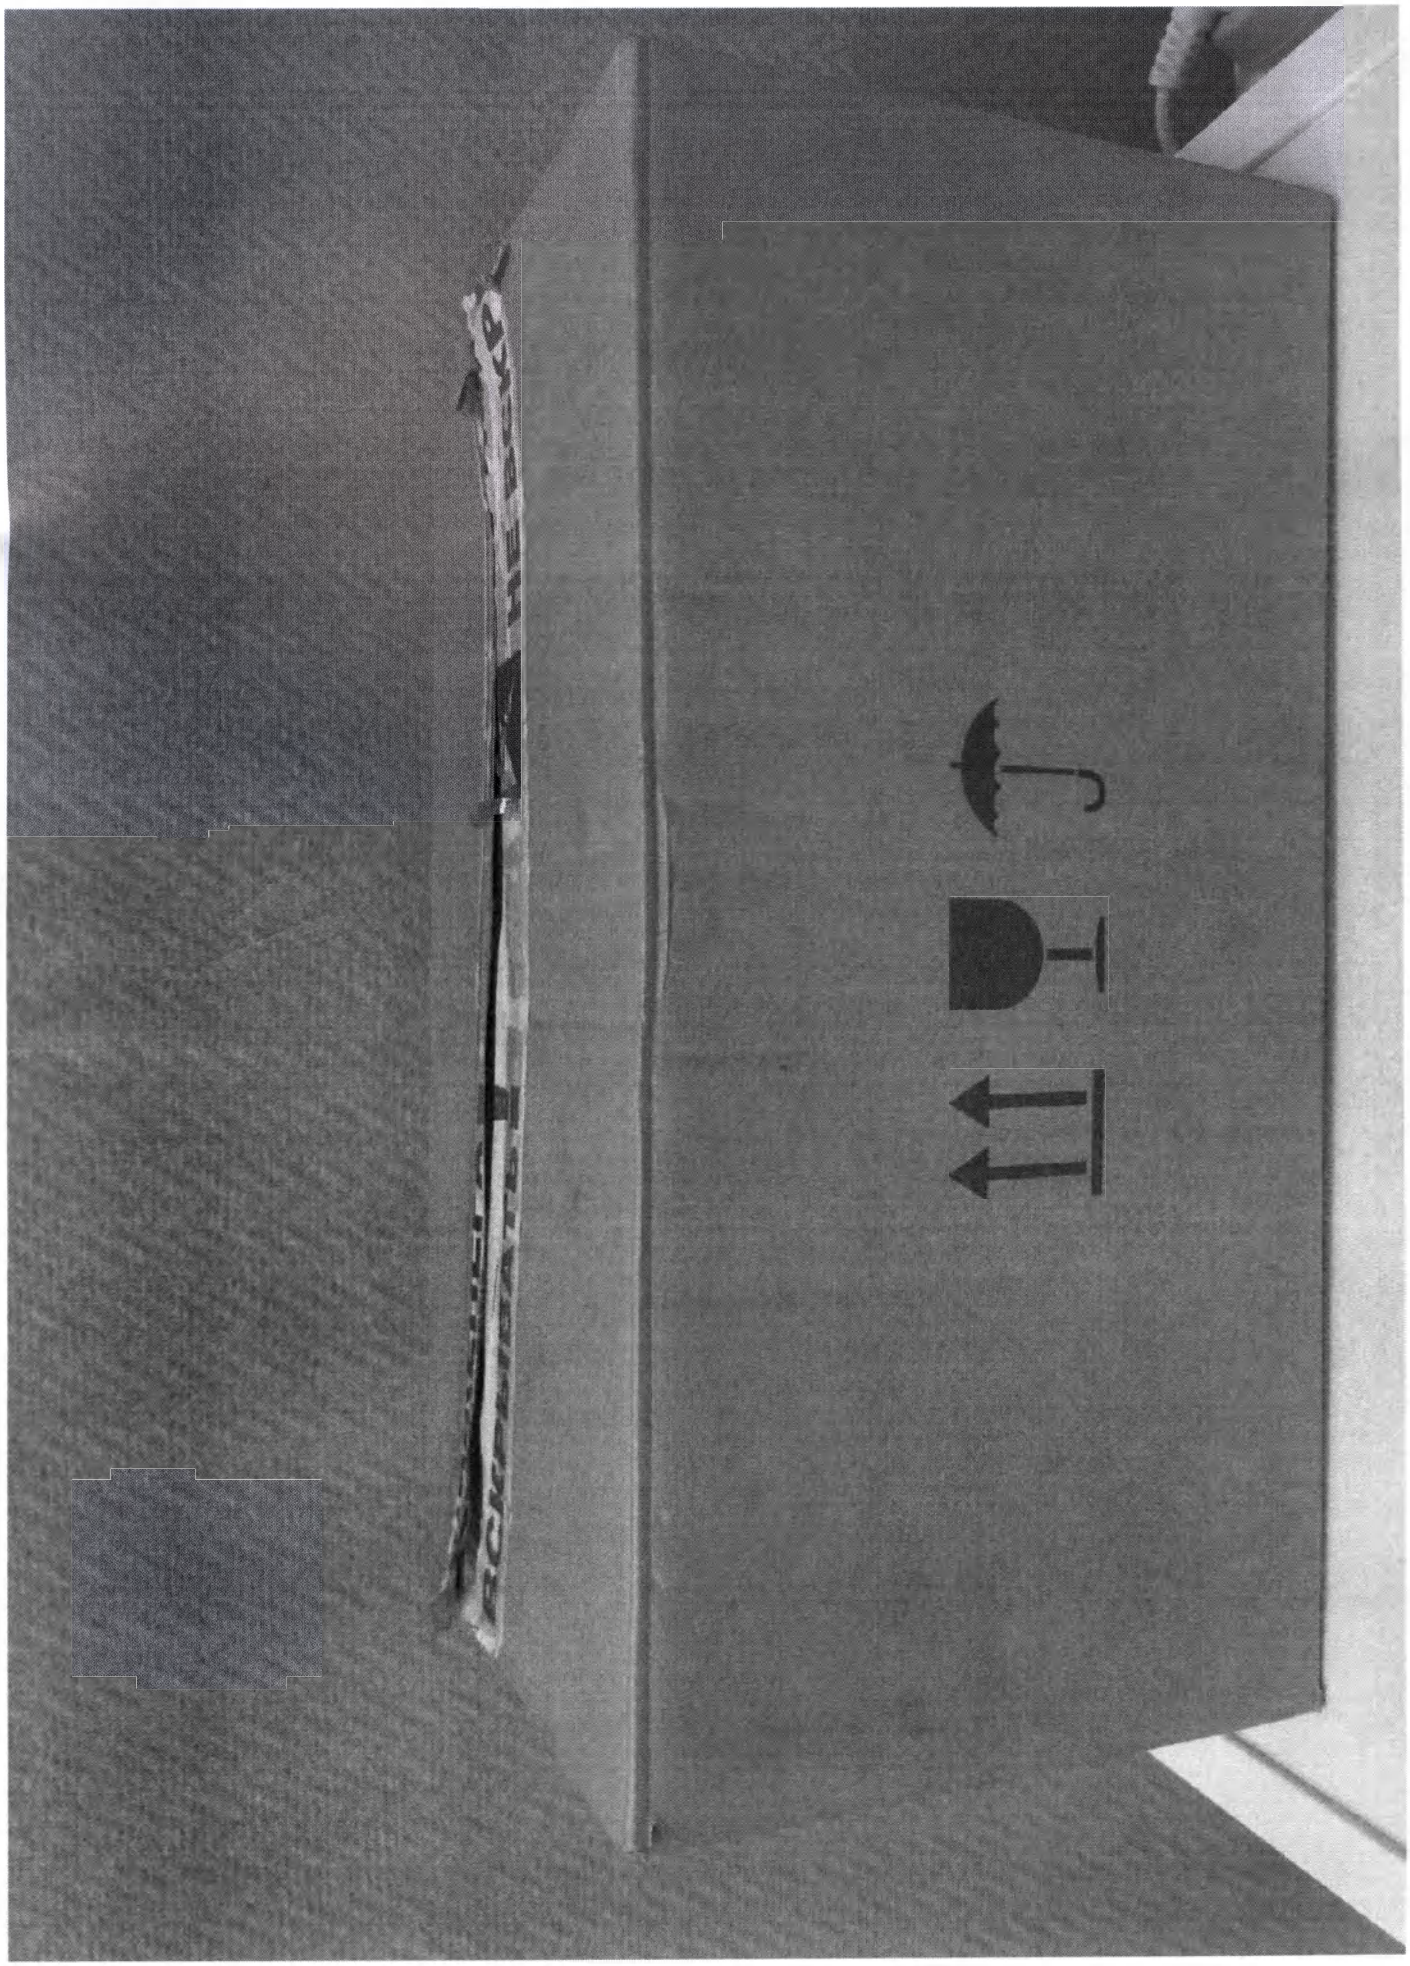

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 20 лист(ов)

Руководитель организации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU