



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
ЭМКО Электромеханическая компания (ООО ЭМКО),
129301 г. Москва, ул. Касаткина, д.11, стр. 1.

ОГРН 1067746558538 ИНН 7719589821

телефон: (495) 287-8100, факс: (495) 287-8400

электронная почта: emco@bk.ru

интернет: emco.ru, coagulometer.ru, stainer.ru

КПП 771601001 ОКПО 95221815




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО ЭМКО


А.А. Мишукова

«6» марта 2020 г.


Фотографические изображения медицинского изделия
Автоматы фиксации и окраски мазков крови по
ТУ 26.60.12-001-95221815-2019

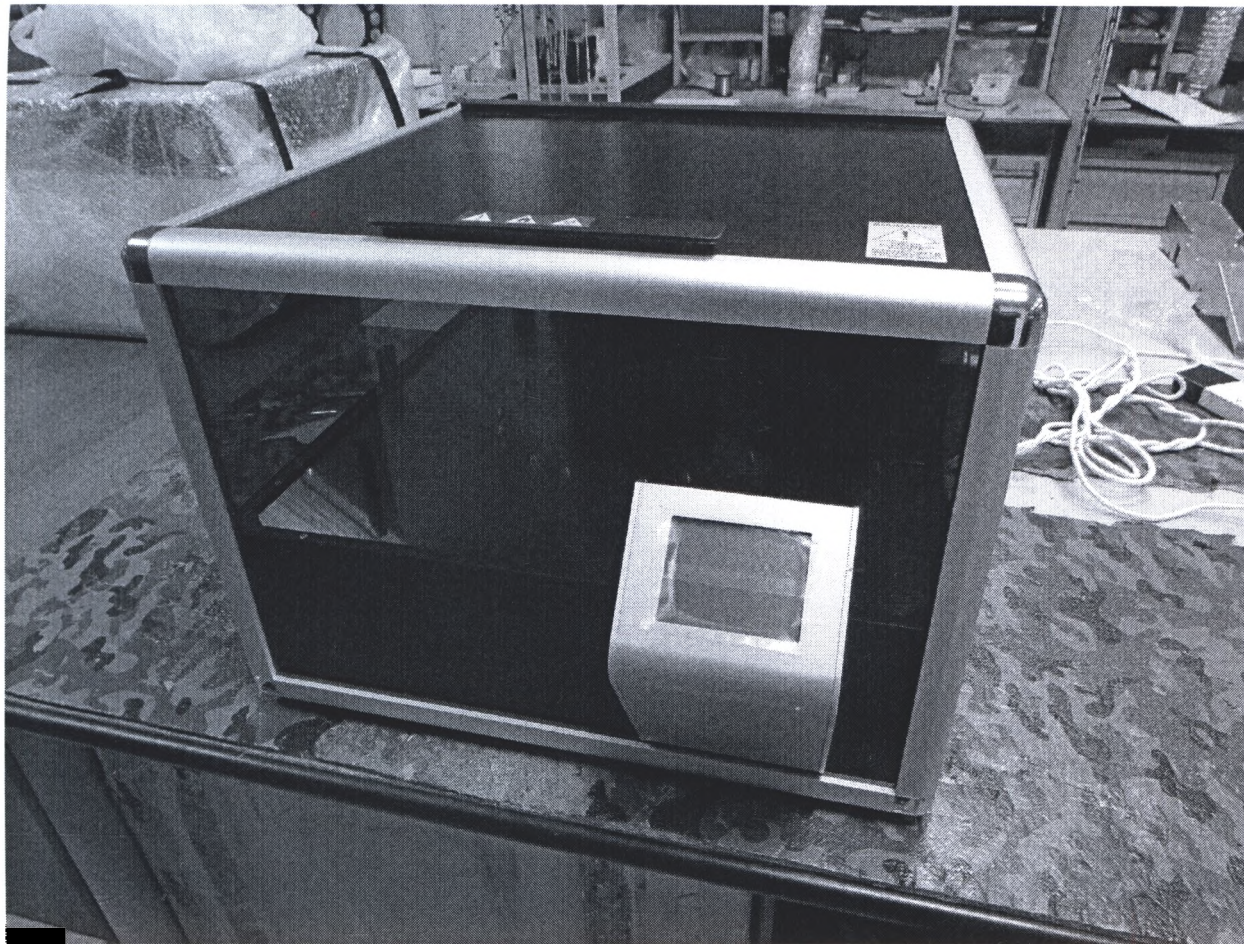


АФОМК8-Г-01

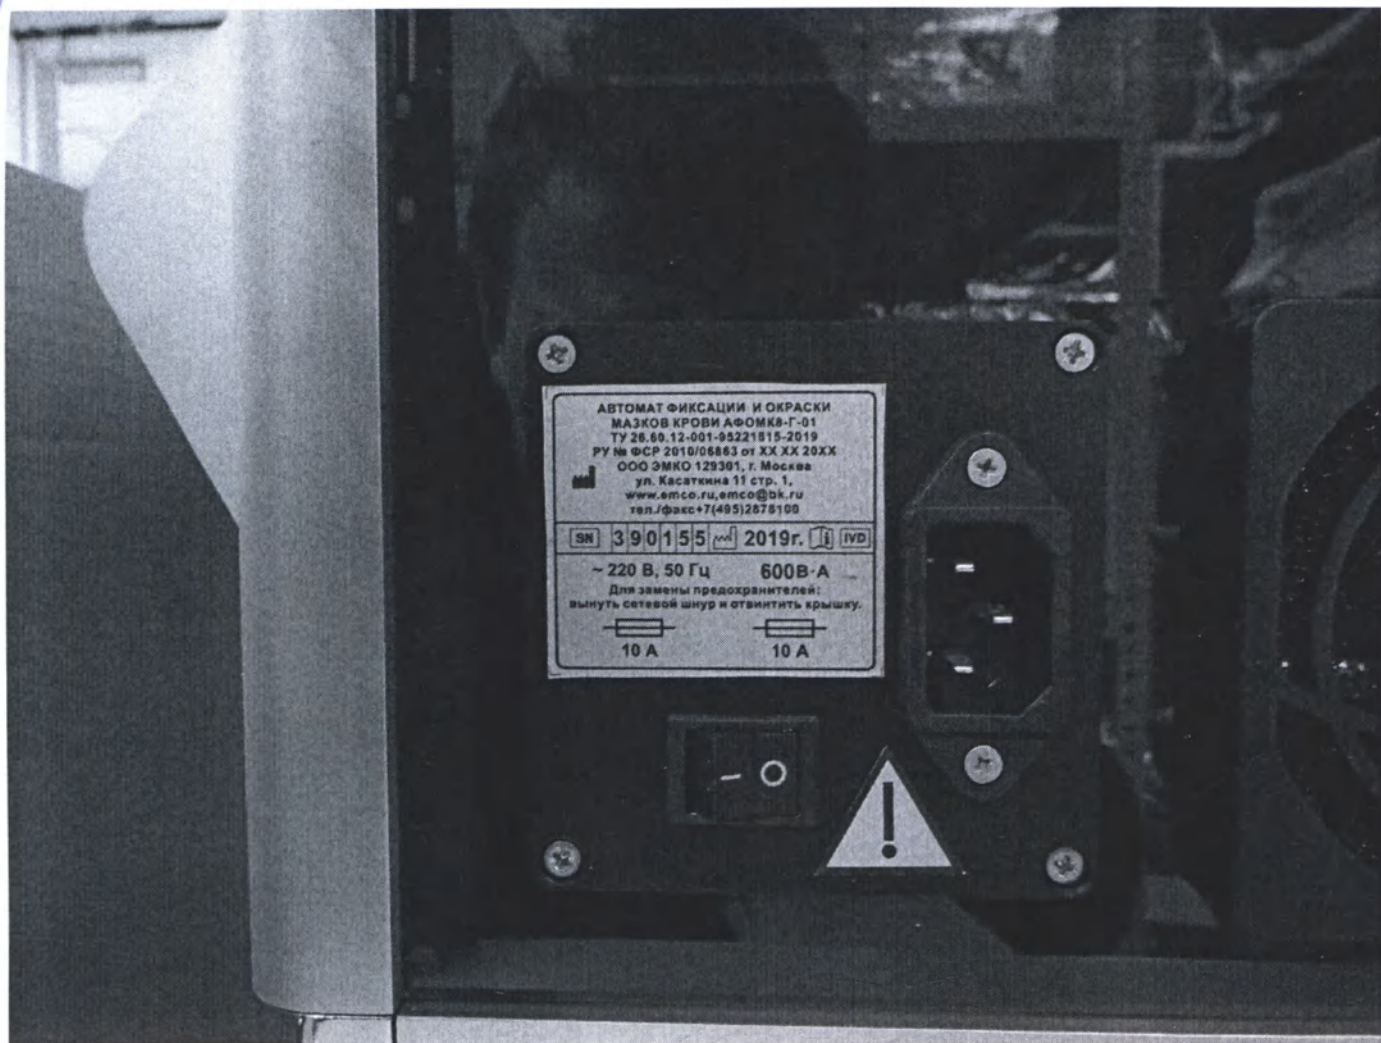

АФОМК8-Г-01 (маркировка)

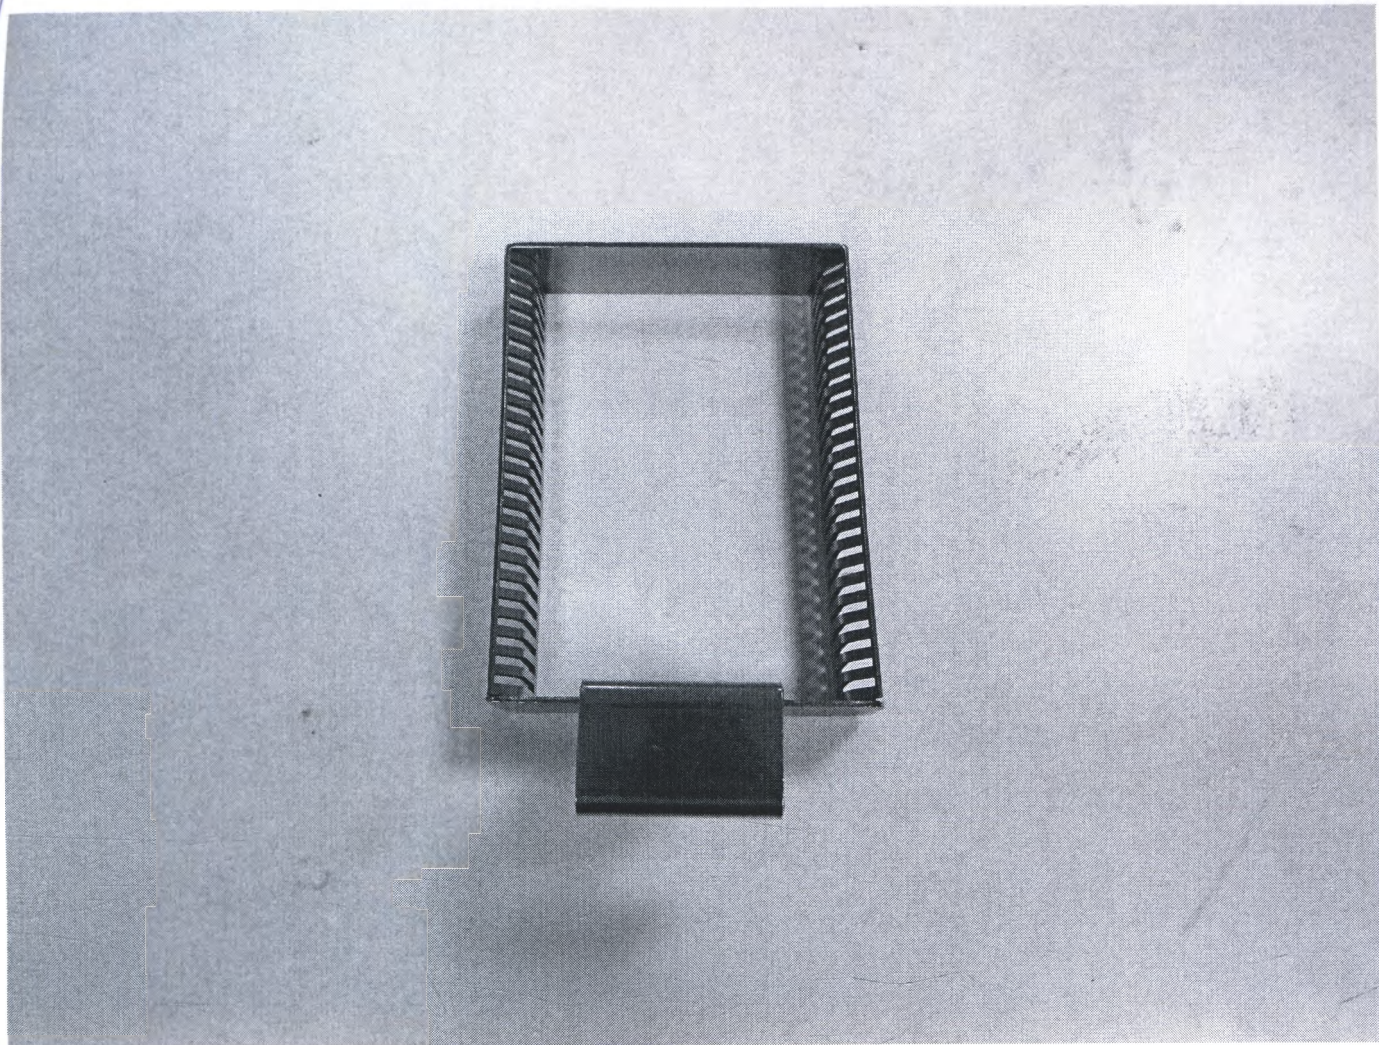


Штатив –Г8

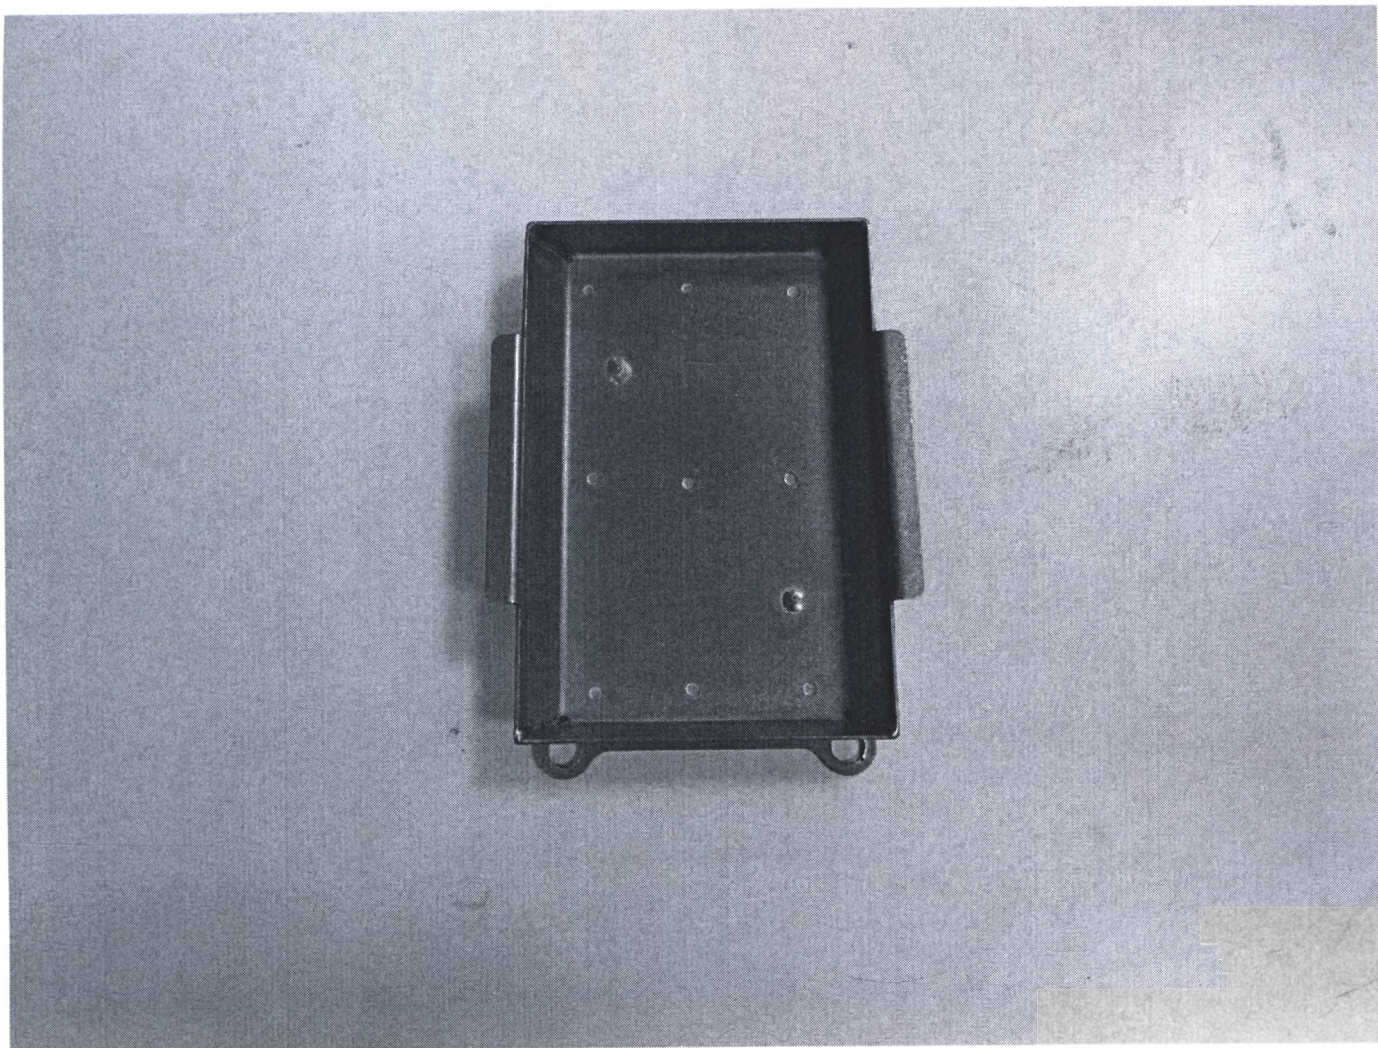


Поддон-Г8




Крышка ванны-Г8

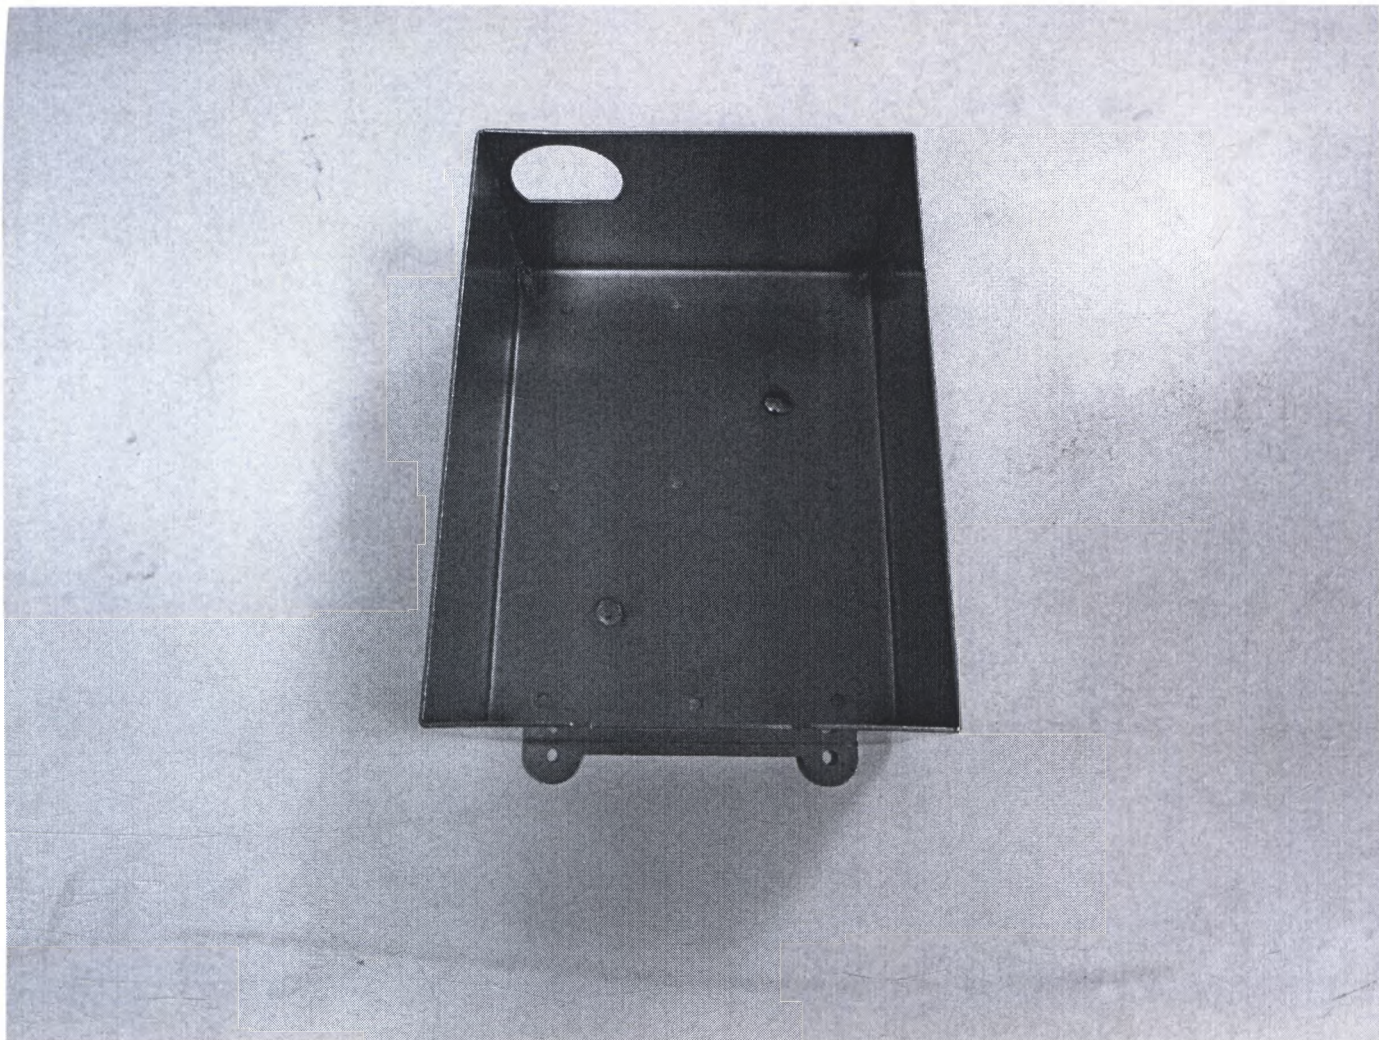


Ванна проточная-Г8

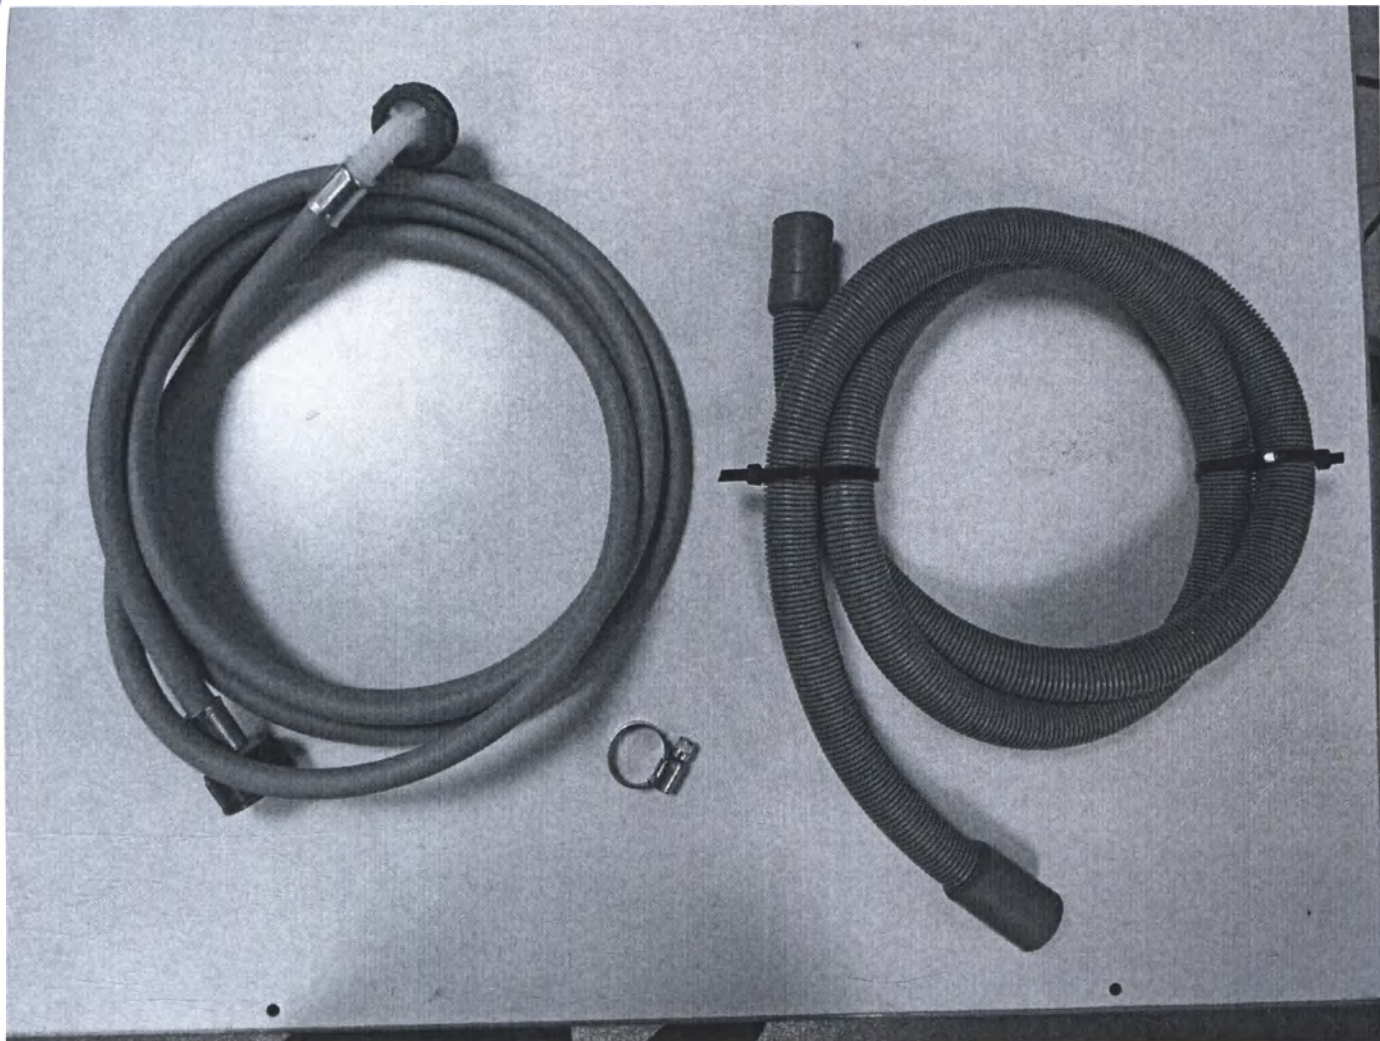


Комплект сантехнический для подключения к водопроводу

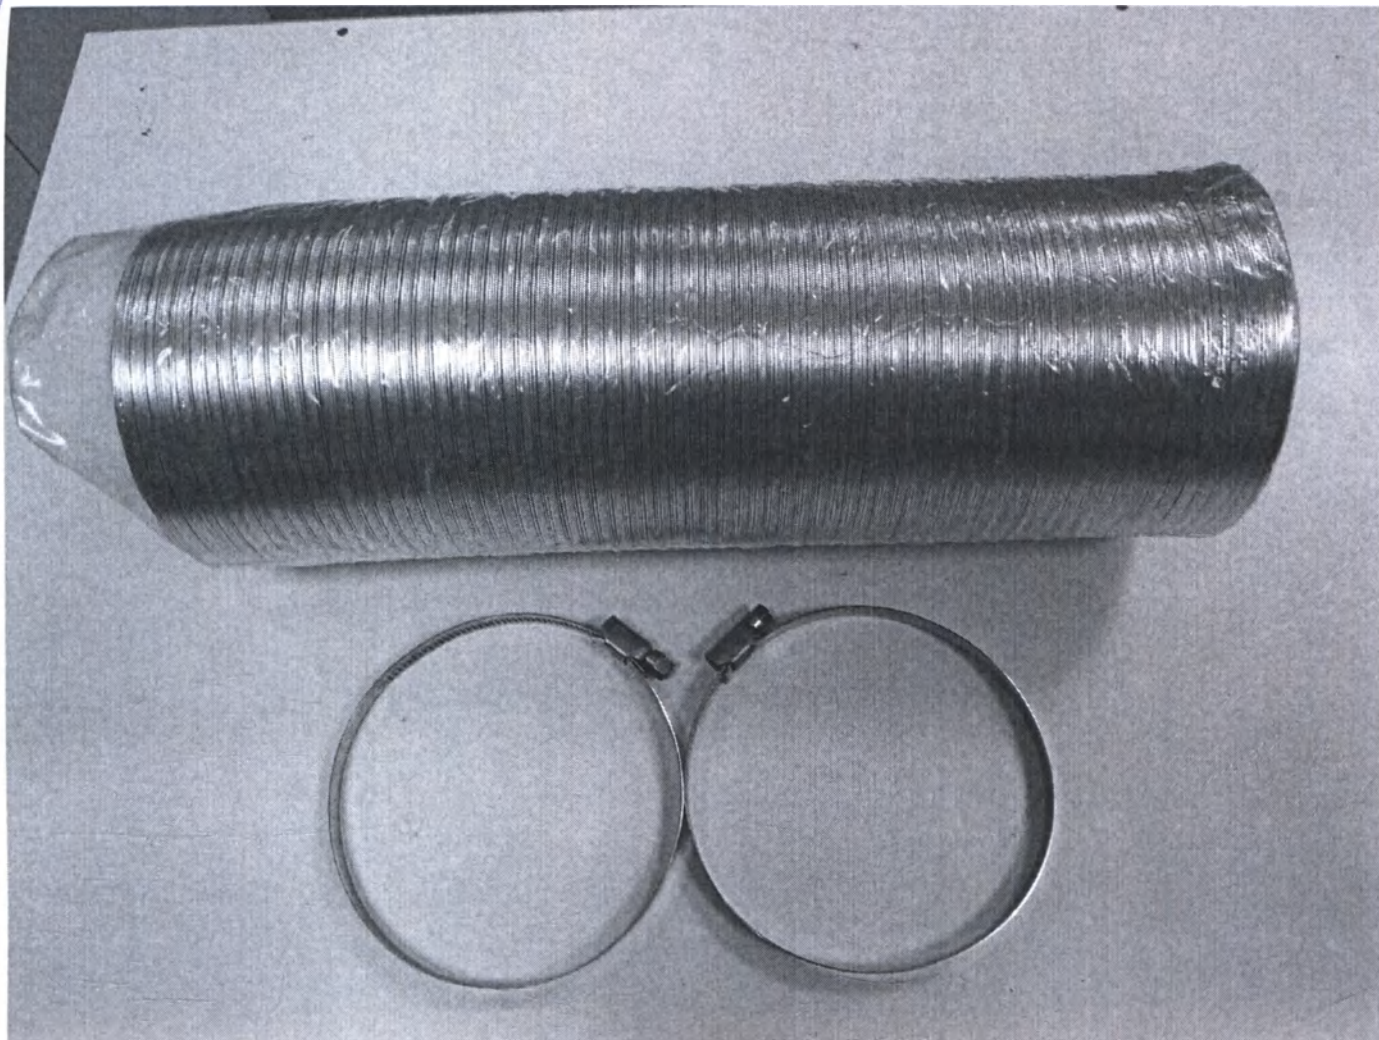


Комплект для подключения к вентиляции

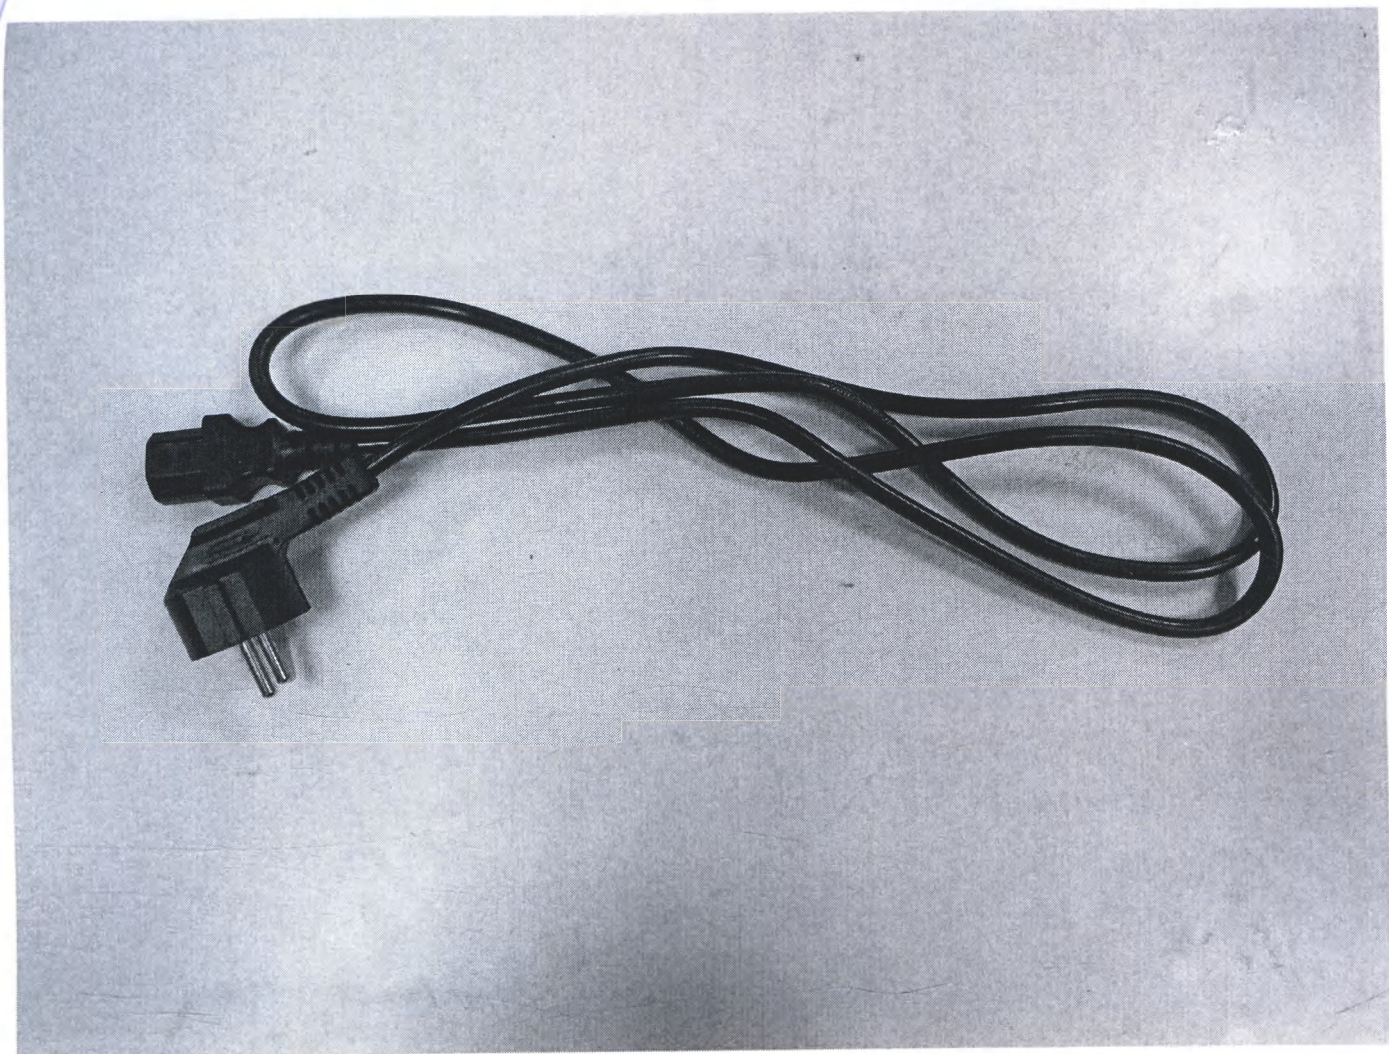

Сетевой кабель питания

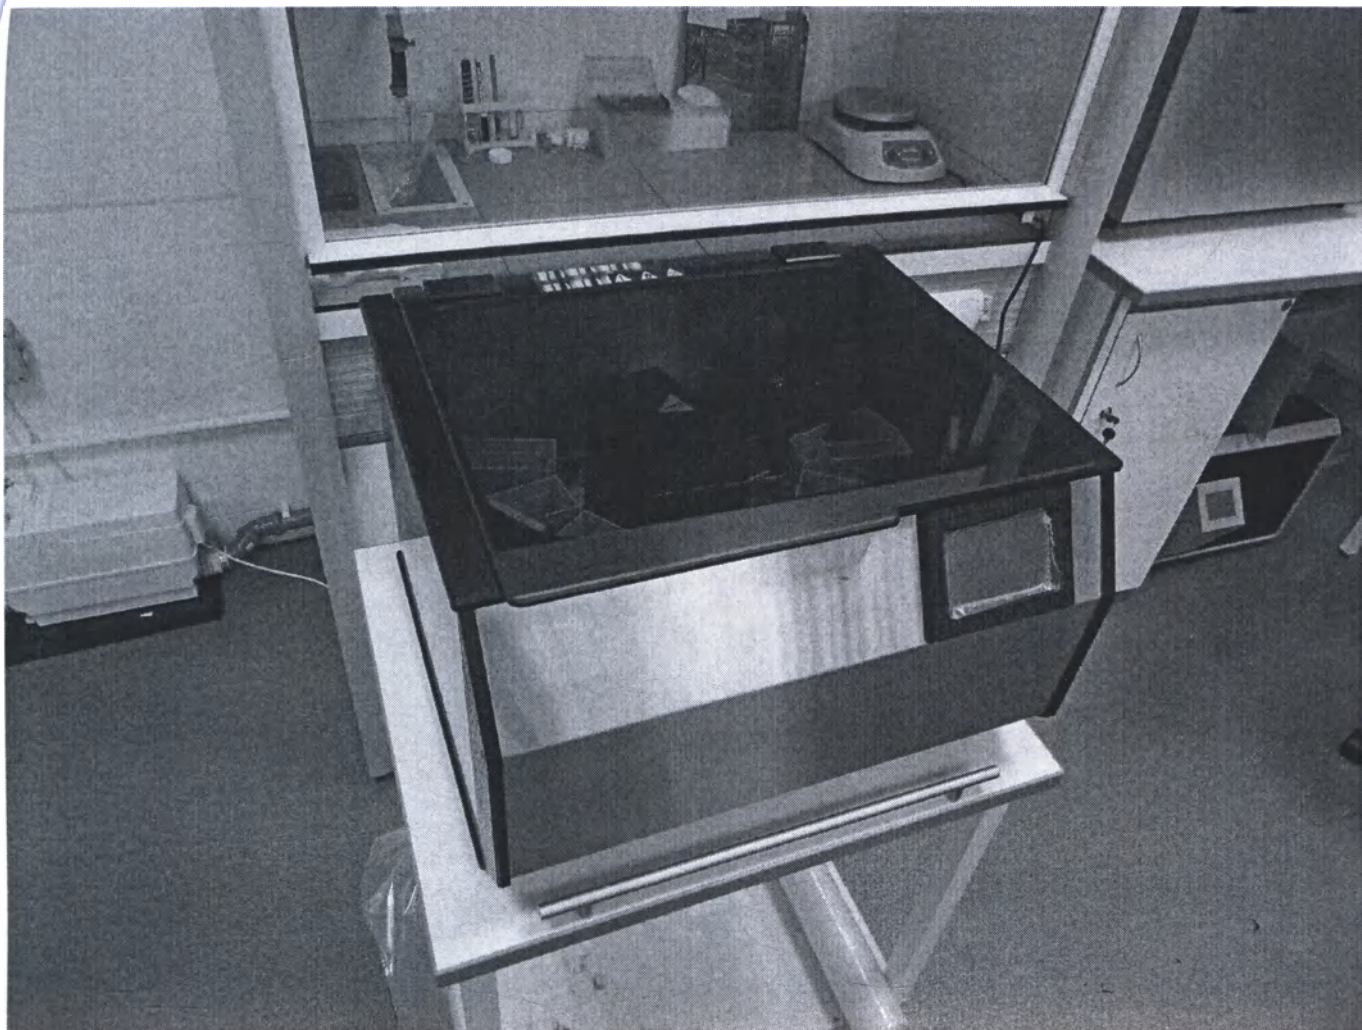


АФОМК8-В-01

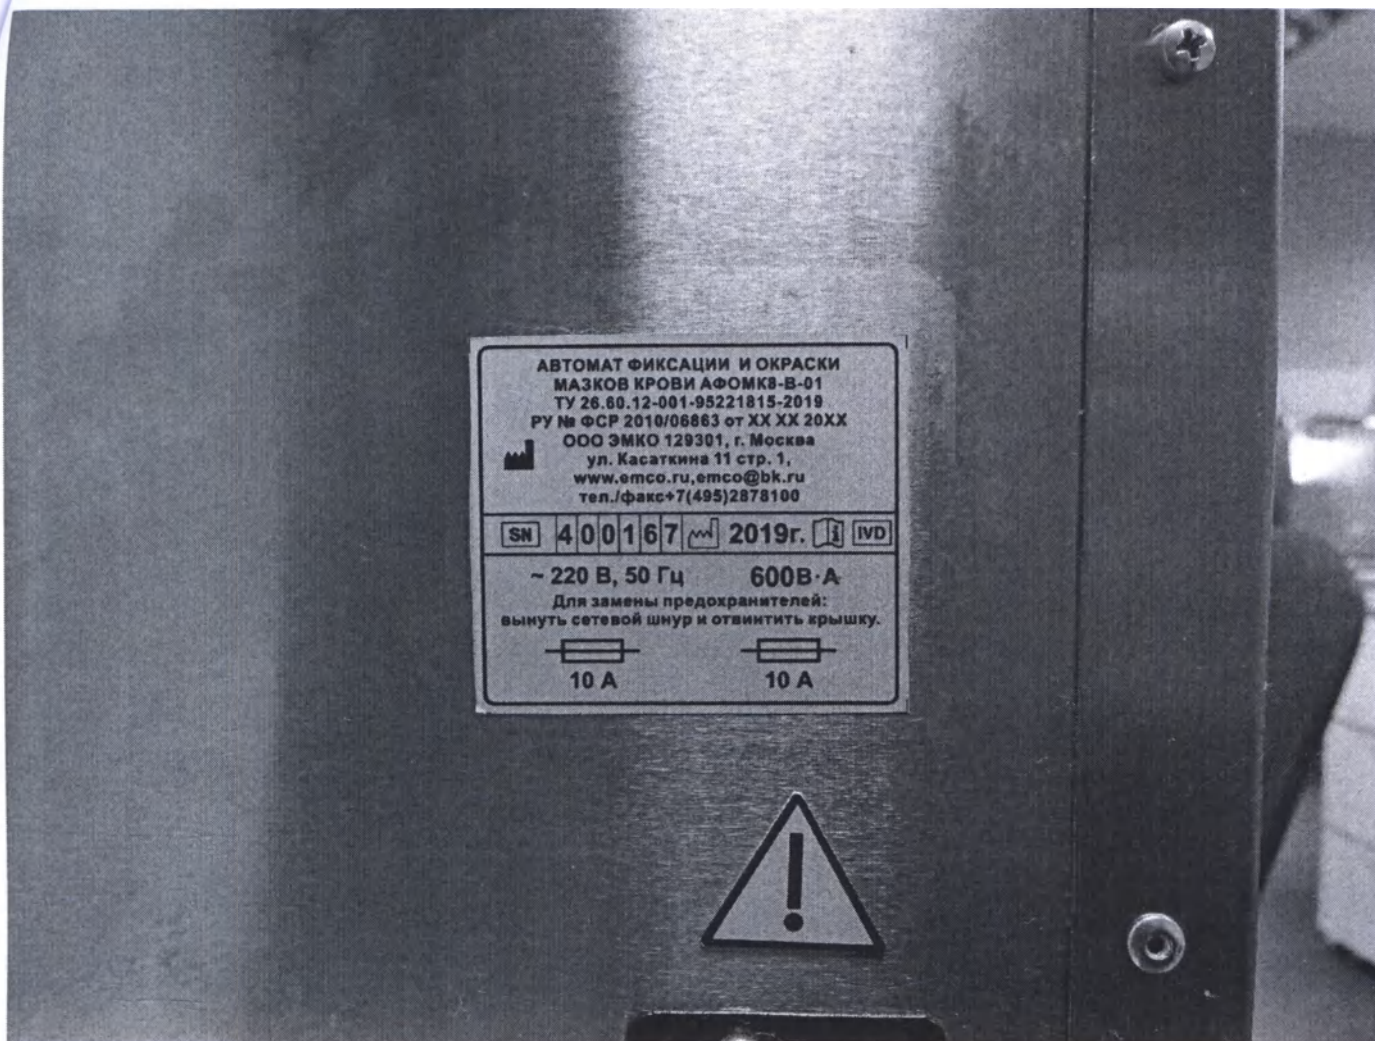



АФОМК8-В-01 (маркировка)

ШТРИБ-B8

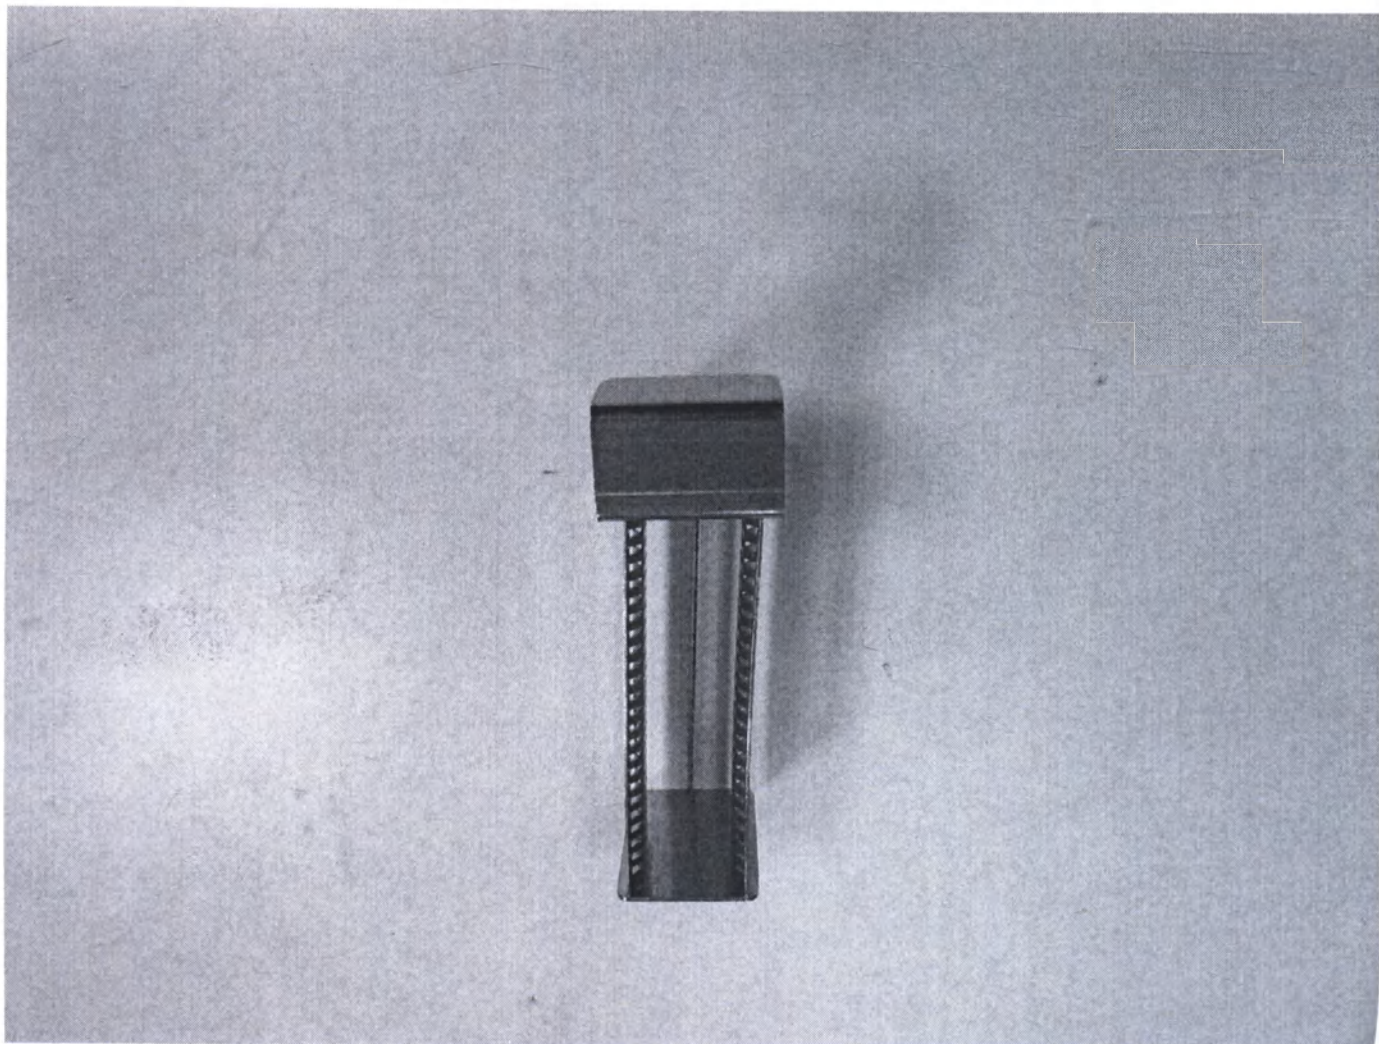


Ванна-В8

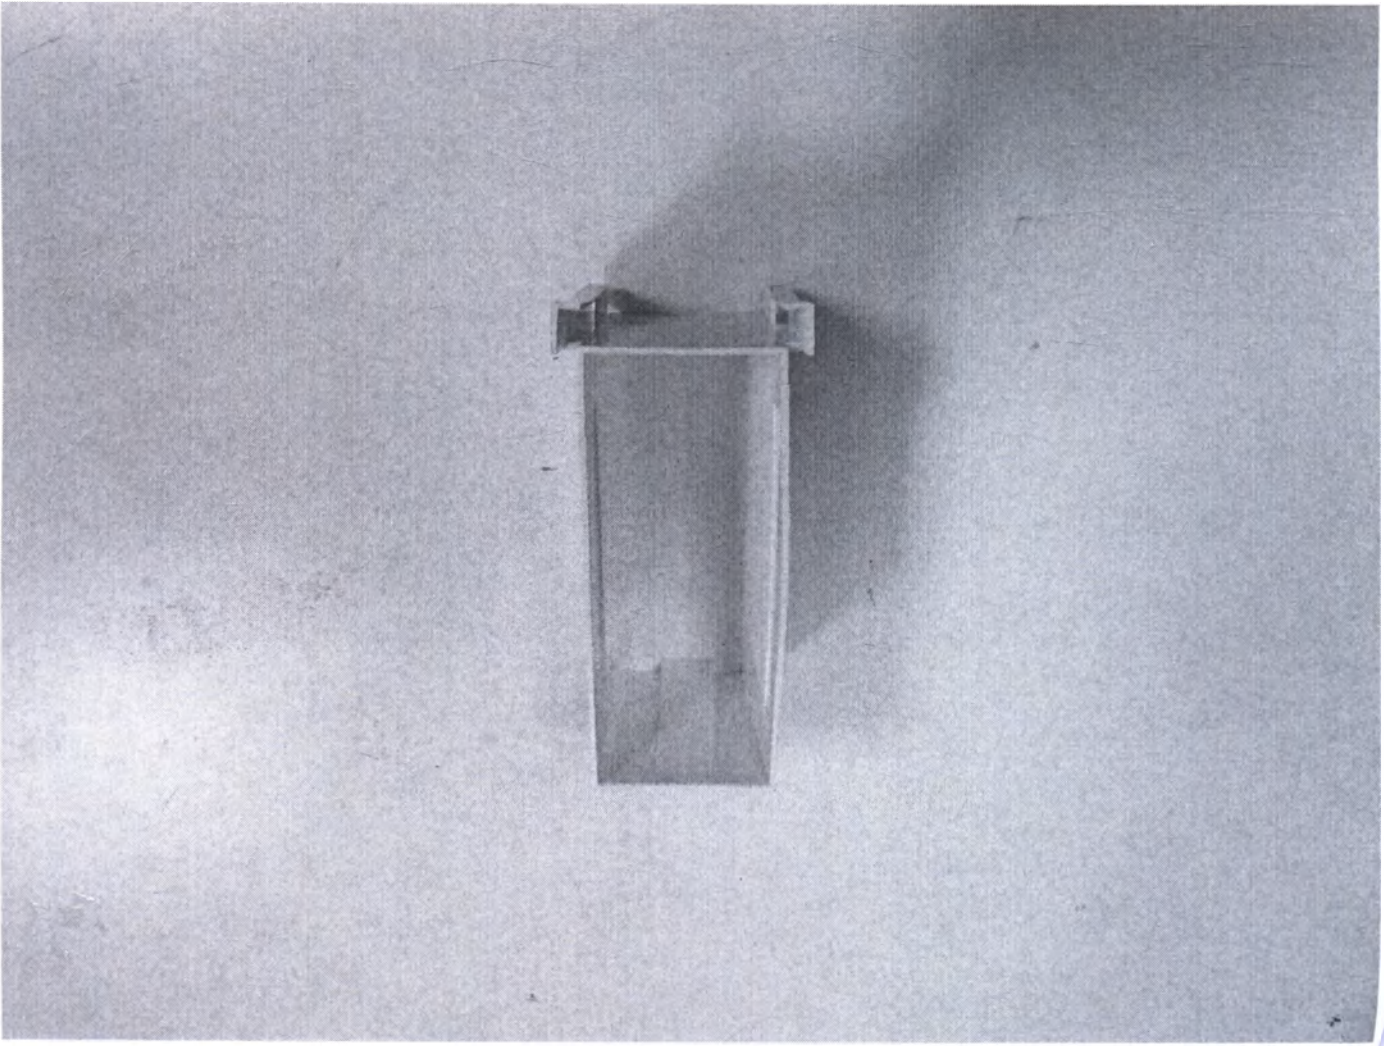

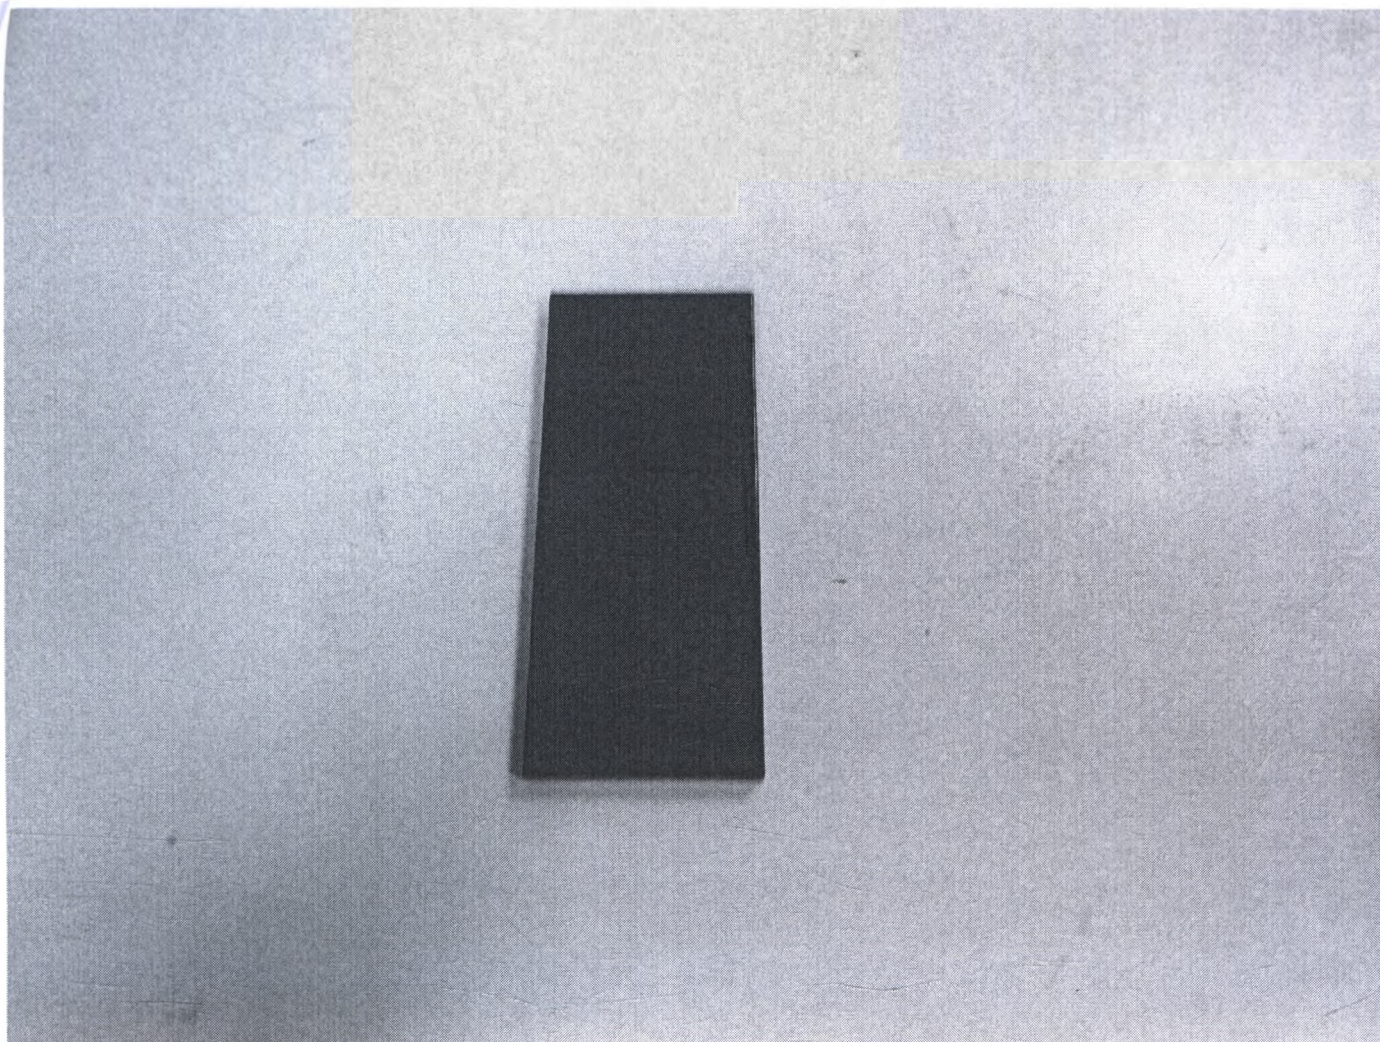



Крышка ванны-В8

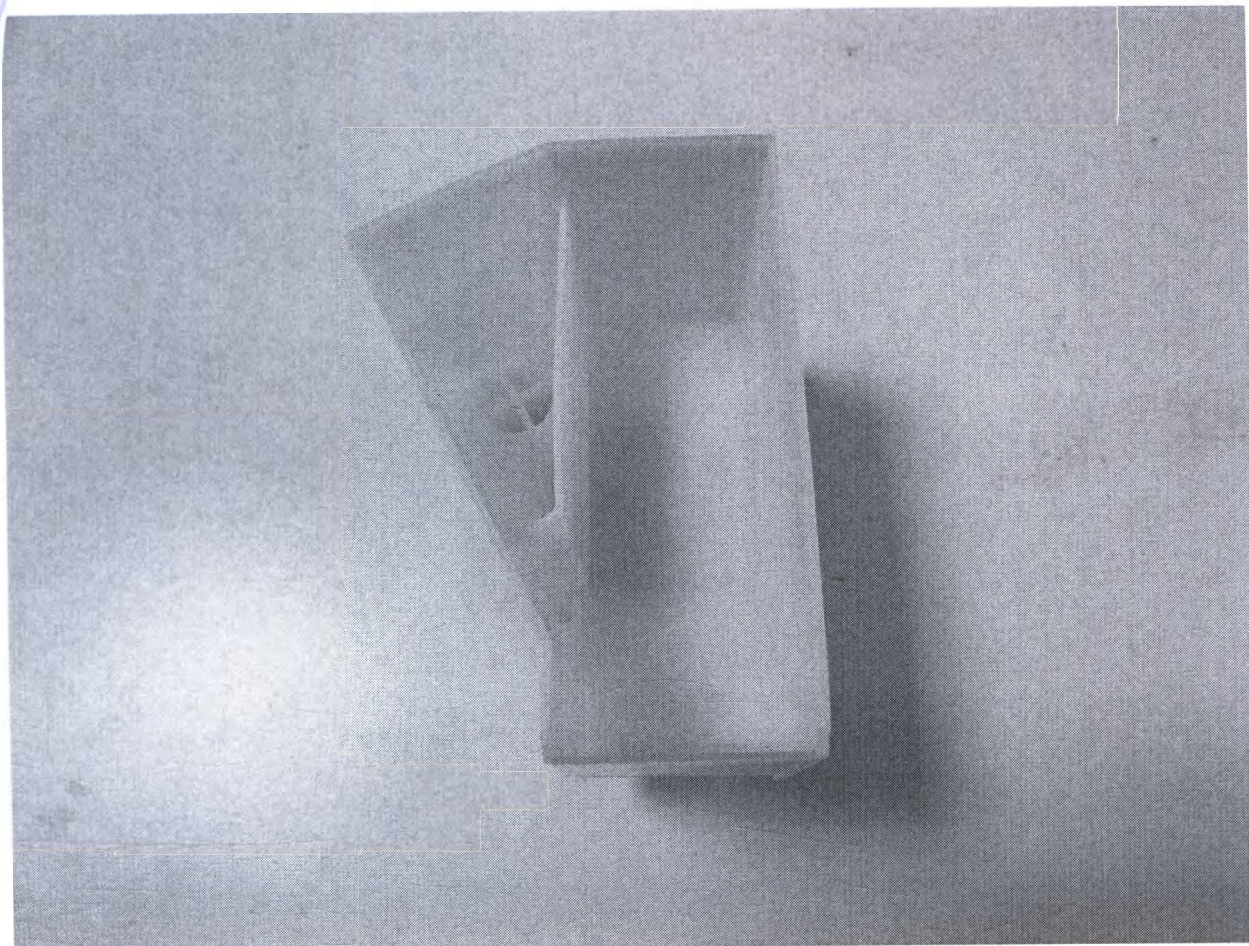

Ванна проточная-В8

Вахна-В8П

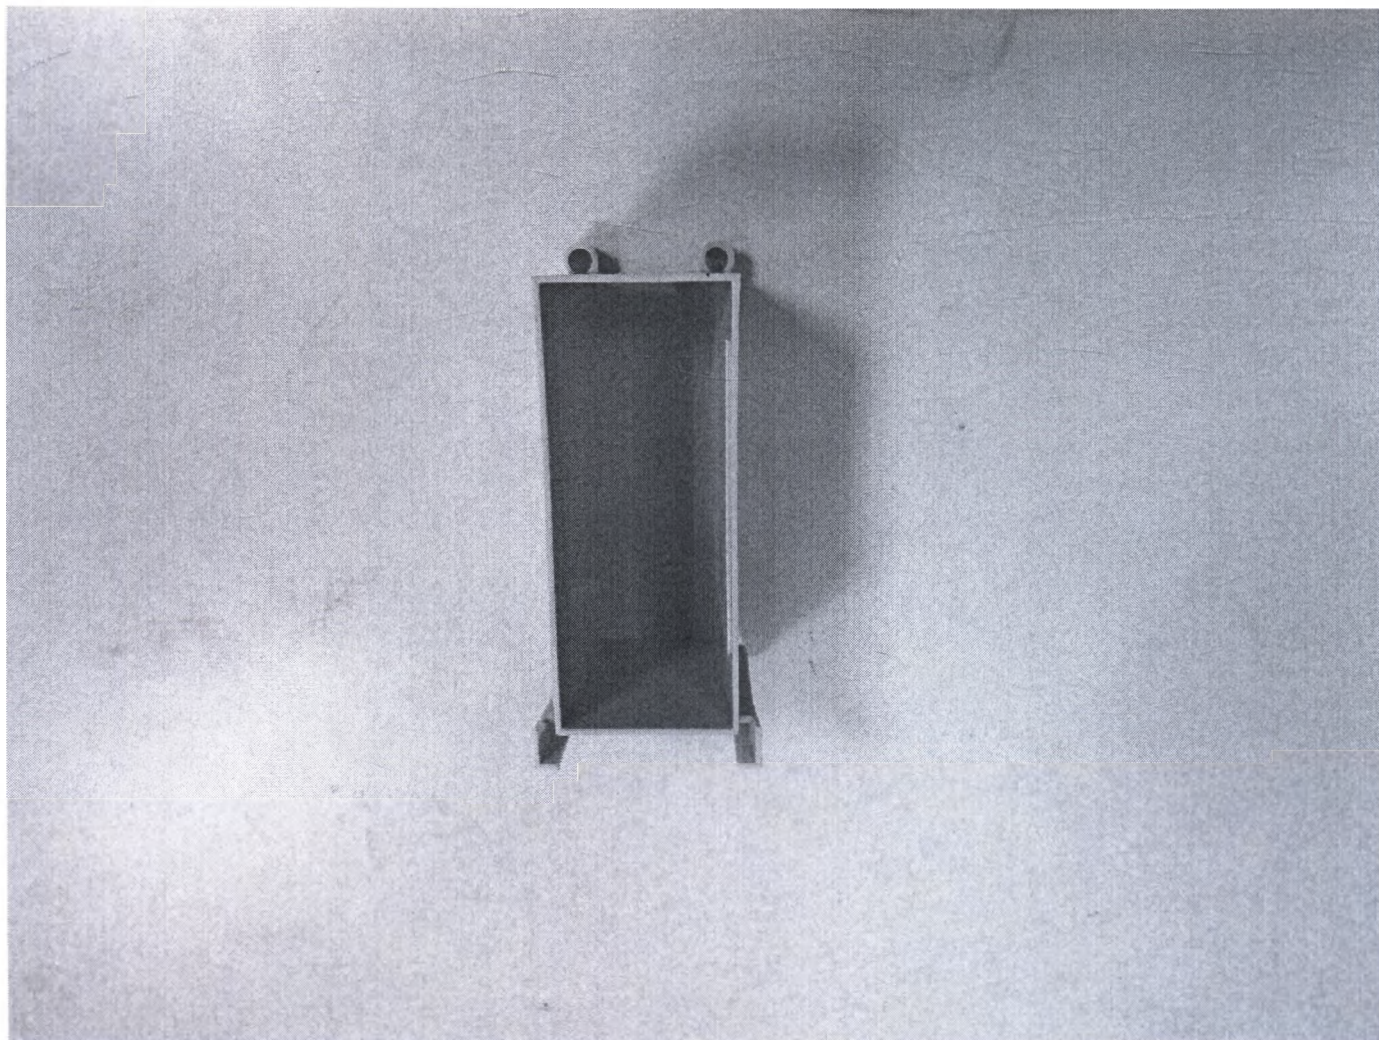

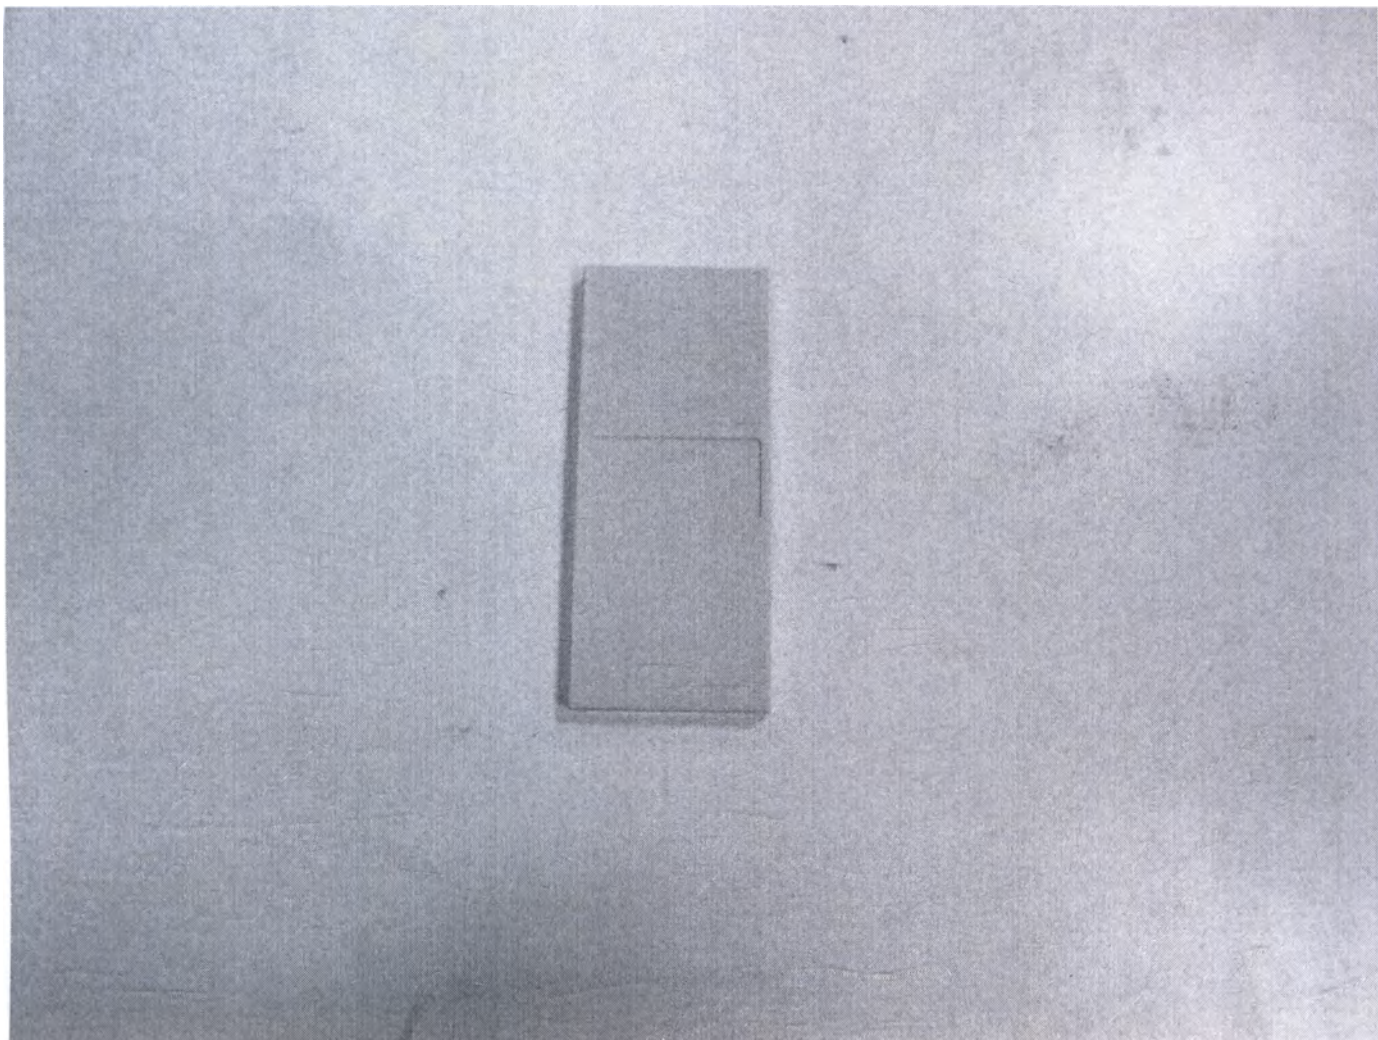

Крышк ванны-В8П

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 18
(60 5000000000) листов

Генеральный директор
ООО ЭМКО

А.А. Мишукова





Общество с ограниченной ответственностью
ЭМКО Электромеханическая компания (ООО ЭМКО),
129301 г. Москва, ул. Касаткина, д.11, стр. 1.

ОГРН 1067746558538 ИНН 7719589821

телефон: (495) 287-8100, факс: (495) 287-8400

электронная почта: emco@bk.ru

интернет: emco.ru, coagulometer.ru, stainer.ru

КПП 771601001 ОКПО 95221815

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО ЭМКО

А.А. Мишукова

« 6 » марта 2020 г.



Образцы маркировки
Автоматы фиксации и окраски мазков крови по
ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



Автомат фиксации и окраски мазков крови

АФОМК8-Г-01


ТУ 26.60.12-001-95221815-2019

РУ № ФСР 2010/06863 от XX XX 20XX



ООО ЭМКО, 129301, г. Москва, ул. Касаткина 11, стр. 1

www.emco.ru тел. +7(495)287-81-00




Упаковщик _____ Дата упаковки _____

Количество мест/место _____ Штамп ОТК _____

Символ	Описание
	Серийный номер
	Для in vitro диагностики
	Изготовитель
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Беречь от влаги.
	Открывать здесь
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности

Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК8-Г-01

(транспортная маркировка, основная наклейка)

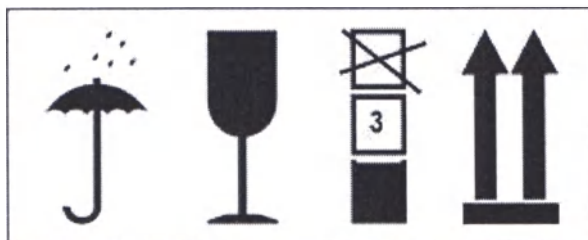


Символ	Описание
	Беречь от влаги.
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Верх.

Транспортная маркировка, дополнительная наклейка для исполнения
АФОМК8-Г-01 и АФОМК8-В-01

Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК8-Г-01

Габаритные размеры и масса

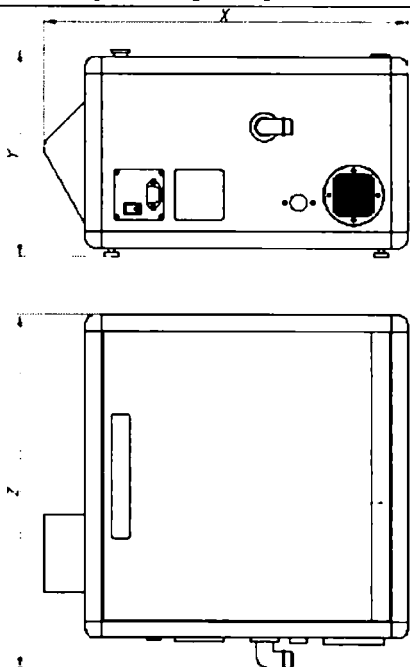

Габаритные
размеры не более

X-590 мм
Y-335 мм
Z-575 мм

Масса не более

110 г

Заводская табличка



Символ

Описание

SN

Серийный номер

IVD

Для in vitro диагностики



Дата изготовления



Изготовитель



Номинал предохранителя



Обратитесь к руководству по эксплуатации



Автомат фиксации и окраски мазков крови
АФОМК8-В-01


ТУ 26.60.12-001-95221815-2019

ПУ № ФСР 2010/06863 от XX XX 20XX



ООО ЭМКО, 129301, г. Москва, ул. Касаткина 11, стр. 1
www.emco.ru тел. +7(495)287-81-00

IVD



SN

Упаковщик _____

Дата упаковки _____

Количество мест/место _____

Штамп ОТК _____


Символ	Описание
	Серийный номер
	Для in vitro диагностики
	Изготовитель
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Беречь от влаги.
	Открывать здесь
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности

Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК8-В-01

(транспортная маркировка, основная наклейка)

Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК8-В-01

Габаритные размеры и масса

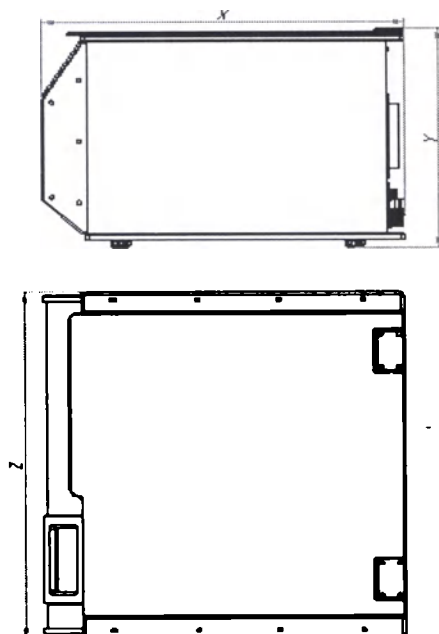

Габаритные
размеры не более

X-460 мм
Y-330 мм
Z-530 мм

Масса не более

110 г

Заводская табличка



Символ

Описание



Серийный номер



Для in vitro диагностики



Дата изготовления



Изготовитель




Номинал предохранителя



Обратитесь к руководству по эксплуатации

Штатив-Г8

Общий вид

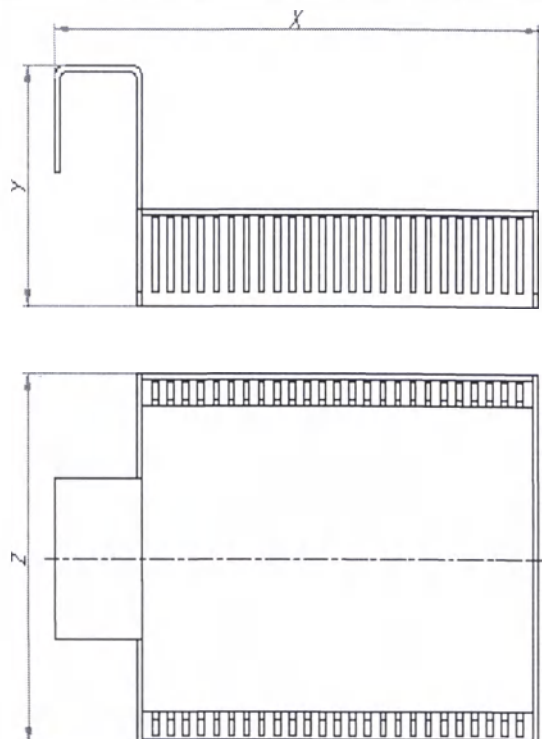

Маркировка



ШТАТИВ-Г8

ЕАТС.01.51.00

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-Г-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



4



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-128 мм
	Y-53 мм
	Z-82 мм
Масса не более	110 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Поддон-Г8

Общий вид

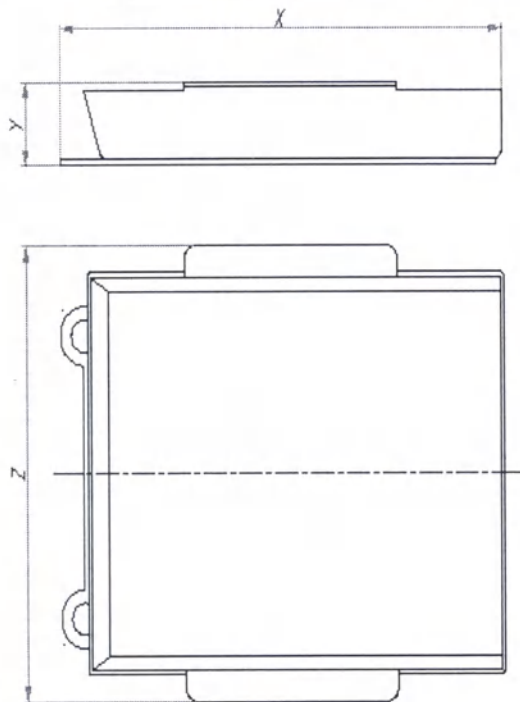

Маркировка



ПОДДОН-Г8

EATC.01.52.00

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-Г-01.
Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



4



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-125 мм Y-20 мм Z-105 мм
Масса не более	210 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Ванна-Г8

Общий вид

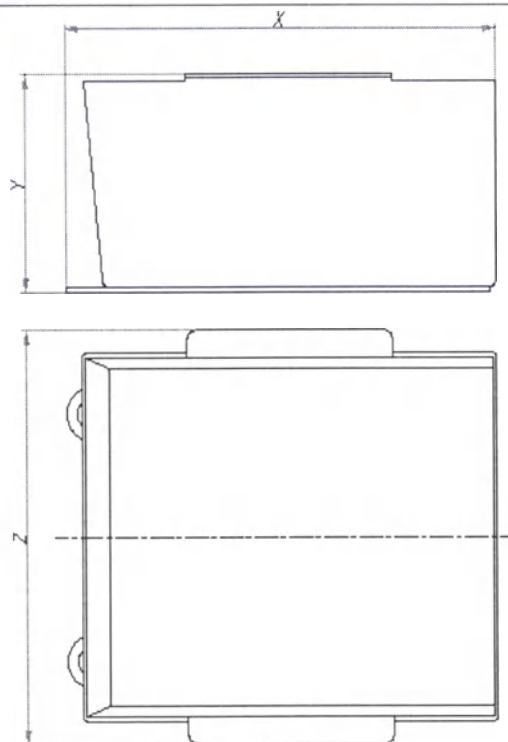

Маркировка



ВАННА-Г8

ЕАТС.01.53.00

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-Г-01,
Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



4



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-125 мм Y-55 мм Z-105 мм
Масса не более	365 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Ванна проточная-Г8

Общий вид

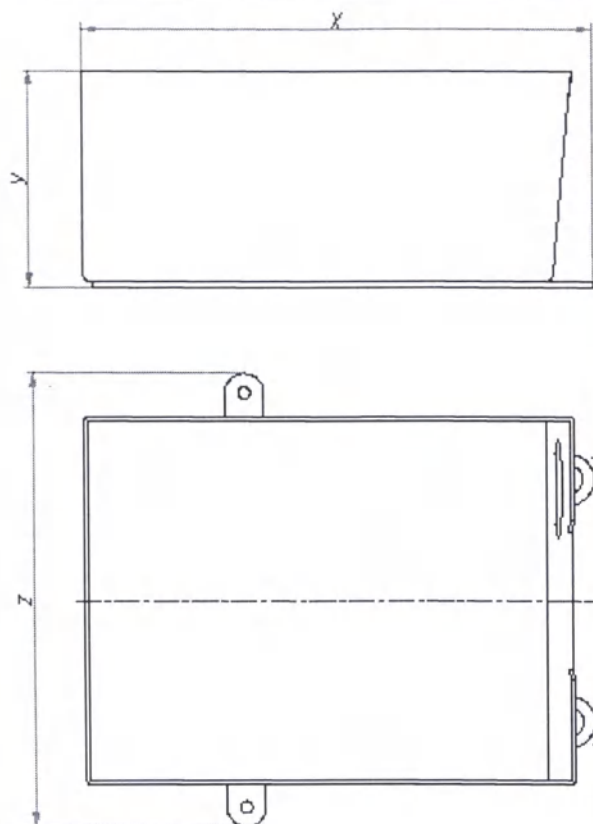

Маркировка



ВАННА ПРОТОЧНАЯ-Г8

ЕАТС.01.54.00

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-Г-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



1



ООО ЭМКО


129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры не более	X-132 мм Y-56 мм Z-117 мм
Масса не более	370 г
Маркировка	
Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Ванна проточная-Г8

Общий вид

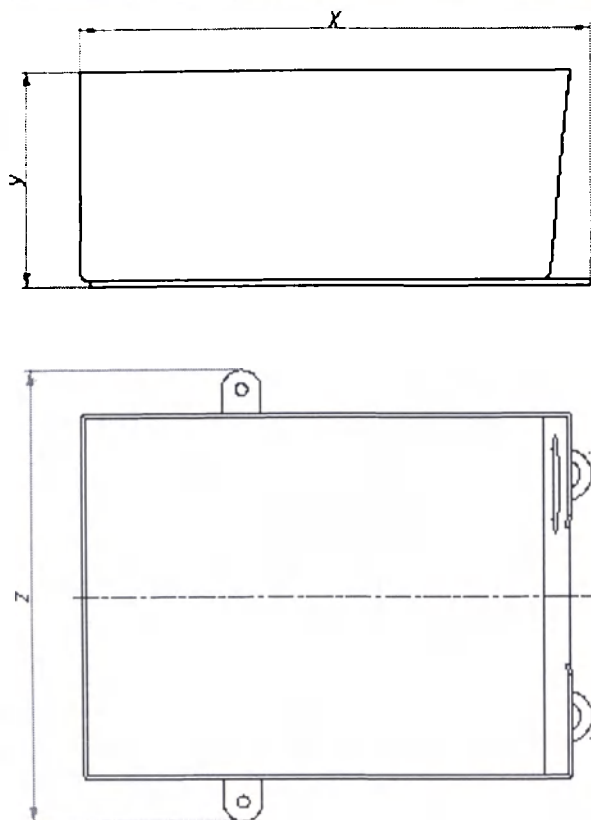

Маркировка



ВАННА ПРОТОЧНАЯ-Г8

EATC.01.54.00

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-Г-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



1



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-132 мм Y-56 мм Z-117 мм
Масса не более	370 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Крышка ванны-Г8

Общий вид

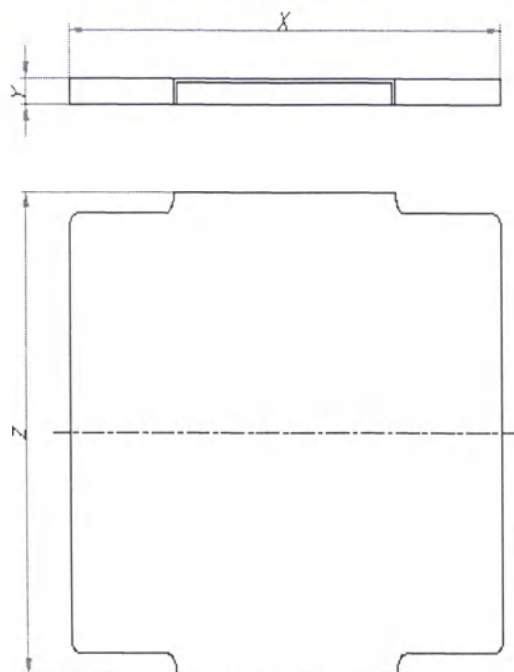

Маркировка



КРЫШКА ВАННЫ-Г8

ЕАТС.01.00.21

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:

АФОМК8-Г-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



4



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,

ул. Касаткина, д.11, стр.1

тел.: 8 (495) 287-81-00

E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-125 мм Y- 6 мм Z- 107 мм
Масса не более	80 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Комплект сантехнический для подключения к водопроводу

Общий вид

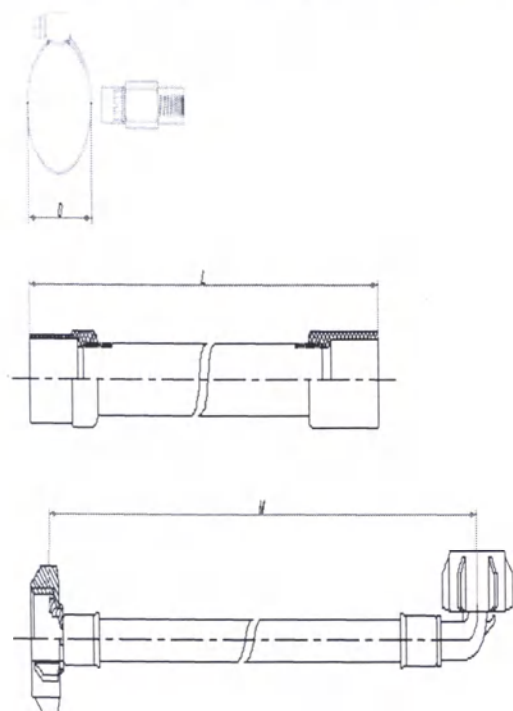

Маркировка



**КОМПЛЕКТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ВОДОПРОВОДУ**

EATC.01.59.00

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01,
Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



1



ООО ЭМКО


129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры не более	D- Ø 20-32 мм L-1500 мм M-1500 мм
Масса не более	250 г
Маркировка	
Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Комплект для подключения к вентиляции

Общий вид

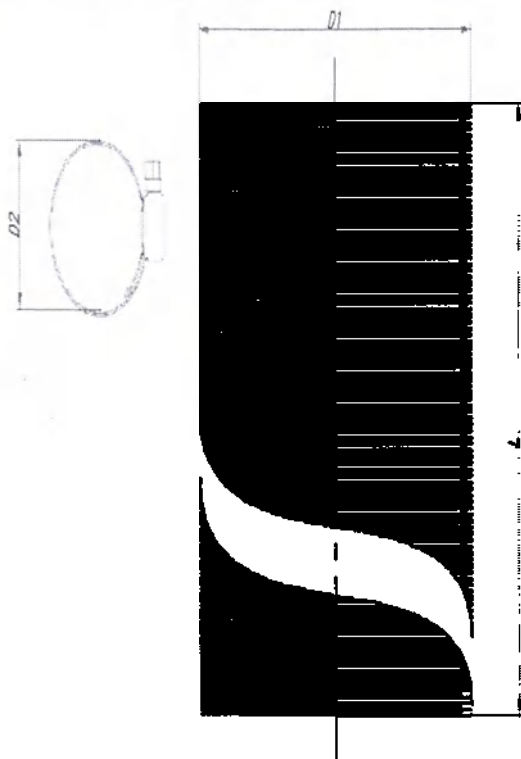

Маркировка



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

EATC.01.60.00

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01,
Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



1



ООО ЭМКО


129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры не более	L-400÷1000мм D1- Ø100 мм D2- Ø 90÷110 мм
Масса не более	350 г
Маркировка	
Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Штатив-B8

Общий вид

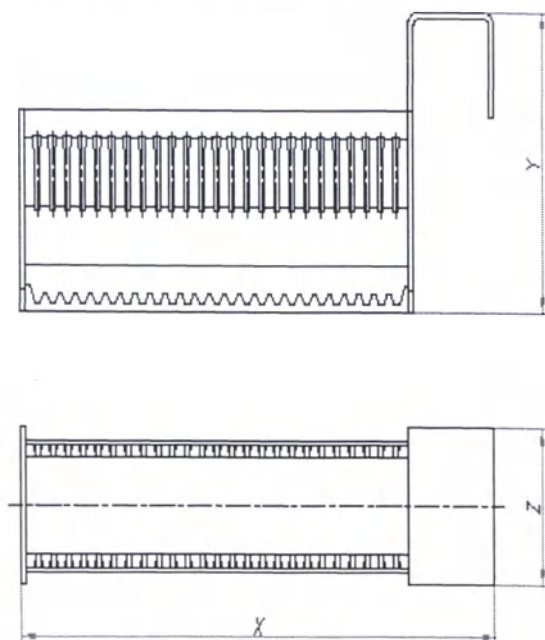

Маркировка



ШТАТИВ-B8

ЕАТС.02.51.00

для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-B-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



4



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,

ул. Касаткина, д.11, стр.1

тел.: 8 (495) 287-81-00

E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-130 мм
	Y-70 мм
	Z-35 мм
Масса не более	110 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Ванна-8В

Общий вид

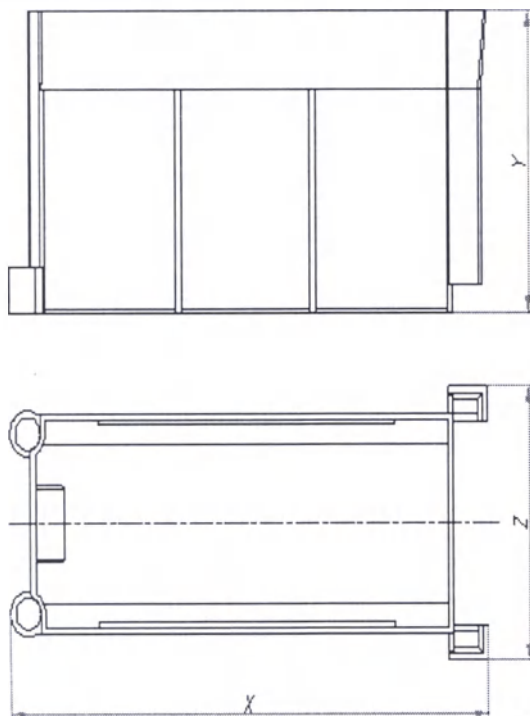

Маркировка



ШТАТИВ-В8

EATC.02.51.00

для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-В-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



4



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-140 мм Y-70 мм Z-65 мм
Масса не более	110 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Ванна проточная-В8

Общий вид

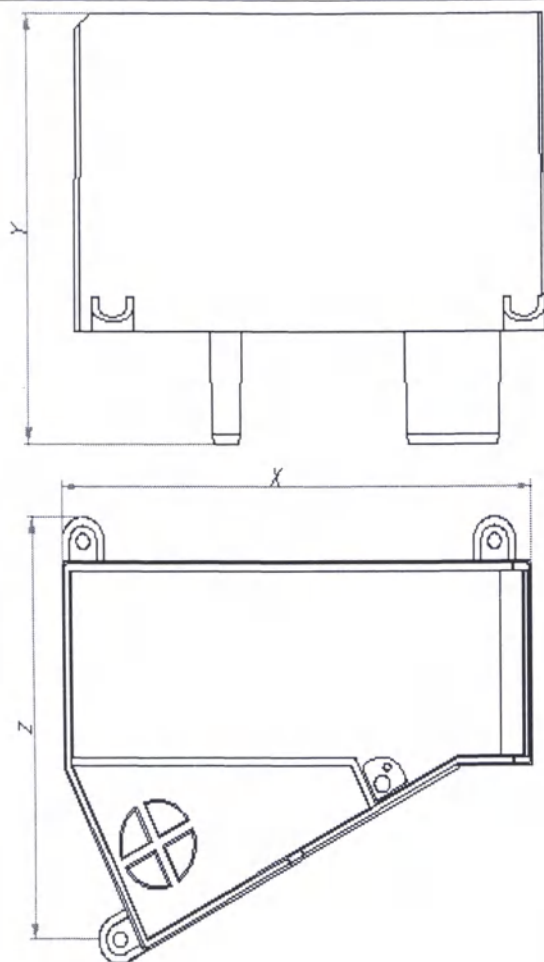

Маркировка



ВАННА ПРОТОЧНАЯ-В8

ЕАТС.02.54.00

для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-В-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



1



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-125 мм Y-100 мм Z-105 мм
Масса не более	370 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Крышка Ванны-В8

Общий вид

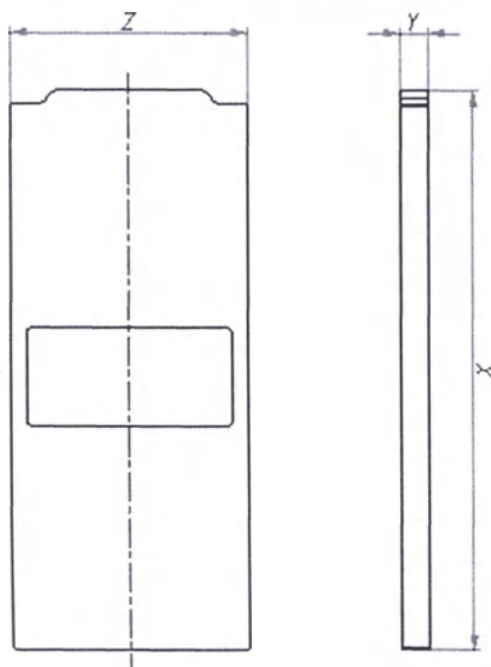

Маркировка



КРЫШКА ВАННЫ-В8

ЕАТС.02.00.22

для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-В-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



7



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-126 мм Y-7 мм Z-55 мм
Масса не более	30 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Ванна-В8П

Общий вид

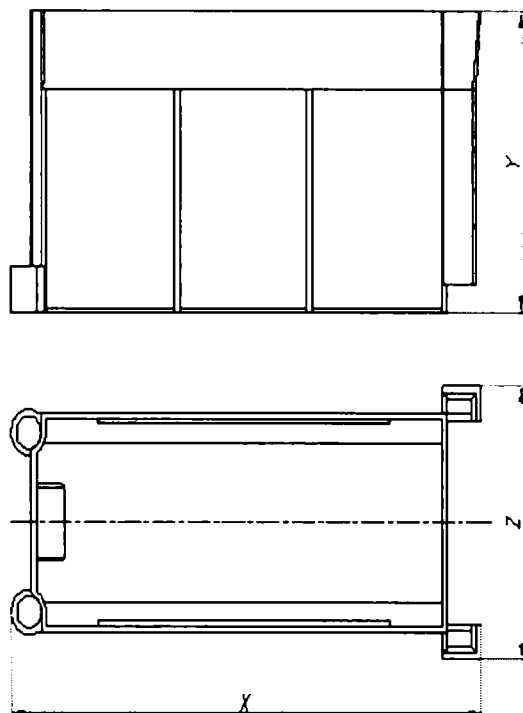

Маркировка



ВАННА-В8П

ЕАТС.02.00.24

Для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови
АФОМК8-В-01
Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



7



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-140 мм Y-70 мм Z-65 мм
Масса не более	110 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Крышка ванны-В8П

Общий вид

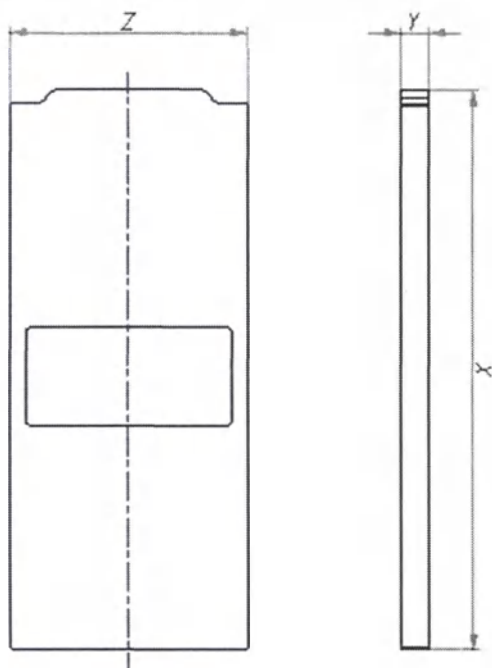

Маркировка



КРЫШКА ВАННЫ-В8П

ЕАТС.02.00.23

для применения с автоматом
фиксации и окраски мазков крови:
АФОМК8-В-01.

Рег. удостоверение №

ТУ 26.60.12-001-95221815-2019



28.06.2019



7



ООО ЭМКО

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры не более	X-126 мм
	Y-7 мм
	Z-55 мм
Масса не более	30 г

Маркировка

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 20
(Мишукова) листов



Генеральный директор
ООО ЭМКО

А.А. Мишукова