

**УТВЕРЖДАЮ**


**Директор**



## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 287-65614693-2022»**

2023

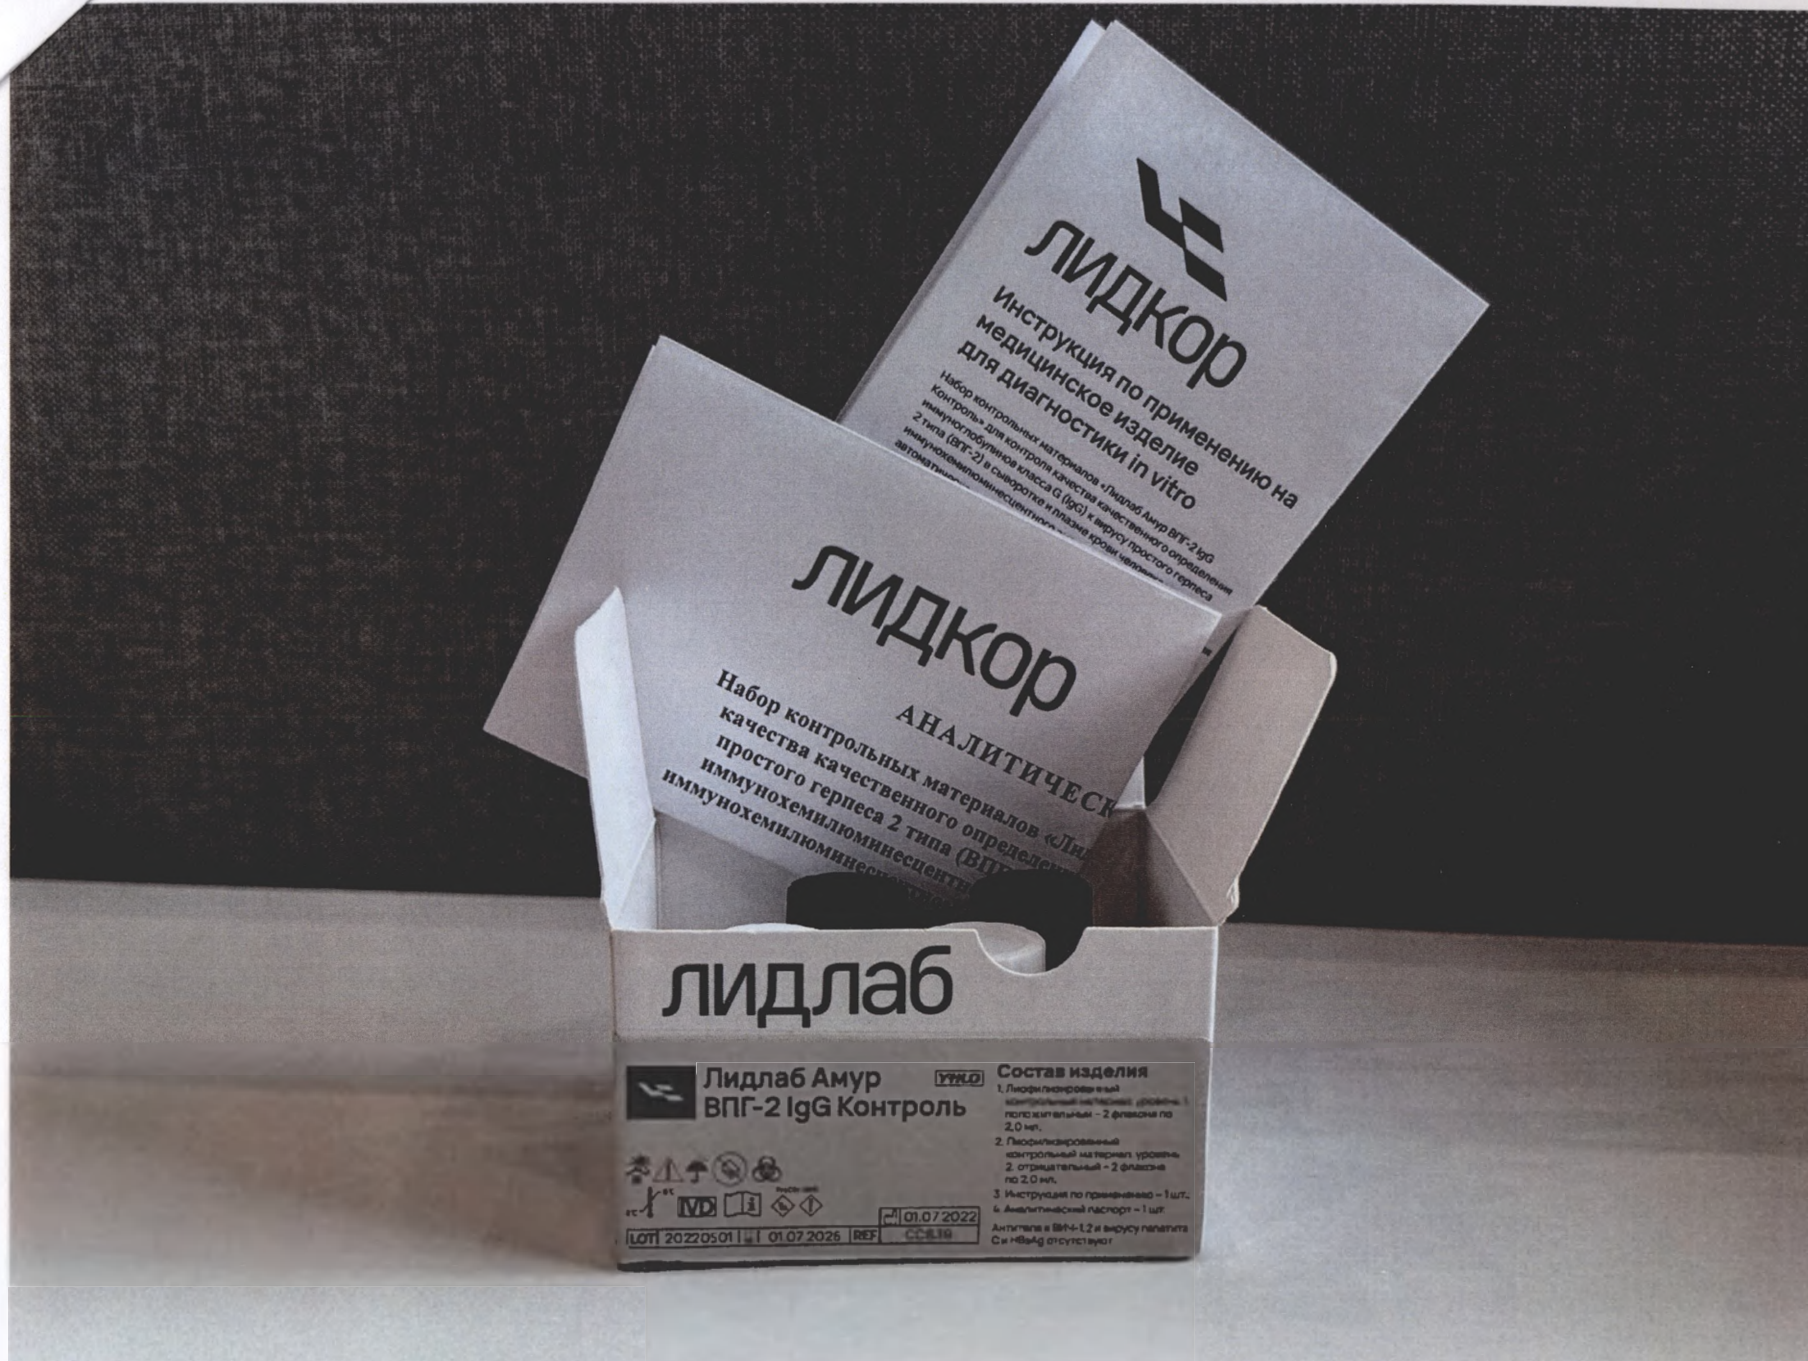



### ООО «ЛИДКОР»


Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,  
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.  
Телефон: 8 800 500 7128. leadcore.ru

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG  
Контроль» для контроля качества качественного определения  
иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса  
2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом  
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе  
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур»  
для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 287-65814693-2022.


Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ N° РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,  
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

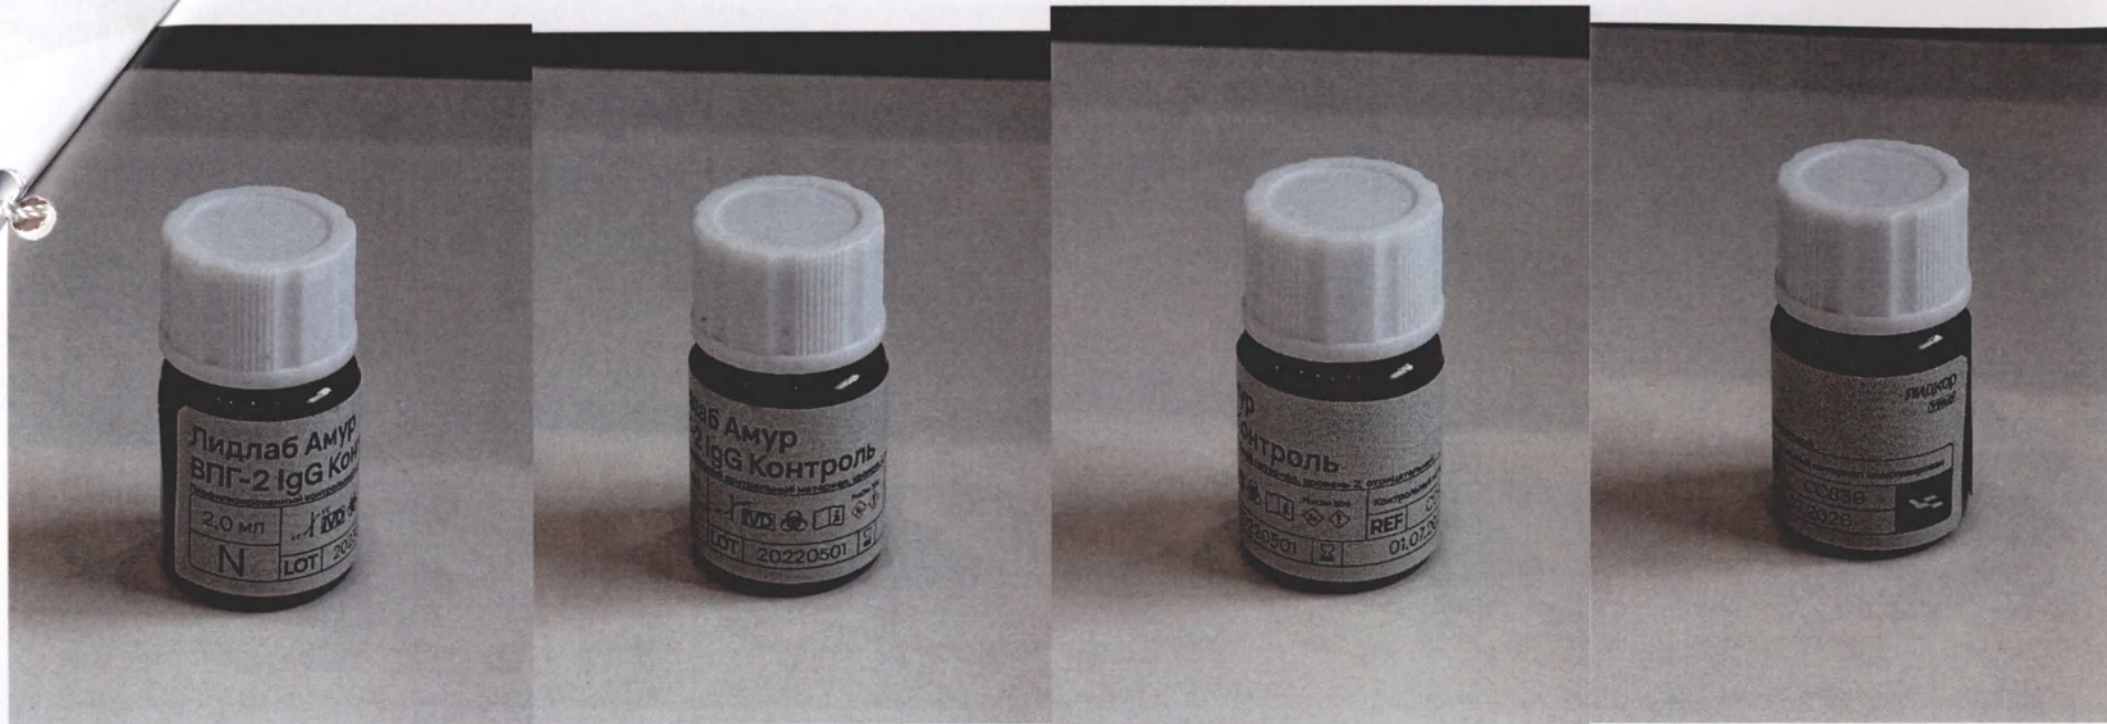

**Контрольный материал, уровень 2, отрицательный**

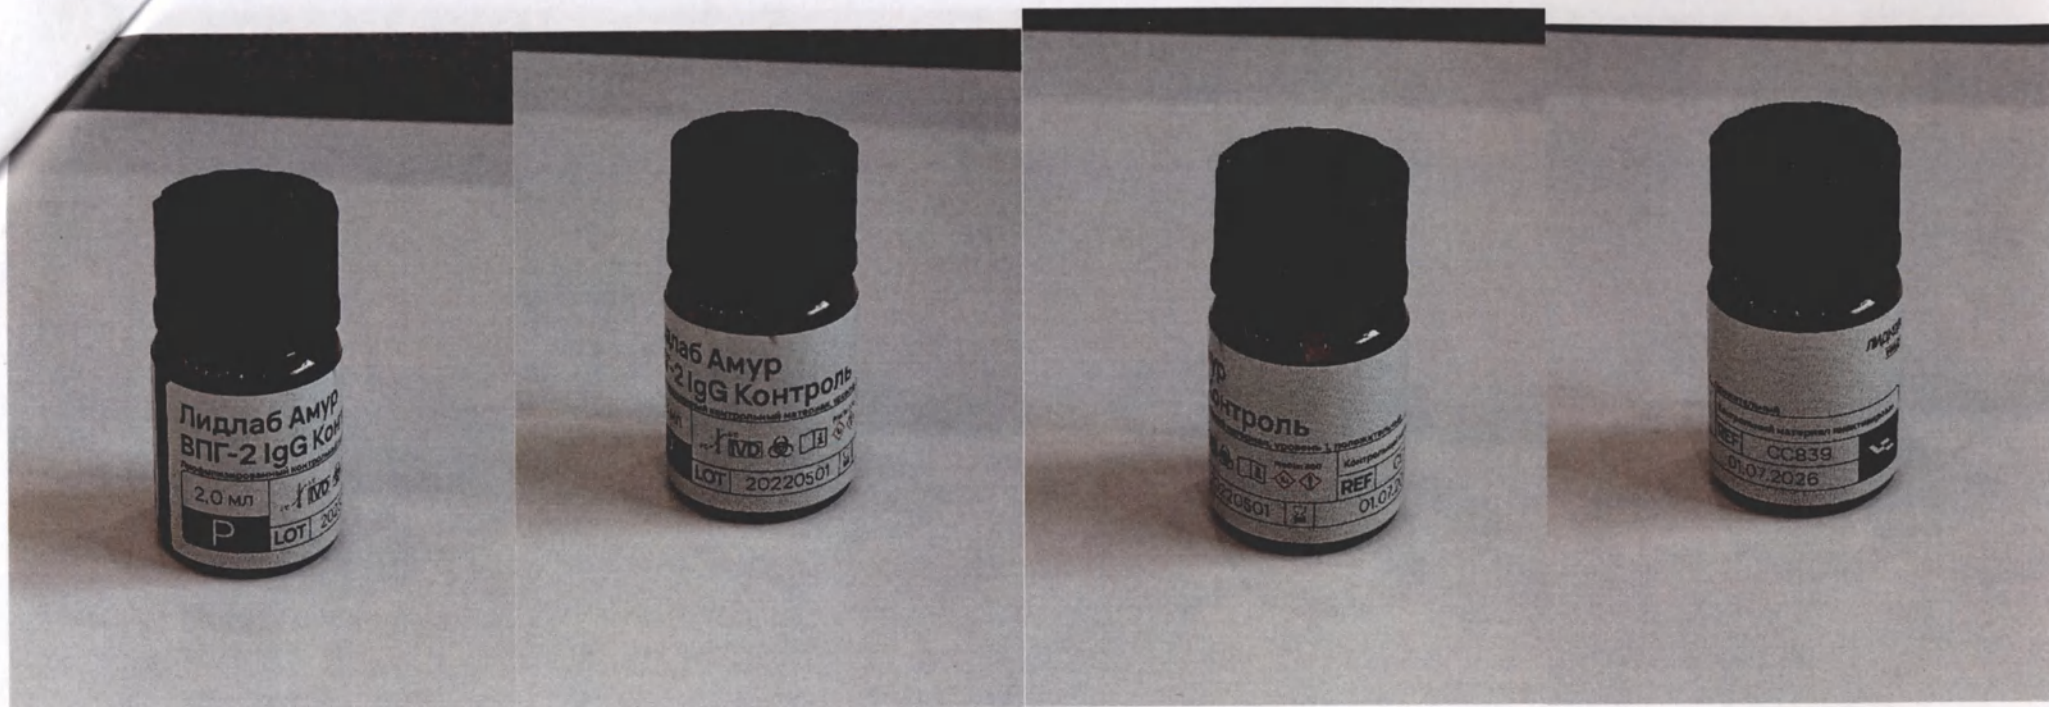

Контрольный материал, уровень 1, положительный



Транспортная тара

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

7 ( Семь ) л.

Директор

ООО «ЦИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

2023 г.

## МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 287-65614693-2022»

2023

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 287-65614693-2022.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:


☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,  
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG Контроль

YHLO

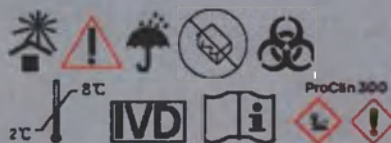

|     |          |            |     |       |
|-----|----------|------------|-----|-------|
| LOT | 20230701 | 01.07.2027 | REF | CC839 |
|-----|----------|------------|-----|-------|

### Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

### Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG Контроль

лидкор  
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный

|        |     |          |            |     |       |                                    |
|--------|-----|----------|------------|-----|-------|------------------------------------|
| 2,0 мл |     |          |            |     |       | Контрольный материал инактивирован |
| N      | LOT | 20230701 | 01.07.2027 | REF | CC839 |                                    |

### Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG Контроль

лидкор  
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

|        |     |          |            |     |       |                                    |
|--------|-----|----------|------------|-----|-------|------------------------------------|
| 2,0 мл |     |          |            |     |       | Контрольный материал инактивирован |
| P      | LOT | 20230701 | 01.07.2027 | REF | CC839 |                                    |

лидър


**СИНДРОМ**

Для профессионального применения

000 471464K08P1

**Address:** 800 631-2424; [www.merck.com](http://www.merck.com)

# Макет транспортной маркировки

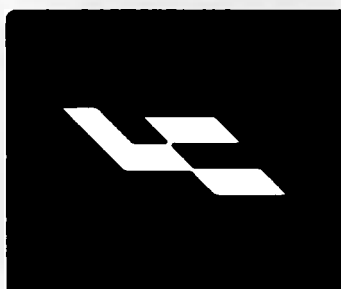


Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgG Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 287-65614693-2022



Для профессионального применения

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                   |            |                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |                                                                                   |            |  | XX.XX.XXXX |
| LOT                                                                               | XXXXXXXXXX                                                                                                                     |  | XX.XX.XXXX | REF                                                                                 | CC839      |

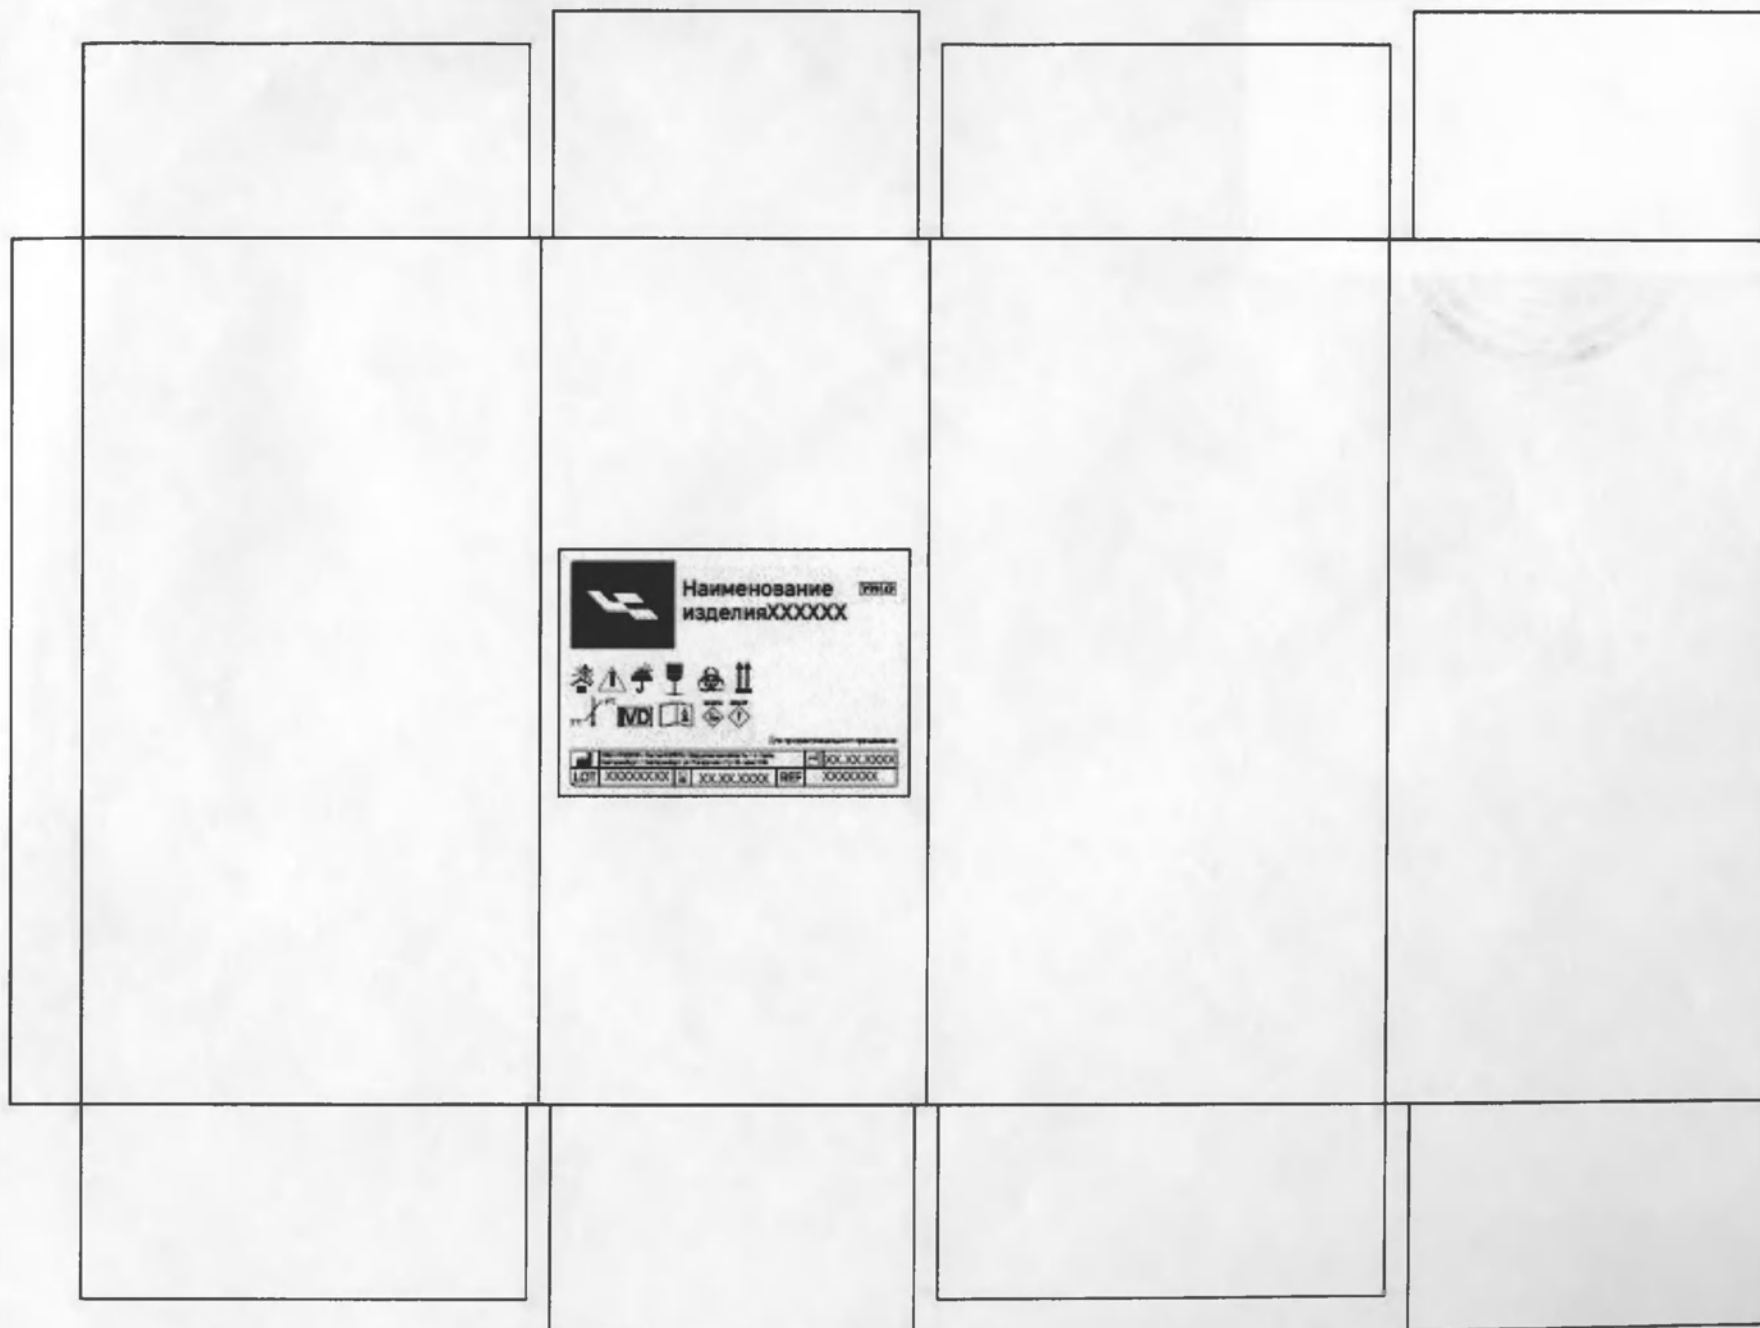

Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

5 (Лечебная)

Директор  
ООО «ЛИДКОР»

/Е.Ю. Гохгут/

