

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«19» октября 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного
определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в
сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ
21.20.23-260-65614693-2022»**


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Краснуха IgM

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88036M
-----	----------	------------	-----	---------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент-антиген (R3), 3,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Краснуха IgM

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88036M
-----	----------	------------	-----	---------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент-антиген (R3), 3,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Краснуха IgM

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88036M
-----	----------	------------	-----	---------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент-антиген (R3), 3,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Краснуха IgM

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88036M
-----	----------	------------	-----	---------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент-антиген (R3), 3,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор

YHLO

Лидлаб Амур

Краснуха IgM

IVD

3,5мл

6,5мл

3,5мл

6,5мл

R 1

R 2

R 3

R 4

LOT

20230701

8°C

20

1

Proclin 300

1+50

01.07.2024

4701

1017

1306

9031

лидкор

Лидлаб Амур

Краснуха IgM

Пароизоляционные крышки – 4 шт.

LOT

20230701

01.07.2024

REF

C88036M

лидкор

Лидлаб Амур Краснуха IgM

8°C

IVD

20

1

Proclin 300

1

1,0 мл

LOT

20230701

01.07.2024

CAL 1

REF

C88036M

лидкор

Лидлаб Амур Краснуха IgM

8°C

IVD

20

1

Proclin 300

1

1,0 мл

LOT

20230701

01.07.2024

CAL 2

REF

C88036M

Лидлаб Амур Краснуха IgM


LOT 20230701

EXP 01.07.2024


ООО ЦИРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


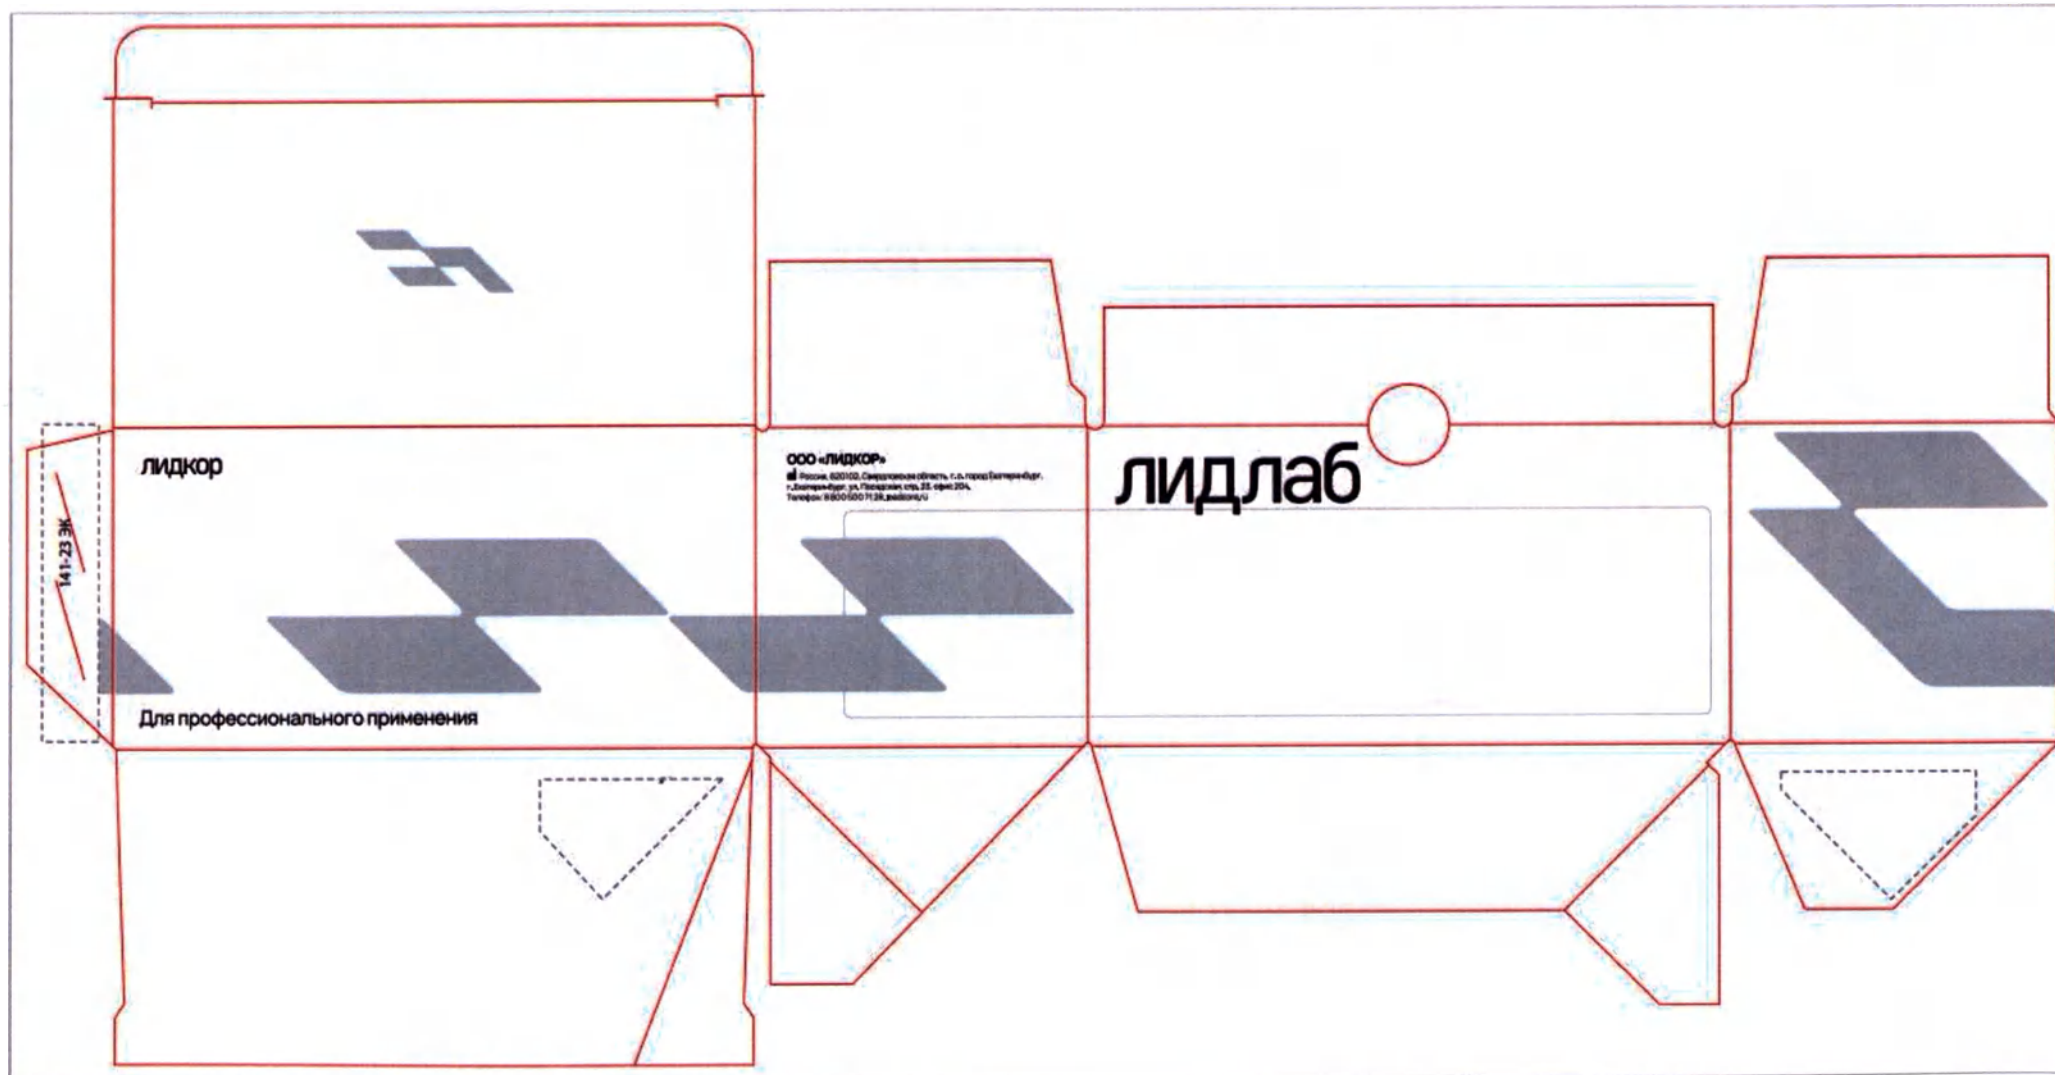


Макет транспортной маркировки

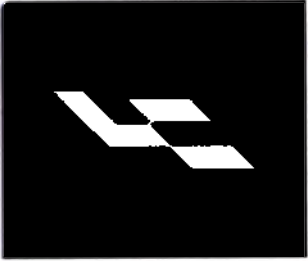


Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022







Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX		
LOT	XXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C88036M

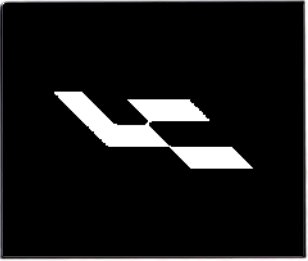


Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022






Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX		
LOT	XXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C88036M

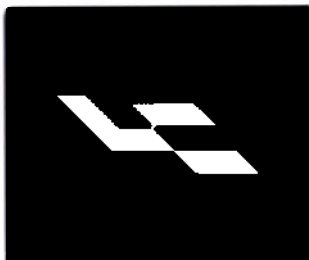


Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022

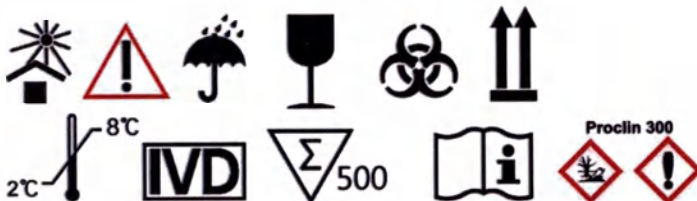

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXX		XX.XX.XXXX REF C88036M

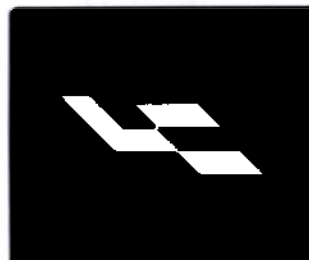

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXX		XX.XX.XXXX REF C88036M

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.	 XXX
Наименование изделия	 MM.GTTT
 XXXXXX	
 XXXXXXXX	 Только для in vitro диагностики Для профессионального применения
	
	 2°C 8°C
	
	GHS07  

и скреплено печатью
8 (восемь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«19» октября 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022»

2023


картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.,
Реагент-антиген (R3), 3,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.)

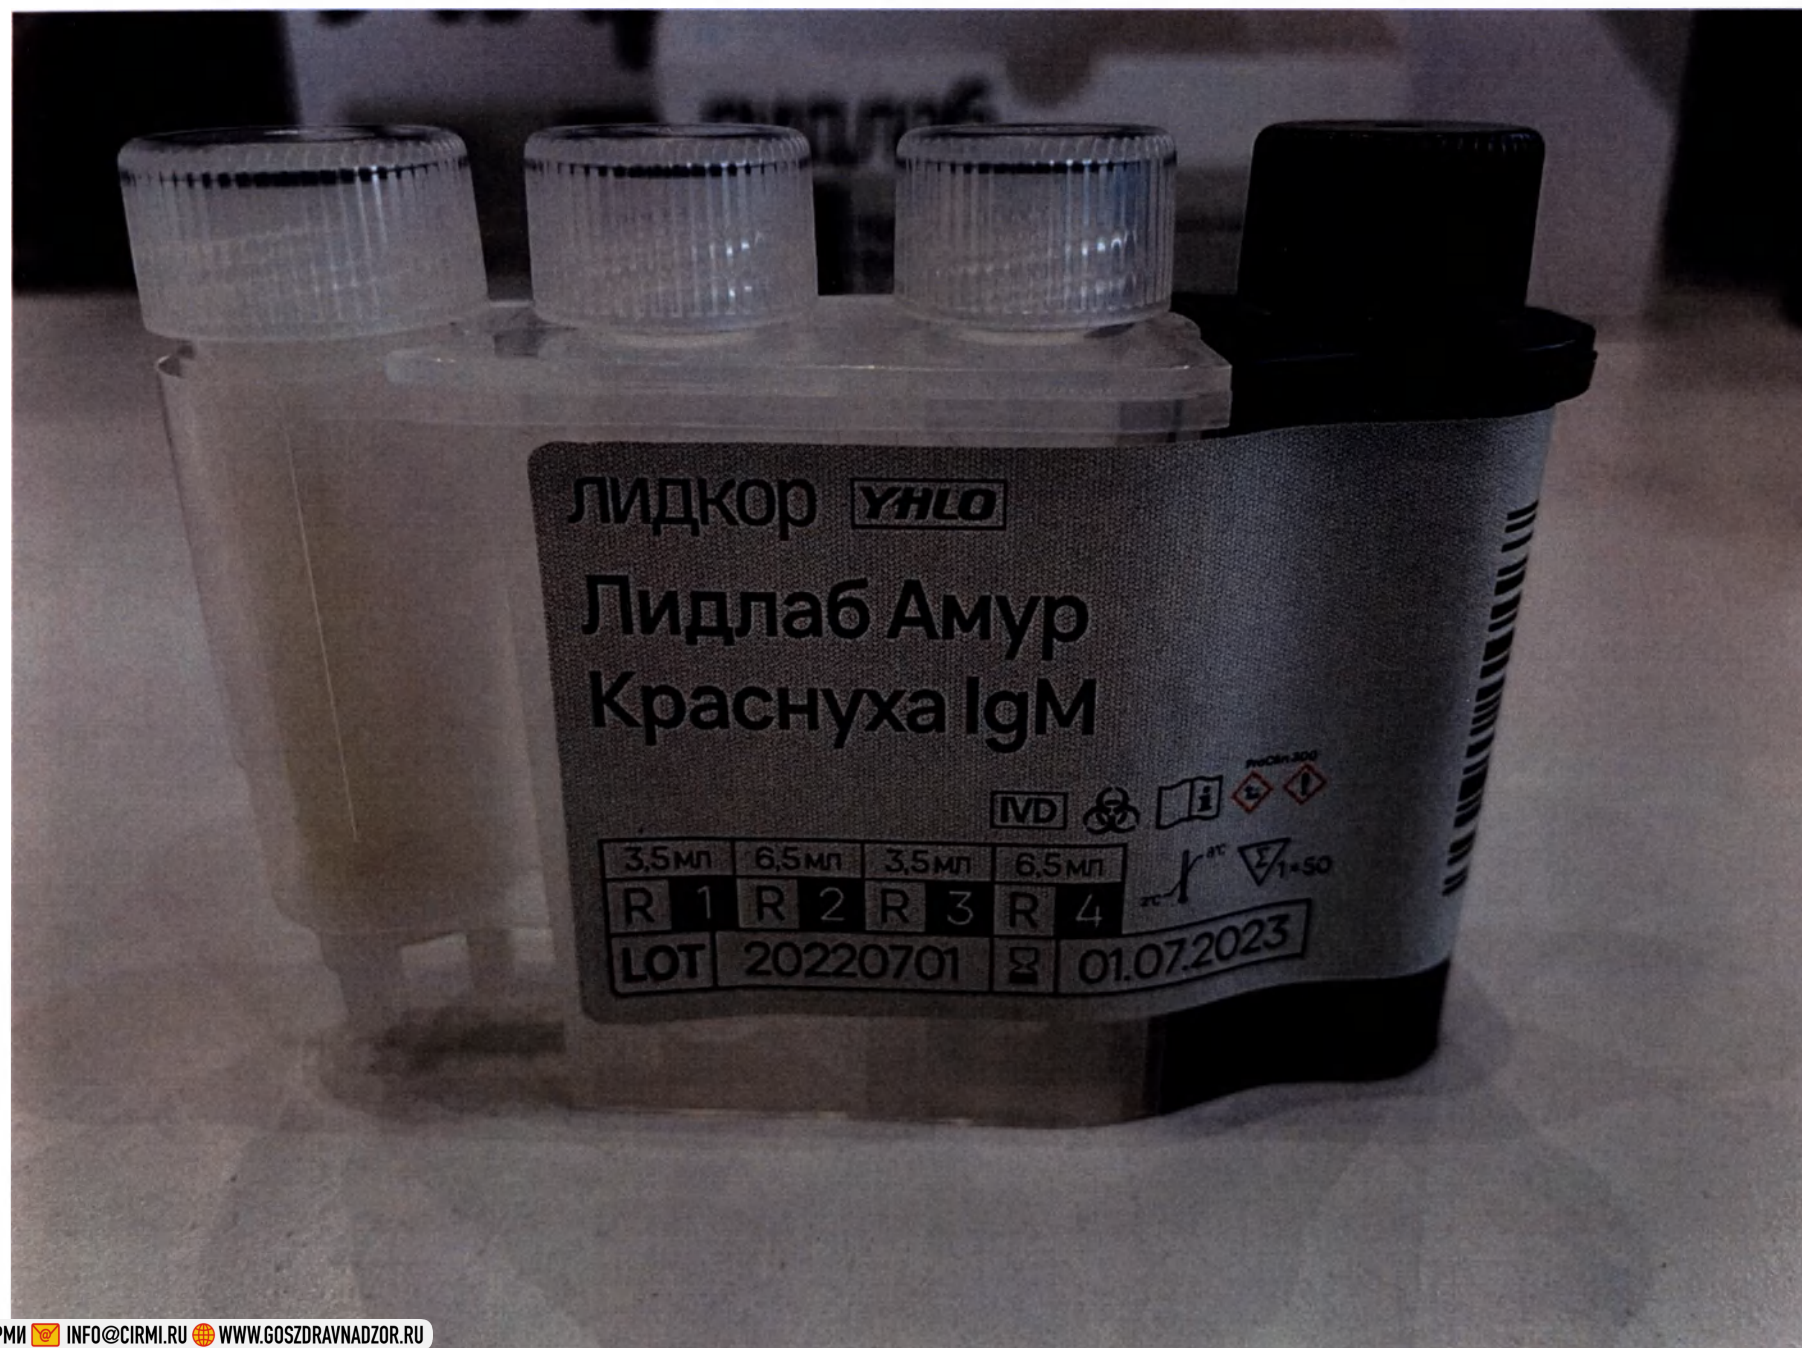


Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон




Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

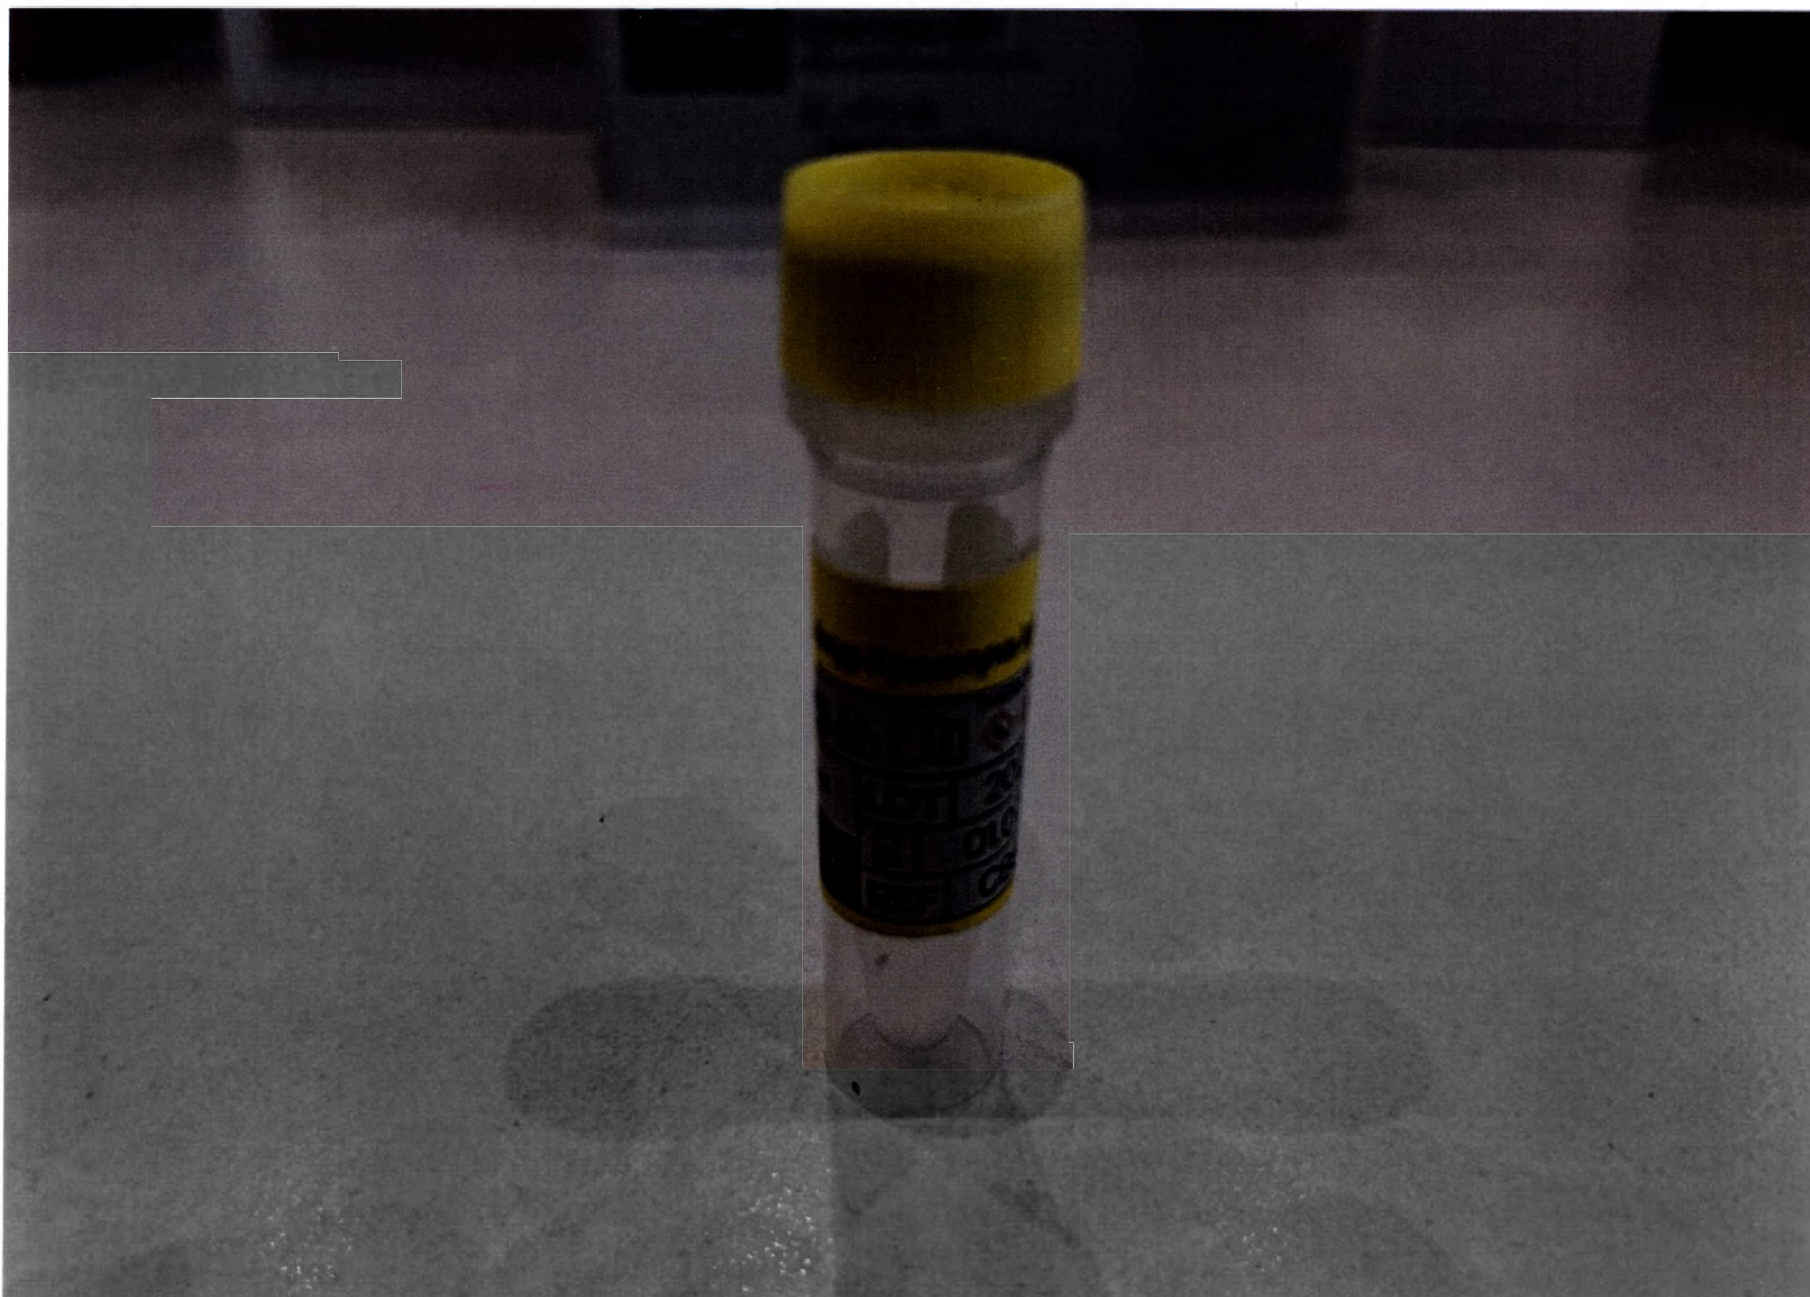


Пароизоляционные крышки

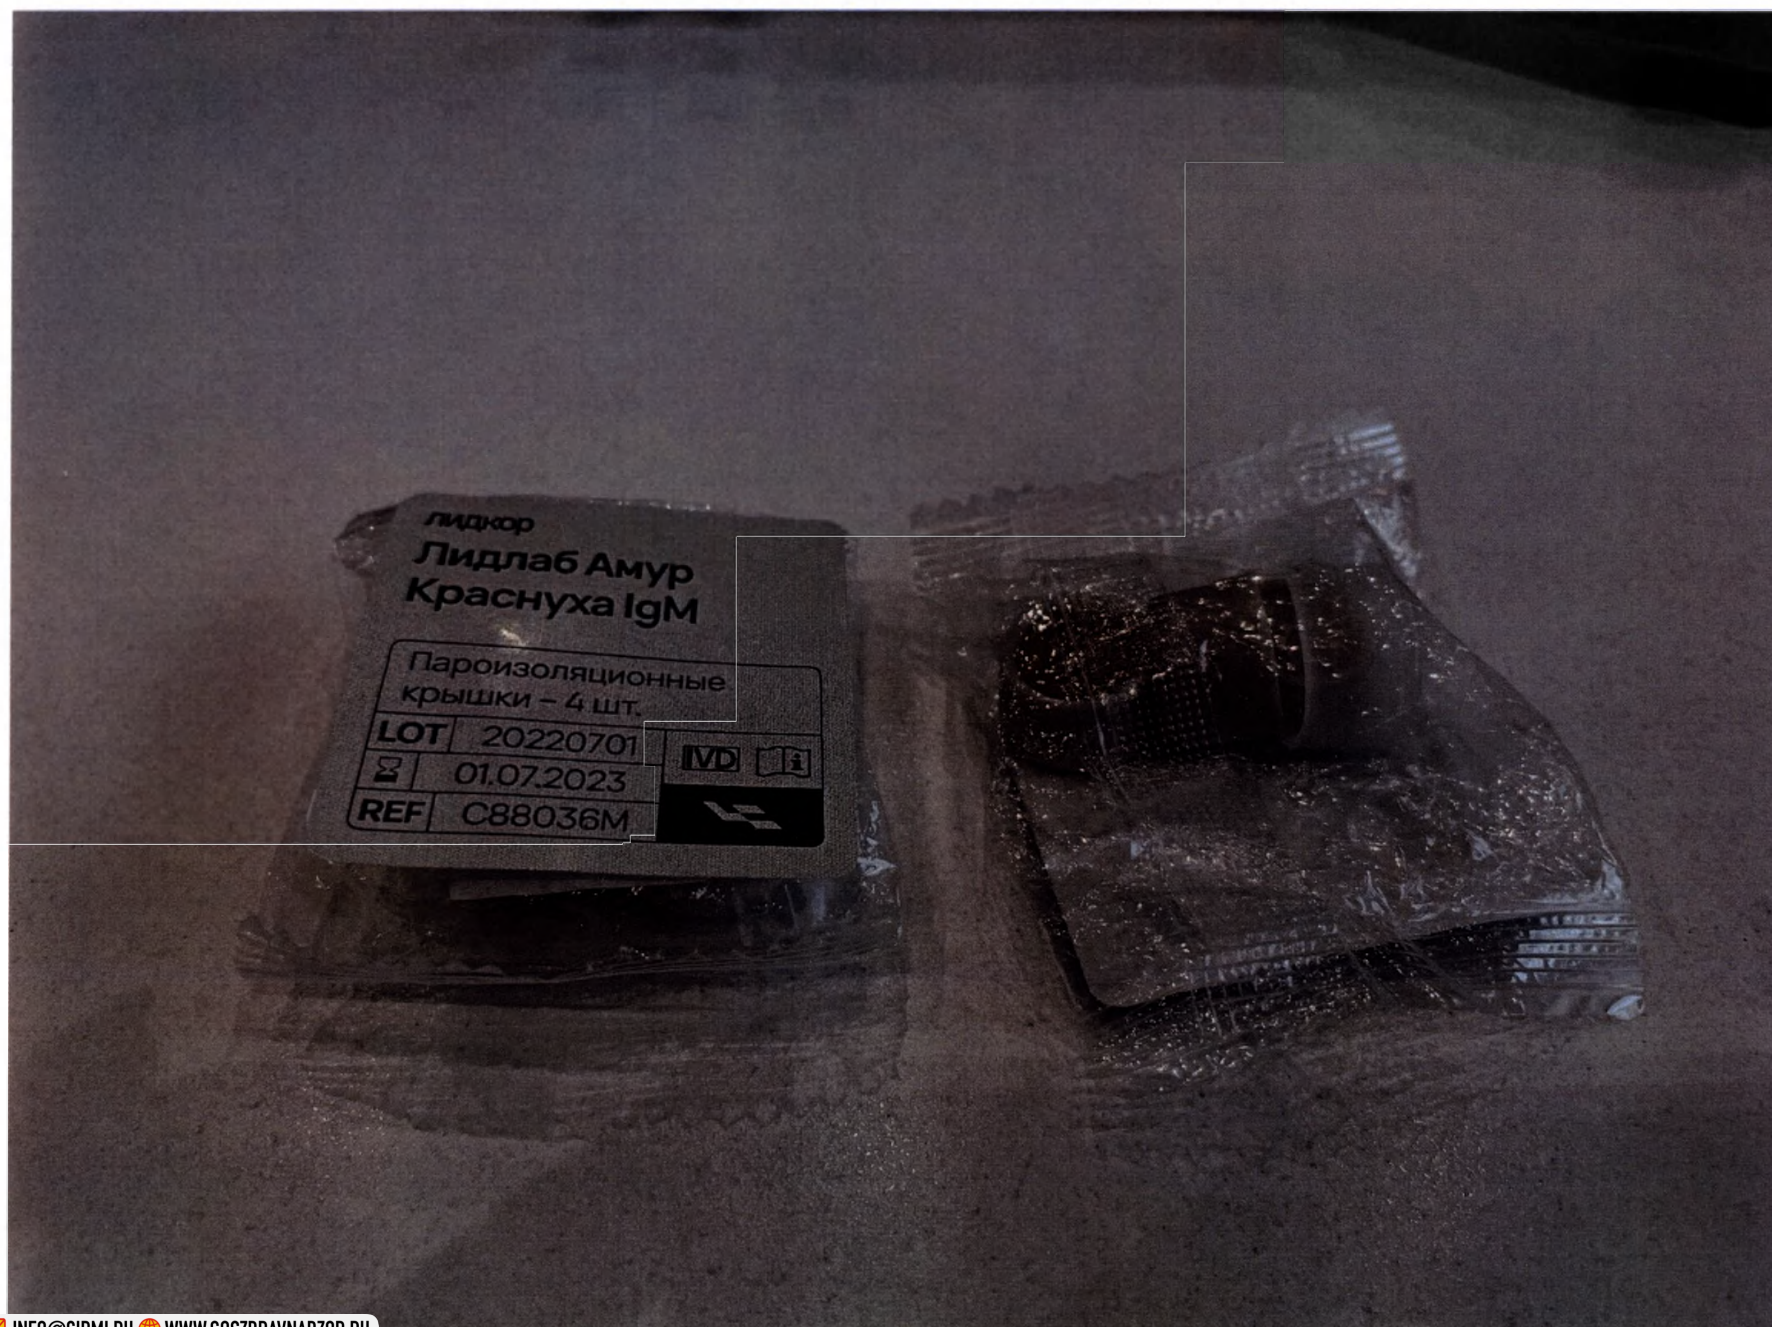

Набор реагентов на 100 тестов

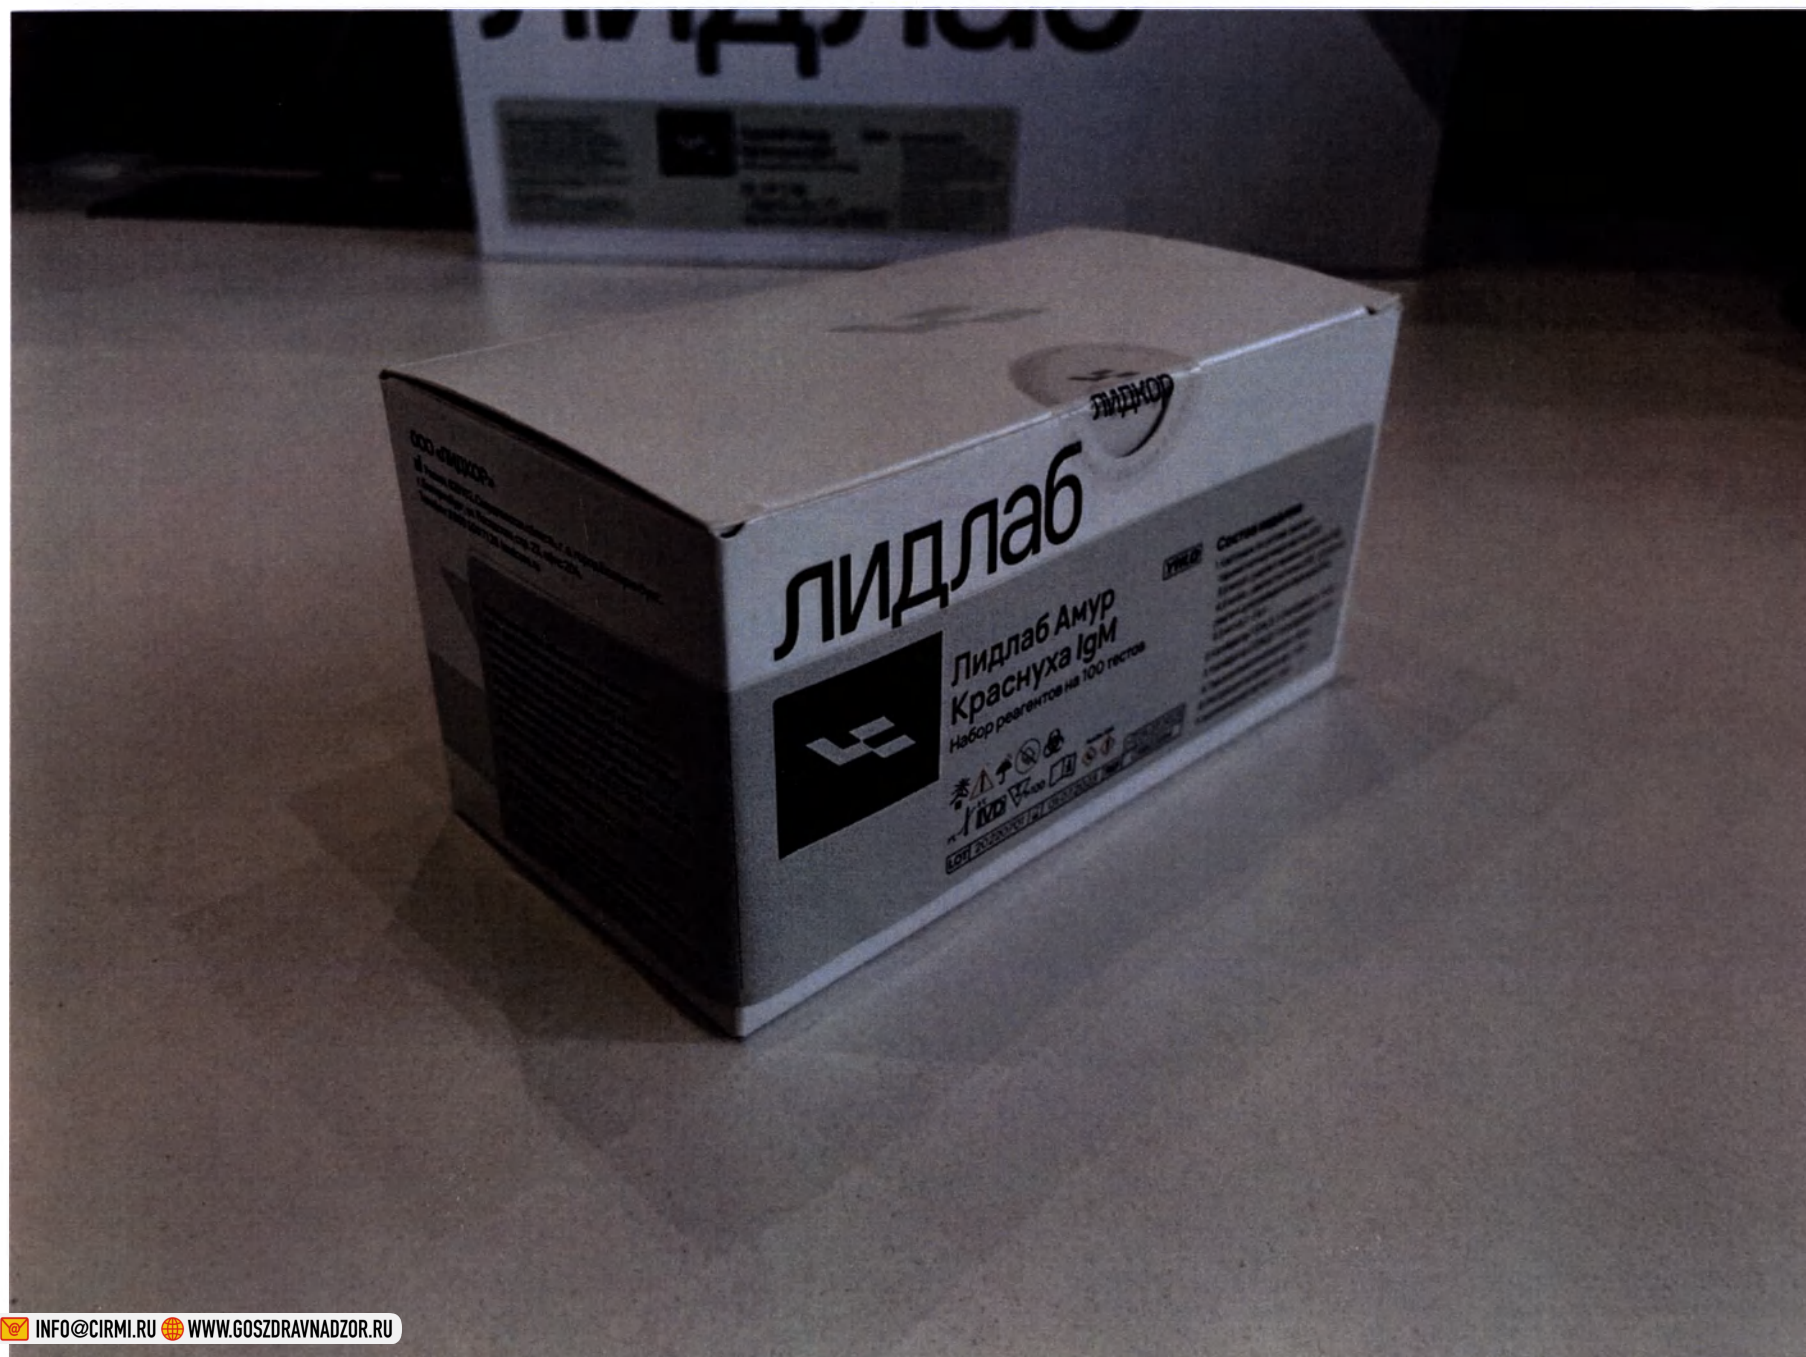

Набор реагентов на 100 тестов (вид сзади)

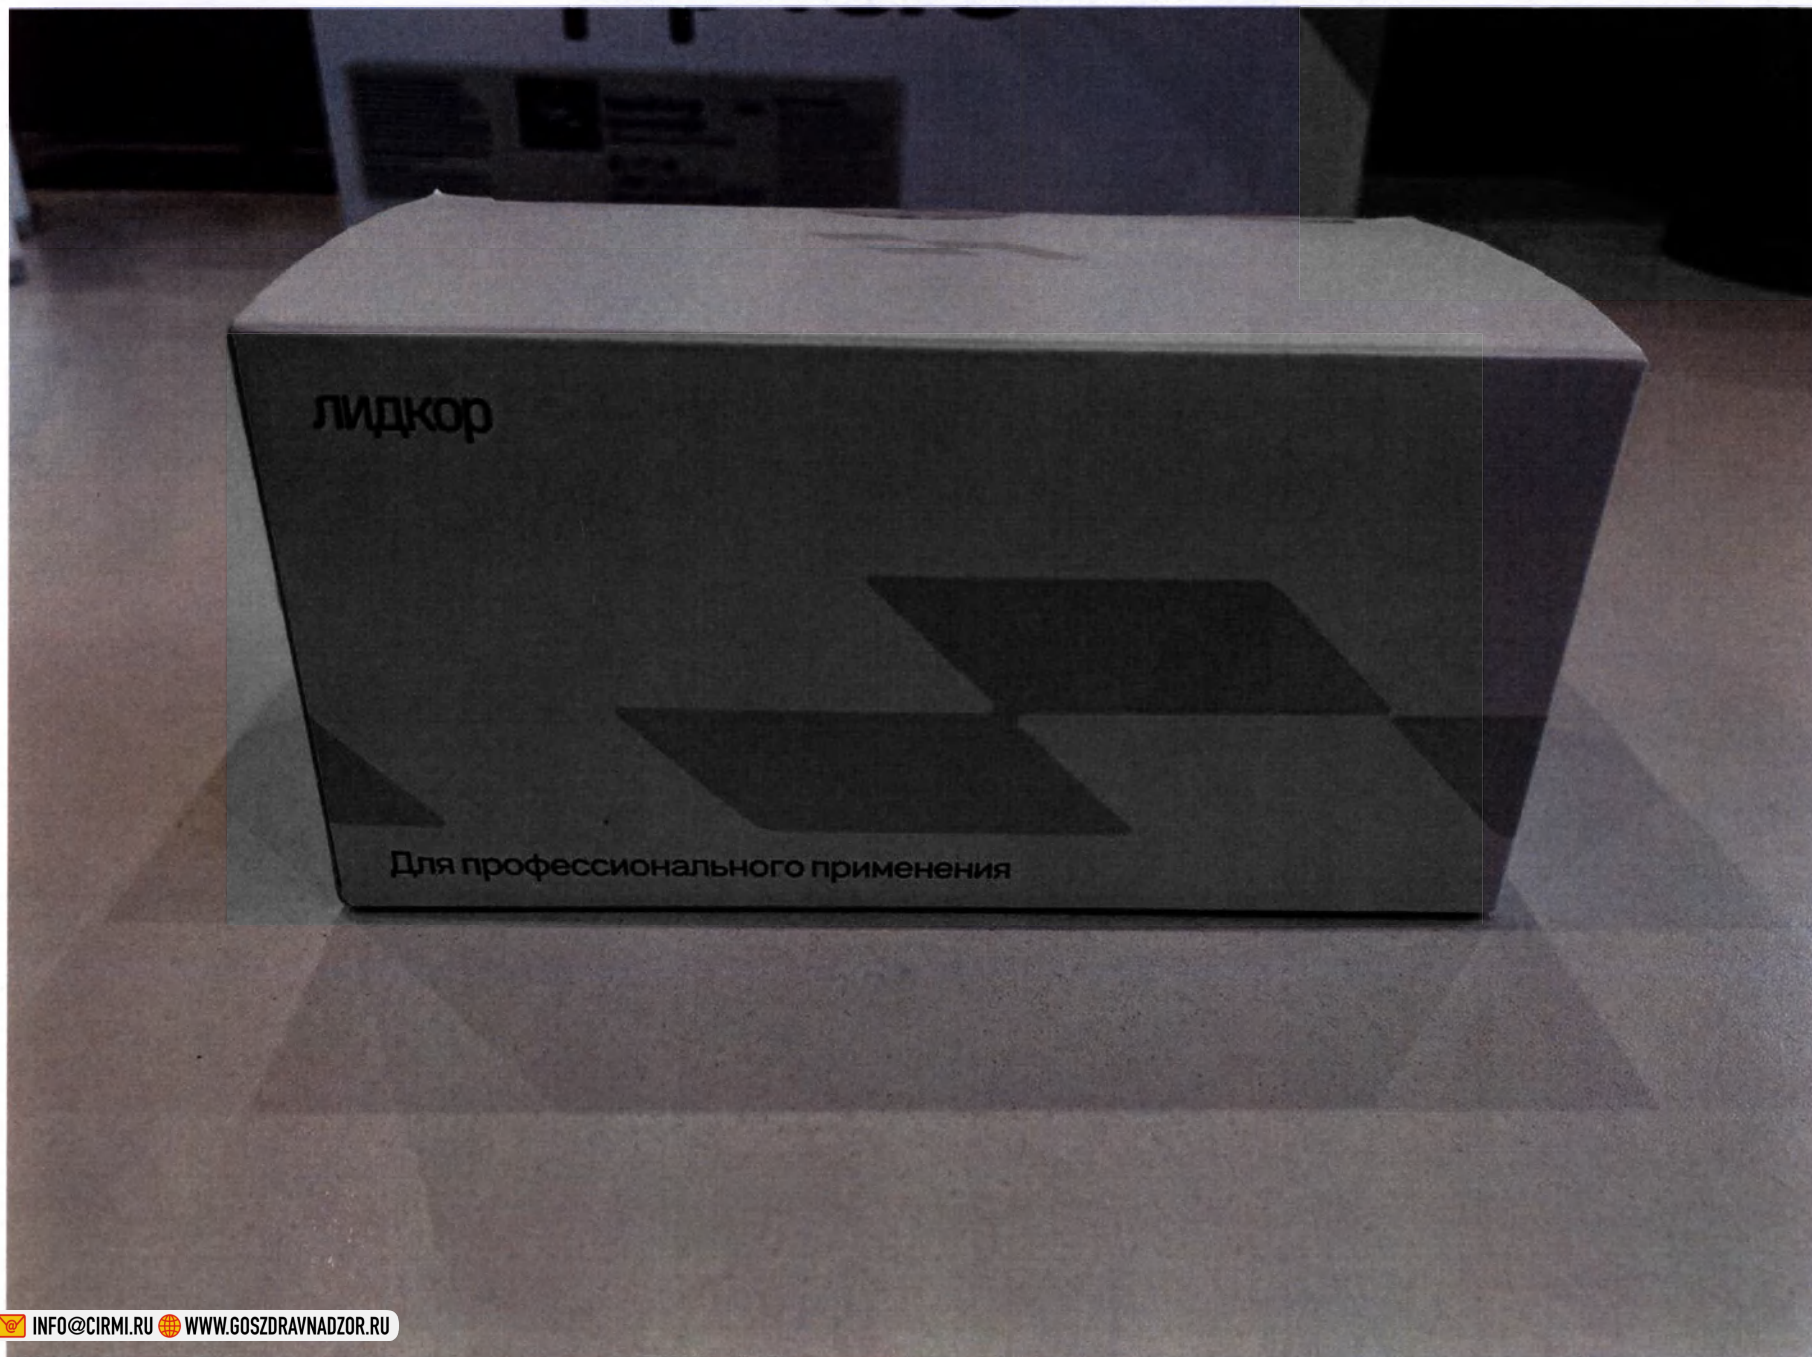

Набор реагентов на 200 тестов

лидлаб



Лидлаб Амур Краснуха IgM

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент-антиген (R3), 3,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.



2°C - 8°C
IVD
Σn=200

ProCln 300

LOT 20220701 01.07.2023 REF C88036M 01.07.2022

лидкор

Для профессионального применения

Набор реагентов на 200 тестов (вид сбоку)

лидлаб

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102 Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса M (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-260-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Набор реагентов на 500 тестов

лидлаб

лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» для выявления антител к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа (ИФА).
 Набор реагентов на 500 тестов.
 Номер и дата регистрации в Росздравнадзоре: RU.07.0000000000 от 10.12.2022.

Лидлаб Амур Краснуха IgM
 Набор реагентов на 500 тестов



RU.07.0000000000 от 10.12.2022

УПЛО


Состав изделия

1. Карtridge (каридж) - 1 шт.
2. 5 мл/шт. реагент основной (R02).
3. 5 мл/шт. реагент для разведения образца (R4).
4. 5 мл/шт. - 10 шт.
5. Калибратор 1 (C4), 6, 10 мл/шт. - 5 шт.
6. Калибратор 2 (C4), 6, 10 мл/шт. - 5 шт.
7. Калибраторный фермент - 4 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.
9. Ассортиментный комплект - 1 шт.

Набор реагентов на 500 тестов (вид сзади)



Набор реагентов на 500 тестов (вид сбоку)

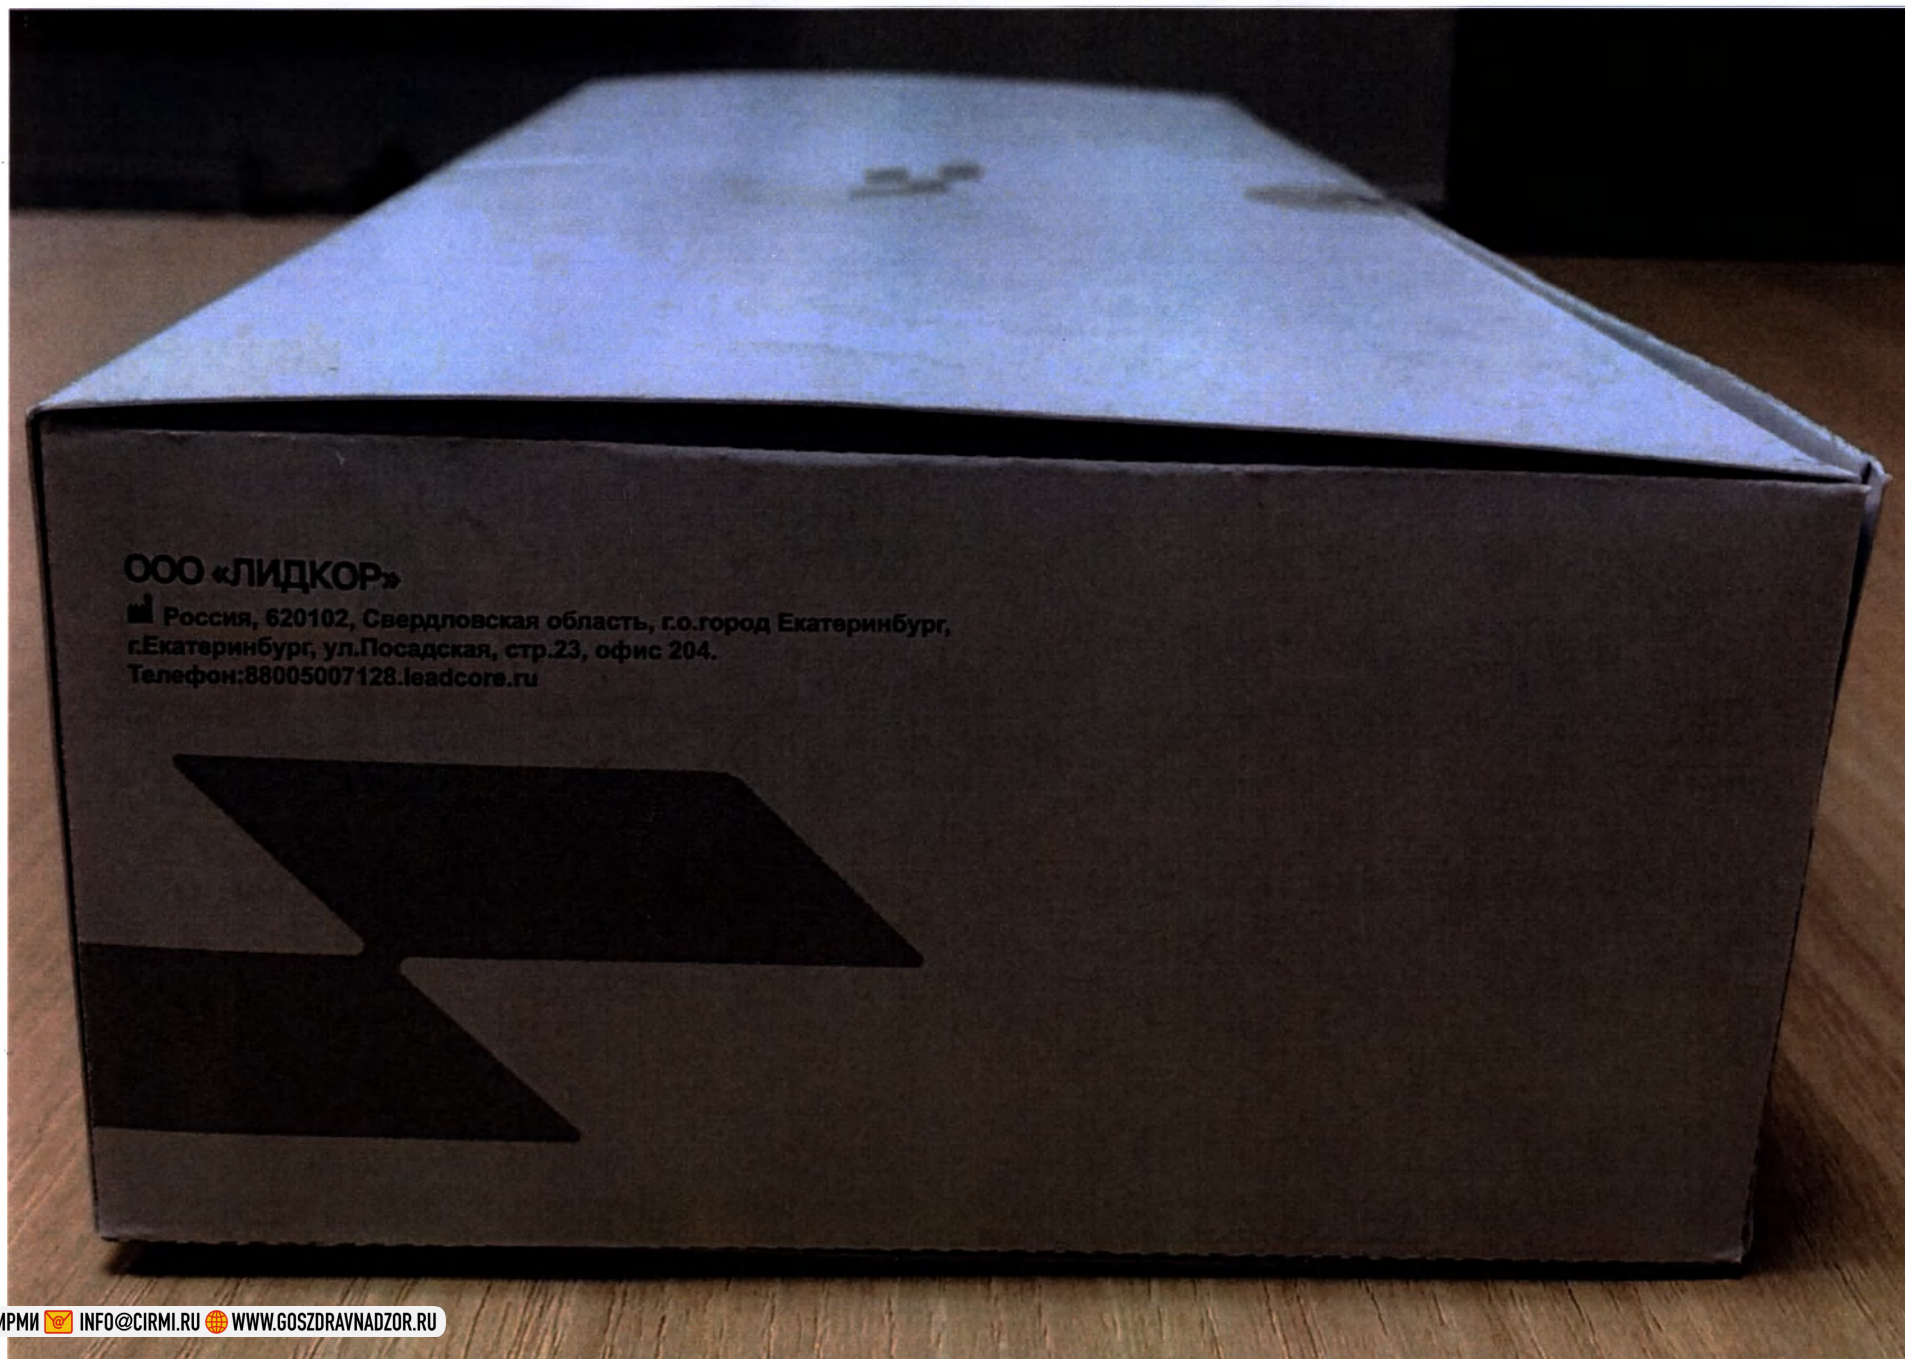

Набор реагентов на 1000 тестов

лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgM» предназначен для качественного определения антител класса М (IgM) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) на анализаторе для иммунохроматографического анализа «Лидлаб Амур» для диагностики в объеме на ТП 21.20.201 «ИСО-ИФА» № 01.2022. Набор реагентов на 1000 тестов.


Исходный и дата регистрации в установленном порядке.

Исходный и дата регистрации в установленном порядке.

Исходный и дата регистрации в установленном порядке.


Исходный и дата регистрации в установленном порядке.

Исходный и дата регистрации в установленном порядке.



Лидлаб Амур
Краснуха IgM
Набор реагентов на 1000 тестов


YMO



Состав изделия

1. Карtridge, 10 картриджей реагент
2. 5 картриджей, реагент начальной диагностики (N2)
3. 5 картриджей, реагент контроля (K2), 1.5 мл/шт.
4. 5 картриджей, реагент для диагностики (D2), 1.5 мл/шт.
5. 5 картриджей, 1 - 20 шт.
6. 5 картриджей, 1 шт.
7. 5 картриджей, 1 шт.
8. 5 картриджей, 1 шт.
9. 5 картриджей, 1 шт.
10. 5 картриджей, 1 шт.
11. 5 картриджей, 1 шт.
12. 5 картриджей, 1 шт.
13. 5 картриджей, 1 шт.
14. 5 картриджей, 1 шт.
15. 5 картриджей, 1 шт.
16. 5 картриджей, 1 шт.
17. 5 картриджей, 1 шт.
18. 5 картриджей, 1 шт.
19. 5 картриджей, 1 шт.
20. 5 картриджей, 1 шт.

Набор реагентов на 1000 (вид сзади)

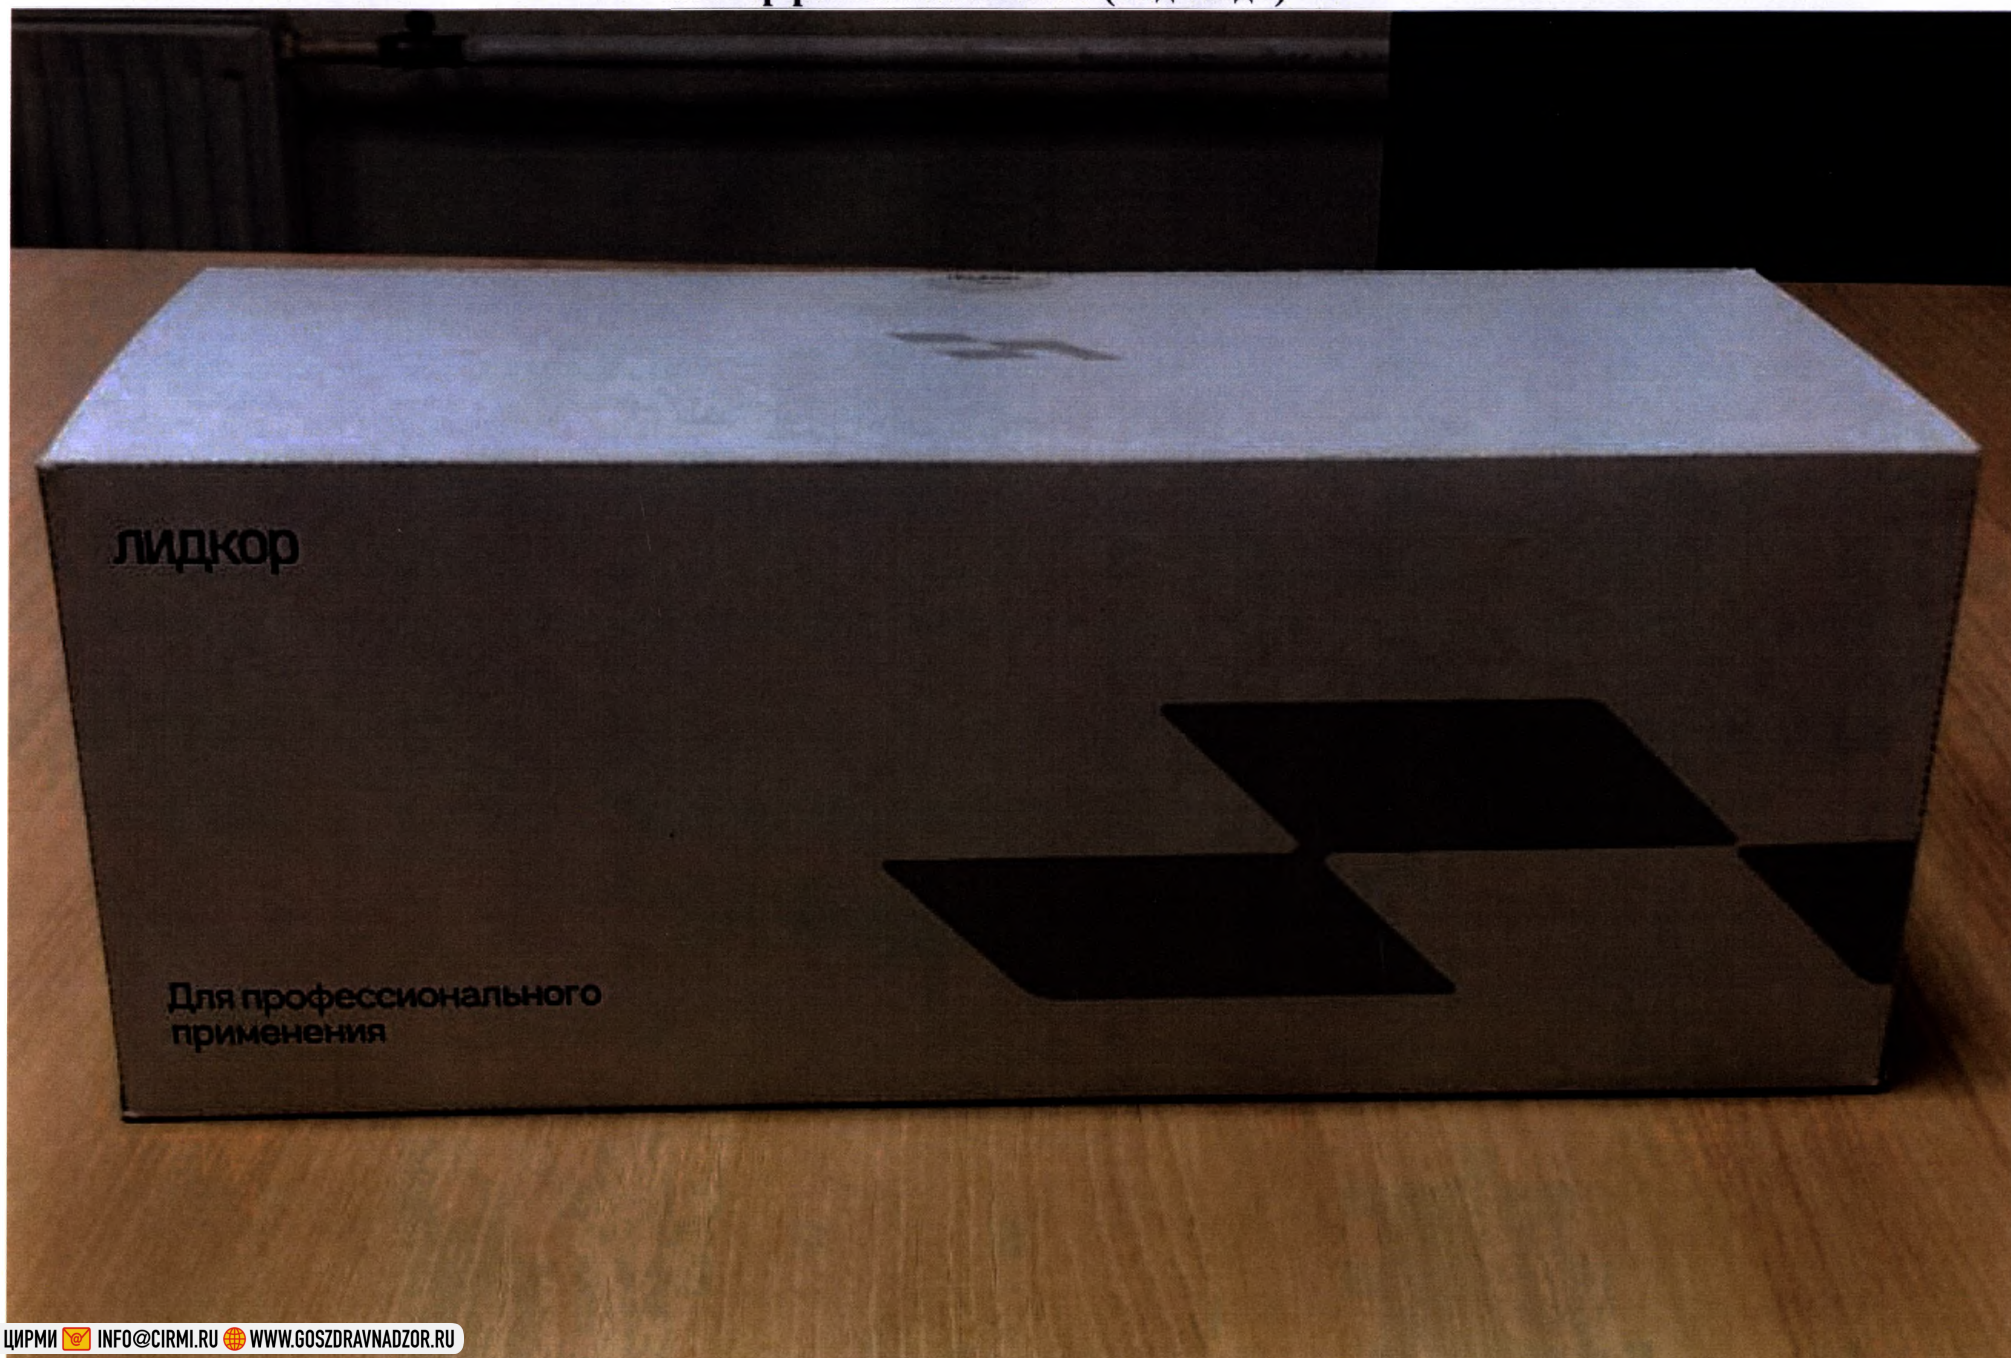


Набор реагентов на 1000 тестов (вид сбоку)



Групповое фото



Транспортная упаковка

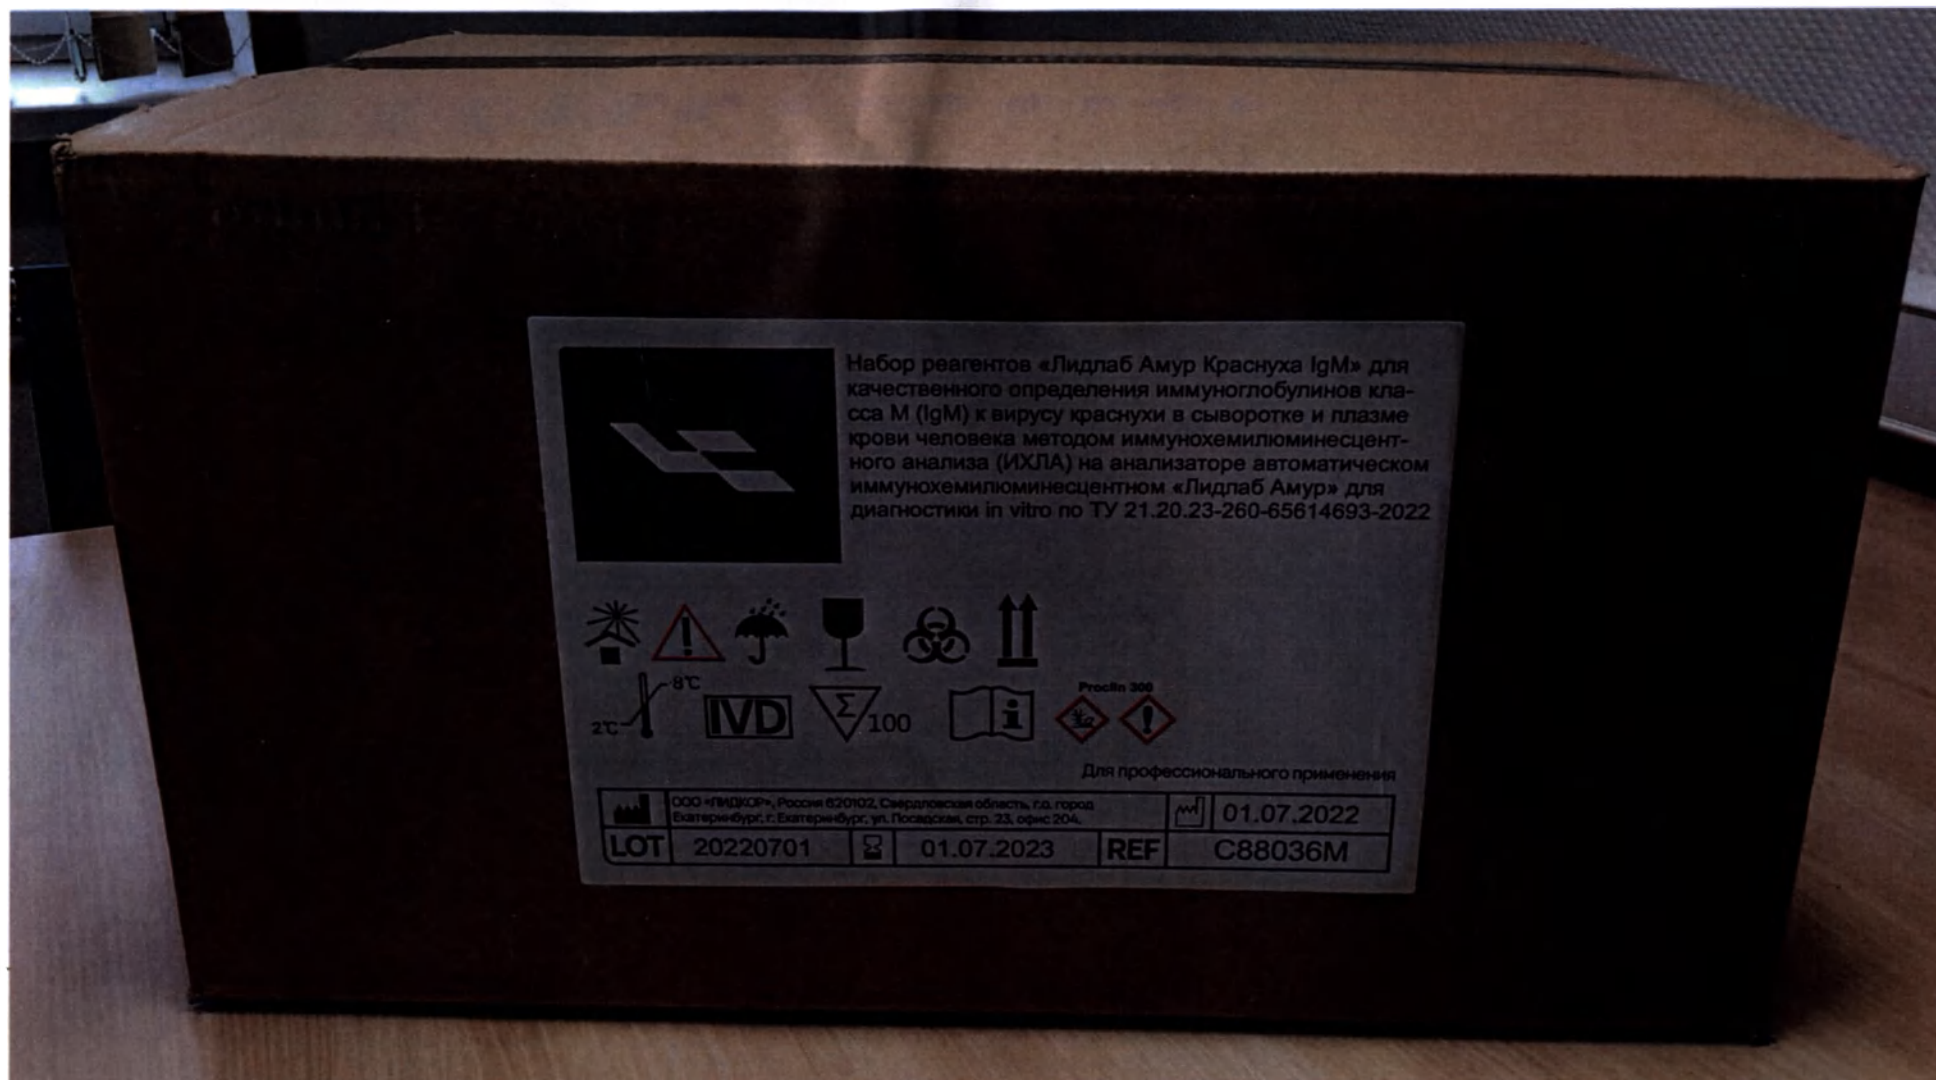

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

18 (Восемнадцать) л.

Директор
ООО «ДИДКОР»



/Е. Ю. Гохгут/