

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Дентсплай Сирона»



 Левин К.Г.

« 26 » 12 2023г.

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023

Фотографическое изображение МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лотки для инструментов для систем дентальных имплантатов, варианты
исполнения: Astra Tech Implant System®, Ankylos®, Xive®, с принадлежностями
производства

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany





**Large Tray EV
Overlay 2**

REF 25722 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01) 07392532002007
(11) 220701
(10) 123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

2022-07-01



R_xOnly



**Dentsply
Sirona**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



21002872

Лоток хирургический большой EV (Large Tray EV)

Large Tray EV

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 25769



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:


ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:

XXX



ifu.dentsplysirona.com

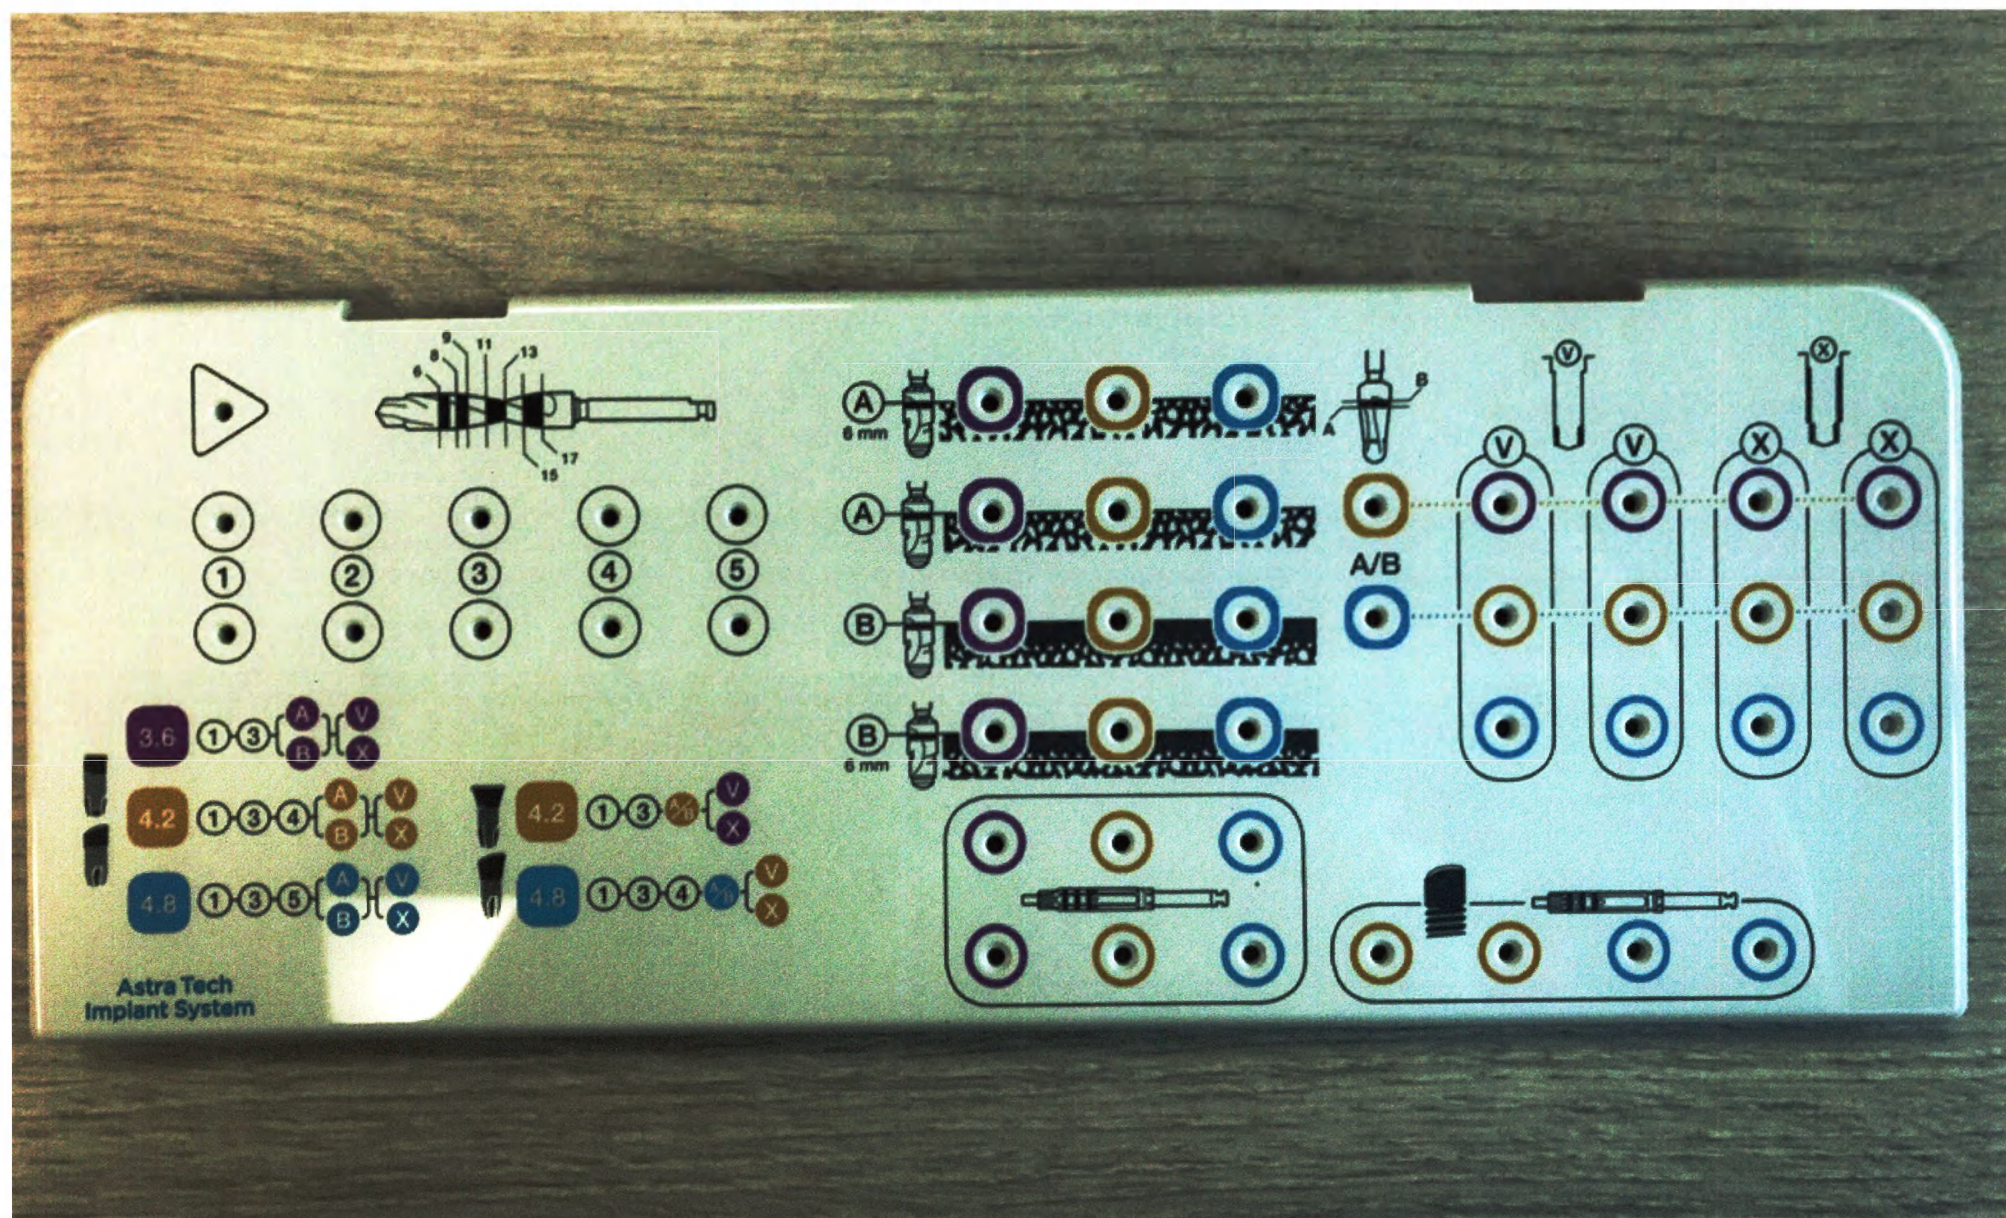

**Large Tray EV
Overlay 1**

REF 25721 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07332532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



Rx Only



21002972



 Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany

Накладка 1 для лотка большого EV (Large Tray EV Overlay 1)

Large Tray EV Overlay 1

ПУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 25721



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

Страна происхождения:
XXX

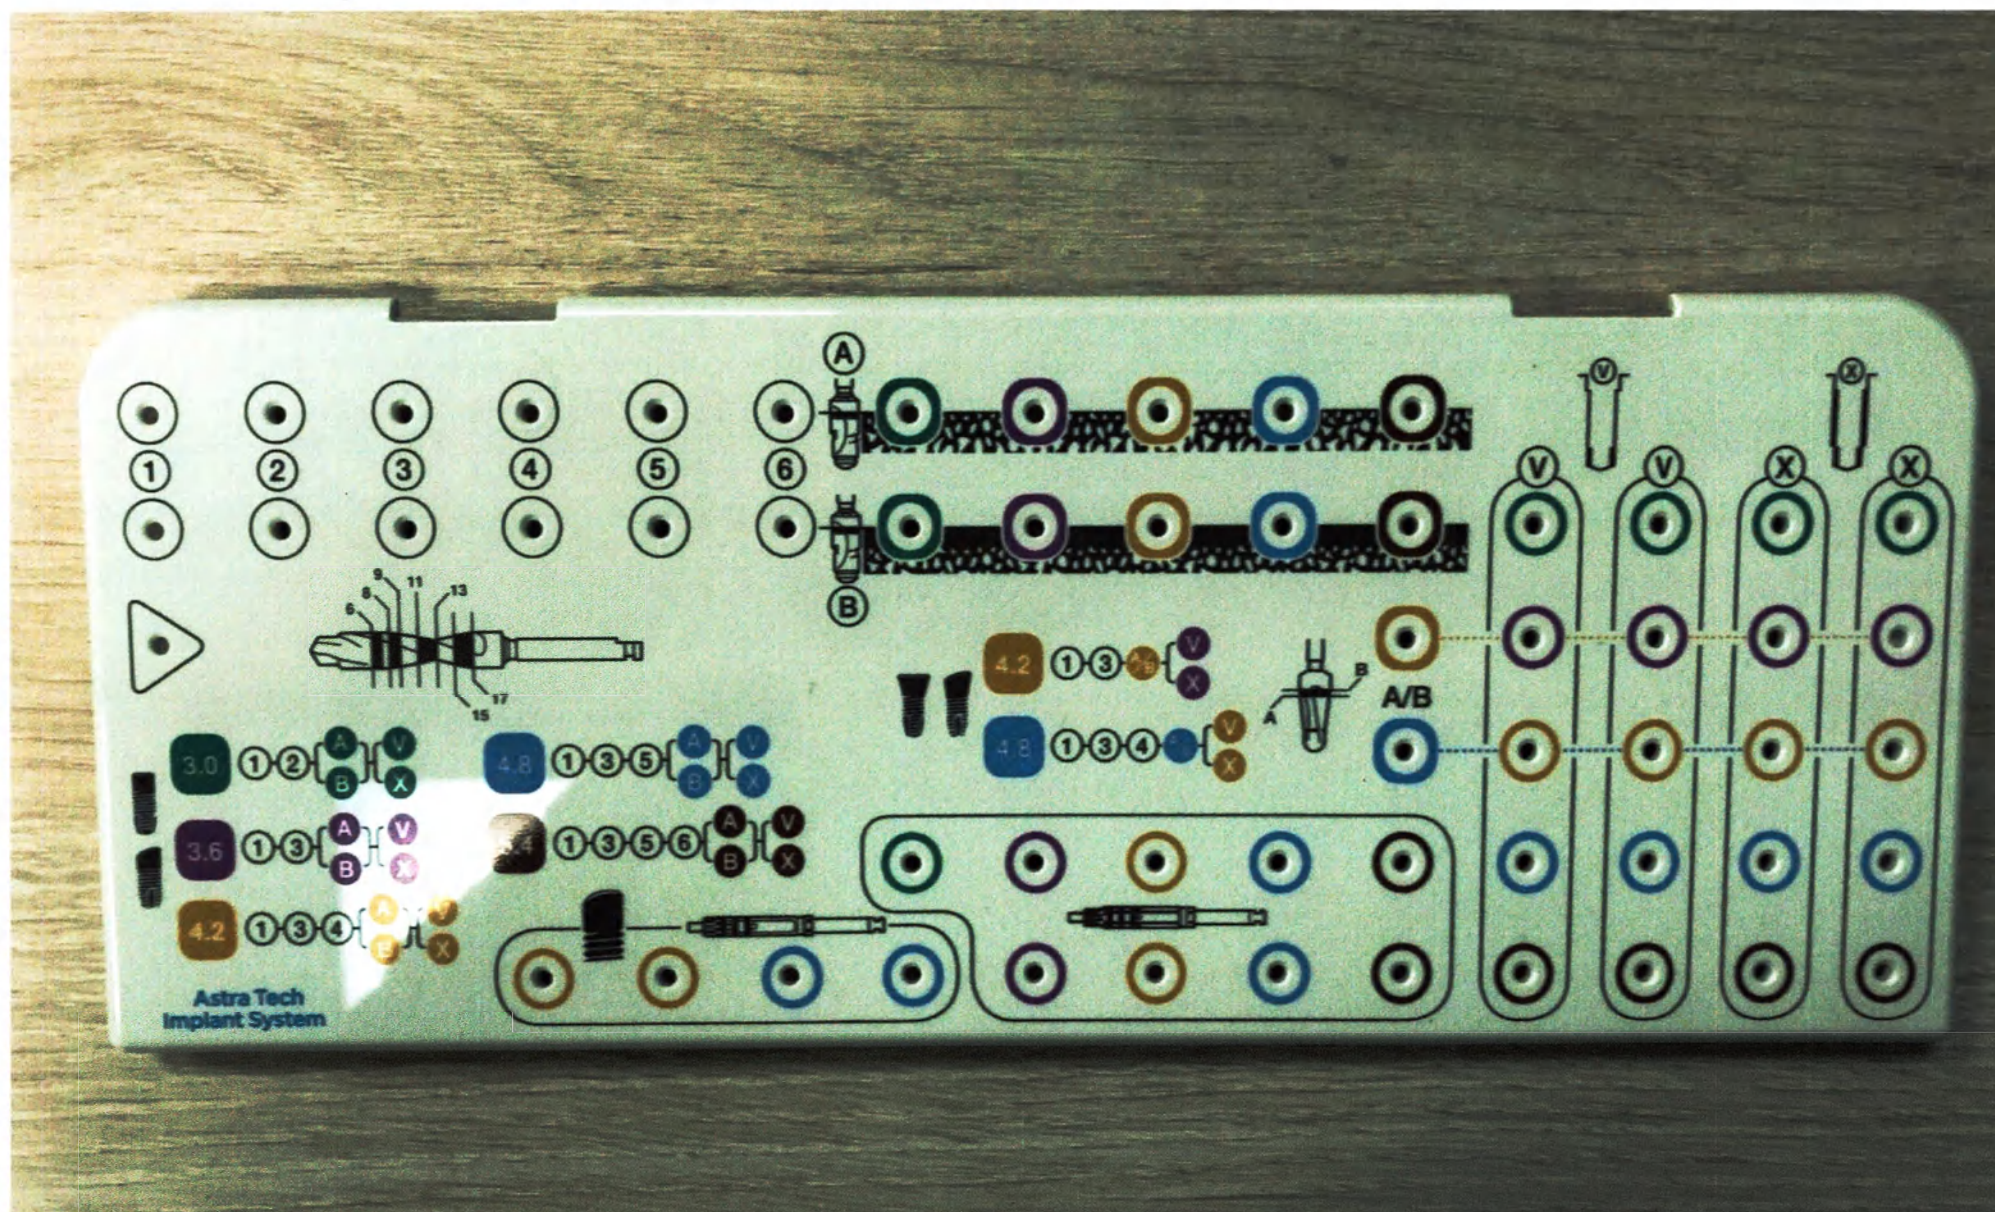

**Large Tray EV
Overlay 2**

REF 25722 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007

(11)220701

(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



Dentsply
Sirona
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



CE

Rx Only

MD

21002972

Накладка 2 для лотка большого EV (Large Tray EV Overlay 2)

Large Tray EV Overlay 2

ПУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 25722



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

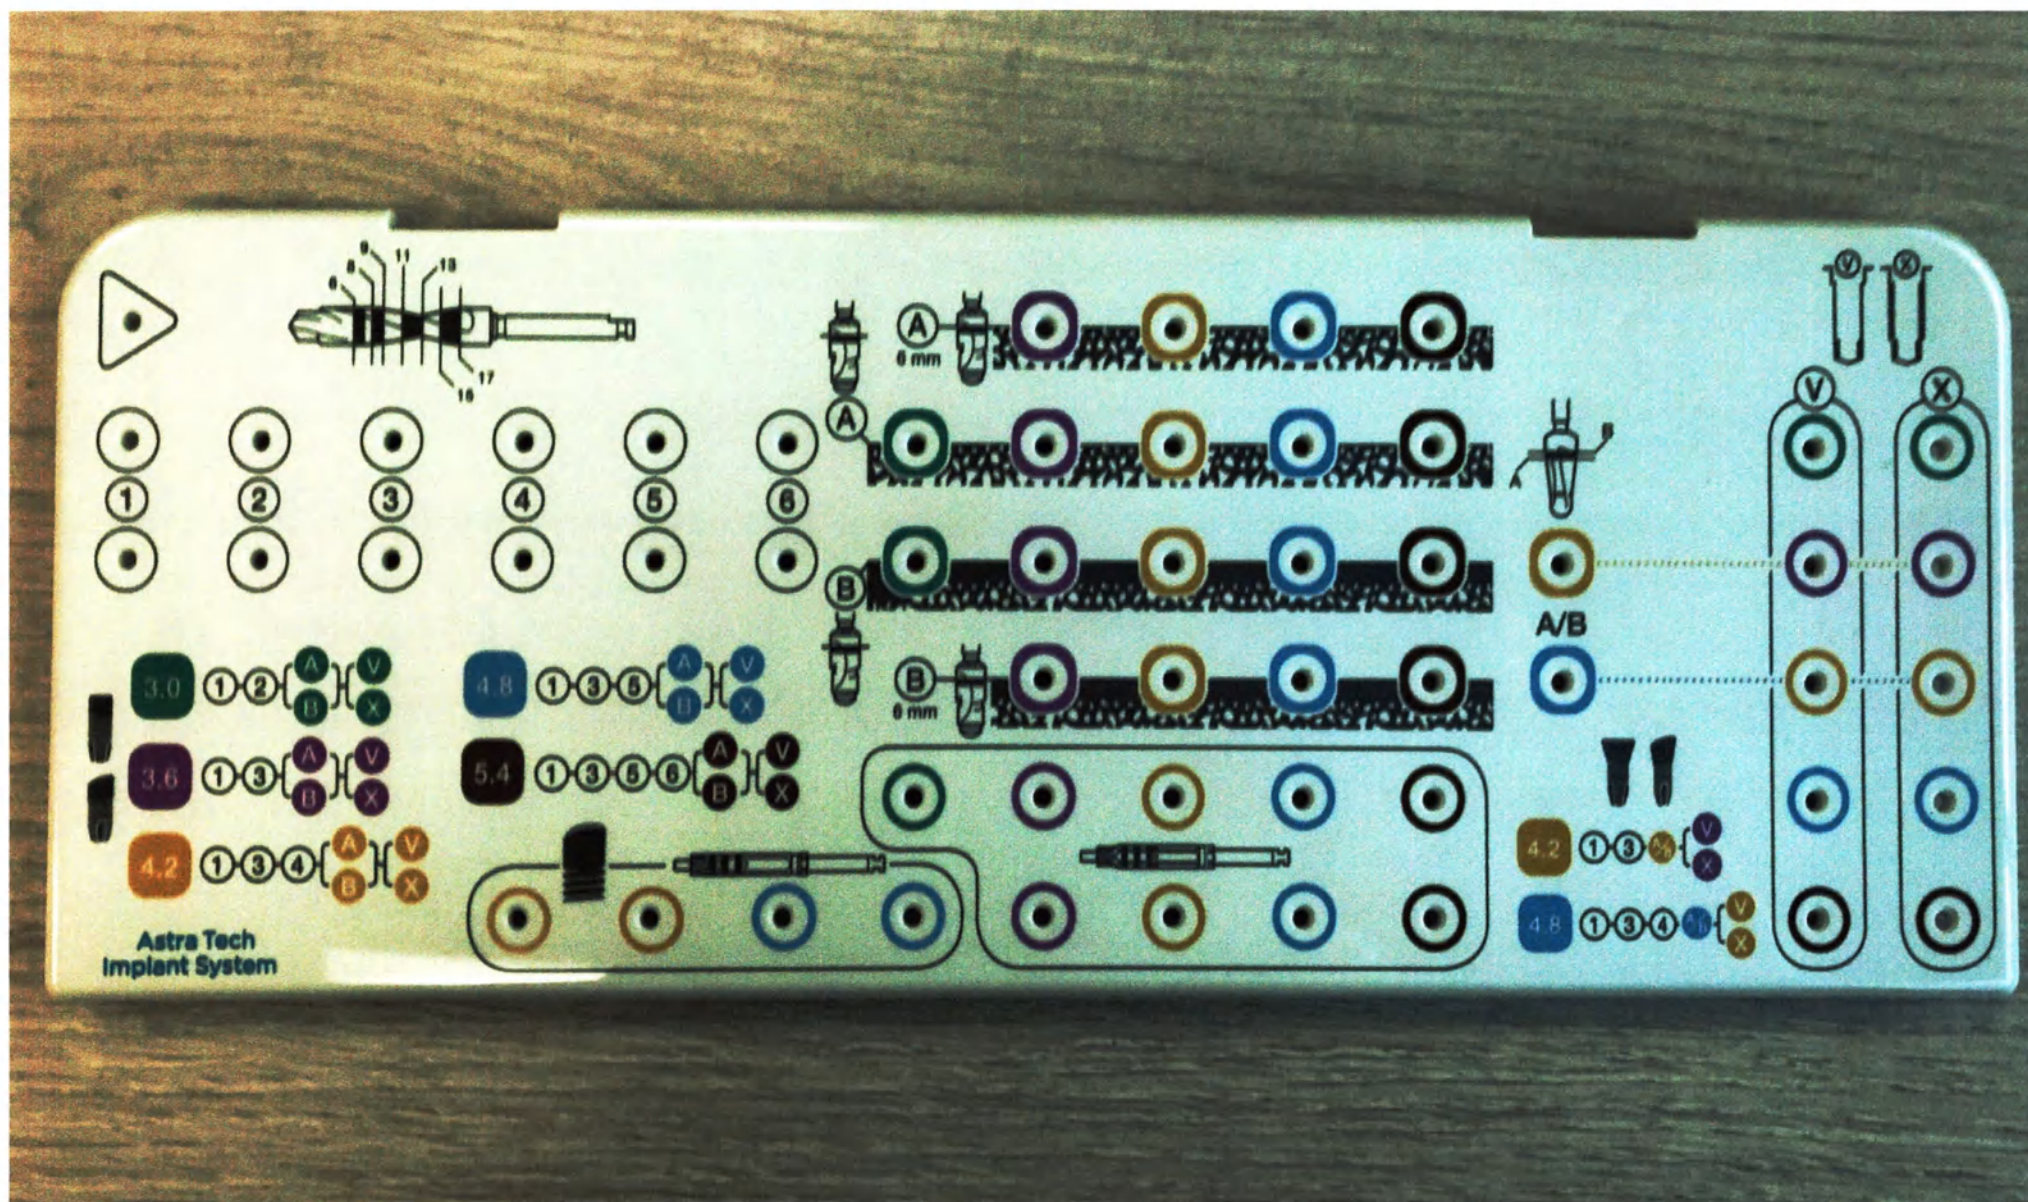

**Large Tray EV
Overlay 3**

REF 25723 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



Dentsply
Sirona
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



CE

Rx Only



21002972

Накладка 3 для лотка большого EV (Large Tray EV Overlay 3)

Large Tray EV Overlay 3

ПУ № P3H 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 25723



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com



Small Tray EV

REF 25770 LOT 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07382532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

2022-07-01



Dentsply Sirona
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



21002972

Лоток малый EV (Small Tray EV)

Small Tray EV

РУ № РЗН 2020/12836

от xx.xx.xxxx

REF 25770



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com



**Small Tray EV
Restorative**

REF 25982 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07382532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



**Dentsply
Sirona**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany

CE **RxOnly**



21002972

Лоток реставрационный малый EV (Small Tray EV Restorative)

Small Tray EV Restorative

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 25982



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д. 18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

Страна происхождения:
XXX



**Small Tray EV
Storage**

REF 25984 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07392632062007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



Dentsply
Sirona
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



21002972

Лоток для хранения малый EV (Small Tray EV Storage)

Small Tray EV Storage

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 25984



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

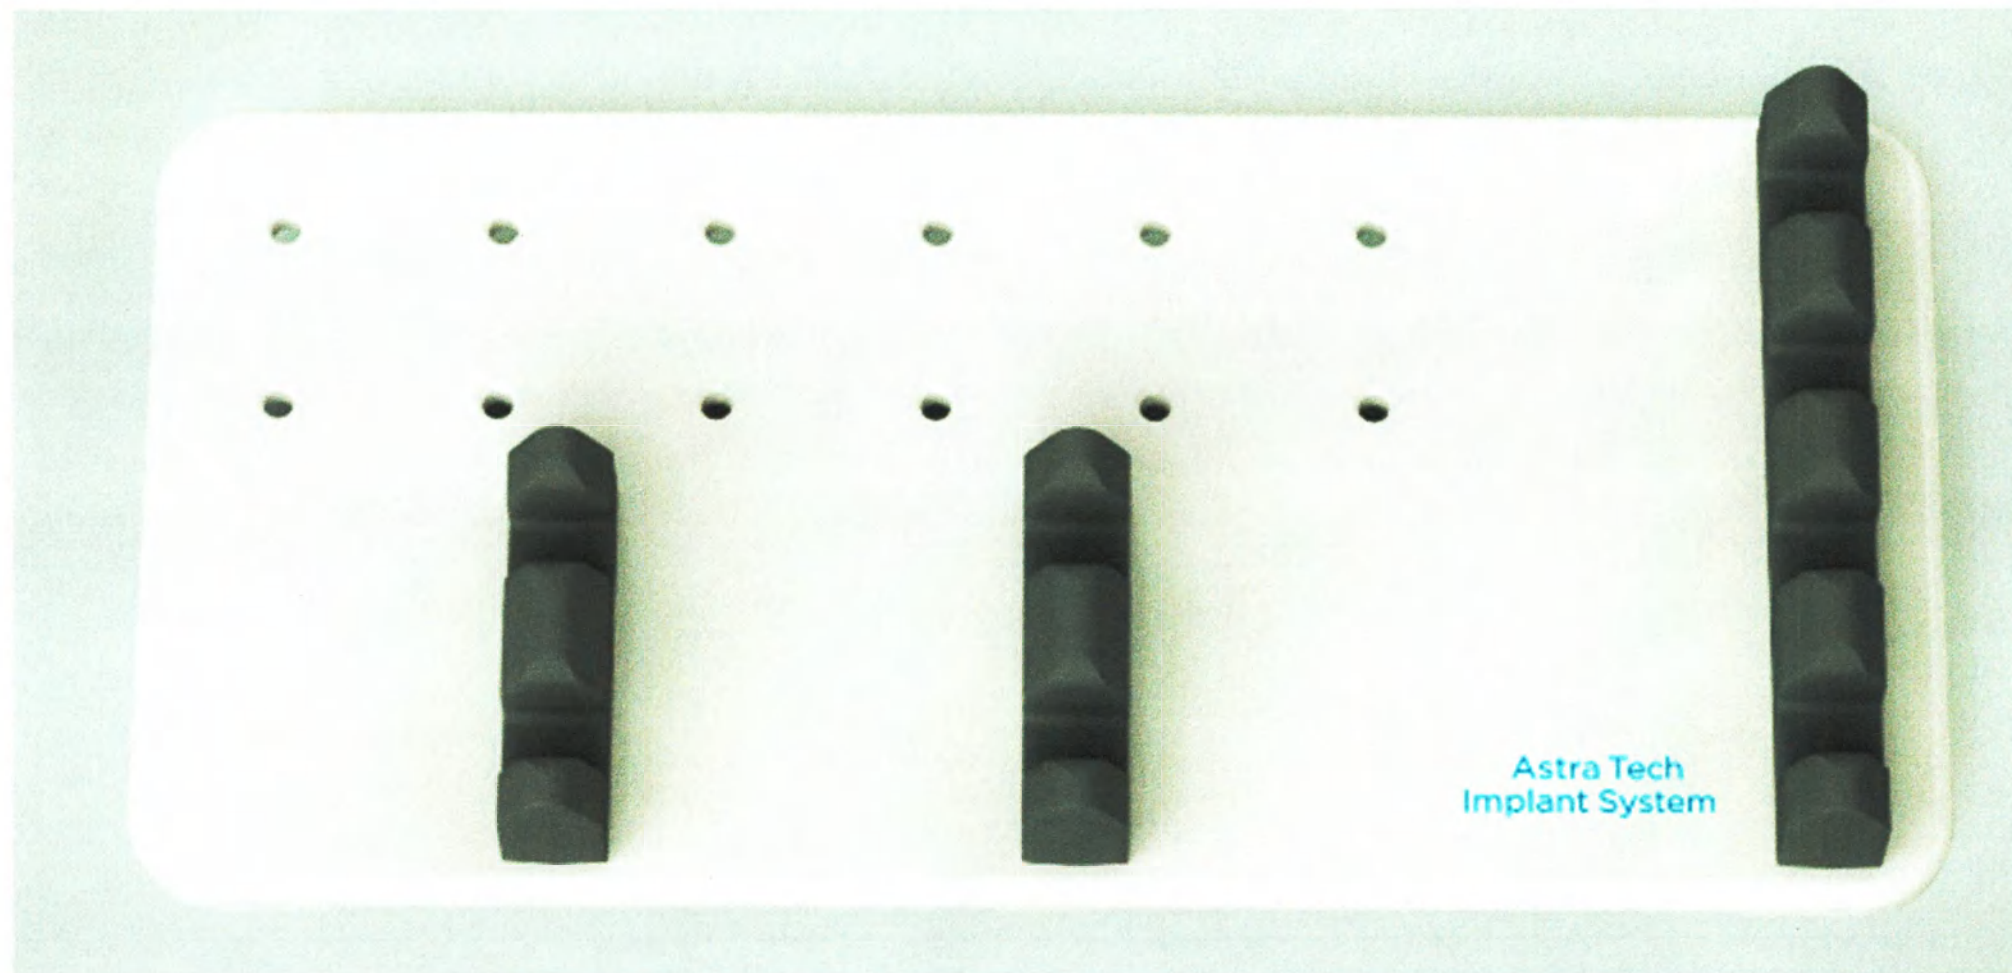

**Small Tray EV
Restorative overlay**

REF 25724 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



**Dentsply
Sirona**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



21002972



R_{Only}



Накладка ортопедическая для лотка малого EV (Small Tray EV Restorative Overlay)

Small Tray EV Restorative Overlay

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 25724



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия


Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

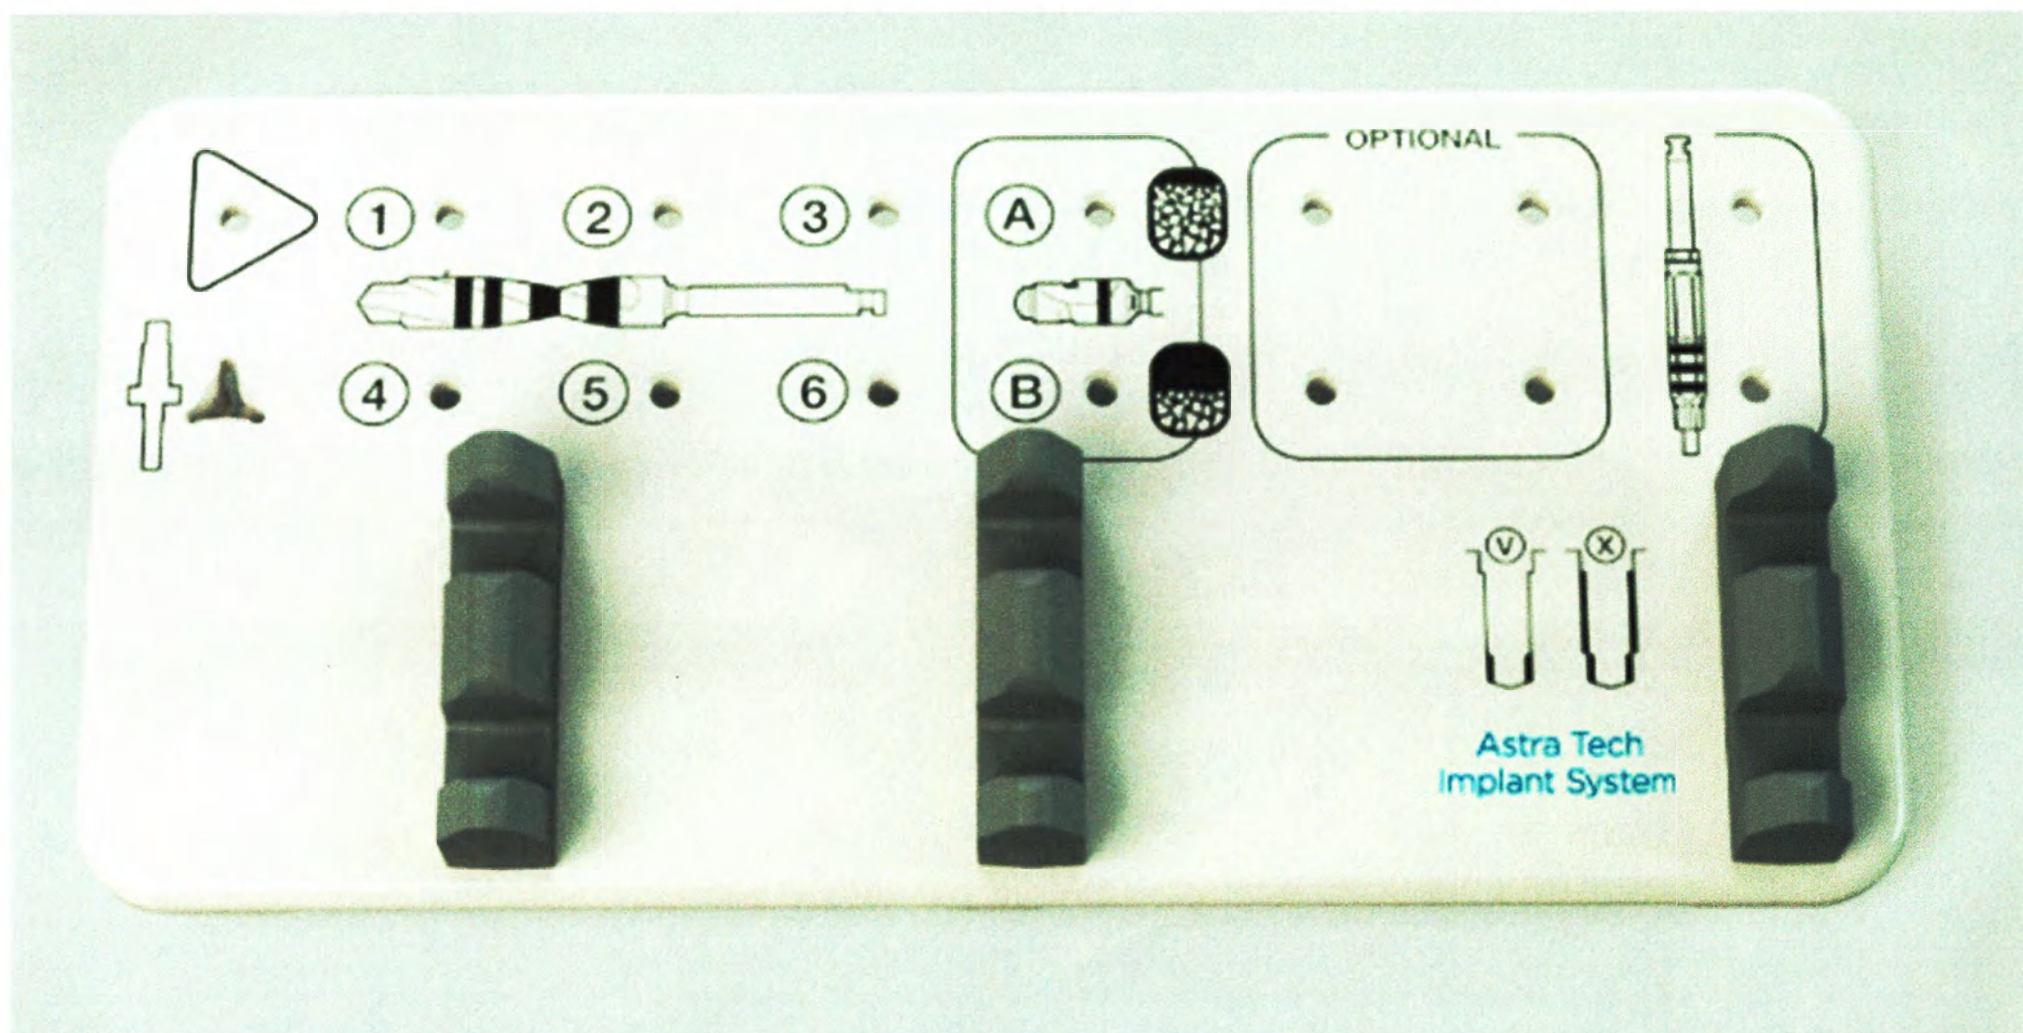

**Small Tray EV
Surgical overlay**

REF 25725 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



**Dentsply
Sirona**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



21002972

Накладка хирургическая для лотка малого EV (Small Tray EV Surgical Overlay)

Small Tray EV Surgical Overlay

ПУ № P3H 2020/12836

от xx.xx.xxxx

REF 25725



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

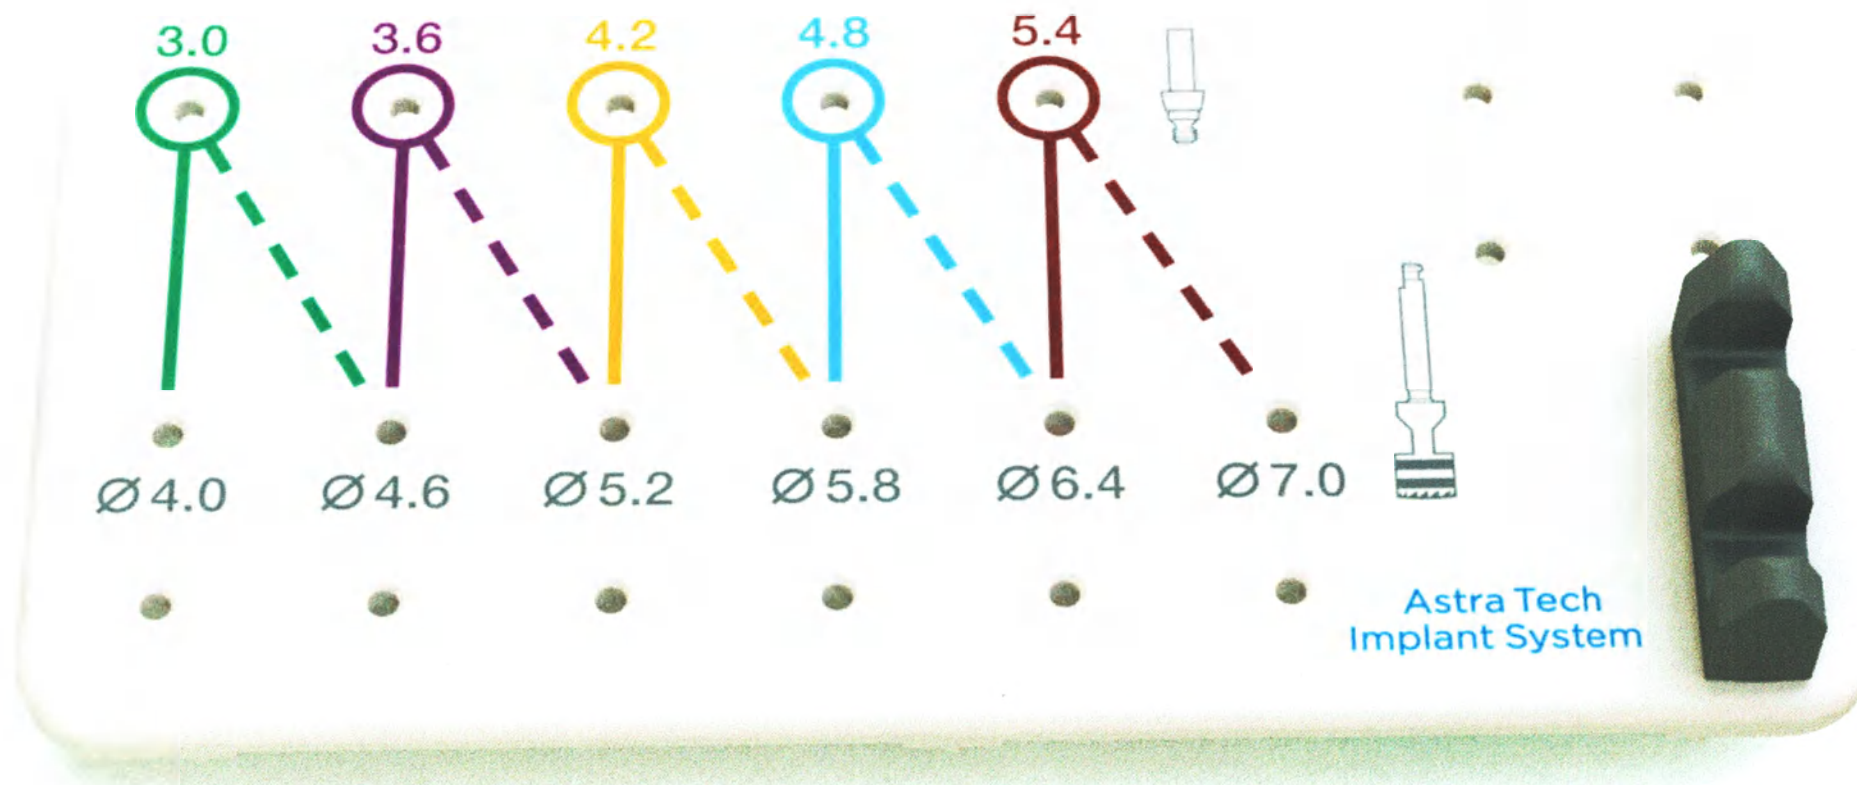

**Small Tray EV
Overlay Bone Reamers**

REF 26217 **LOT** 999999



ifu.dentsplysirona.com



(01)07332532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

 2022-07-01



Dentsply
Sirona
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



R_xonly



21002872

Накладка для примеров для лотка малого EV (Small Tray EV Overlay Bone Reamers)

Small Tray EV Overlay Bone Reamers

ПУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 26217



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия


Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д. 18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

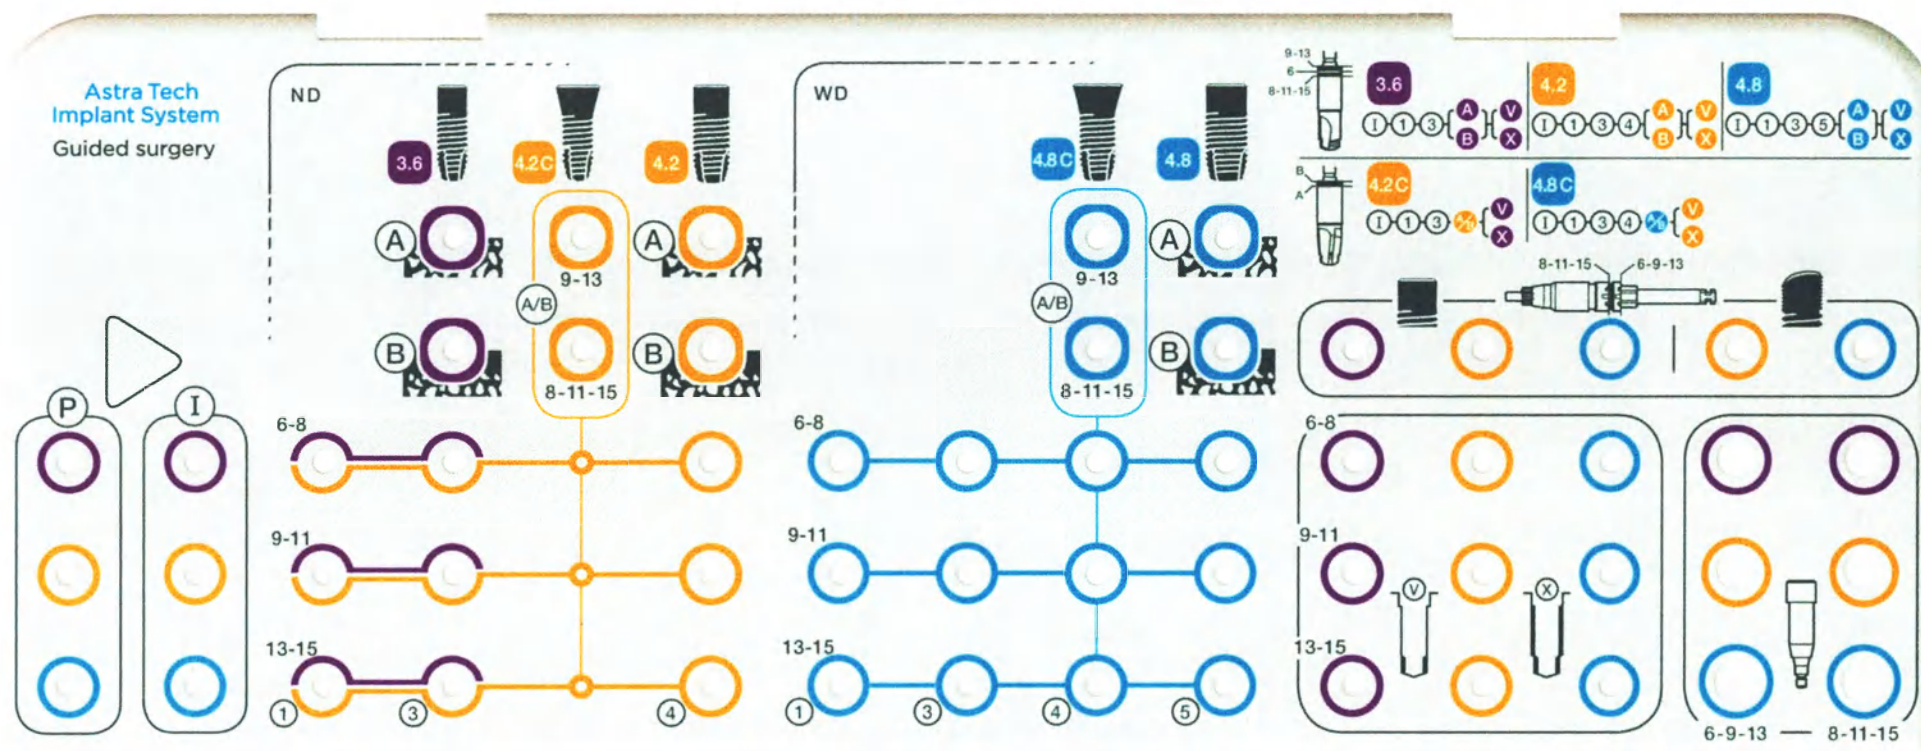

Overlay, Proline

REF 26098 LOT 999999



ifu.dentsplysirona.com



(81)67382532062007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

2022-07-01

CE Rx Only



Dentsply
Sirona
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



21002872

Накладка Proline (Overlay, Proline)

Overlay, Proline

РУ № РЗН 2020/12836

от xx.xx.xxxx

REF 26098



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
xxx

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

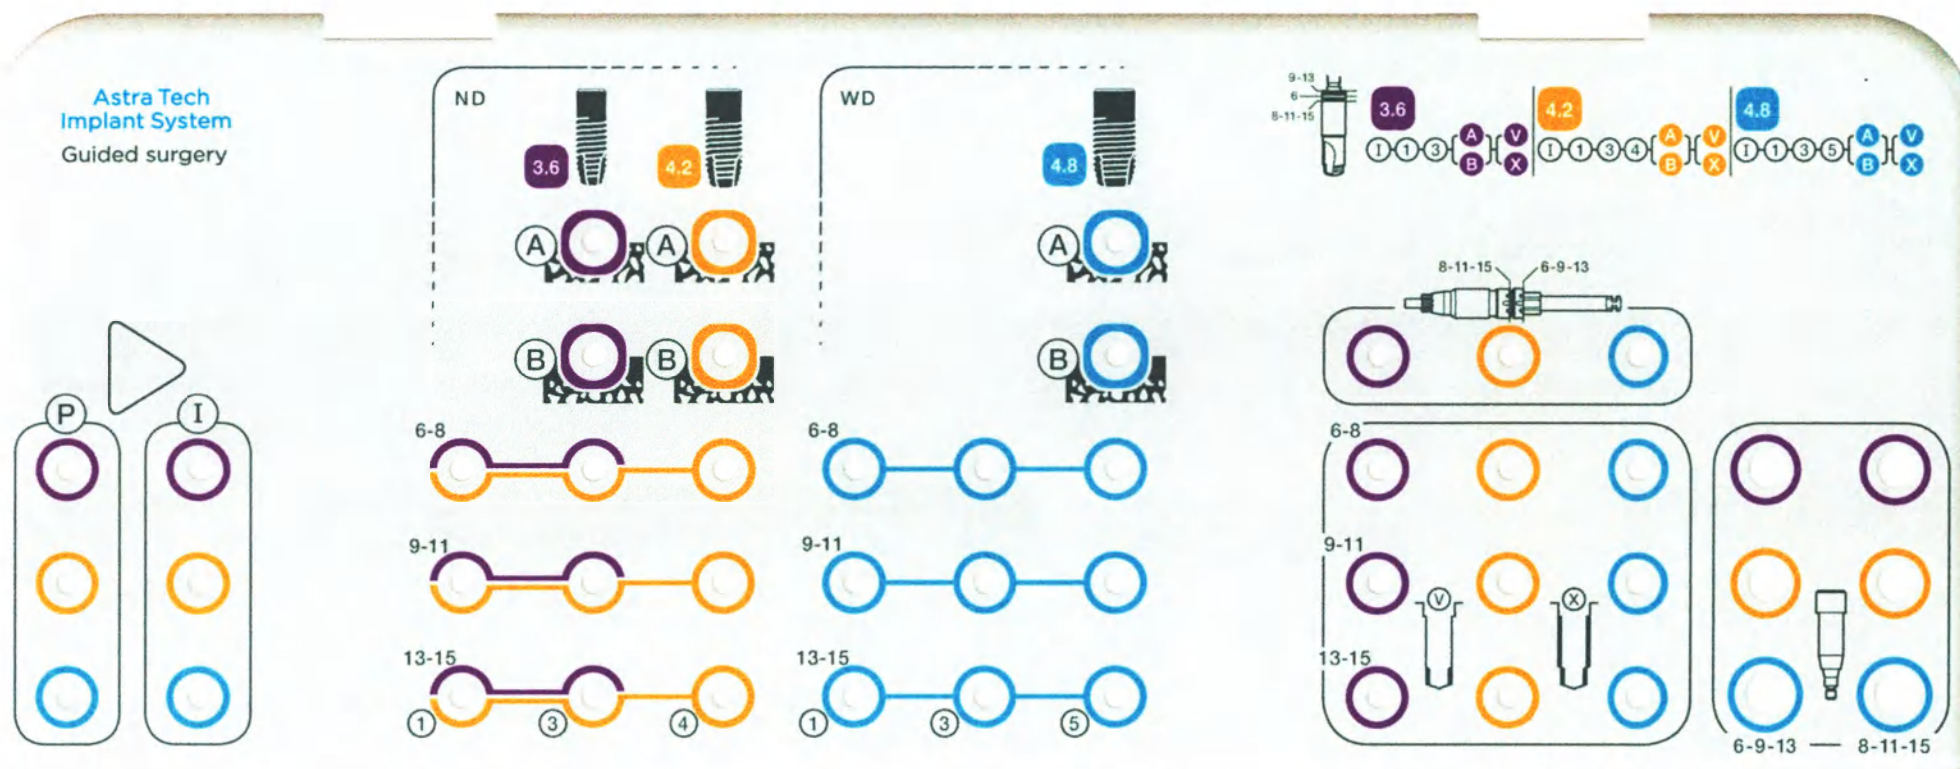

Overlay, Streamline

REF 26099 LOT 999999



ifu.dentsplysirona.com



(81)87392532002007
(11)220701
(10)123456

Astra Tech
Implant System

Made in <Country>

2022-07-01



Dentsply
Sirona
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany



Rx Only



21002972

Накладка Streamline (Overlay, Streamline)

Overlay, Streamline

ПУ № P3H 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 26099



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

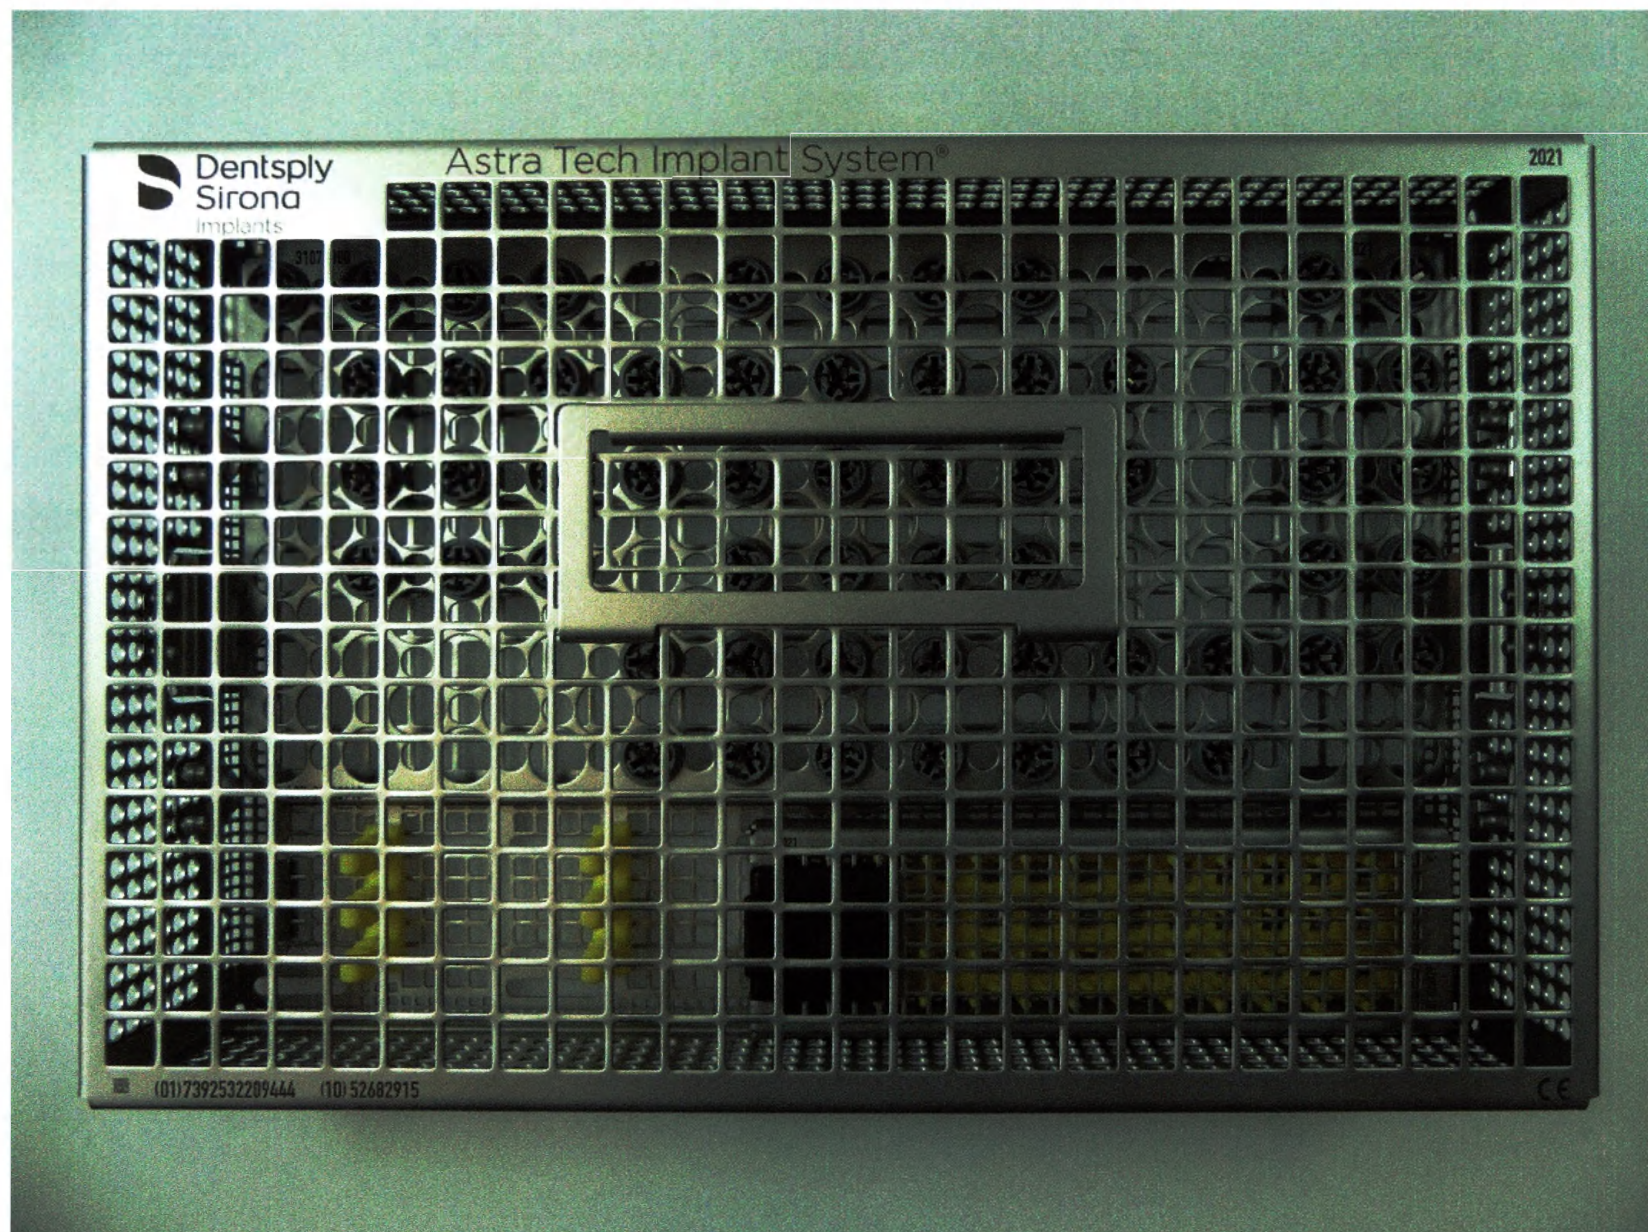

Astra Tech Implant System®

Руководство по лотку Washtray и протоколу сверления Astra Tech Implant System® EV — навигационная хирургия

Сверла конические EV-GS 4,2C, 9-13 мм, диаметр 3,1/4,2 (Conical Drill EV-GS 4,2C, 9-13 mm, Ø3,1/4,2)
Ид. 26000

Сверла конические EV-GS 4,2C, 8-11-15 мм, диаметр 3,1/4,2 (Conical Drill EV-GS 4,2C, 8-11-15 mm, Ø3,1/4,2)
Ид. 26001

Сверла кортикальные EV-GS 3,6, диаметр 3,1/3,6 (Cortical Drill EV-GS 3,6, Ø3,1/3,6)
Ид. 26004

Сверла кортикальные EV-GS 3,6, диаметр 3,1/3,6 (Cortical Drill EV-GS 3,6, Ø3,1/3,6)
Ид. 26005

Сверла кортикальные EV-GS 4,2, диаметр 3,7/3,9 (Cortical Drill EV-GS 4,2, Ø3,7/3,9)
Ид. 26006

Сверла кортикальные EV-GS 4,2, диаметр 3,7/4,2 (Cortical Drill EV-GS 4,2, Ø3,7/4,2)
Ид. 26007

Сверла конические EV-GS 4,8C, 9-13 мм, диаметр 3,7/4,8 (Conical Drill EV-GS 4,8C, 9-13 mm, Ø3,7/4,8)
Ид. 26002

Сверла конические EV-GS 4,8C, 8-11-15 мм, диаметр 3,7/4,8 (Conical Drill EV-GS 4,8C, 8-11-15 mm, Ø3,7/4,8)
Ид. 26003

Сверла кортикальные EV-GS 4,8, диаметр 4,3/4,5 (Cortical Drill EV-GS 4,8, Ø4,3/4,5)
Ид. 26008

Сверла кортикальные EV-GS 4,8, диаметр 4,3/4,8 (Cortical Drill EV-GS 4,8, Ø4,3/4,8)
Ид. 26009

Удлинитель для имплантовода EV-GS (Implant Driver Extender EV-GS)
Ид. 26021

Имплантовод EV-GS, диаметр 3,6 (Implant Driver EV-GS Ø3,6)
Ид. 26016

Имплантовод EV-GS, диаметр 4,2 (Implant Driver EV-GS Ø4,2)
Ид. 26017

Имплантовод EV-GS, диаметр 4,8 (Implant Driver EV-GS Ø4,8)
Ид. 26018

Имплантовод Profile EV-GS, диаметр 4,2 (Implant Driver Profile EV-GS Ø4,2)
Ид. 26019

Имплантовод Profile EV-GS, диаметр 4,8 (Implant Driver Profile EV-GS Ø4,8)
Ид. 26020

Аббатмент стабилизирующий EV, диаметр 3,6 (EV-Stabilization Abutment, Ø3,6)
8-11-15 мм Ид. 26033, 6-9-13 мм Ид. 26034

Аббатмент стабилизирующий EV, диаметр 4,2 (EV-Stabilization Abutment, Ø4,2)
8-11-15 мм Ид. 26035, 6-9-13 мм Ид. 26036

Аббатмент стабилизирующий EV, диаметр 4,8 (EV-Stabilization Abutment, Ø4,8)
8-11-15 мм Ид. 26037, 6-9-13 мм Ид. 26038

Сверла EV-GS 3,6, 4,2C (Drill EV-GS 3,6, 4,2C)
6-8 мм Ид. 26084, 9-11 мм Ид. 26085, 13-15 мм Ид. 26086

Сверла EV-GS 4,2 (Drill EV-GS 4,2)
6-8 мм Ид. 26087, 9-11 мм Ид. 26088, 13-15 мм Ид. 26089

Сверла EV-GS 4,8C (Drill EV-GS 4,8C)
6-8 мм Ид. 26090, 9-11 мм Ид. 26091, 13-15 мм Ид. 26092

Сверла EV-GS 4,8 (Drill EV-GS 4,8)
6-8 мм Ид. 26093, 9-11 мм Ид. 26094, 13-15 мм Ид. 26095

Сверла EV-GS 3,6, 4,2C (Drill EV-GS 3,6, 4,2C)
6-8 мм Ид. 26072, 9-11 мм Ид. 26073, 13-15 мм Ид. 26074

Сверла EV-GS 4,2 (Drill EV-GS 4,2)
6-8 мм Ид. 26075, 9-11 мм Ид. 26076, 13-15 мм Ид. 26077

Сверла EV-GS 4,8C (Drill EV-GS 4,8C)
6-8 мм Ид. 26078, 9-11 мм Ид. 26079, 13-15 мм Ид. 26080

Сверла EV-GS 4,8 (Drill EV-GS 4,8)
6-8 мм Ид. 26081, 9-11 мм Ид. 26082, 13-15 мм Ид. 26083

Сверла EV-GS, диаметр 1,9 WD (Drill EV-GS, Ø1,9 WD)
6-8 мм Ид. 26060, 9-11 мм Ид. 26061, 13-15 мм Ид. 26062

Сверла EV-GS, диаметр 2,5/3,1 WD (Drill EV-GS, Ø2,5/3,1 WD)
6-8 мм Ид. 26063, 9-11 мм Ид. 26064, 13-15 мм Ид. 26065

Сверла EV-GS, диаметр 3,1/3,7 WD (Drill EV-GS, Ø3,1/3,7 WD)
6-8 мм Ид. 26066, 9-11 мм Ид. 26067, 13-15 мм Ид. 26068

Сверла EV-GS, диаметр 3,7/4,3 WD (Drill EV-GS, Ø3,7/4,3 WD)
6-8 мм Ид. 26069, 9-11 мм Ид. 26070, 13-15 мм Ид. 26071

Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV)
Ид. 25774

Ручка хирургическая (Surgical Driver Handle)
Ид. 25775

Отвертка шестигранная ручная EV (Hex Driver EV Manual)
короткая 20 мм Ид. 25771, средняя 31 мм Ид. 25772

Год изготовления, также указанный на крышке и корпусе

Сверла для фиксирующего винта (Drill for Guide Fixation Screw)
Ид. 26050

Накладка Washtray EV-GS (Washtray Overlay EV-GS)
Ид. 3107 1021

Сверла перьевые EV-GS, диаметр 3,6 (Initial Drill EV-GS Ø3,6)
Ид. 26013

Сверла перьевые EV-GS, диаметр 4,2 (Initial Drill EV-GS Ø4,2)
Ид. 26014

Сверла перьевые EV-GS, диаметр 4,8 (Initial Drill EV-GS Ø4,8)
Ид. 26015

Сверла EV-GS, диаметр 1,9 ND (Drill EV-GS, Ø1,9 ND)
6-8 мм Ид. 26051, 9-11 мм Ид. 26052, 13-15 мм Ид. 26053

Сверла EV-GS, диаметр 2,5/3,1 ND (Drill EV-GS, Ø2,5/3,1 ND)
6-8 мм Ид. 26054, 9-11 мм Ид. 26055, 13-15 мм Ид. 26056


Сверла EV-GS, диаметр 3,1/3,7 ND (Drill EV-GS, Ø3,1/3,7 ND)
6-8 мм Ид. 26057, 9-11 мм Ид. 26058, 13-15 мм Ид. 26059

Инструкция по очистке и стерилизации
Накладку с лотка Washtray необходимо снять перед очисткой и установить на место перед стерилизацией. Пожалуйста, соблюдайте инструкции по использованию отдельных инструментов и инструкцию Dentsply Sirona Implants по стерилизации и уходу за инструментами или инструкцию по очистке и стерилизации для системы имплантатов Astra Tech Implant System EV. Перед использованием лотка Washtray для первой хирургической операции он должен пройти полный цикл обработки и стерилизации вместе с инструментами.

Срок службы: 4 года

Примечание. Одноразовые атлукки и микротомы не подлежат очистке и стерилизации. Перед очисткой и стерилизацией лотка атлукку нужно снять со сверла и утилизировать.

Dentsply Sirona Implants

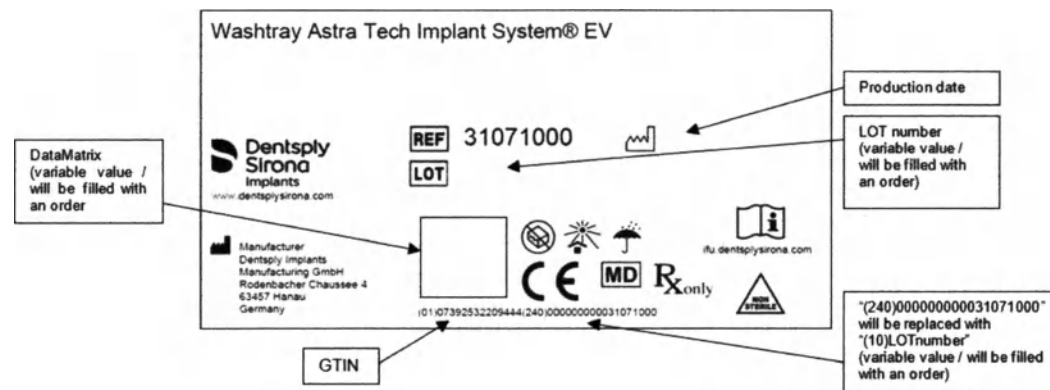

Лоток Washtray Astra Tech Implant System® EV

Washtray Astra Tech Implant System® EV

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 31071000

 см. на упаковке


Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


 **Производитель:**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
xxx


ifu.dentsplysirona.com

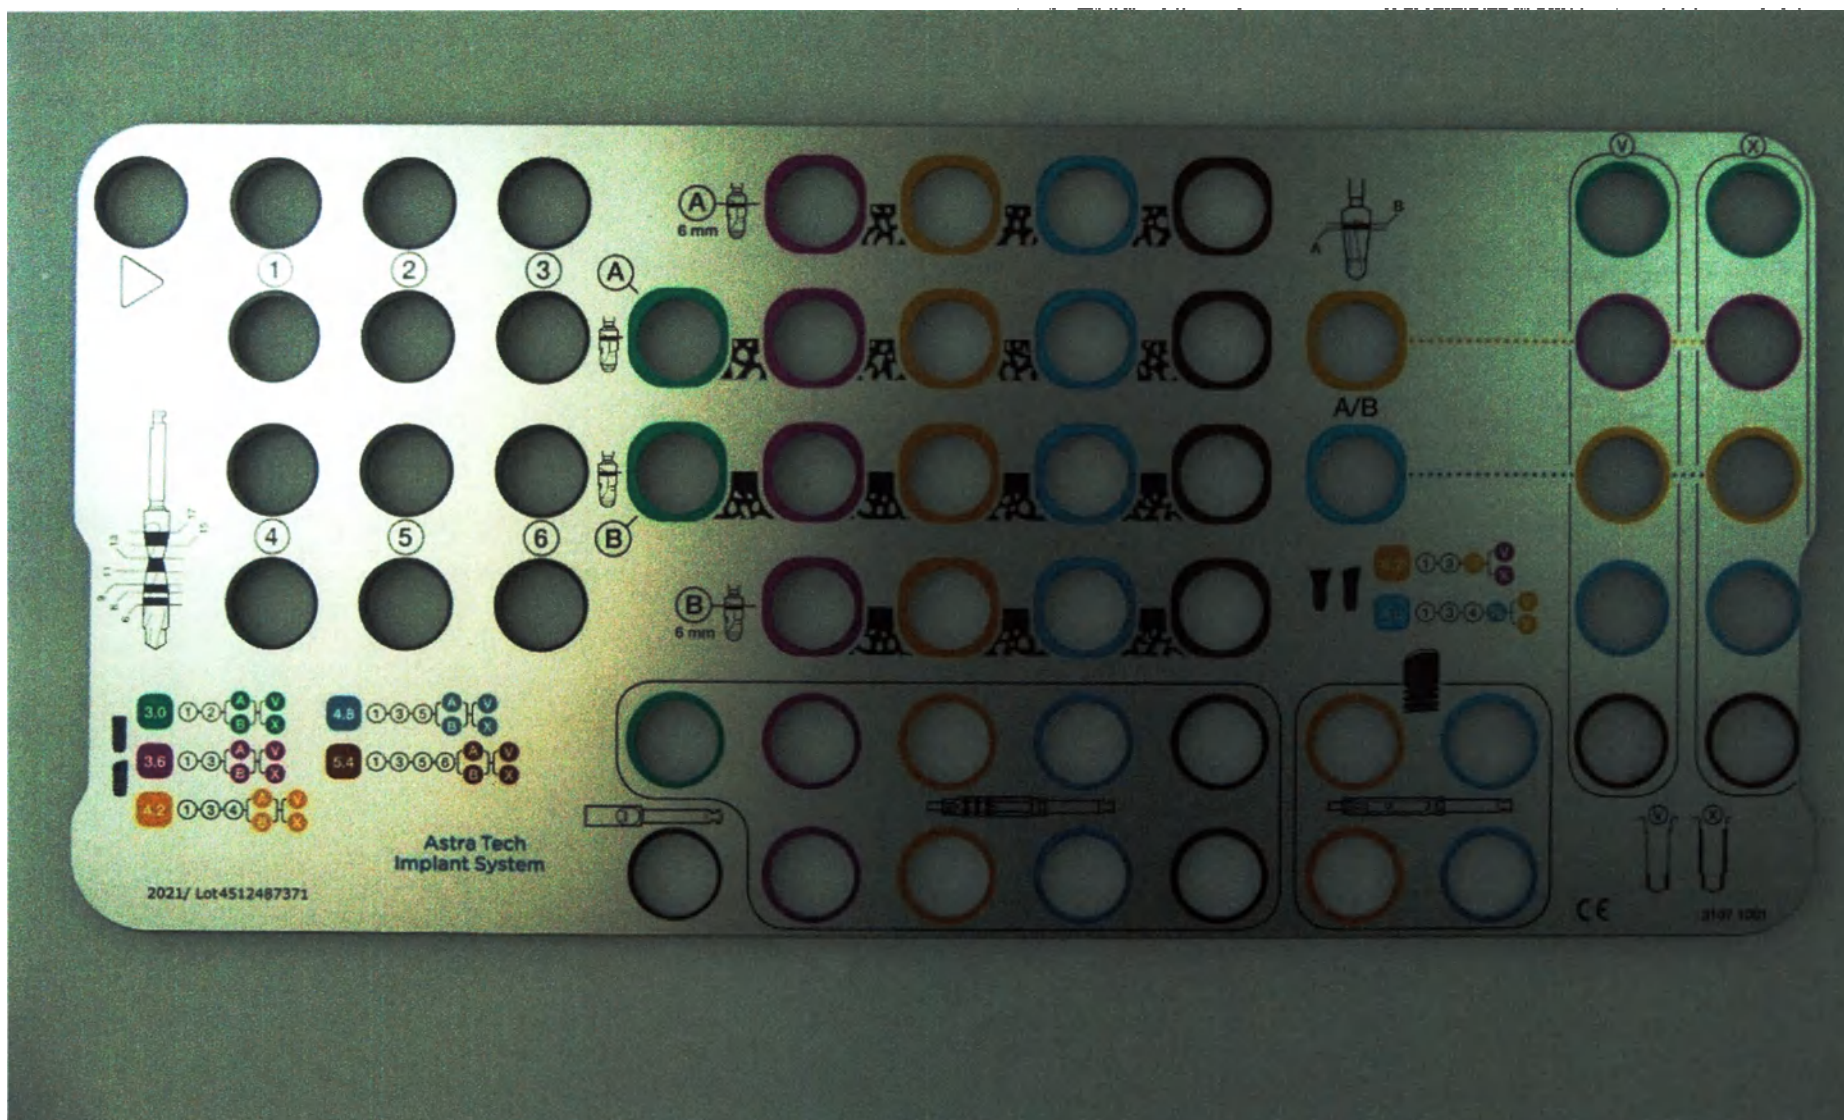

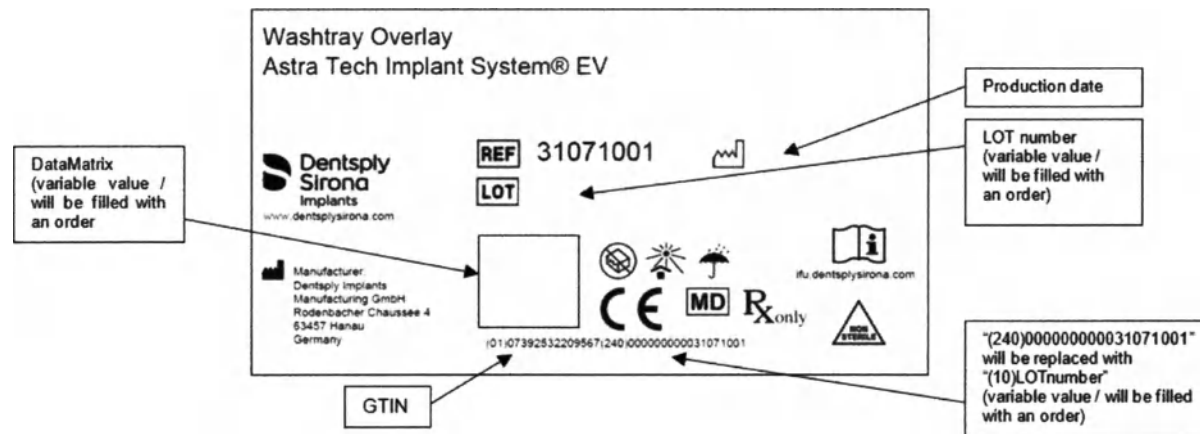

Накладка Washtray Astra Tech Implant System® EV (Washtray Overlay Astra Tech Implant System® EV)

Washtray Overlay Astra Tech Implant System® EV

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 31071001

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия


Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д. 18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ife.dentsplysirona.com

Страна происхождения:
xxx

Лоток под хирургический набор Ankylos® ручные ABC (пустой) (Ankylos® Surgical Kit Tray ABC (empty))

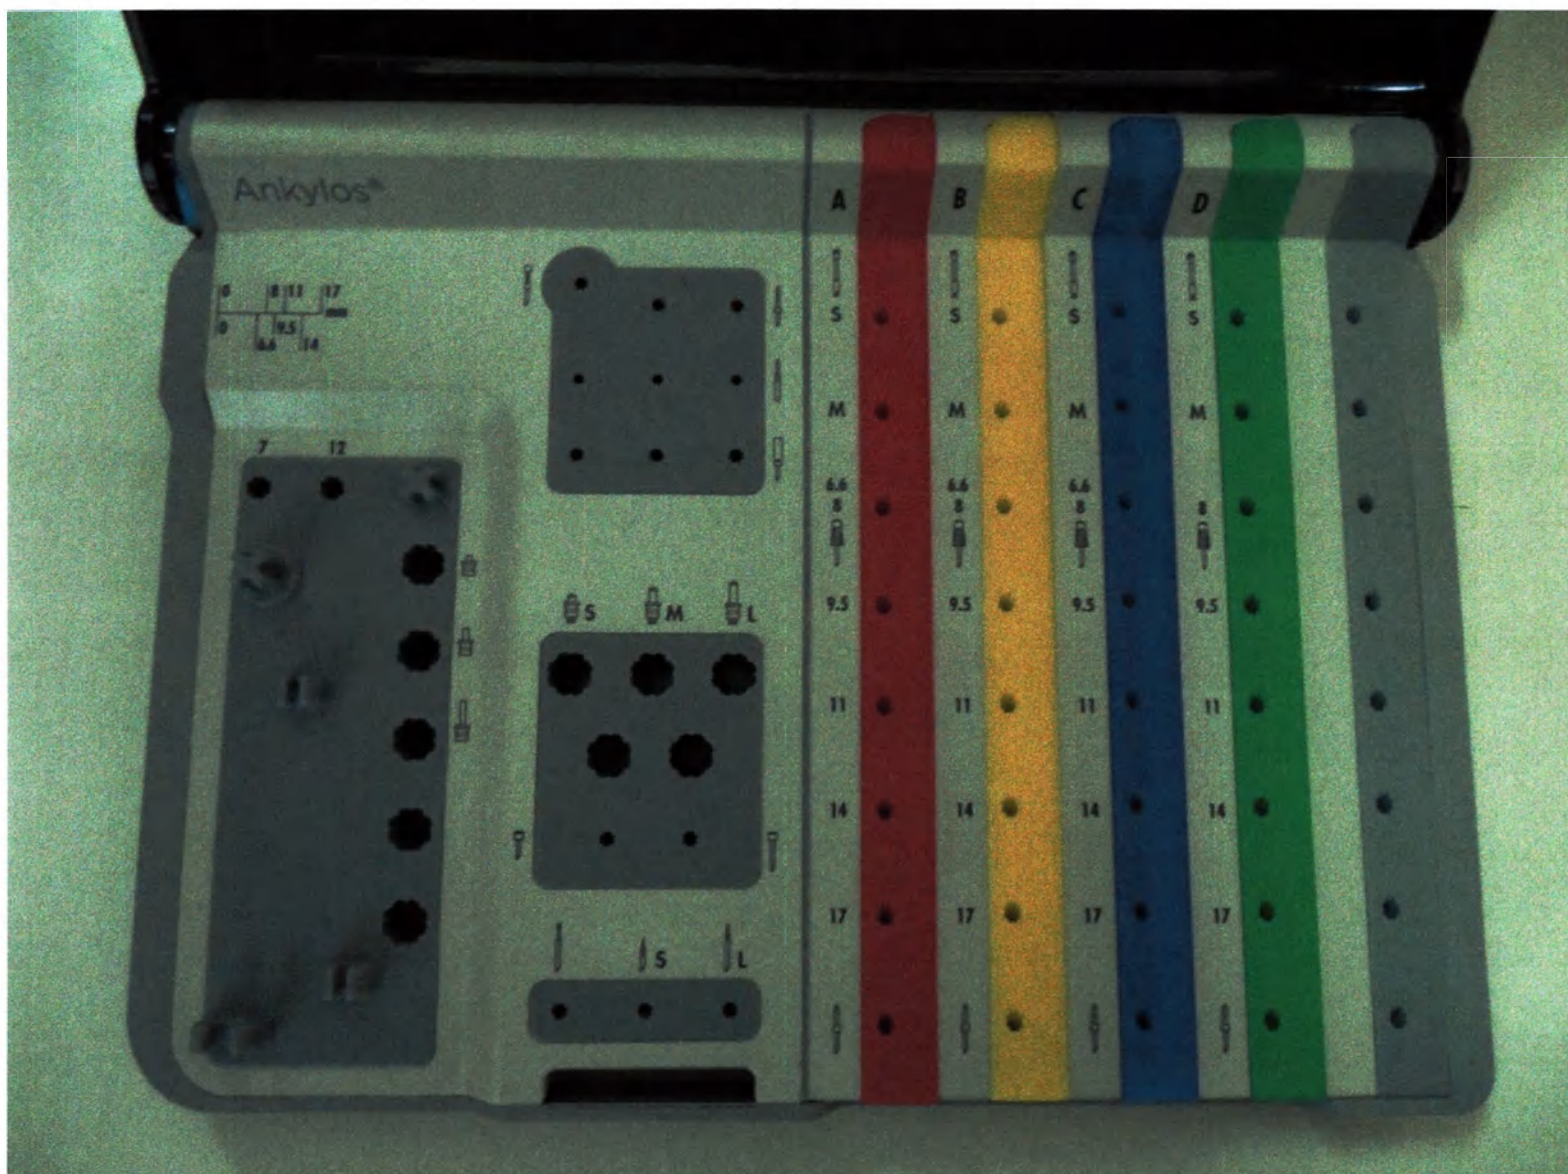

Ankylos®		X-Ray-Template Ankylos® Implants Röntgenschablone Ankylos® Implantate				Dentsply Sirona		
Scale / Maßstab 1 : 1		○ Marker ball	Scale / Maßstab 1.1 : 1		○ Marker ball	Scale / Maßstab 1.25 : 1		○ Marker ball
6.6	A 6.6  Ø 3.5 mm	B 6.6  Ø 4.5 mm	C 6.6  Ø 5.5 mm		A 6.6  Ø 3.5 mm	B 6.6  Ø 4.5 mm	C 6.6  Ø 5.5 mm	
8	A 8  Ø 3.5 mm	B 8  Ø 4.5 mm	C 8  Ø 5.5 mm	D 8  Ø 7 mm	A 8  Ø 3.5 mm	B 8  Ø 4.5 mm	C 8  Ø 5.5 mm	D 8  Ø 7 mm
9.5	A 9.5  Ø 3.5 mm	B 9.5  Ø 4.5 mm	C 9.5  Ø 5.5 mm	D 9.5  Ø 7 mm	A 9.5  Ø 3.5 mm	B 9.5  Ø 4.5 mm	C 9.5  Ø 5.5 mm	D 9.5  Ø 7 mm
11	A 11  Ø 3.5 mm	B 11  Ø 4.5 mm	C 11  Ø 5.5 mm	D 11  Ø 7 mm	A 11  Ø 3.5 mm	B 11  Ø 4.5 mm	C 11  Ø 5.5 mm	D 11  Ø 7 mm
14	A 14  Ø 3.5 mm	B 14  Ø 4.5 mm	C 14  Ø 5.5 mm	D 14  Ø 7 mm	A 14  Ø 3.5 mm	B 14  Ø 4.5 mm	C 14  Ø 5.5 mm	D 14  Ø 7 mm
17	A 17  Ø 3.5 mm	B 17  Ø 4.5 mm	C 17  Ø 5.5 mm		A 17  Ø 3.5 mm	B 17  Ø 4.5 mm	C 17  Ø 5.5 mm	
Order no. 3103 3370/17-5070 www.dentsplysirona.com								
CE								

Ankylos®

RU

Хирургический набор

**Dentsply
Sirona**
Implants

Мукотом Ankylos® Center Punch 3 мм с внутренним охлаждением
Арт. 3103 3010

Винтовое сверло Ankylos® Twist Drill 2 мм с внутренним охлаждением
Арт. 3103 3022

Ручка Ankylos® Handle для насадки для ключа-трещотки
Арт. 3103 3040

3 параллельные направляющие Ankylos® Parallel Gauge для винтового сверла
Арт. 3103 3026

Ручка Ankylos® Handle для отвертки 7 мм
Арт. 3103 3410

Удлинитель Ankylos® Extension Instrument HXSS*
Арт. 3103 7408 и 2 запасных гнезда

Ключ-трещотка Ankylos® Ratchet
Арт. 3103 3030

Рожковый ключ Ankylos® Open-end Wrench
Арт. 3103 3050

Насадка для ключа-трещотки Ankylos® Ratchet для инструментов короткая
Арт. 3103 3070

Инструмент Ankylos® Insertion для установки имплантатов короткий
Арт. 3103 7531

средняя
Арт. 3103 3080

средний
Арт. 3103 7532

длинная
Арт. 3103 3090

длинный
Арт. 3103 7533

и два запасных гнезда

и 2 запасных гнезда

Насадка для ключа-трещотки Ankylos® Ratchet для M-инструментов*
средняя HXSS Арт. 3103 7511*
длинная HXSS Арт. 3103 7512*
и 3 запасных гнезда*

Инструмент Ankylos® Implant для установки имплантатов M / короткий*
Арт. 3103 7541

Насадка-отвертка Ankylos® 1 мм, шестигранная
Арт. 3103 3455

Инструмент Ankylos® Implant для установки имплантатов M / длинный*
Арт. 3103 7543

Инструмент Ankylos® Cleaning для очистки сверл (не показан)
Арт. 3103 7320

Модули с коническими развертками Ankylos® Conical Reamer и ручным метчиком Ankylos® Tap

Модули с коническими развертками Ankylos® Conical Reamer и машинным метчиком Ankylos® Tap

Трехгранная фреза Ankylos® Tri-Spade Drill
A / S Арт. 3103 7325
B / S Арт. 3103 7345
C / S Арт. 3103 7365**
A / M Арт. 3103 7330
B / M Арт. 3103 7350
C / M Арт. 3103 7370**

Параллельная фреза Ankylos® Parallel Drill для D-имплантатов***
S Арт. 3103 3182***
M Арт. 3103 3183***

Коническая развертка Ankylos® Conical Reamer, ручная
A 6,6/A 8 Арт. 3103 3185
A 9,5 Арт. 3103 3188
A 11 Арт. 3103 3190
A 14 Арт. 3103 3200
A 17 Арт. 3103 3202***
B 6,6/B 8 Арт. 3103 3205
B 9,5 Арт. 3103 3208
B 11 Арт. 3103 3210
B 14 Арт. 3103 3220
B 17 Арт. 3103 3230***
C 6,6/C 8 Арт. 3103 3233**
C 9,5 Арт. 3103 3235**
C 11 Арт. 3103 3238**
C 14 Арт. 3103 3240**
C 17 Арт. 3103 3250***
D 8 Арт. 3103 3252***
D 9,5 Арт. 3103 3254***
D 11 Арт. 3103 3256***
D 14 Арт. 3103 3258***

Коническая развертка Ankylos® Conical Reamer, машинная*
A 6,6/A 8 Арт. 3103 7185*
A 9,5 Арт. 3103 7188*
A 11 Арт. 3103 7190*
A 14 Арт. 3103 7200*
A 17 Арт. 3103 7202***
B 6,6/B 8 Арт. 3103 7205*
B 9,5 Арт. 3103 7208*
B 11 Арт. 3103 7210*
B 14 Арт. 3103 7220*
B 17 Арт. 3103 7230***

Метчик Ankylos® Tap, ручной
A Арт. 3103 3260
B Арт. 3103 3270
C Арт. 3103 3280**
D Арт. 3103 3285***

Метчик Ankylos® Tap, машинный*
A Арт. 3103 7440*
B Арт. 3103 7450*

Инструмент Ankylos® Unscrew Instrument для удаления винтов-заглушек S
Арт. 3103 3434

L
Арт. 3103 3435

Все инструменты без звездочек являются частью ручного хирургического набора Ankylos® Surgical Kit, AB.

* Только инструменты машинного хирургического набора Ankylos® Surgical Kit, AB.

** Только хирургический набор Ankylos® Surgical Kit ABC.


*** Гнездо для дополнительных инструментов.

Компания Dentsply Sirona не отказывается от любых прав на свои товарные знаки, включая символы "и" и "и/или". 30/7/18/7-18/3-17/08 © Dentsply Sirona, 2017. Все права защищены. (S400 8623)

Ankylos®
Surgical Kit Tray ABC empty

REF 31036540

LOT B123456789

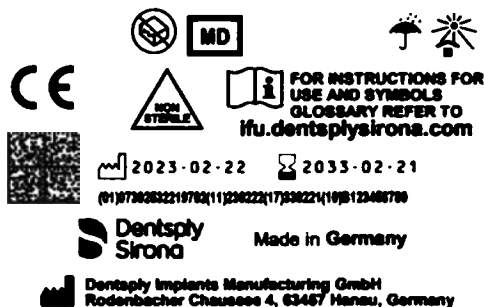

Лоток под хирургический набор Ankylos® ручные ABC (пустой) (Ankylos® Surgical Kit Tray ABC (empty))

Ankylos® Surgical Kit Tray ABC empty

ПУ № P3H 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 31036540

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
xxx

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com

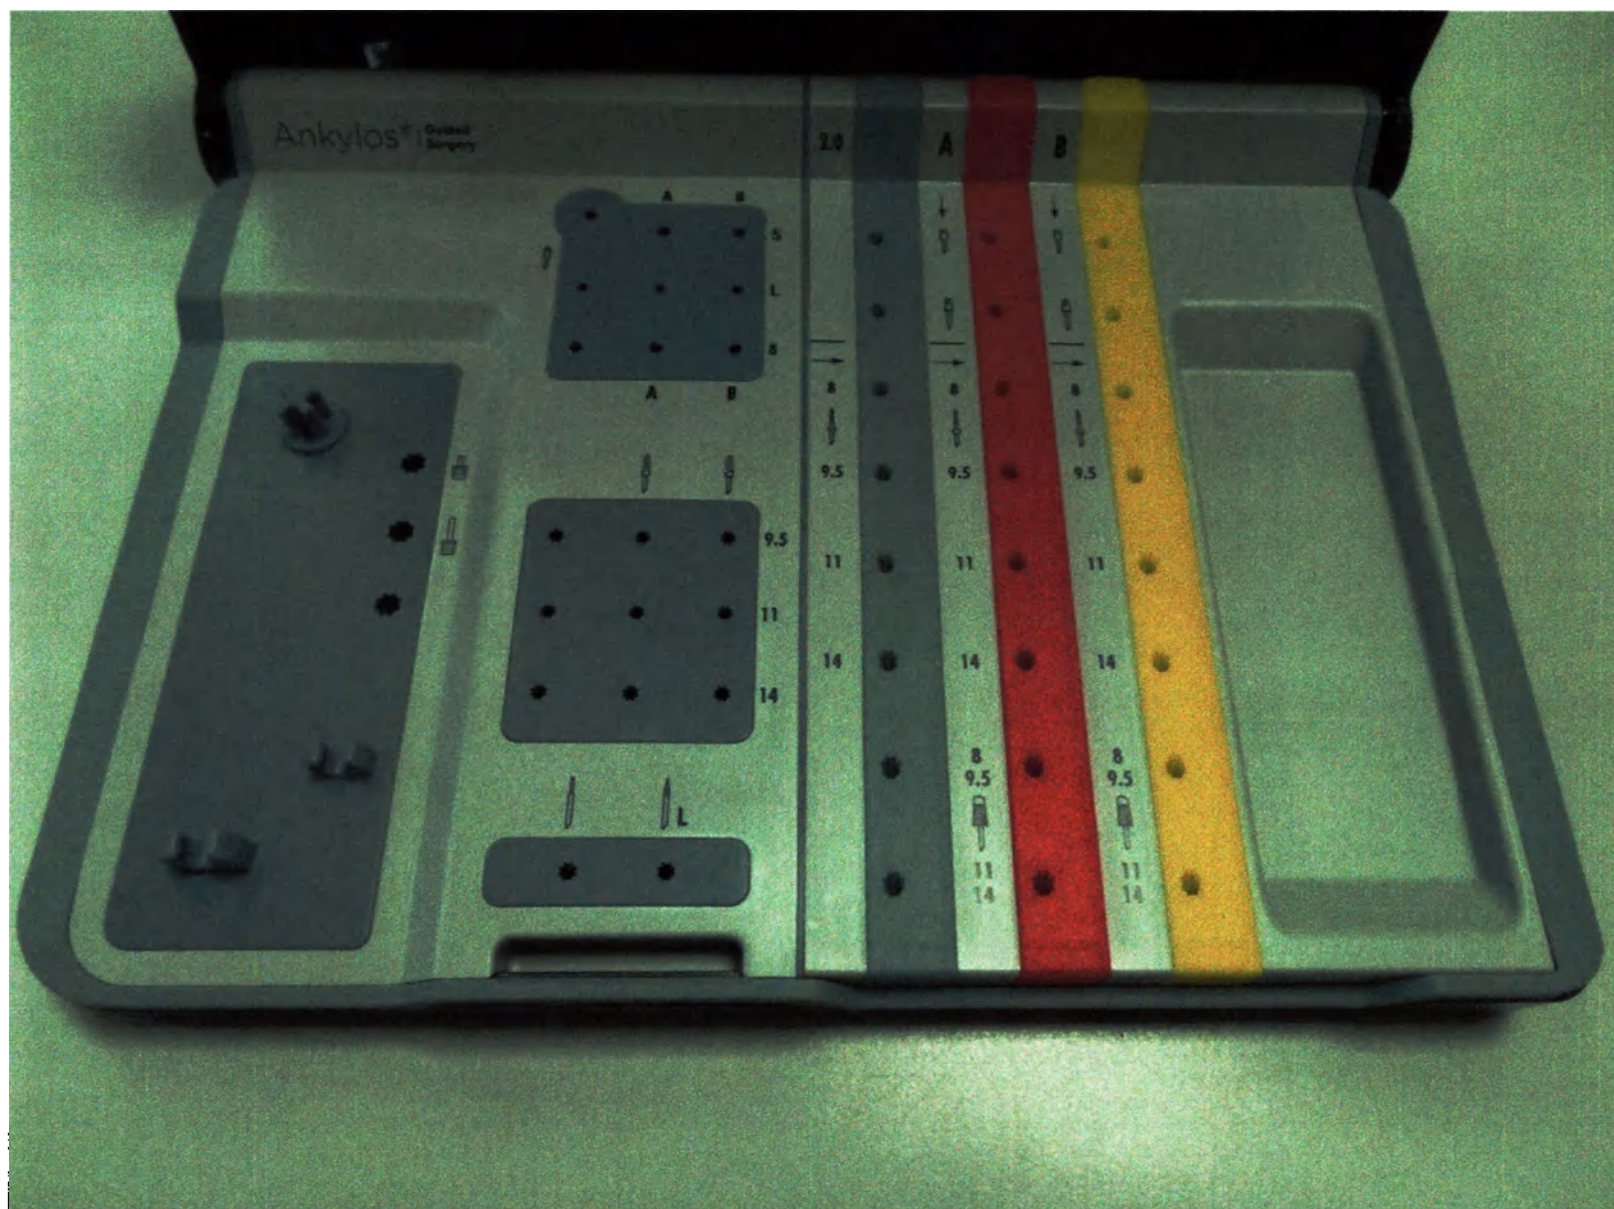

X-Ray-Template Ankylos® Implants Röntgenschablone Ankylos® Implantate															
Scale/Maßstab 1 : 1					Scale/Maßstab 1.1 : 1					Scale/Maßstab 1.25 : 1					
				Marker ball					Marker ball					Marker ball	
6.6	A 6.6	B 6.6	C 6.6		A 6.6	B 6.6	C 6.6			A 6.6	B 6.6	C 6.6			
															
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm			Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm			
8	A 8	B 8	C 8	D 8	A 8	B 8	C 8	D 8		A 8	B 8	C 8	D 8		
															
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		
9.5	A 9.5	B 9.5	C 9.5	D 9.5	A 9.5	B 9.5	C 9.5	D 9.5		A 9.5	B 9.5	C 9.5	D 9.5		
															
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		
11	A 11	B 11	C 11	D 11	A 11	B 11	C 11	D 11		A 11	B 11	C 11	D 11		
															
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		
14	A 14	B 14	C 14	D 14	A 14	B 14	C 14	D 14		A 14	B 14	C 14	D 14		
															
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm		
17	A 17	B 17	C 17		A 17	B 17	C 17			A 17	B 17	C 17			
															
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm			Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm			
Order no. 3103 3370/17-5070															
www.dentsplysirona.com															

Ankylos®

RU

Хирургический набор для навигационной хирургии

Dentsply
Sirona
Implants

Имплантовод Ankylos® Implant Driver
GS короткий,
узкий для имплантатов C/X A
Арт. 3103 7690

Имплантовод Ankylos® Implant Driver
GS короткий,
широкий для имплантатов C/X B
Арт. 3103 7691

Имплантовод Ankylos® Implant Driver
GS длинный,
узкий для имплантатов C/X A
Арт. 3103 7692

Имплантовод Ankylos® Implant Driver
GS длинный,
широкий для имплантатов C/X B
Арт. 3103 7693

Ключ-трещотка Ankylos® Ratchet*
Арт. 3103 3030

Насадка для ключа-трещотки Ankylos®
Ratchet для М-инструментов HXSS*
короткая Арт. 3103 7510

средняя Арт. 3103 7511

длинная Арт. 3103 7512

Метчик Ankylos® Tap GS

A 8 Арт. 3103 7671

B 8 Арт. 3103 7681

A 9,5 Арт. 3103 7672

B 9,5 Арт. 3103 7682

A 11 Арт. 3103 7673

B 11 Арт. 3103 7683


A 14 Арт. 3103 7674

B 14 Арт. 3103 7684

* Не входит в набор.

ND Narrow Diameter (узкий диаметр)

WD Wide Diameter (широкий диаметр)

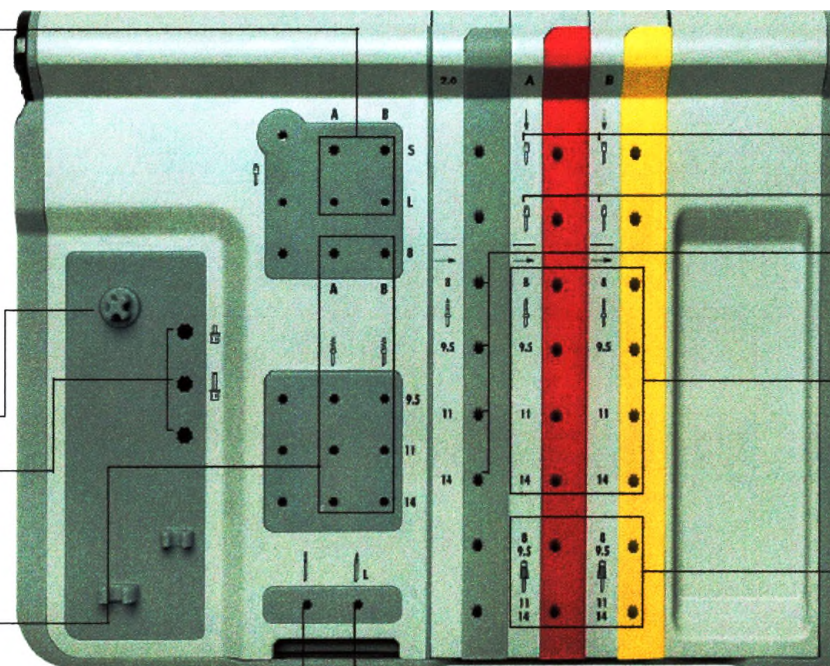

Мукотом Ankylos®
Rotary Tissue Punch GS
A Арт. 3103 7610
B Арт. 3103 7612

Сверло первичное Ankylos®
Initial Drill GS
A Арт. 3103 7602
B Арт. 3103 7604

Винтовое сверло Ankylos®
Twist Drill GS
Ø 2,0/L 8 Арт. 3103 7621
Ø 2,0/L 9,5 Арт. 3103 7622
Ø 2,0/L 11 Арт. 3103 7623
Ø 2,0/L 14 Арт. 3103 7624

Трехгранная фреза Ankylos®
Tri-Spade-Drill GS
A 8 Арт. 3103 7631
B 8 Арт. 3103 7641
A 9,5 Арт. 3103 7632
B 9,5 Арт. 3103 7642
A 11 Арт. 3103 7633
B 11 Арт. 3103 7643
A 14 Арт. 3103 7634
B 14 Арт. 3103 7644

Коническая развертка Ankylos®
Conical Reamer GS
A 8/9,5 Арт. 3103 7651
B 8/9,5 Арт. 3103 7661
A 11/14 Арт. 3103 7653
B 11/14 Арт. 3103 7663

Инструмент Ankylos® Unscrew Instrument
для удаления винтов-заглушек, длинный*
Арт. 3103 3435


Насадка-отвертка Ankylos® Screwdriver
1 мм, шестигранная*
Арт. 3103 3455

Комплект Dentsply Sirona не отличается от аналогичного набора на английском языке, опубликованного компанией Dentsply Sirona, 2017. Все права защищены. (2066 253)

**Ankylos®
Surgical Kit Tray Guided Surgery
(empty)**

REF 31036531

LOT B123456789

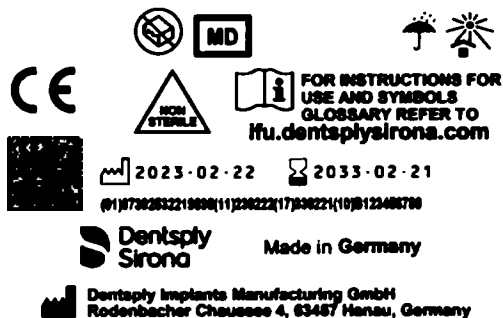

Лоток под хирургический набор Ankylos® GS (пустой) (Ankylos® Surgical Kit Tray Guided Surgery (empty))

Ankylos® Surgical Kit Tray Guided Surgery (empty)

РУ № P3H 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 31036531

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


 **Производитель:**

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
xxx


ifu.dentsplysirona.com

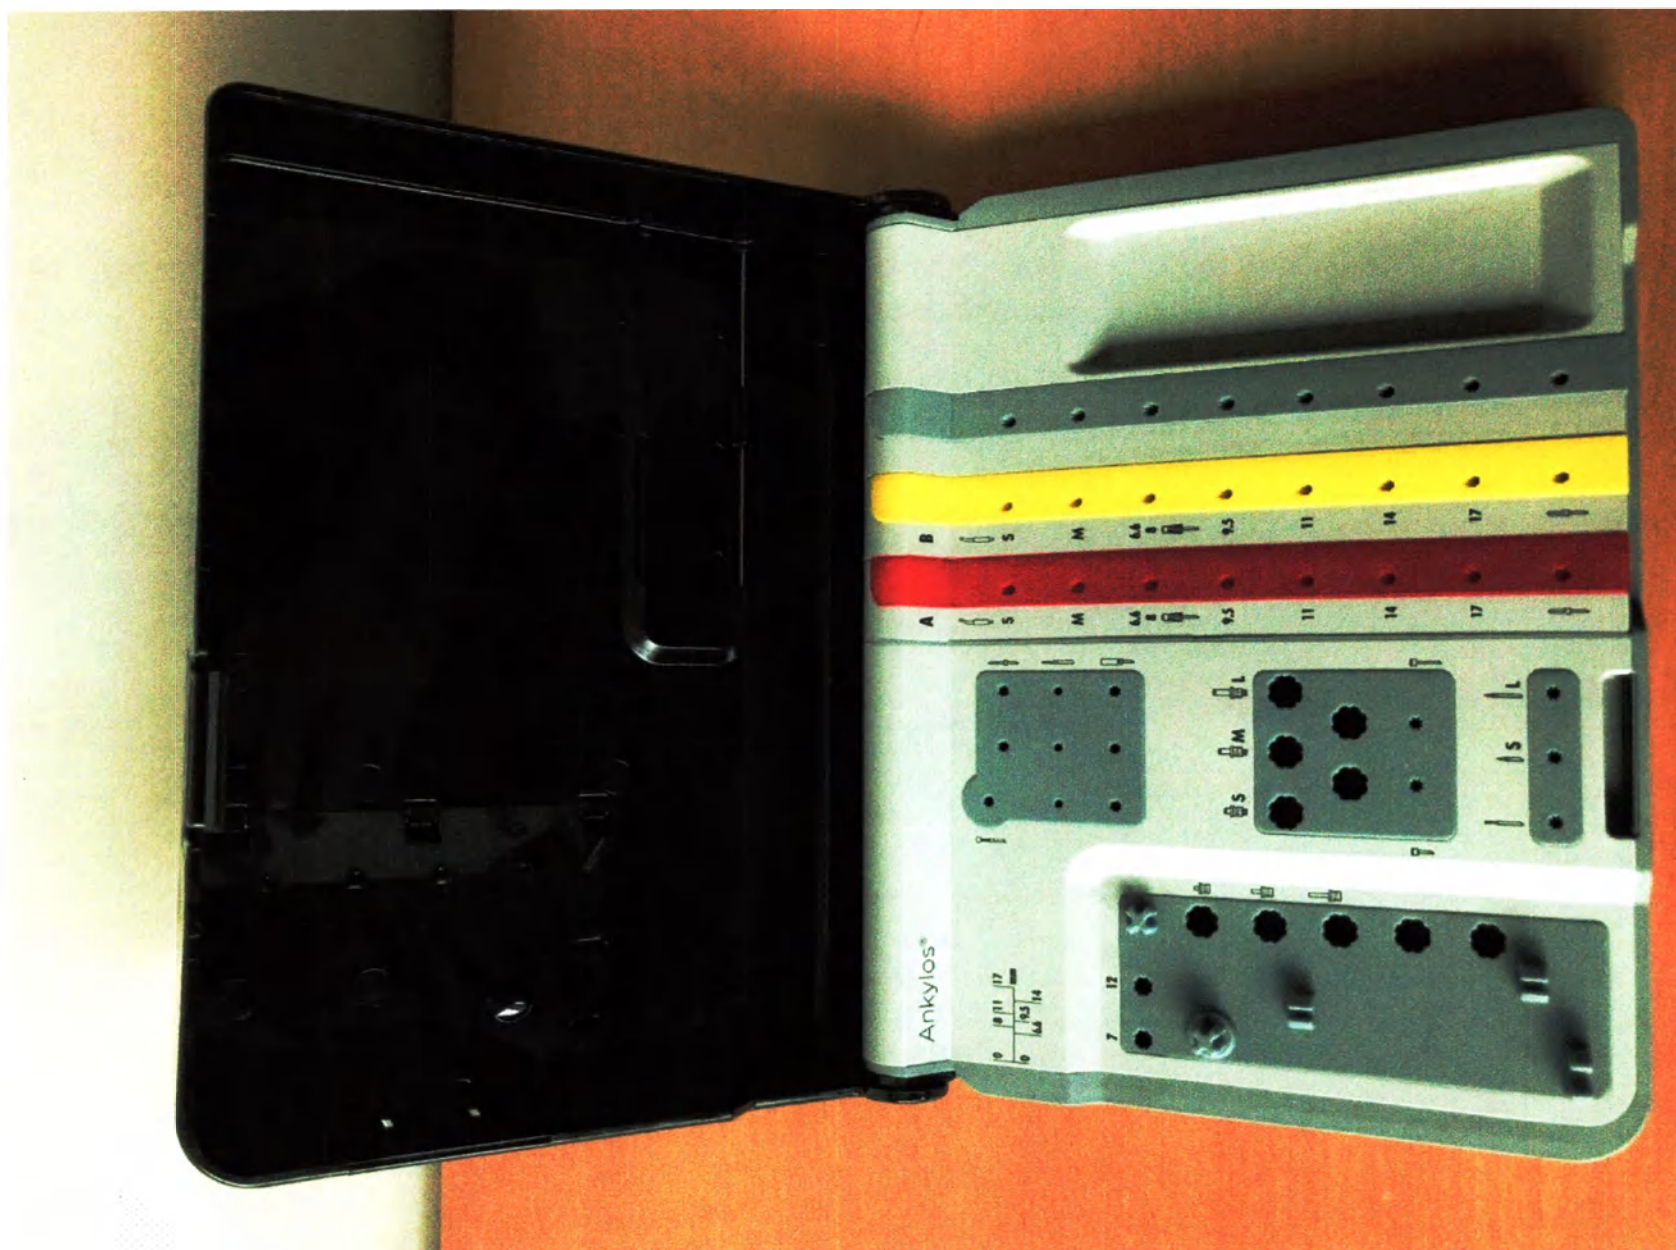


Ankylos®		X-Ray-Template Ankylos® Implants Röntgenschablone Ankylos® Implantate				Dentsply Sirona		
Scale / Maßstab 1 : 1		○ Marker ball	Scale / Maßstab 1.1 : 1		○ Marker ball	Scale / Maßstab 1.25 : 1		○ Marker ball
6.6	A 6.6	B 6.6	C 6.6		A 6.6	B 6.6	C 6.6	
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	
8	A 8	B 8	C 8	D 8	A 8	B 8	C 8	D 8
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm
9.5	A 9.5	B 9.5	C 9.5	D 9.5	A 9.5	B 9.5	C 9.5	D 9.5
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm
11	A 11	B 11	C 11	D 11	A 11	B 11	C 11	D 11
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm
14	A 14	B 14	C 14	D 14	A 14	B 14	C 14	D 14
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 7 mm
17	A 17	B 17	C 17		A 17	B 17	C 17	
	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm		Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	
Order no. 3103 3370/17-5070 www.dentsplysirona.com								
								CE

Ankylos®

RU

Хирургический набор

**Dentsply
Sirona**
Implants

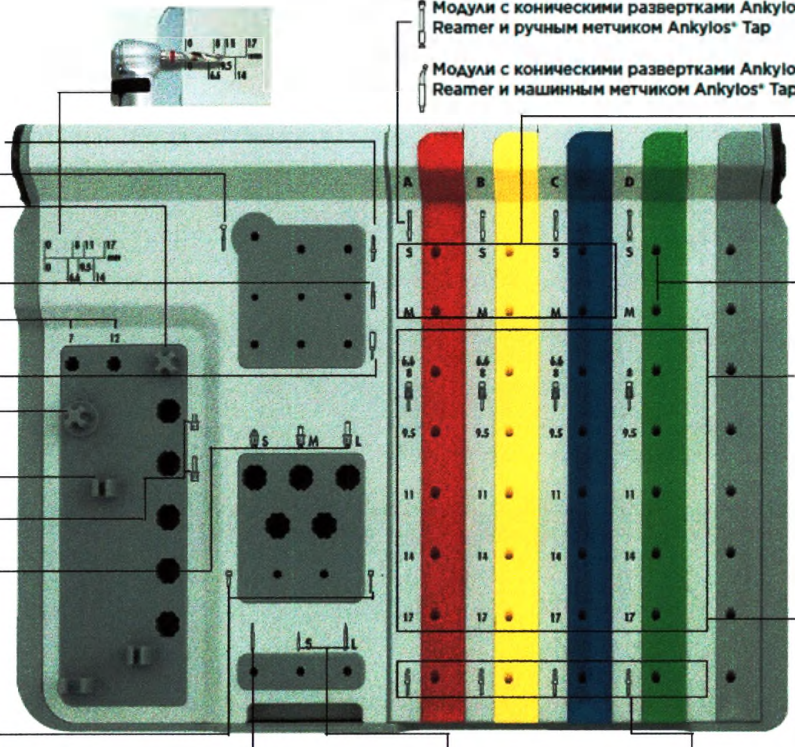

Мукотом Ankylos® Center Punch 3 мм с внутренним охлаждением
Арт. 3103 3010

Винтовое сверло Ankylos® Twist Drill 2 мм с внутренним охлаждением
Арт. 3103 3022

Рукоятка Ankylos® Handle для насадки для ключа-трещотки
Арт. 3103 3040

Рукоятка Ankylos® Handle для отвертки 7 мм Арт. 3103 3410 12 мм Арт. 3103 3415

Ключ-трещотка Ankylos® Ratchet
Арт. 3103 3030

Рожковый ключ Ankylos® Open-end Wrench
Арт. 3103 3050

Насадка для ключа-трещотки Ankylos® Ratchet для инструментов короткая Арт. 3103 3070 средняя Арт. 3103 3080 длинная Арт. 3103 3090 и два запасных гнезда

Насадка для ключа-трещотки Ankylos® Ratchet для M-инструментов* средняя HXSS Арт. 3103 7511* длинная HXSS Арт. 3103 7512* и 3 запасных гнезда*

3 параллельные направляющие Ankylos® Parallel Gauge для винтового сверла
Арт. 3103 3026

Удлинитель Ankylos® Extension Instrument HXSS* Арт. 3103 7408 и 2 запасных гнезда

Инструмент Ankylos® Insertion для установки имплантатов короткий Арт. 3103 7531 средний Арт. 3103 7532 длинный Арт. 3103 7533 и 2 запасных гнезда

Инструмент Ankylos® Implant для установки имплантатов M / короткий* Арт. 3103 7541

Инструмент Ankylos® Implant для установки имплантатов M / длинный* Арт. 3103 7543

Насадка-отвертка Ankylos® 1 мм, шестигранная
Арт. 3103 3455

Инструмент Ankylos® Unscrew Instrument для удаления винтов-заглушек S Арт. 3103 3434 L Арт. 3103 3435

Метчик Ankylos® Tap, ручной A Арт. 3103 3260 B Арт. 3103 3270 C Арт. 3103 3280 D Арт. 3103 3285*****

Метчик Ankylos® Tap, машинный* A Арт. 3103 7440* B Арт. 3103 7450*

Инструмент Ankylos® Cleaning для очистки сверл (не показан)
Арт. 3103 7320

Модули с коническими развертками Ankylos® Conical Reamer и ручным метчиком Ankylos® Tap

Модули с коническими развертками Ankylos® Conical Reamer и машинным метчиком Ankylos® Tap

Треугольная фреза Ankylos® Tri-Spade Drill
A / S Арт. 3103 7325
B / S Арт. 3103 7345
C / S Арт. 3103 7365**
A / M Арт. 3103 7330
B / M Арт. 3103 7350
C / M Арт. 3103 7370**

Параллельная фреза Ankylos® Parallel Drill для D-имплантатов***
S Арт. 3103 3182***
M Арт. 3103 3183***

Коническая развертка Ankylos® Conical Reamer, ручная
A 6,6/A 8 Арт. 3103 3185
A 9,5 Арт. 3103 3188
A 11 Арт. 3103 3190
A 14 Арт. 3103 3200
A 17 Арт. 3103 3202***
B 6,6/B 8 Арт. 3103 3205
B 9,5 Арт. 3103 3208
B 11 Арт. 3103 3210
B 14 Арт. 3103 3220
B 17 Арт. 3103 3230***
C 6,6/C 8 Арт. 3103 3233**
C 9,5 Арт. 3103 3235**
C 11 Арт. 3103 3238**
C 14 Арт. 3103 3240**
C 17 Арт. 3103 3250***
D 8 Арт. 3103 3252***
D 9,5 Арт. 3103 3254***
D 11 Арт. 3103 3256***
D 14 Арт. 3103 3258***

Коническая развертка Ankylos® Conical Reamer, машинная*
A 6,6/A 8 Арт. 3103 7185*
A 9,5 Арт. 3103 7188*
A 11 Арт. 3103 7190*
A 14 Арт. 3103 7200*
A 17 Арт. 3103 7202***
B 6,6/B 8 Арт. 3103 7205*
B 9,5 Арт. 3103 7208*
B 11 Арт. 3103 7210*
B 14 Арт. 3103 7220*
B 17 Арт. 3103 7230***

Все инструменты без звездочек являются частью ручного хирургического набора Ankylos® Surgical Kit, AB.

* Только инструменты машинного хирургического набора Ankylos® Surgical Kit, AB.

** Только хирургический набор Ankylos® Surgical Kit ABC.

*** Гнездо для дополнительных инструментов.

Копирование Dentsply Sirona или отрывание от копии, либо права на свои товарные знаки, отнесенные к имплантам, является нарушением. (1400 8623)

Ankylos®
Surgical Kit Tray motor AB reamer
empty

REF 31036542

LOT B123456789



Лоток под хирургический набор Ankylos® машинные АВ (пустой) (Ankylos® Surgical Kit Tray motor AB reamer (empty))

Ankylos® Surgical Kit Tray motor AB reamer empty

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 31036542

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


 Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
xxx

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87


ifu.dentsplysirona.com

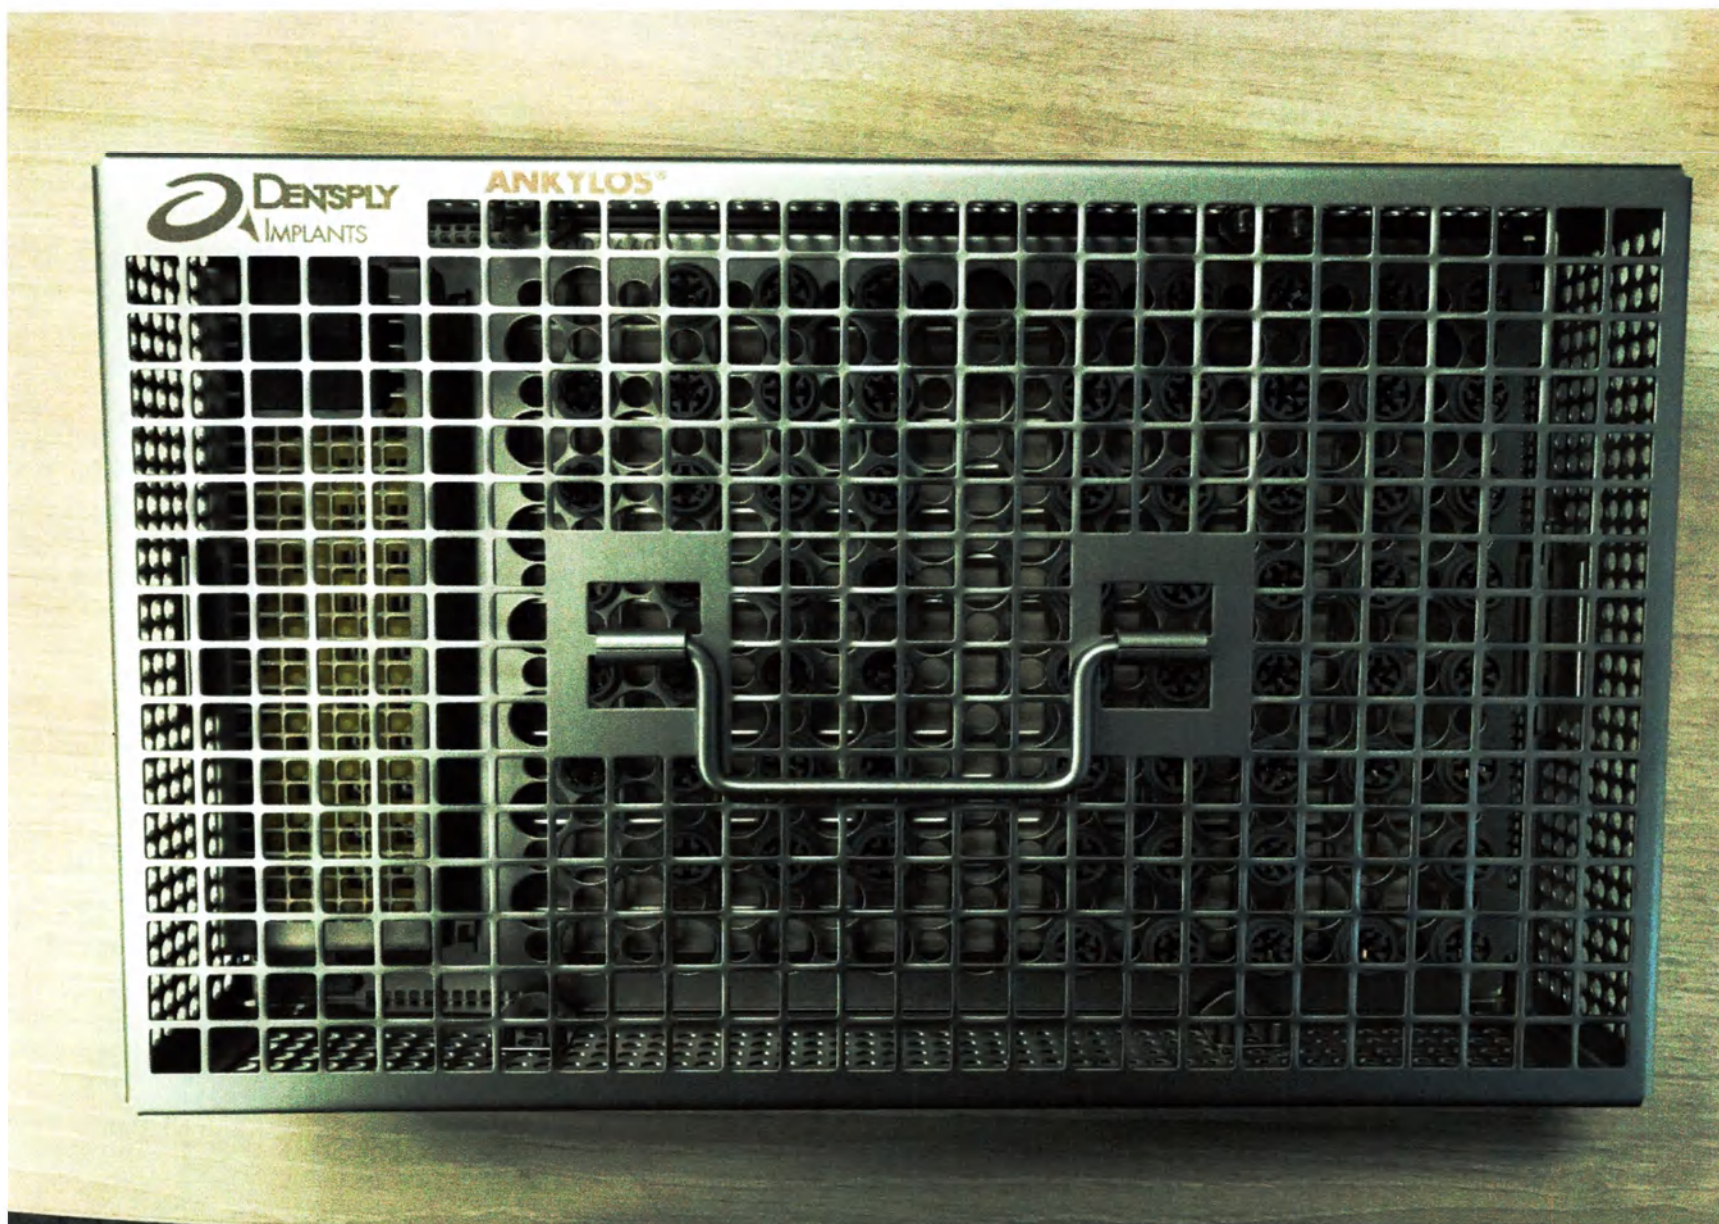

Ankylos®

Washtray Ankylos® Implant System - Guide

TAQ 150 12

Ankylos Washtray Overlay
Order no. 3103 6501

Ankylos Handle for Screwdriver, standard
Ø 7 mm Order no. 3103 1410
Ø 12 mm Order no. 3103 1415

Ankylos Surgical Ratchet with Torque Indication
Order no. 3103 7500

Ankylos Open-end Wrench C/X
Order no. 3103 7502

Ankylos Ratchet Insert for Instruments*
short Order no. 3103 3070
medium Order no. 3103 3080
long Order no. 3103 3090

Ankylos Ratchet Insert for M-Instruments*
medium HXSS Order no. 3103 7511
long HXSS Order no. 3103 7512

Ankylos Screwdriver Insert 1 mm, HXSS
Order no. 3103 3455

Year of manufacture, also provided on the lid and the basket

Cleaning and sterilization instructions
The overlay must be separated from the washtray before cleaning and re-assembled prior to sterilization. Please observe the instructions for Use of the Individual Instruments and the Dentsply Sirona implants instructions for Sterilization and Instrument Care. The Handle for Ratchet Insert (Order no. 3103 3040) must not be processed in the Washtray. Before using the Washtray for the first surgical treatment it must undergo a complete processing and sterilization cycle together with the instruments.

Service life: 5 years

3 Ankylos Parallel Gauges for Twist Drill
Order no. 3103 3025

Ankylos Round Drill
Order no. 3103 7040

Ankylos Twist Drill D 2.0 / S
Order no. 3103 7043
Ankylos Twist Drill D 2.0 / M
Order no. 3103 7044

Ankylos Twist Drill A / S
Order no. 3103 7062
Ankylos Twist Drill B / S
Order no. 3103 7062
Ankylos Twist Drill C / S
Order no. 3103 7072
Ankylos Twist Drill D / S
Order no. 3103 7082

Ankylos Twist Drill A / M
Order no. 3103 7063
Ankylos Twist Drill B / M
Order no. 3103 7063
Ankylos Twist Drill C / M
Order no. 3103 7073
Ankylos Twist Drill D / M
Order no. 3103 7083

Ankylos Conical Reamer manual*
A 6.5/A 8 Order no. 3103 3185
A 9.5 Order no. 3103 3188
A 11 Order no. 3103 3190
A 14 Order no. 3103 3200
A 17 Order no. 3103 3202
B 6.5/B 8 Order no. 3103 3205
B 9.5 Order no. 3103 3208
B 11 Order no. 3103 3210
B 14 Order no. 3103 3220
B 17 Order no. 3103 3230
C 6.5/C 8 Order no. 3103 3233
C 9.5 Order no. 3103 3235
C 11 Order no. 3103 3238
C 14 Order no. 3103 3240
C 17 Order no. 3103 3250
D 9 Order no. 3103 3252
D 9.5 Order no. 3103 3254
D 11 Order no. 3103 3256
D 14 Order no. 3103 3258

Ankylos Conical Reamer motor*
A 6.5/A 8 Order no. 3103 3185
A 9.5 Order no. 3103 3188
A 11 Order no. 3103 3190
A 14 Order no. 3103 3200
A 17 Order no. 3103 3202
B 6.5/B 8 Order no. 3103 3205
B 9.5 Order no. 3103 3208
B 11 Order no. 3103 3210
B 14 Order no. 3103 3220
B 17 Order no. 3103 3230

Ankylos Tap manual*
A Order no. 3103 3260
B Order no. 3103 3270
C Order no. 3103 3280
D Order no. 3103 3285

Ankylos Tap motor HXSS*
A Order no. 3103 7440
B Order no. 3103 7450

Ankylos Unscrew Instrument for Cover Screws
short Order no. 3103 3454
long Order no. 3103 3455


Ankylos Seating Instrument for C/X Implants, HXSS motor
short Order no. 3103 7541
long Order no. 3103 7543

Ankylos Ratchet Insert for C/X Implants
short Order no. 3103 7531
medium Order no. 3103 7532
long Order no. 3103 7533

Ankylos Extension Instrument HXSS*
Order no. 3103 7408

*** manual or motor-driven instruments**

Dentsply Sirona Implants

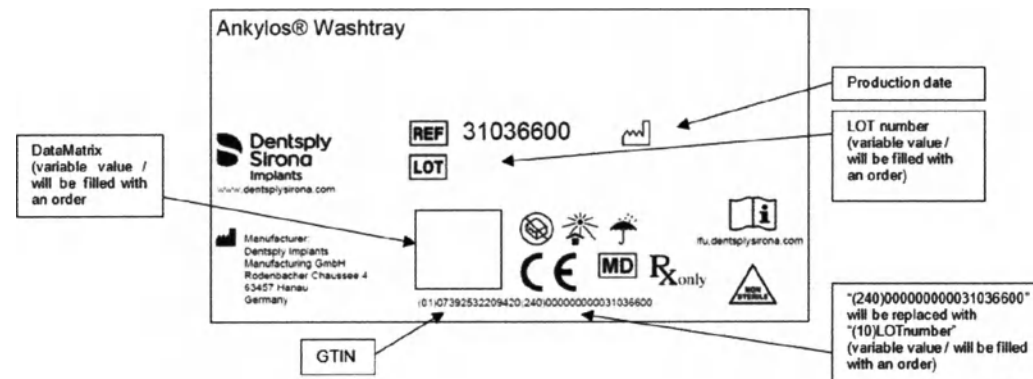

Лоток Washtrey Ankylos®

Ankylos® Washtrey

РУ № РЗН 2020/12836

от xx.xx.xxxx

REF 31036600

 см. на упаковке


Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


 **Производитель:**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
xxx

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д. 18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87


ifu.dentsplysirona.com

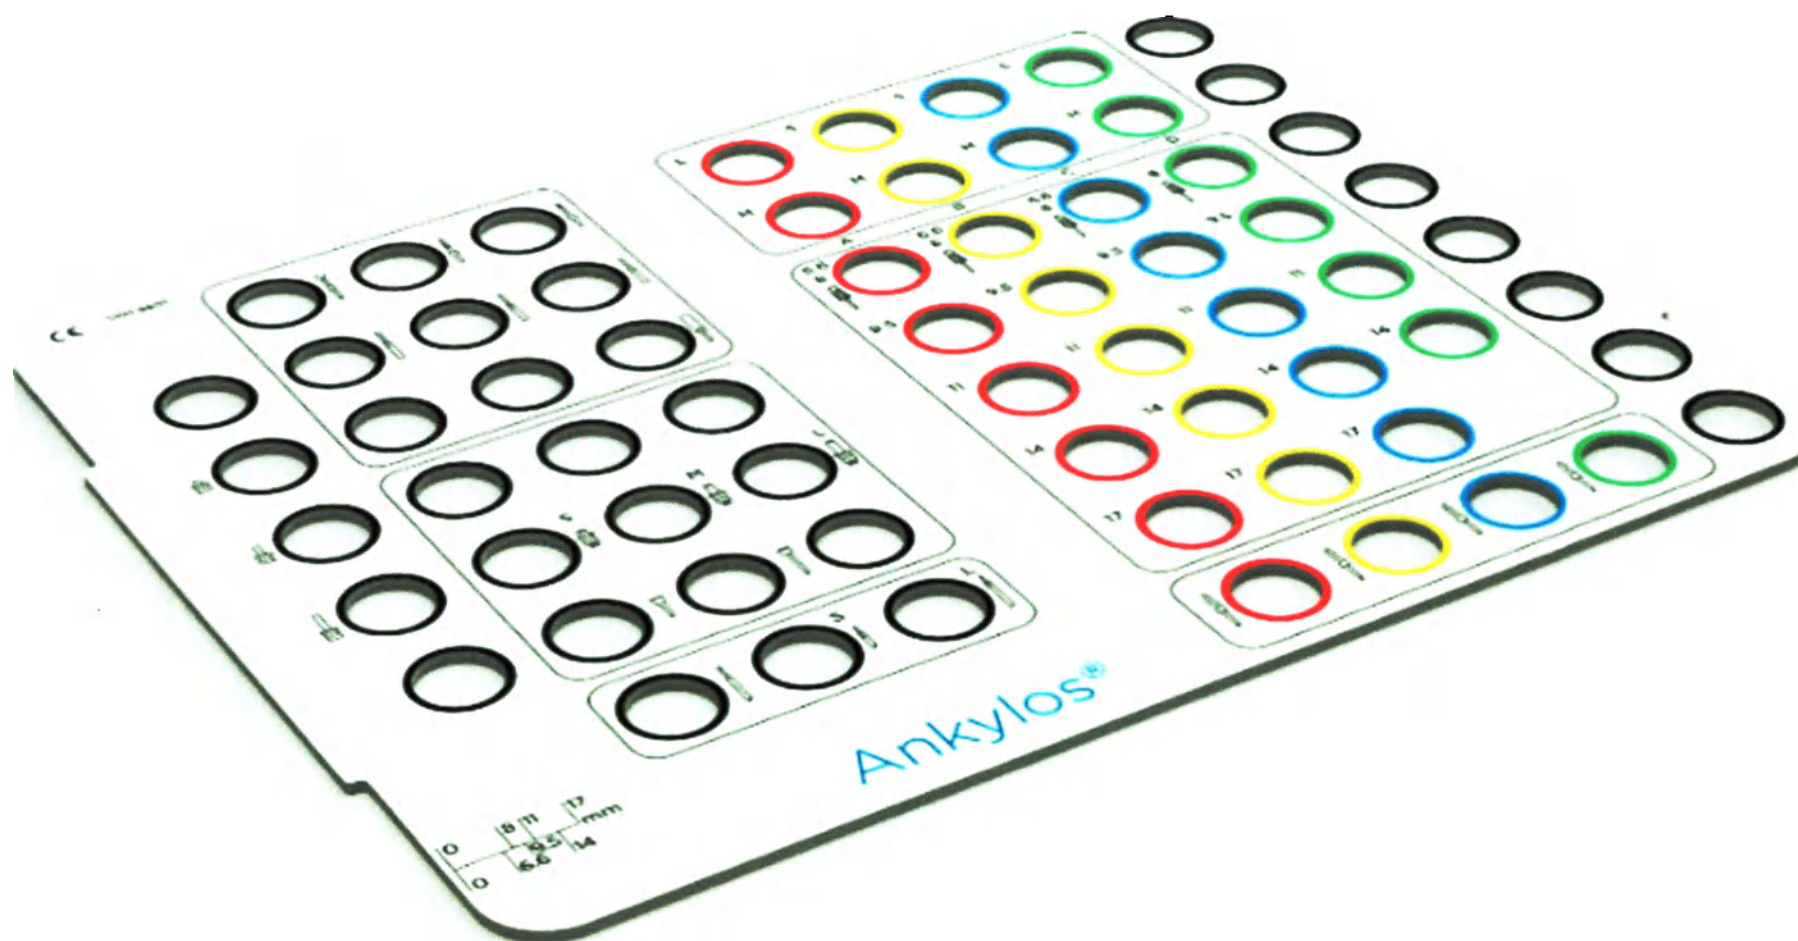

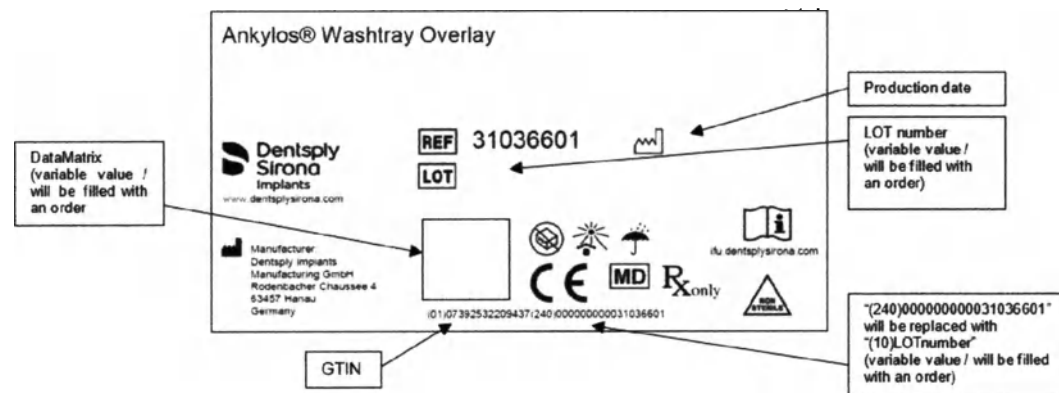

Накладка Washtray Ankylos® (Ankylos® Washtray Overlay)

Ankylos® Washtray Overlay

РУ № РЗН 2020/12836

от xx.xx.xxxx

REF 31036601

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
xxx

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com



**Xive®
Surgical Kit Tray empty**

REF 26-7010 / 32267010 **LOT** B123456789

Chirurgie Kit Tray leer

Plateau du Kit chirurgical vide

Tray per Kit chirurgico vuoto

Bandeja del Juego quirúrgico vacía



21002311

Лоток под хирургический набор Xive® (пустой) (Xive® Surgical Kit Tray (empty))

Xive® Surgical Kit Tray empty

РУ № РЗН 2020/12836

от xx.xx.xxxx

REF 32267010

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия


Страна происхождения:
xxx

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



[ifu.dentsplysirona.com](http://fu.dentsplysirona.com)

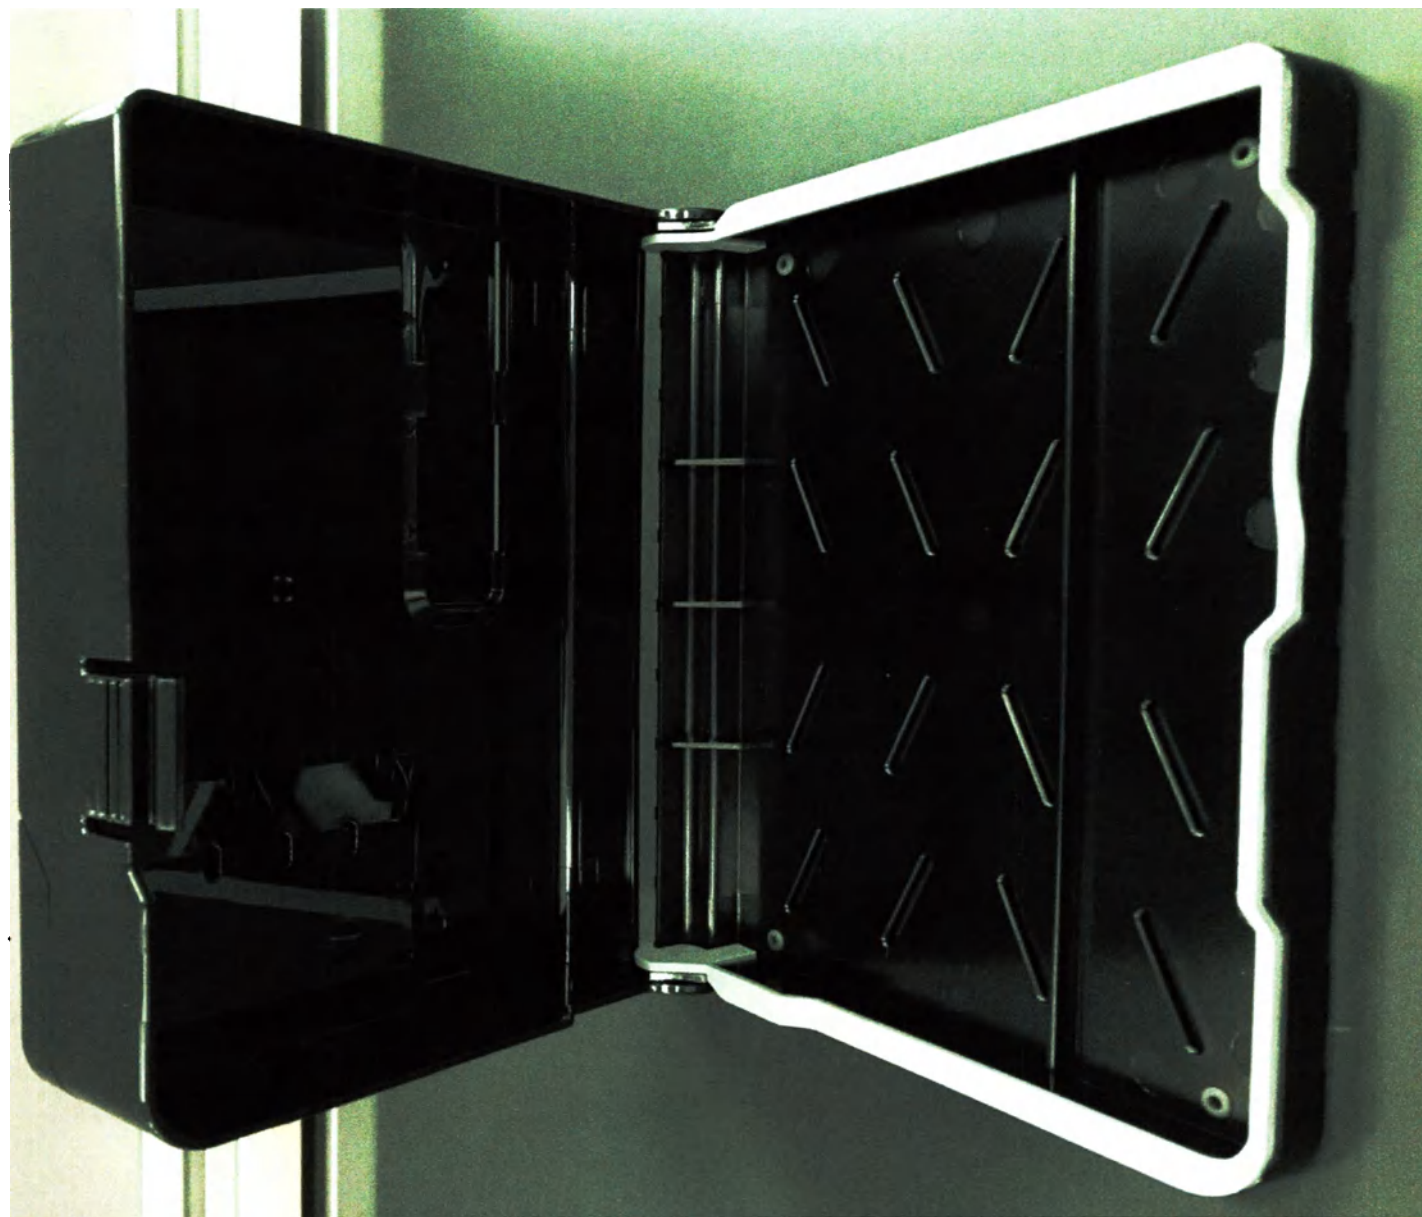

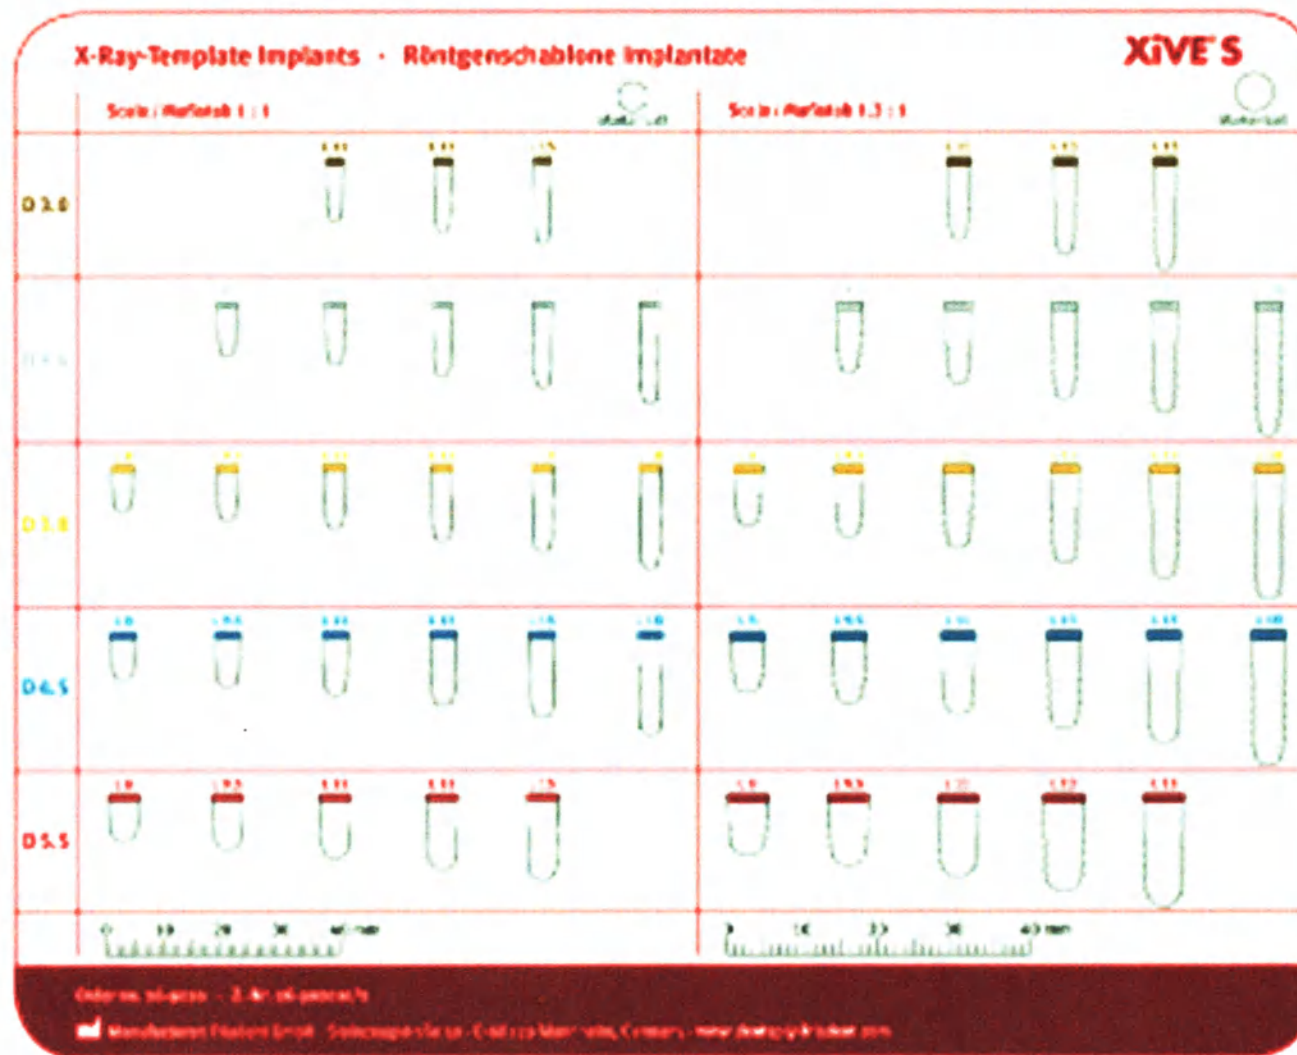

Xive®

RU

Хирургический набор для навигационной хирургии

**Dentsply
Sirona**
Implants

S Имплантовод Xive® GS
короткий, узкий для
TempBase
Арт. 26 - 5700
широкий для TempBase
Арт. 26 - 5701

L Имплантовод Xive® GS
длинный, узкий для
TempBase
Арт. 26 - 5702
широкий для TempBase
Арт. 26 - 5703

 Вставка для трещотки
для инструментов Xive®
Арт. 26 - 6120
и 2 свободных гнезда

Ключ-трещотка Xive®
Арт. 45 - 6020


 Метчик Xive® GS
D 3,0 Арт. 26 - 5022
D 3,4 Арт. 26 - 5032
D 3,8 Арт. 26 - 5042
D 4,5 Арт. 26 - 5052

 Удлинитель Xive®
Арт. 26 - 6130

 Шестигранная отвертка Xive®
0,9 мм / S
Арт. 26 - 6190
Шестигранная
отвертка Xive®
0,9 мм / L
Арт. 26 - 6195

* Не входит в набор.

ND Narrow Diameter (узкий диаметр)
WD Wide Diameter (широкий диаметр)

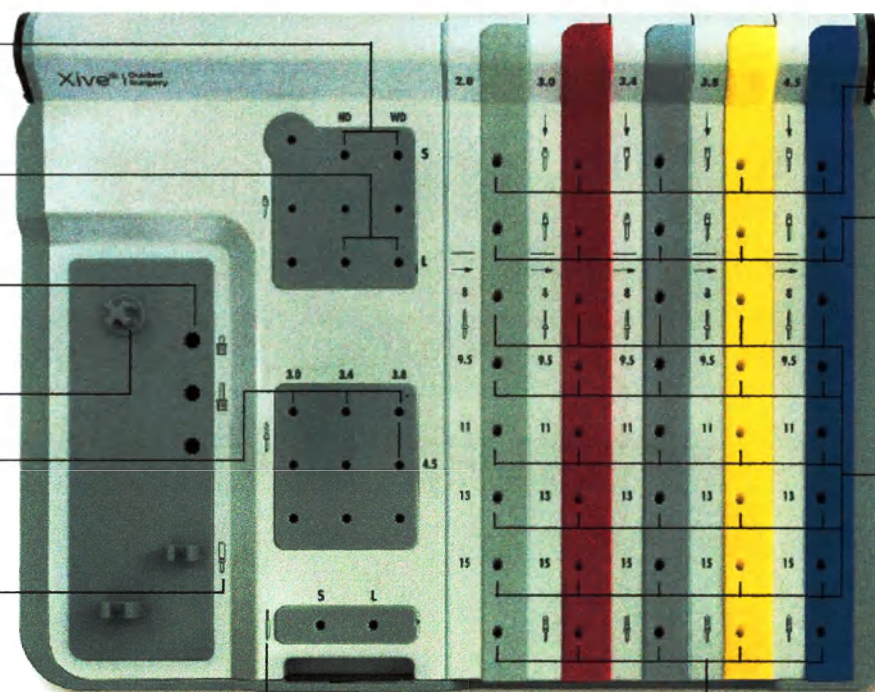

 Кортикальное сверло Xive® GS
D 3,0 Арт. 26 - 5020
D 3,4 Арт. 26 - 5030
D 3,8 Арт. 26 - 5040
D 4,5 Арт. 26 - 5050

 Микротом Xive® GS
D 3,0 Арт. 26 - 5201
D 3,4 Арт. 26 - 5301
D 3,8 Арт. 26 - 5401
D 4,5 Арт. 26 - 5501

 Начальное сверло Xive® GS
D 3,0 Арт. 26 - 5202
D 3,4 Арт. 26 - 5302
D 3,8 Арт. 26 - 5402
D 4,5 Арт. 26 - 5502

 Винтовое сверло Xive® GS
D 2,0 / L 8 Арт. 26 - 5108
D 3,0 / L 8 Арт. 26 - 5208
D 3,4 / L 8 Арт. 26 - 5308
D 3,8 / L 8 Арт. 26 - 5408
D 4,5 / L 8 Арт. 26 - 5508

D 2,0 / L 9,5 Арт. 26 - 5195
D 3,0 / L 9,5 Арт. 26 - 5295
D 3,4 / L 9,5 Арт. 26 - 5395
D 3,8 / L 9,5 Арт. 26 - 5495
D 4,5 / L 9,5 Арт. 26 - 5595

D 2,0 / L 11 Арт. 26 - 5111
D 3,0 / L 11 Арт. 26 - 5211
D 3,4 / L 11 Арт. 26 - 5311
D 3,8 / L 11 Арт. 26 - 5411
D 4,5 / L 11 Арт. 26 - 5511

D 2,0 / L 13 Арт. 26 - 5113
D 3,0 / L 13 Арт. 26 - 5213
D 3,4 / L 13 Арт. 26 - 5313
D 3,8 / L 13 Арт. 26 - 5413
D 4,5 / L 13 Арт. 26 - 5513

D 2,0 / L 15 Арт. 26 - 5115
D 3,0 / L 15 Арт. 26 - 5215
D 3,4 / L 15 Арт. 26 - 5315
D 3,8 / L 15 Арт. 26 - 5415
D 4,5 / L 15 Арт. 26 - 5515

Иллюстрированное руководство Xive®. Не является медицинским документом. Все права защищены. 2017. Все права защищены. (24.01.2018)

Xive®
Surgical Kit Tray Guided Surgery
(empty)

REF 26-5010 / 32265010 **LOT** B123456789

Chirurgie Kit Tray Guided Surgery
(leer)
Plateau du kit chirurgical Guided Surgery
(vide)
Tray per kit chirurgico Guided Surgery
(vuoto)
Bandeja del juego quirúrgico Guided Surgery
(vacía)



Dentsply Sirona
Made in <Country>
Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

271002911

Лоток под хирургический набор Xive® GS (пустой) (Xive® Surgical Kit Tray Guided Surgery (empty))

Xive® Surgical Kit Tray Guided Surgery (empty)

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 32265010

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


 **Производитель:**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия


Страна происхождения:
XXX

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д. 18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87


ifu.dentsplysirona.com



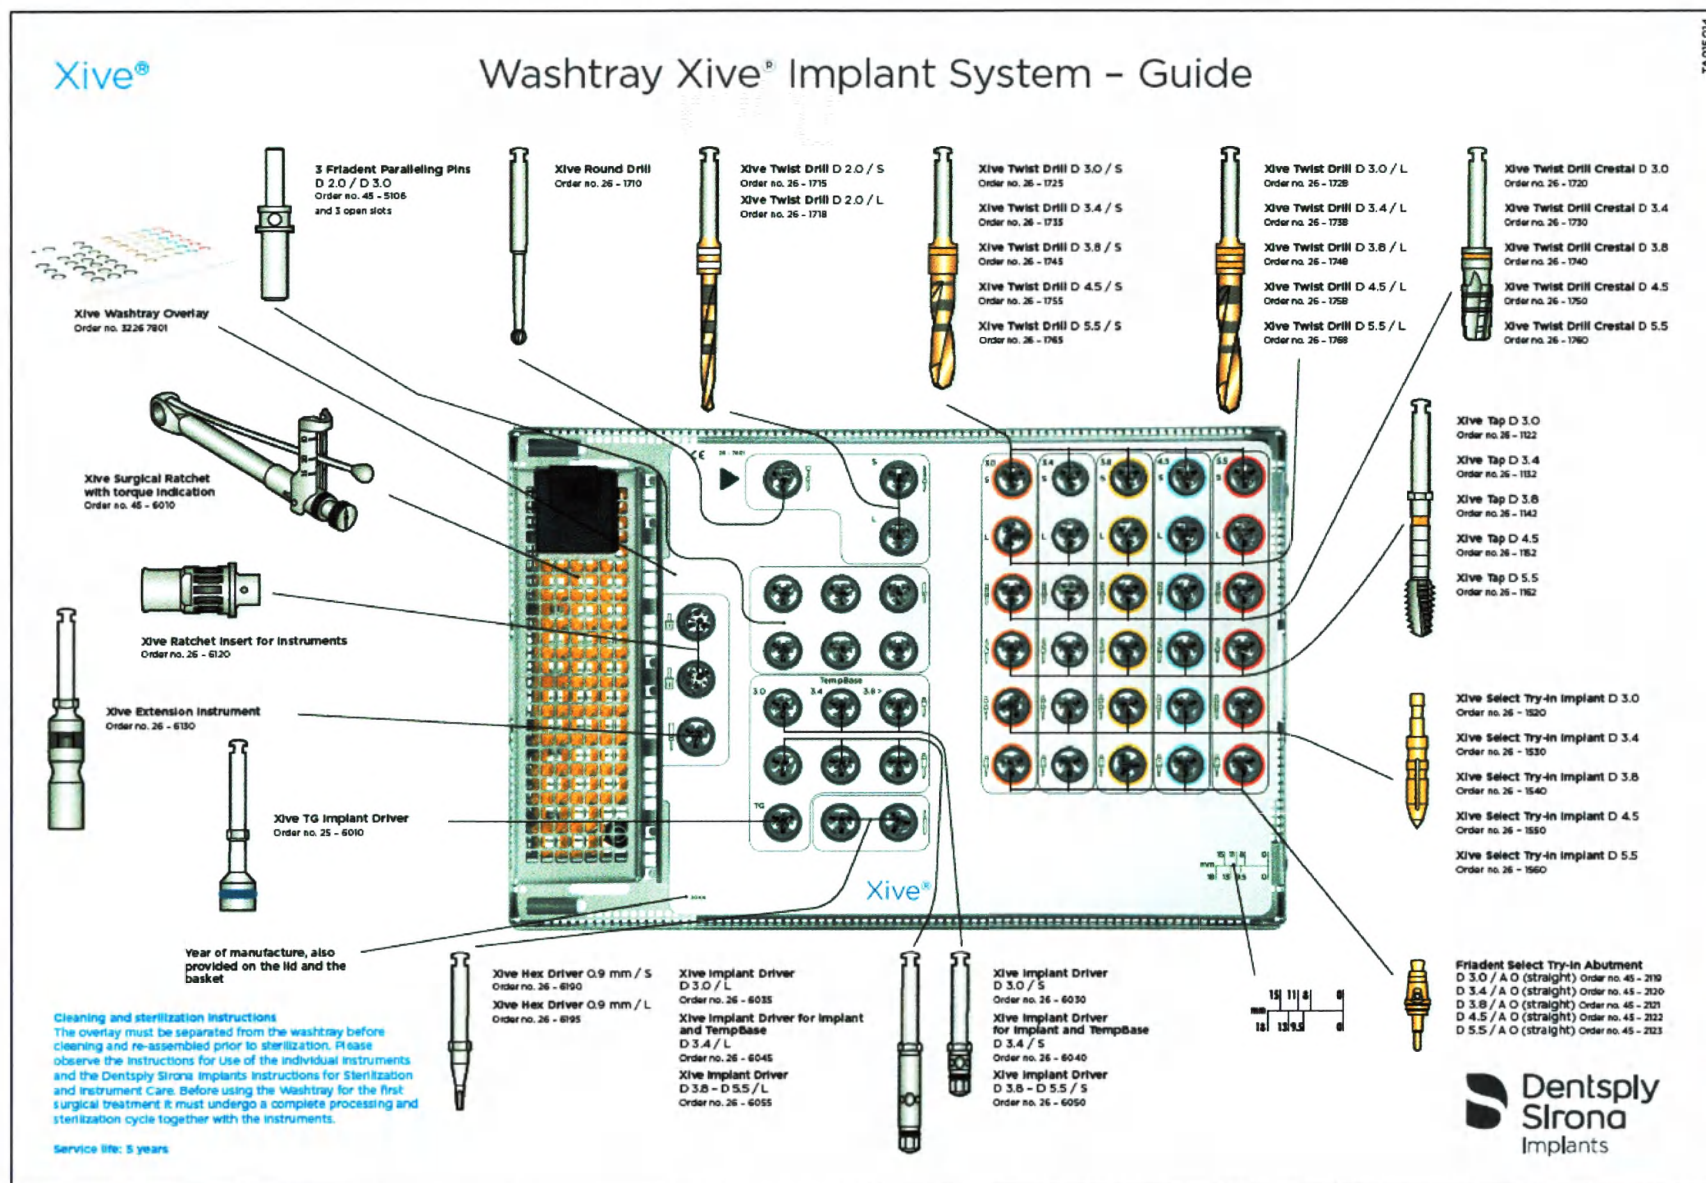

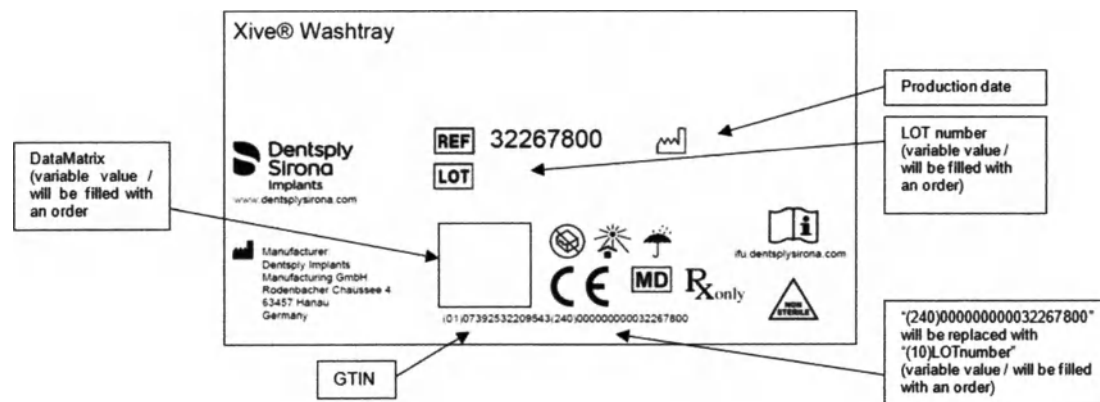

Лоток Washtray Xive®

Xive® Washtray

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 32267800

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Страна происхождения:
xxx


Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentsplysirona.com



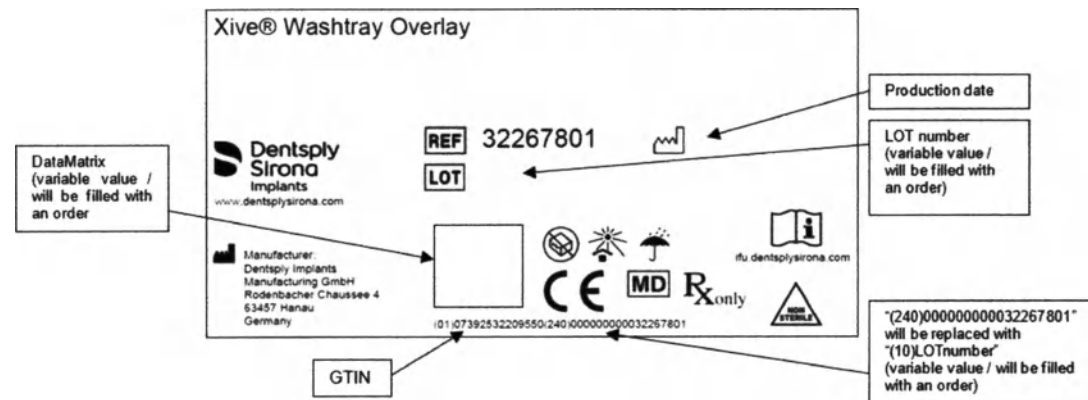

Накладка Xive® Washtray (Xive® Washtray Overlay)

Xive® Washtray Overlay

ПУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 32267801

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
 Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


 **Производитель:**
 Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
 Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
 Германия

Страна происхождения:
 xxx

Уполномоченный представитель в РФ:
 ООО «Дентсплай Сирона»,
 115035, г. Москва,
 наб. Овчинниковская, д.18/1,
 стр. 2, помещ. 3Н
 Тел. +7 (495) 725-10-87


 ifu.dentsplysirona.com



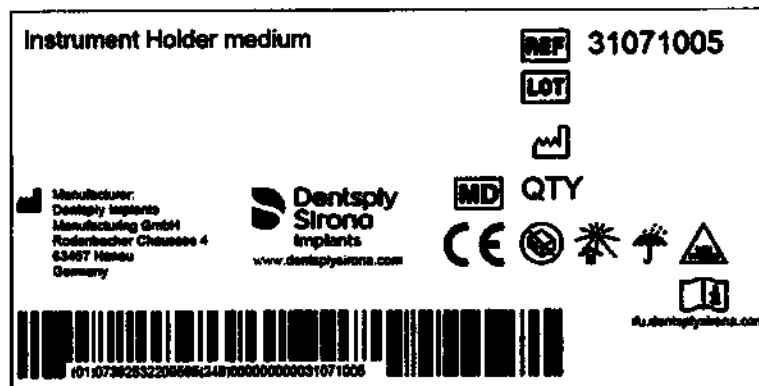

Держатель для стрежня средний (5 шт.) Instrument Holder medium (5 pcs.)

Instrument Holder medium (5 pcs.)

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 31071005

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:


ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
xxx



ifu.dentsplysirona.com



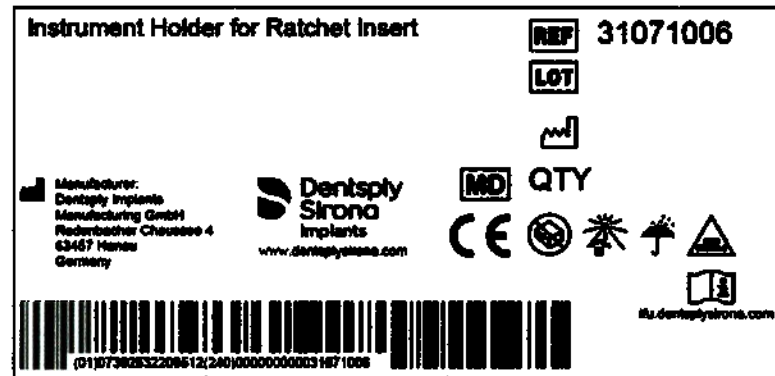

Держатель для для вставки в трещетку (5 шт.) (Instrument Holder for Ratchet Insert (5 pcs.))

Instrument Holder for Ratchet Insert

РУ № РЗН 2020/12836

от XX.XX.XXXX

REF 31071006

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

**Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
 Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
 Германия**


**Уполномоченный представитель в РФ:
 ООО «Дентсплай Сирона»,
 115035, г. Москва,
 наб. Овчинниковская, д.18/1,
 стр. 2, помещ. 3Н
 Тел. +7 (495) 725-10-87**

**Страна происхождения:
 xxx**



ifu.dentsplysirona.com



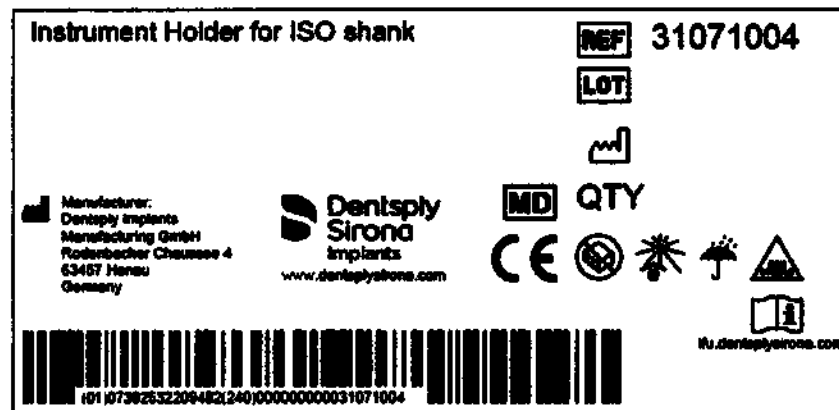

Держатель для стержня стандарта ISO (5 шт.) (Instrument Holder for ISO shank (5 pcs.))

Instrument Holder for ISO shank

РУ № РЗН 2020/12836

от xx.xx.xxxx

REF 31071004

 см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия


Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115035, г. Москва,
наб. Овчинниковская, д.18/1,
стр. 2, помещ. 3Н
Тел. +7 (495) 725-10-87




ifu.dentsplysirona.com

Страна происхождения:
xxx


Все лотки упакованы в коробку, пример ниже.

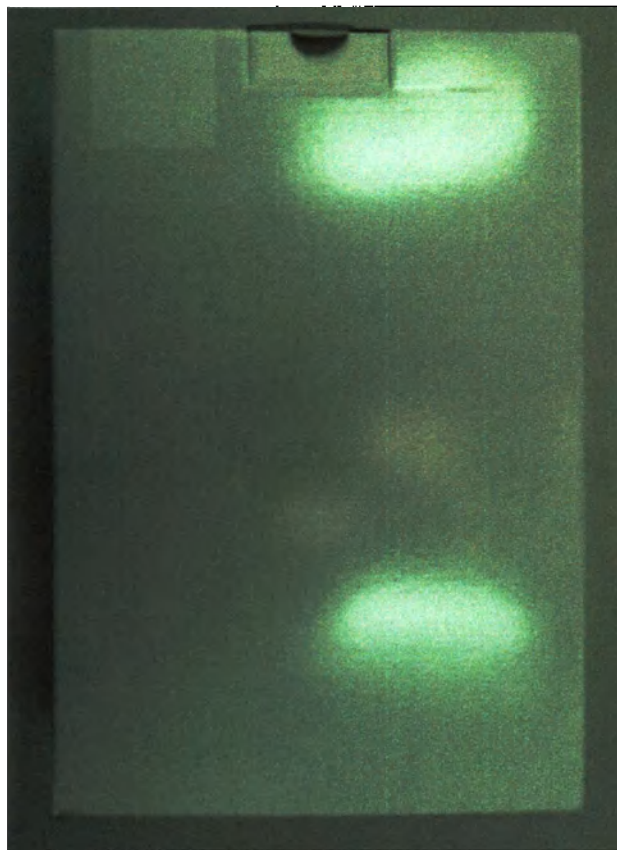

Все накладки упакованы в полиэтиленовый пакет, пример ниже.

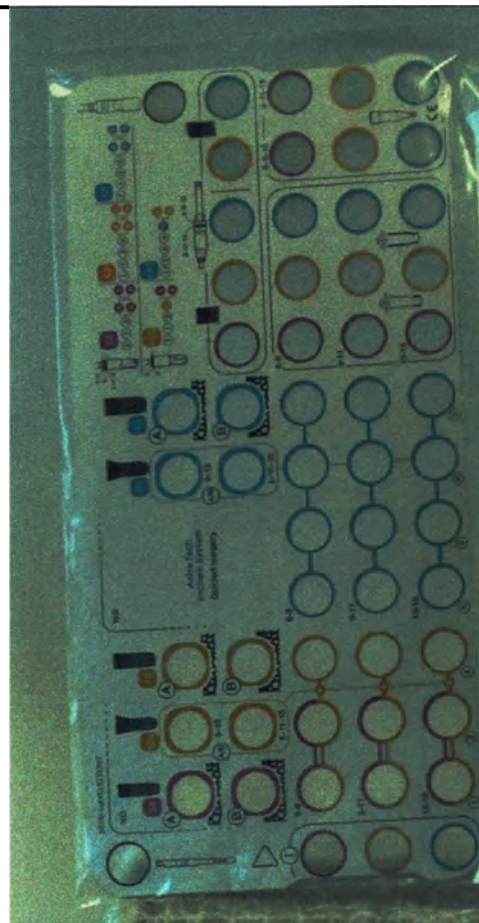

Все держатели для стержня упакованы в полиэтиленовый пакет, пример ниже.

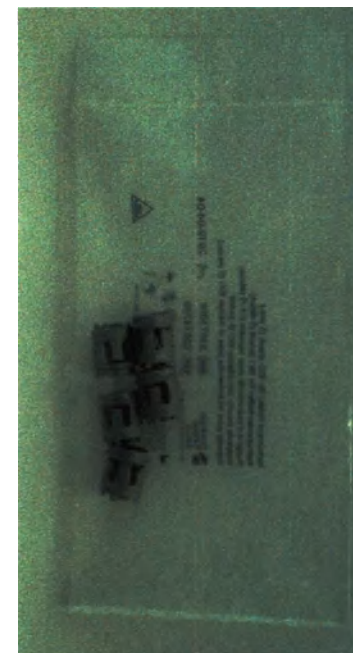



Сшито и скреплено печатью «65» лист

Директор по регистрации Россия и СНГ
ООО «Дентсплай Сирона»
Хаиндрава В.Г.

Дата: 26 12 2023

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023