

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«19» октября 2023 г.

## **МАКЕТ МАРКИРОВКИ**

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения  
прокальцитонина (ПКТ, PCT) в сыворотке и плазме крови человека методом  
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе  
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для  
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022»**


**2023**

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, РСТ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15  
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур ПКТ

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



|     |          |            |     |        |
|-----|----------|------------|-----|--------|
| LOT | 20230701 | 01.07.2024 | REF | C86039 |
|-----|----------|------------|-----|--------|

### Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, РСТ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15  
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур ПКТ

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



|     |          |            |     |        |
|-----|----------|------------|-----|--------|
| LOT | 20230701 | 01.07.2024 | REF | C86039 |
|-----|----------|------------|-----|--------|

### Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, PCT) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур ПКТ

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO

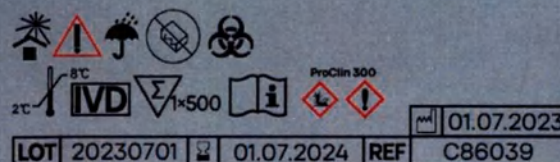

### Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, PCT) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур ПКТ

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



### Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

**Лидлаб Амур**  
**ПКТ**

3,5мл 4,0мл  
R 1 R 2

LOT 20230701 01.07.2024

IVD

2°C 37°C 1х50

47101 1017 1306

лидкор

**Лидлаб Амур**  
**ПКТ**

Пароизоляционные  
крышки – 4 шт.

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86039

IVD

лидкор

**Лидлаб Амур ПКТ**

1,0 мл

CAL 1

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86039

IVD

лидкор

**Лидлаб Амур ПКТ**

1,0 мл

CAL 2

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86039

IVD

лидкор

**Лидлаб Амур ПКТ**

1,0 мл

CAL 3


LOT 20230701 01.07.2024 REF C86039

IVD

**Лидлаб Амур ПКТ**

LOT 20230701 EXP 01.07.2024



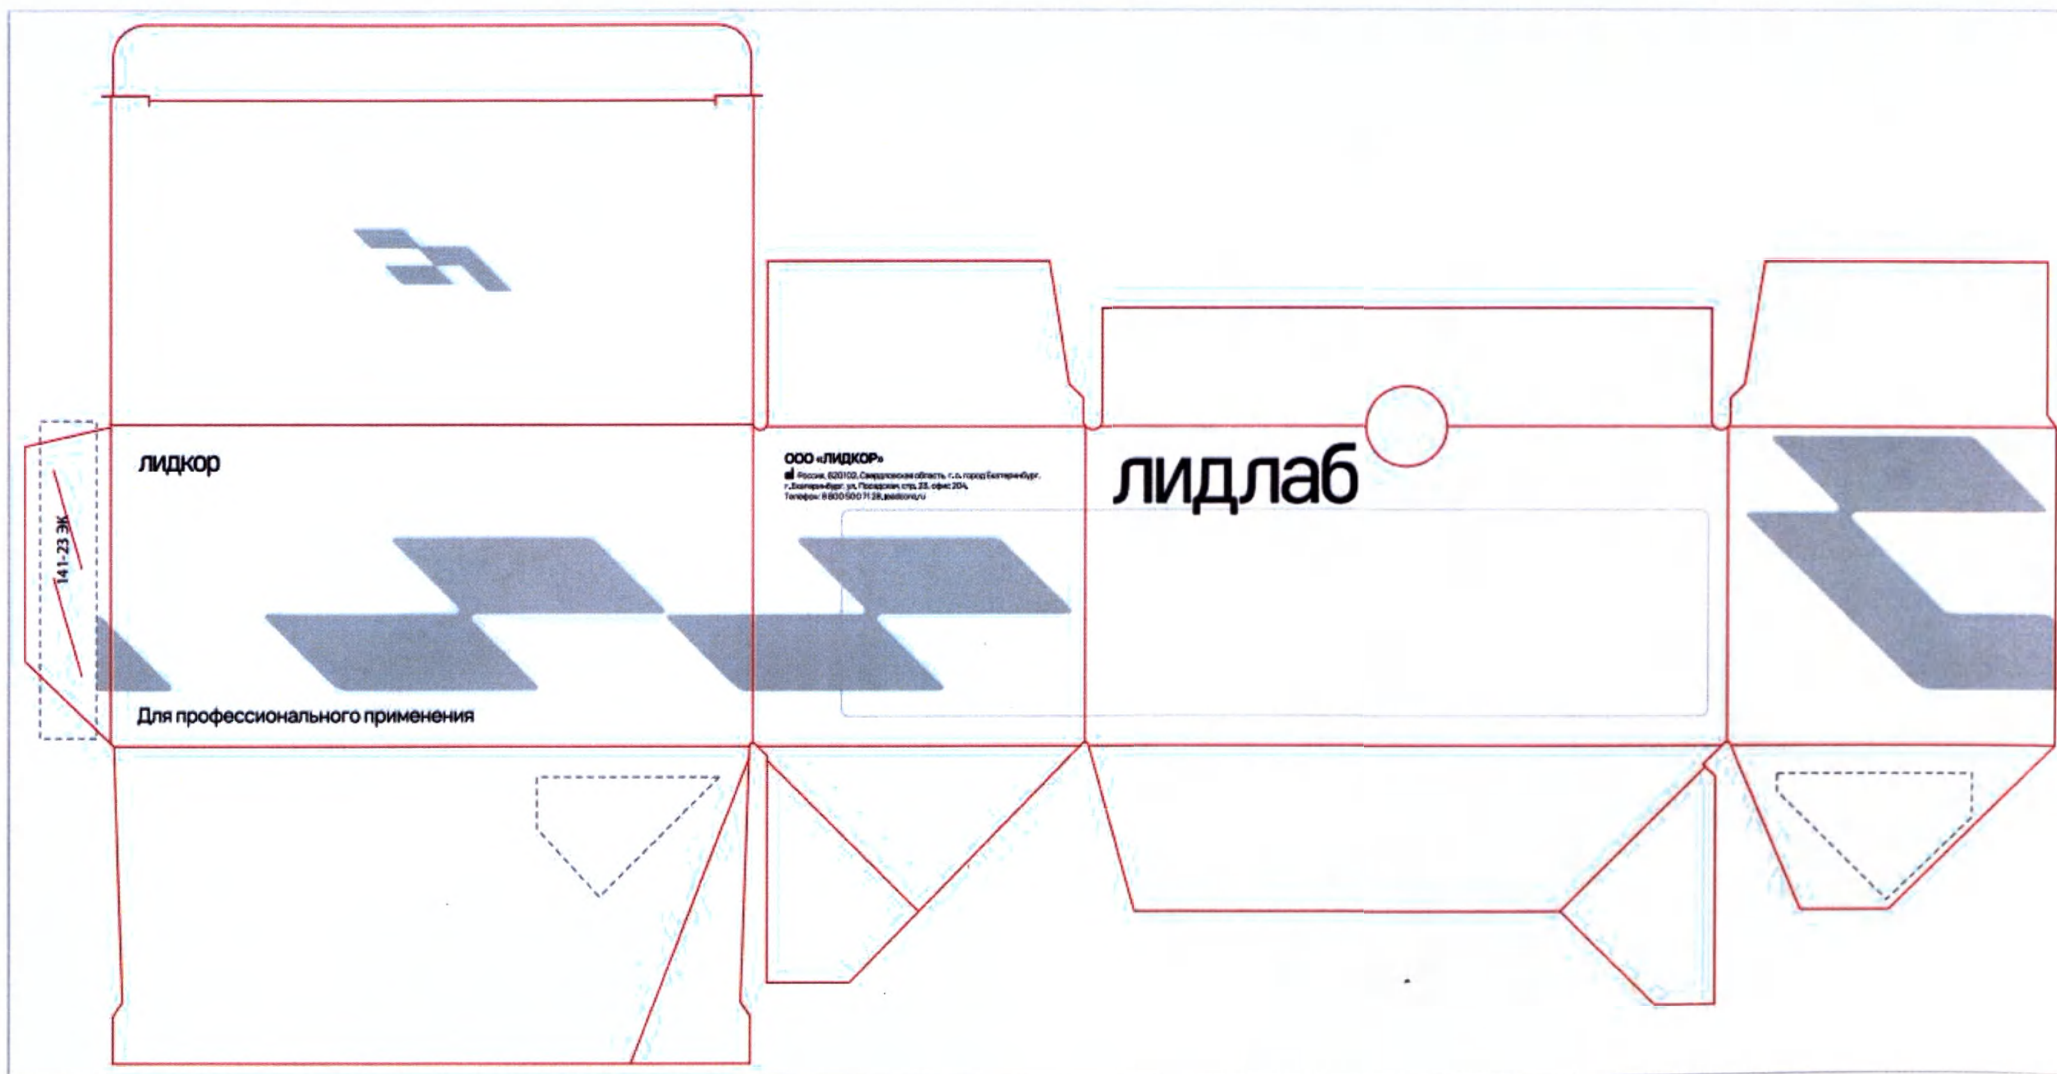




Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, РСТ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022



Для профессионального применения

|            |                                                                                                                                |  |            |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
|            | ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |  |            |            | 01.07.2023 |
| <b>LOT</b> | 20230701                                                                                                                       |  | 01.07.2024 | <b>REF</b> | C86039     |

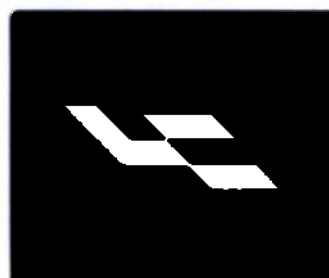

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, РСТ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022



Для профессионального применения

|            |                                                                                                                                |  |            |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
|            | ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |  |            |            | 01.07.2023 |
| <b>LOT</b> | 20230701                                                                                                                       |  | 01.07.2024 | <b>REF</b> | C86039     |



Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, PCT) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022



Для профессионального применения

|     |                                                                                                                                |  |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|     | ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |  | 01.07.2023 |
| LOT | 20230701                                                                                                                       |  | 01.07.2024 |
| REF | C86039                                                                                                                         |  |            |




Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокальцитонина (ПКТ, PCT) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022



Для профессионального применения

|     |                                                                                                                                |  |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|     | ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |  | 01.07.2023 |
| LOT | 20230701                                                                                                                       |  | 01.07.2024 |
| REF | C86039                                                                                                                         |  |            |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ООО «ЛИДКОР», Россия 620102,<br>Свердловская область, г.о. город<br>Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул.<br>Посадская, стр. 23, офис 204. |  XXX                                                                                             |
| Наименование изделия                                                                                                                                                                                                      |  ММ.ГТТГ                                                                                         |
|  XXXXXX                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|  XXXXXXXX                                                                                                                                |  Только для in vitro диагностики<br>Для профессионального применения                               |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                        | GHS07<br>  |

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

8 (восемь) л.

Директор  
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«19» октября 2023 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения  
прокальцитонина (ПКТ, РСТ) в сыворотке и плазме крови человека методом  
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе  
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для  
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022»**

2023

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

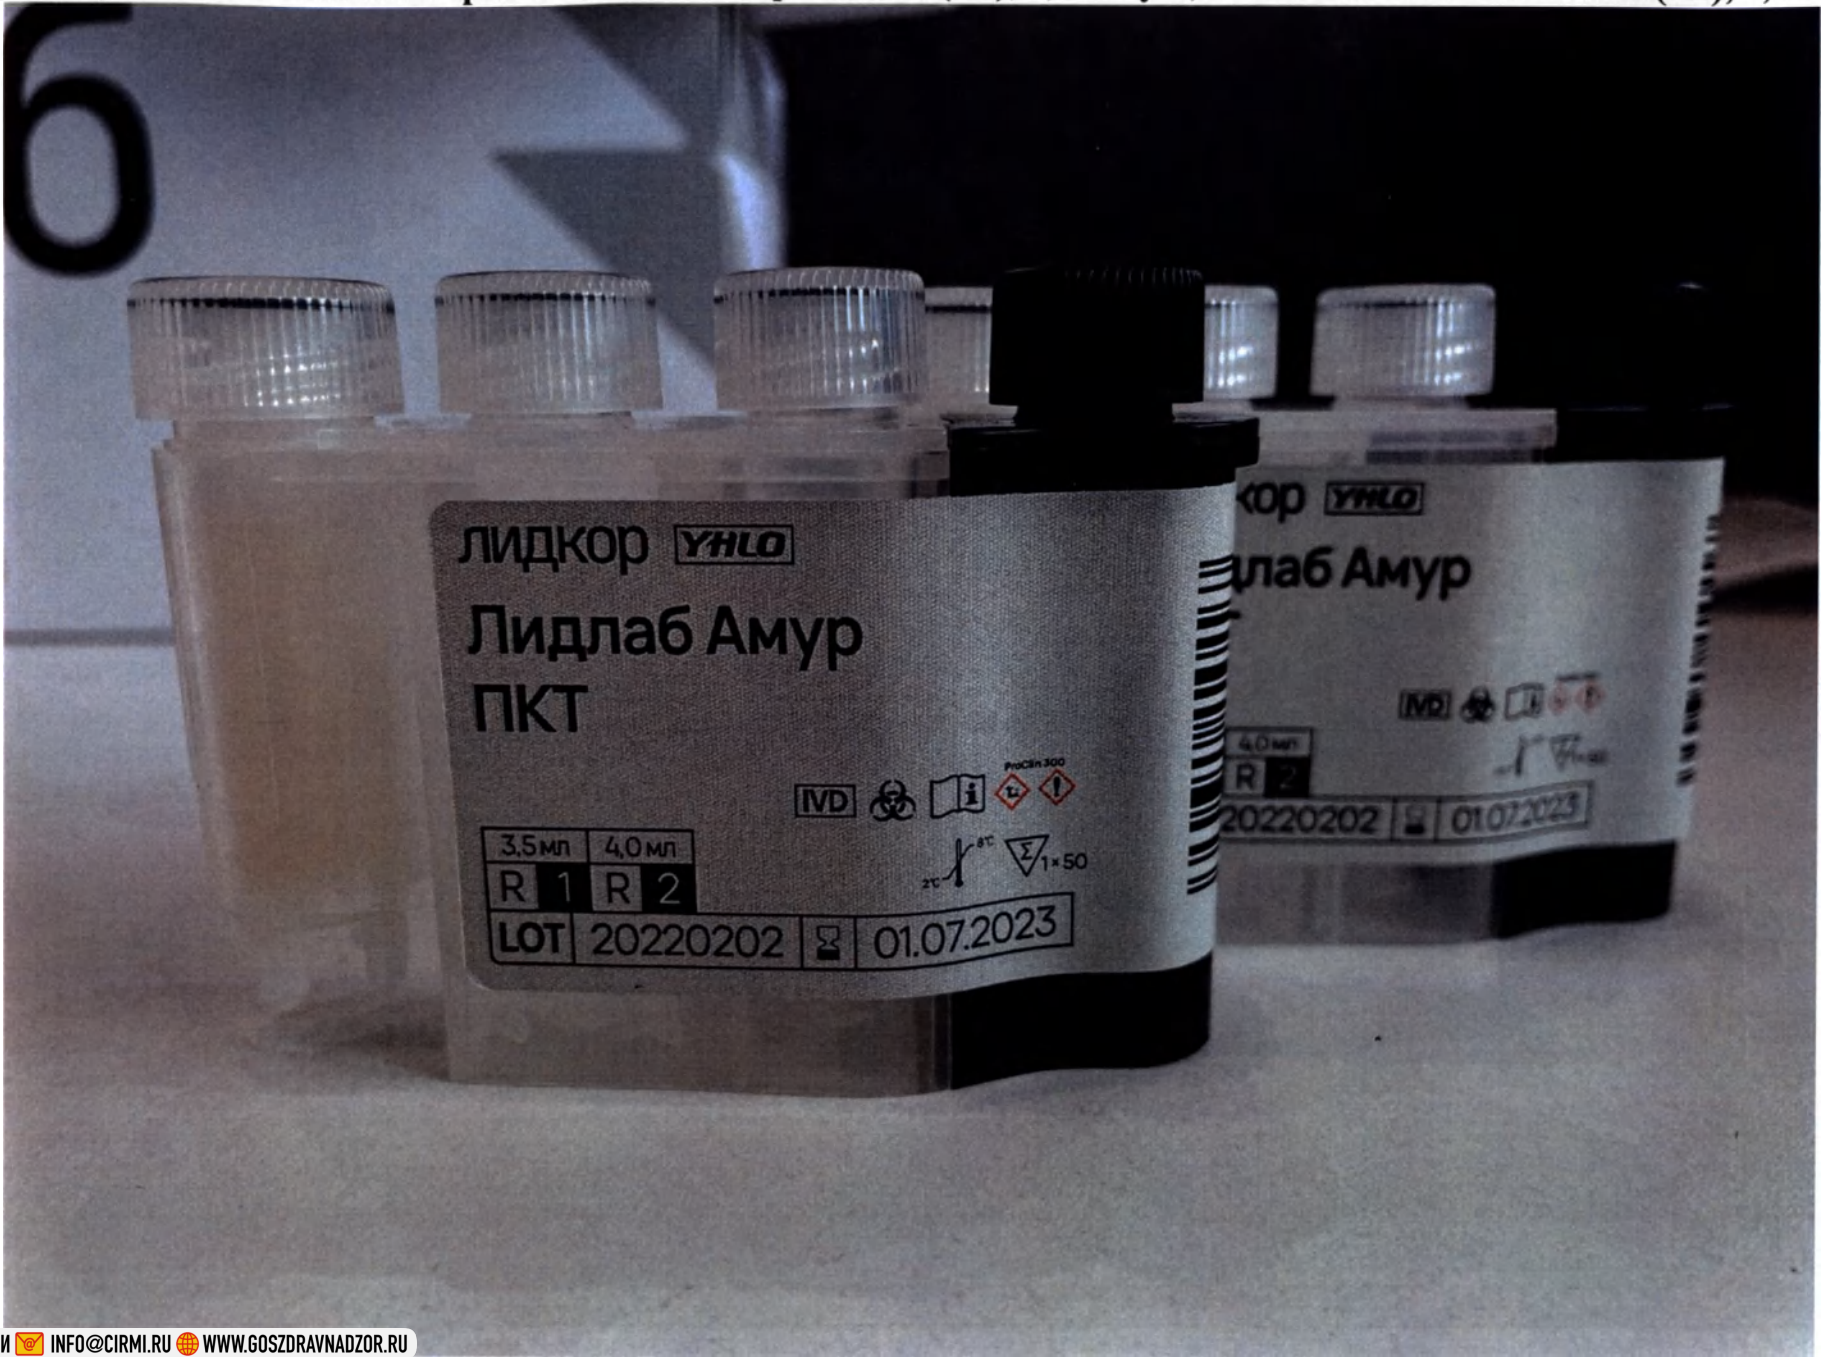

**Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон**




Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон




# Пароизоляционные крышки

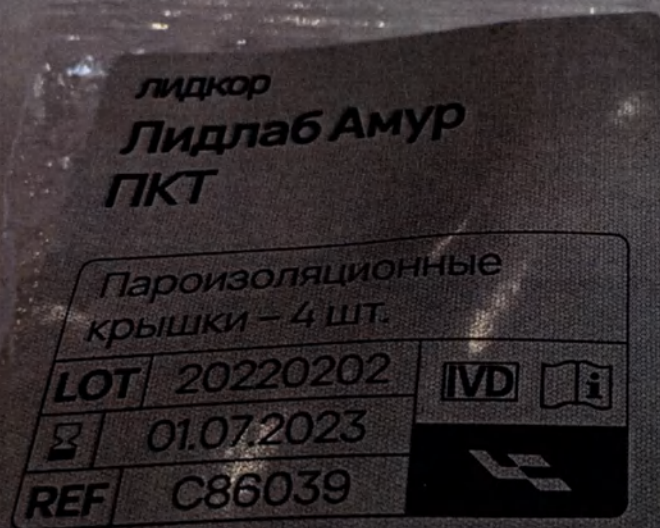

## Набор реагентов на 100 тестов



**Набор реагентов на 100 тестов (вид сзади)**

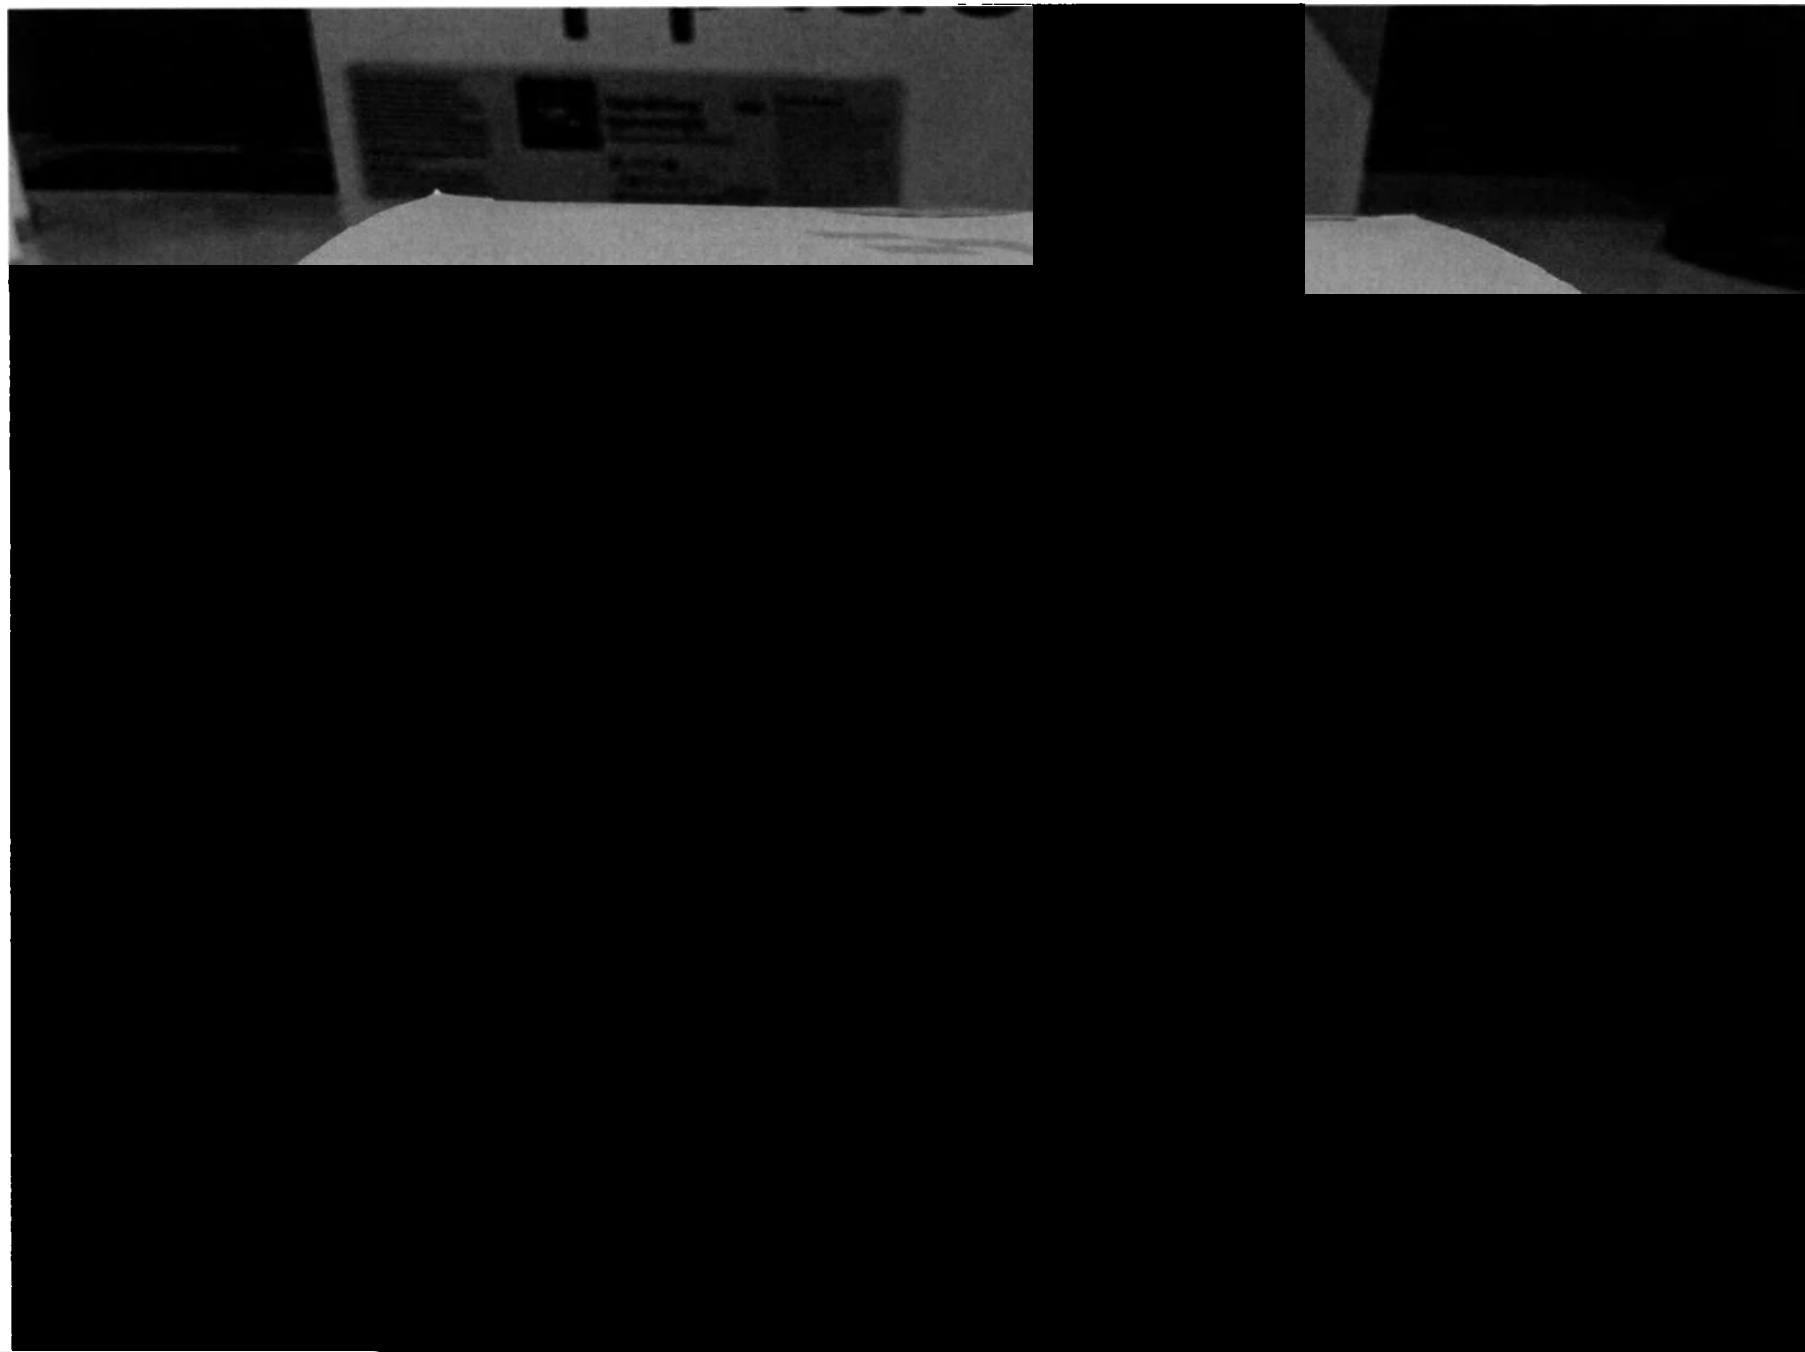



#### Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамгнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., реагент мочевой кислоты (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), (микроинформационный), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), (микроинформационный), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), (микроинформационный), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароксидирующий кристалл – 10 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Анализаторный паспорт – 1 шт.

YHLO


LOT 20220202 01.07.2023 REF 01.07.2022 C86039




**Набор реагентов на 200 тестов (вид сбоку)**




## Набор реагентов на 500 тестов

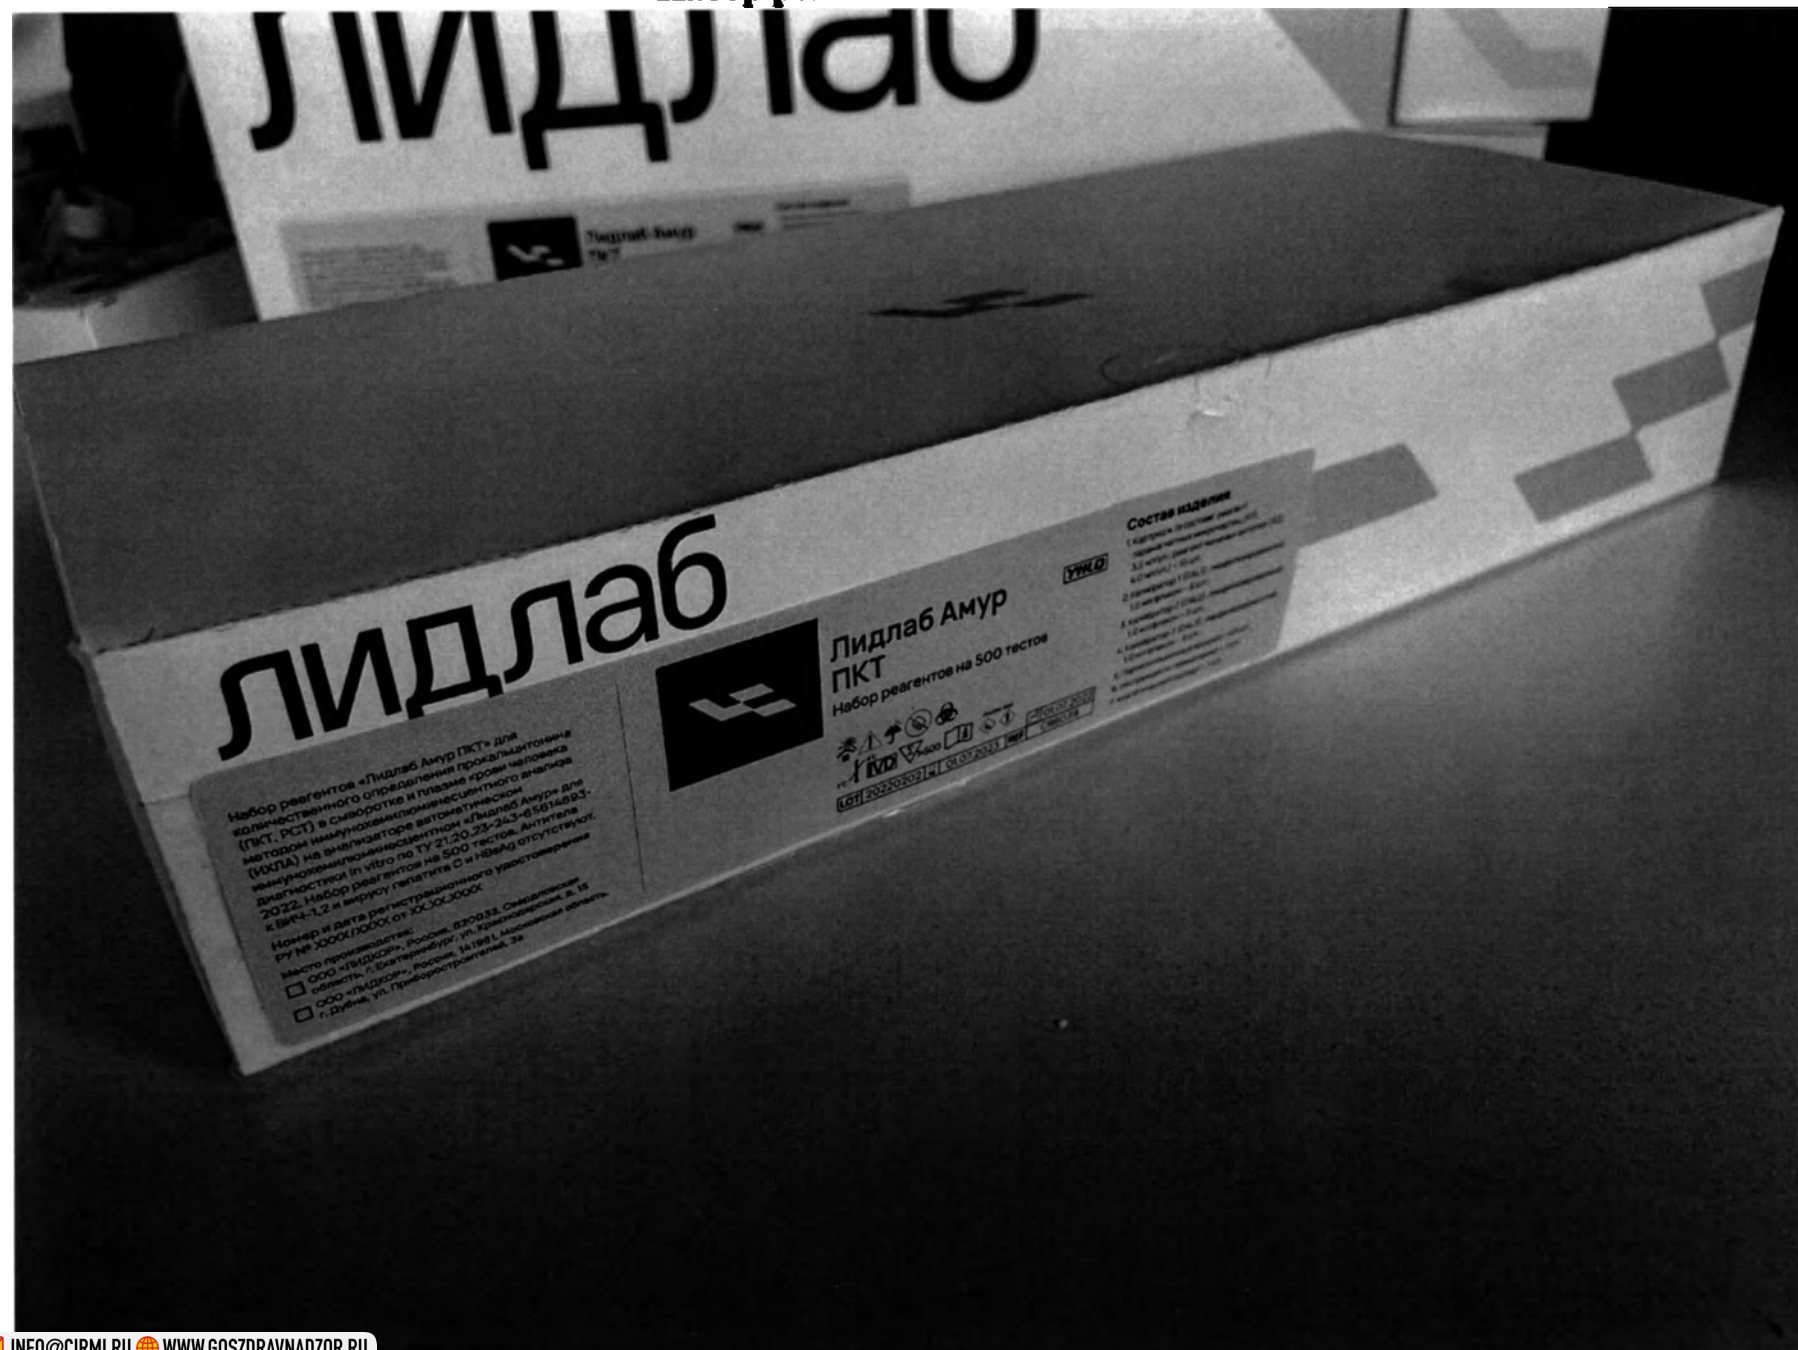

**Набор реагентов на 500 тестов (вид сзади)**

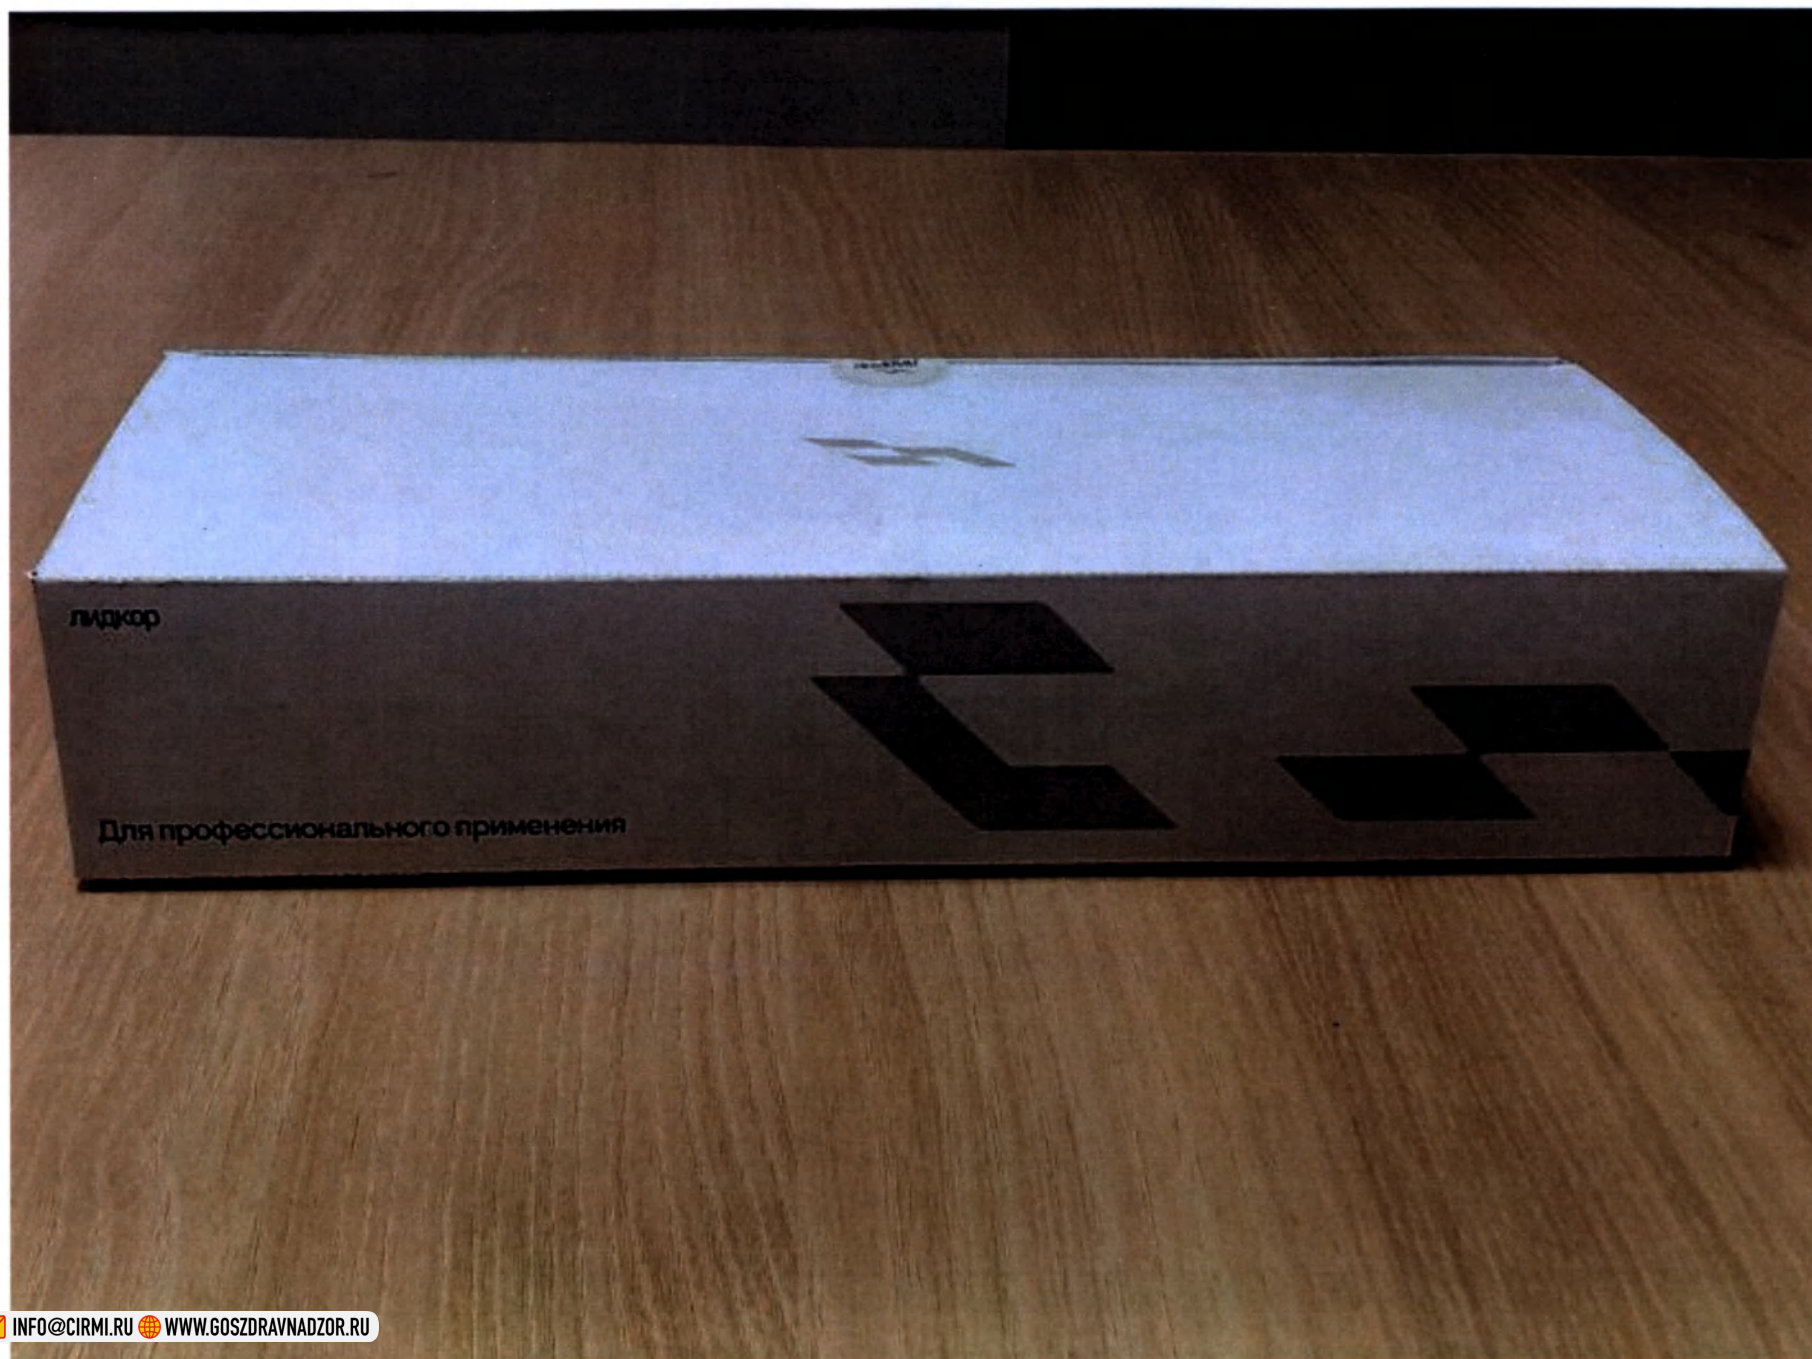

**Набор реагентов на 500 тестов (вид сбоку)**

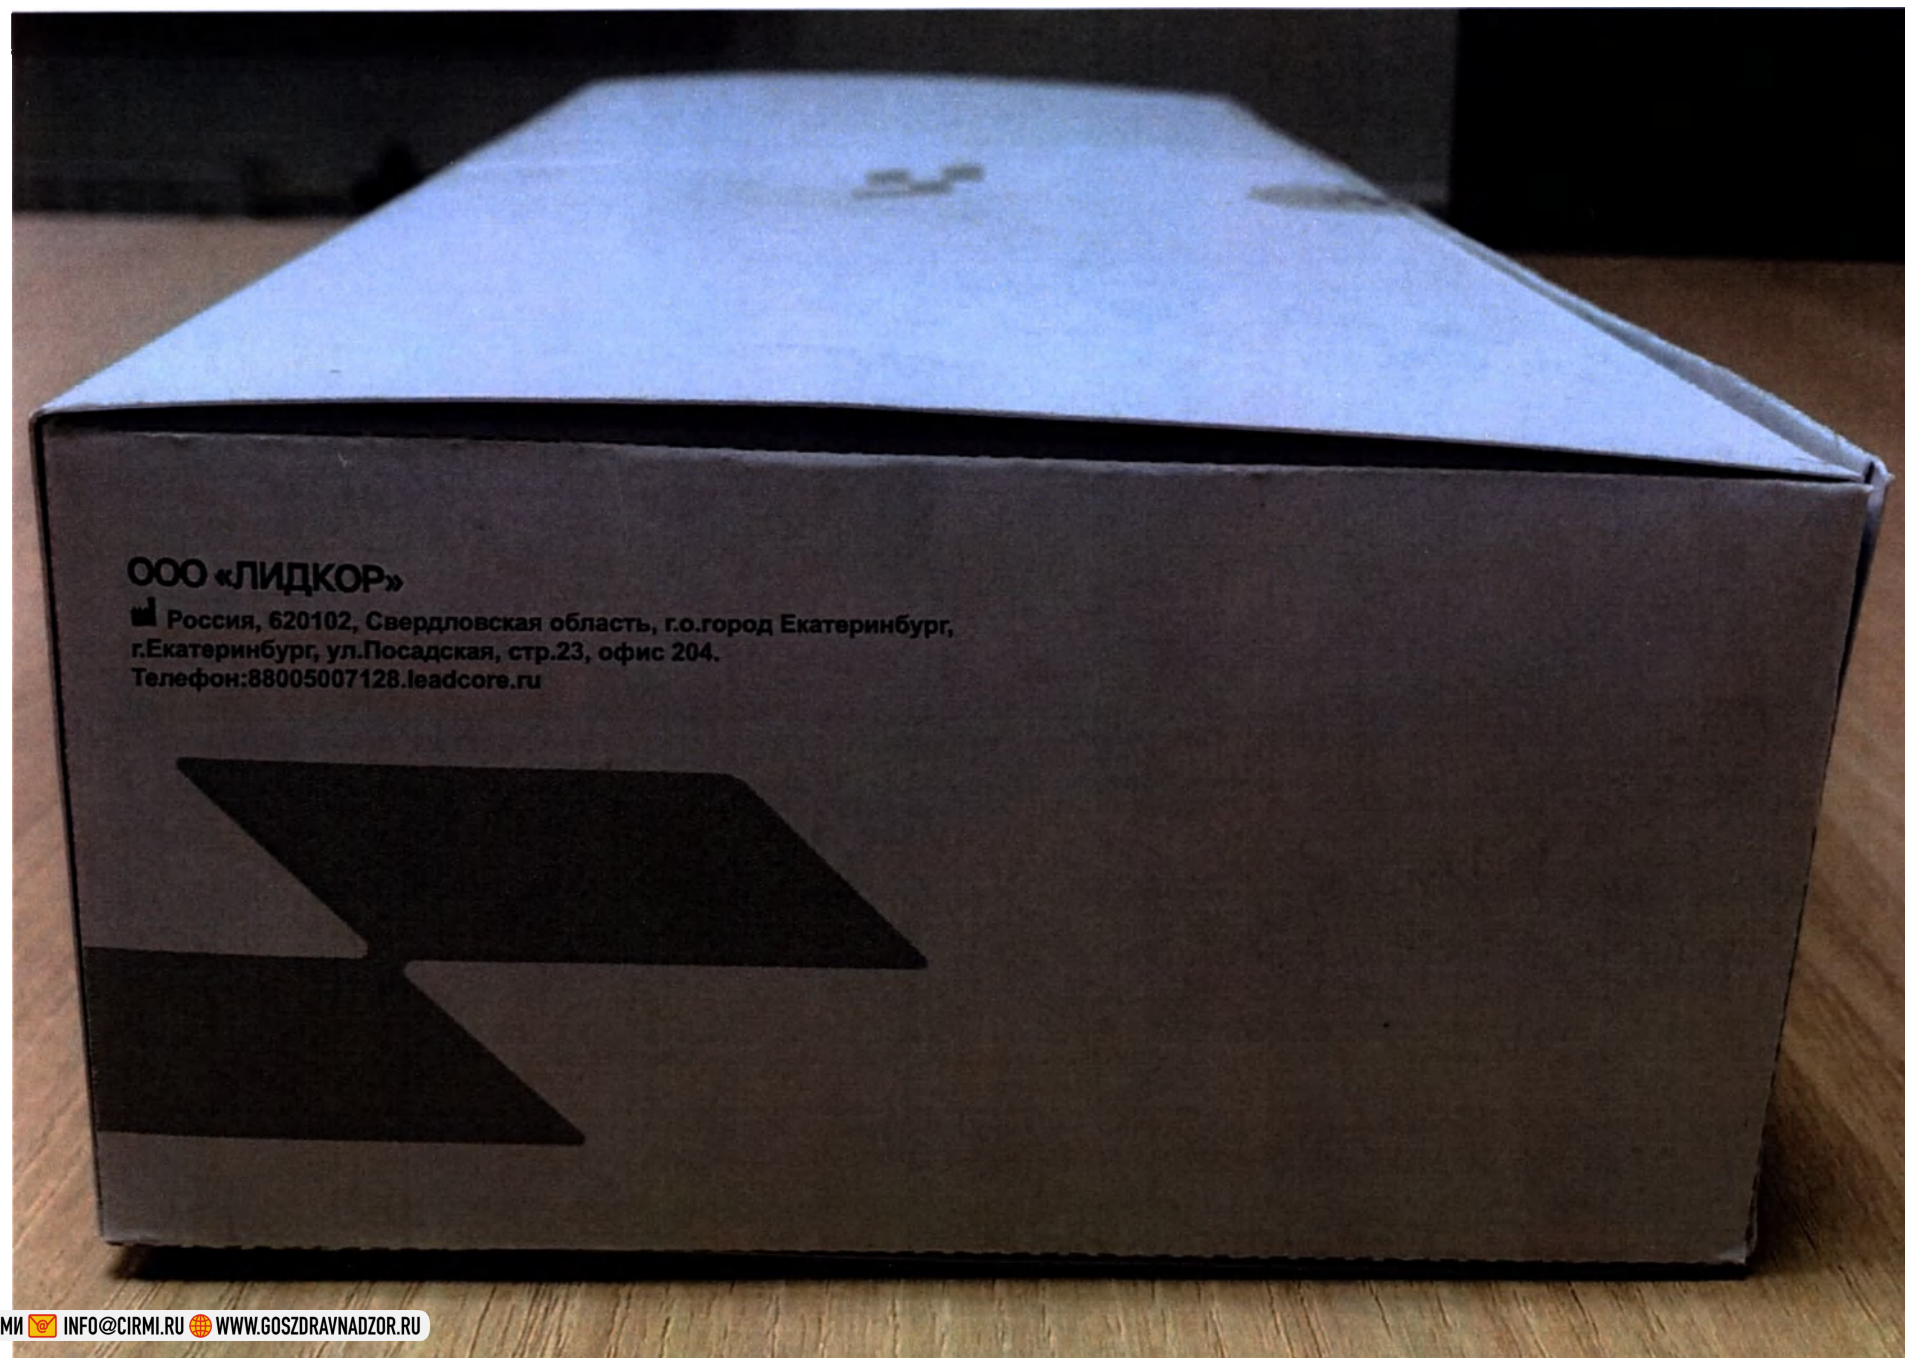

**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,  
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.  
Телефон:88005007128.leadcore.ru



## Набор реагентов на 1000 тестов

# ЛИДЛАБ


Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для количественного определения прокариотического (ПКТ, РСТ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохимическим «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТП 21.20.23-243-65814893-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
RU № 1000/1000 от 30.09.2022

Место производства:  
☐ ООО «Цирми», Россия, 620033, Омская область, г. Беговый, ул. Промышленная, 5, 18  
☐ ООО «Лидлаб», Россия, 441000, Московская область, г. Видное, ул. Гайдара, 39



**Лидлаб Амур**  
**ПКТ**  
Набор реагентов на 1000 тестов



### Состав изделия

- 1. Набор реагентов для количественного определения ПКТ, РСТ в сыворотке и плазме крови человека (1000 тестов)
- 2. Реагент 1 (200 мл)
- 3. Реагент 2 (200 мл)
- 4. Реагент 3 (200 мл)
- 5. Реагент 4 (200 мл)
- 6. Реагент 5 (200 мл)
- 7. Реагент 6 (200 мл)
- 8. Реагент 7 (200 мл)
- 9. Реагент 8 (200 мл)
- 10. Реагент 9 (200 мл)
- 11. Реагент 10 (200 мл)
- 12. Реагент 11 (200 мл)
- 13. Реагент 12 (200 мл)
- 14. Реагент 13 (200 мл)
- 15. Реагент 14 (200 мл)
- 16. Реагент 15 (200 мл)
- 17. Реагент 16 (200 мл)
- 18. Реагент 17 (200 мл)
- 19. Реагент 18 (200 мл)
- 20. Реагент 19 (200 мл)
- 21. Реагент 20 (200 мл)
- 22. Реагент 21 (200 мл)
- 23. Реагент 22 (200 мл)
- 24. Реагент 23 (200 мл)
- 25. Реагент 24 (200 мл)
- 26. Реагент 25 (200 мл)
- 27. Реагент 26 (200 мл)
- 28. Реагент 27 (200 мл)
- 29. Реагент 28 (200 мл)
- 30. Реагент 29 (200 мл)
- 31. Реагент 30 (200 мл)
- 32. Реагент 31 (200 мл)
- 33. Реагент 32 (200 мл)
- 34. Реагент 33 (200 мл)
- 35. Реагент 34 (200 мл)
- 36. Реагент 35 (200 мл)
- 37. Реагент 36 (200 мл)
- 38. Реагент 37 (200 мл)
- 39. Реагент 38 (200 мл)
- 40. Реагент 39 (200 мл)
- 41. Реагент 40 (200 мл)
- 42. Реагент 41 (200 мл)
- 43. Реагент 42 (200 мл)
- 44. Реагент 43 (200 мл)
- 45. Реагент 44 (200 мл)
- 46. Реагент 45 (200 мл)
- 47. Реагент 46 (200 мл)
- 48. Реагент 47 (200 мл)
- 49. Реагент 48 (200 мл)
- 50. Реагент 49 (200 мл)
- 51. Реагент 50 (200 мл)
- 52. Реагент 51 (200 мл)
- 53. Реагент 52 (200 мл)
- 54. Реагент 53 (200 мл)
- 55. Реагент 54 (200 мл)
- 56. Реагент 55 (200 мл)
- 57. Реагент 56 (200 мл)
- 58. Реагент 57 (200 мл)
- 59. Реагент 58 (200 мл)
- 60. Реагент 59 (200 мл)
- 61. Реагент 60 (200 мл)
- 62. Реагент 61 (200 мл)
- 63. Реагент 62 (200 мл)
- 64. Реагент 63 (200 мл)
- 65. Реагент 64 (200 мл)
- 66. Реагент 65 (200 мл)
- 67. Реагент 66 (200 мл)
- 68. Реагент 67 (200 мл)
- 69. Реагент 68 (200 мл)
- 70. Реагент 69 (200 мл)
- 71. Реагент 70 (200 мл)
- 72. Реагент 71 (200 мл)
- 73. Реагент 72 (200 мл)
- 74. Реагент 73 (200 мл)
- 75. Реагент 74 (200 мл)
- 76. Реагент 75 (200 мл)
- 77. Реагент 76 (200 мл)
- 78. Реагент 77 (200 мл)
- 79. Реагент 78 (200 мл)
- 80. Реагент 79 (200 мл)
- 81. Реагент 80 (200 мл)
- 82. Реагент 81 (200 мл)
- 83. Реагент 82 (200 мл)
- 84. Реагент 83 (200 мл)
- 85. Реагент 84 (200 мл)
- 86. Реагент 85 (200 мл)
- 87. Реагент 86 (200 мл)
- 88. Реагент 87 (200 мл)
- 89. Реагент 88 (200 мл)
- 90. Реагент 89 (200 мл)
- 91. Реагент 90 (200 мл)
- 92. Реагент 91 (200 мл)
- 93. Реагент 92 (200 мл)
- 94. Реагент 93 (200 мл)
- 95. Реагент 94 (200 мл)
- 96. Реагент 95 (200 мл)
- 97. Реагент 96 (200 мл)
- 98. Реагент 97 (200 мл)
- 99. Реагент 98 (200 мл)
- 100. Реагент 99 (200 мл)
- 101. Реагент 100 (200 мл)
- 102. Реагент 101 (200 мл)
- 103. Реагент 102 (200 мл)
- 104. Реагент 103 (200 мл)
- 105. Реагент 104 (200 мл)
- 106. Реагент 105 (200 мл)
- 107. Реагент 106 (200 мл)
- 108. Реагент 107 (200 мл)
- 109. Реагент 108 (200 мл)
- 110. Реагент 109 (200 мл)
- 111. Реагент 110 (200 мл)
- 112. Реагент 111 (200 мл)
- 113. Реагент 112 (200 мл)
- 114. Реагент 113 (200 мл)
- 115. Реагент 114 (200 мл)
- 116. Реагент 115 (200 мл)
- 117. Реагент 116 (200 мл)
- 118. Реагент 117 (200 мл)
- 119. Реагент 118 (200 мл)
- 120. Реагент 119 (200 мл)
- 121. Реагент 120 (200 мл)
- 122. Реагент 121 (200 мл)
- 123. Реагент 122 (200 мл)
- 124. Реагент 123 (200 мл)
- 125. Реагент 124 (200 мл)
- 126. Реагент 125 (200 мл)
- 127. Реагент 126 (200 мл)
- 128. Реагент 127 (200 мл)
- 129. Реагент 128 (200 мл)
- 130. Реагент 129 (200 мл)
- 131. Реагент 130 (200 мл)
- 132. Реагент 131 (200 мл)
- 133. Реагент 132 (200 мл)
- 134. Реагент 133 (200 мл)
- 135. Реагент 134 (200 мл)
- 136. Реагент 135 (200 мл)
- 137. Реагент 136 (200 мл)
- 138. Реагент 137 (200 мл)
- 139. Реагент 138 (200 мл)
- 140. Реагент 139 (200 мл)
- 141. Реагент 140 (200 мл)
- 142. Реагент 141 (200 мл)
- 143. Реагент 142 (200 мл)
- 144. Реагент 143 (200 мл)
- 145. Реагент 144 (200 мл)
- 146. Реагент 145 (200 мл)
- 147. Реагент 146 (200 мл)
- 148. Реагент 147 (200 мл)
- 149. Реагент 148 (200 мл)
- 150. Реагент 149 (200 мл)
- 151. Реагент 150 (200 мл)
- 152. Реагент 151 (200 мл)
- 153. Реагент 152 (200 мл)
- 154. Реагент 153 (200 мл)
- 155. Реагент 154 (200 мл)
- 156. Реагент 155 (200 мл)
- 157. Реагент 156 (200 мл)
- 158. Реагент 157 (200 мл)
- 159. Реагент 158 (200 мл)
- 160. Реагент 159 (200 мл)
- 161. Реагент 160 (200 мл)
- 162. Реагент 161 (200 мл)
- 163. Реагент 162 (200 мл)
- 164. Реагент 163 (200 мл)
- 165. Реагент 164 (200 мл)
- 166. Реагент 165 (200 мл)
- 167. Реагент 166 (200 мл)
- 168. Реагент 167 (200 мл)
- 169. Реагент 168 (200 мл)
- 170. Реагент 169 (200 мл)
- 171. Реагент 170 (200 мл)
- 172. Реагент 171 (200 мл)
- 173. Реагент 172 (200 мл)
- 174. Реагент 173 (200 мл)
- 175. Реагент 174 (200 мл)
- 176. Реагент 175 (200 мл)
- 177. Реагент 176 (200 мл)
- 178. Реагент 177 (200 мл)
- 179. Реагент 178 (200 мл)
- 180. Реагент 179 (200 мл)
- 181. Реагент 180 (200 мл)
- 182. Реагент 181 (200 мл)
- 183. Реагент 182 (200 мл)
- 184. Реагент 183 (200 мл)
- 185. Реагент 184 (200 мл)
- 186. Реагент 185 (200 мл)
- 187. Реагент 186 (200 мл)
- 188. Реагент 187 (200 мл)
- 189. Реагент 188 (200 мл)
- 190. Реагент 189 (200 мл)
- 191. Реагент 190 (200 мл)
- 192. Реагент 191 (200 мл)
- 193. Реагент 192 (200 мл)
- 194. Реагент 193 (200 мл)
- 195. Реагент 194 (200 мл)
- 196. Реагент 195 (200 мл)
- 197. Реагент 196 (200 мл)
- 198. Реагент 197 (200 мл)
- 199. Реагент 198 (200 мл)
- 200. Реагент 199 (200 мл)

Набор реагентов на 1000 (вид сзади)




**Набор реагентов на 1000 тестов (вид сбоку)**



**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,  
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.  
Телефон:88005007128.leadcore.ru

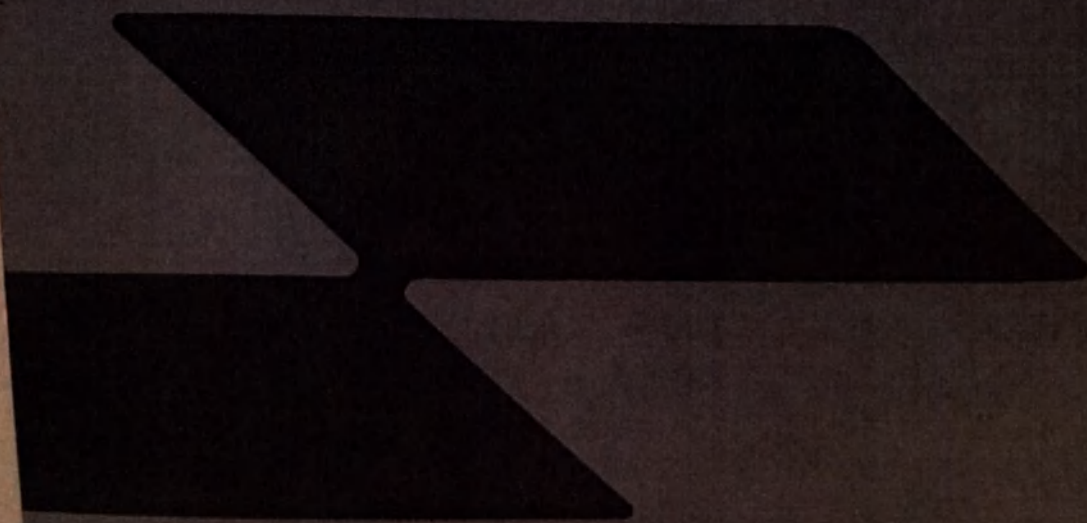

**Набор реагентов на 1000 тестов (вид сбоку)**



**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,  
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.  
Телефон:88005007128.leadcore.ru







Набор реагентов «Лидлаб Амур ПКТ» для  
количественного определения прокальци-  
тонина (ПКТ, PCT) в сыворотке и плазме  
крови человека методом иммунохемилюми-  
несцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе  
автоматическом иммунохемилюминесцентном  
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro  
по ТУ 21.20.23-243-65614693-2022



Для профессионального применения

|     |          |                                                                                                                                   |            |     |            |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
|     |          | ООО «ЛИДЛАБ», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город<br>Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |            |     | 01.07.2023 |
| LOT | 20230701 |                                                                                                                                   | 01.07.2024 | REF | C86039     |

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

19 ( девятнадцать ) л.



/Е. Ю. Гохгут/