

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«19» октября 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-259-65614693-2022»

2023


 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-259-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Краснуха IgG

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO

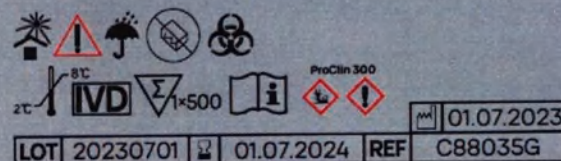

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент биотинилированных антигенов (R3), 3,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.) – 10 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-259-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Краснуха IgG

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO

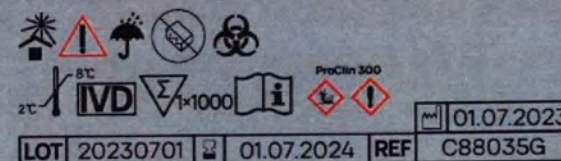

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент биотинилированных антигенов (R3), 3,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

**Лидлаб Амур
Краснуха IgG**

3,5мл 6,5мл 3,5мл 6,5мл

R 1 R 2 R 3 R 4

LOT 20230701 01.07.2024

IVD

РесКл 300

Barcode: 9031 1017

лидкор

**Лидлаб Амур
Краснуха IgG**

Пароизоляционные
крышки - 4 шт.

LOT 20230701

01.07.2024

REF C88035G

IVD

лидкор

Лидлаб Амур Краснуха IgG

1,0 мл

CAL 1

LOT 20230701

REF C88035G

IVD

РесКл 300

лидкор

Лидлаб Амур Краснуха IgG

Калибратор инактивирован

1,0 мл

CAL 2

LOT 20230701

REF C88035G

IVD

РесКл 300

лидкор

Лидлаб Амур Краснуха IgG

Калибратор инактивирован

1,0 мл

CAL 3

LOT 20230701

REF C88035G

IVD


РесКл 300

Лидлаб Амур Краснуха IgG

Barcode

LOT 20230701 EXP 01.07.2024



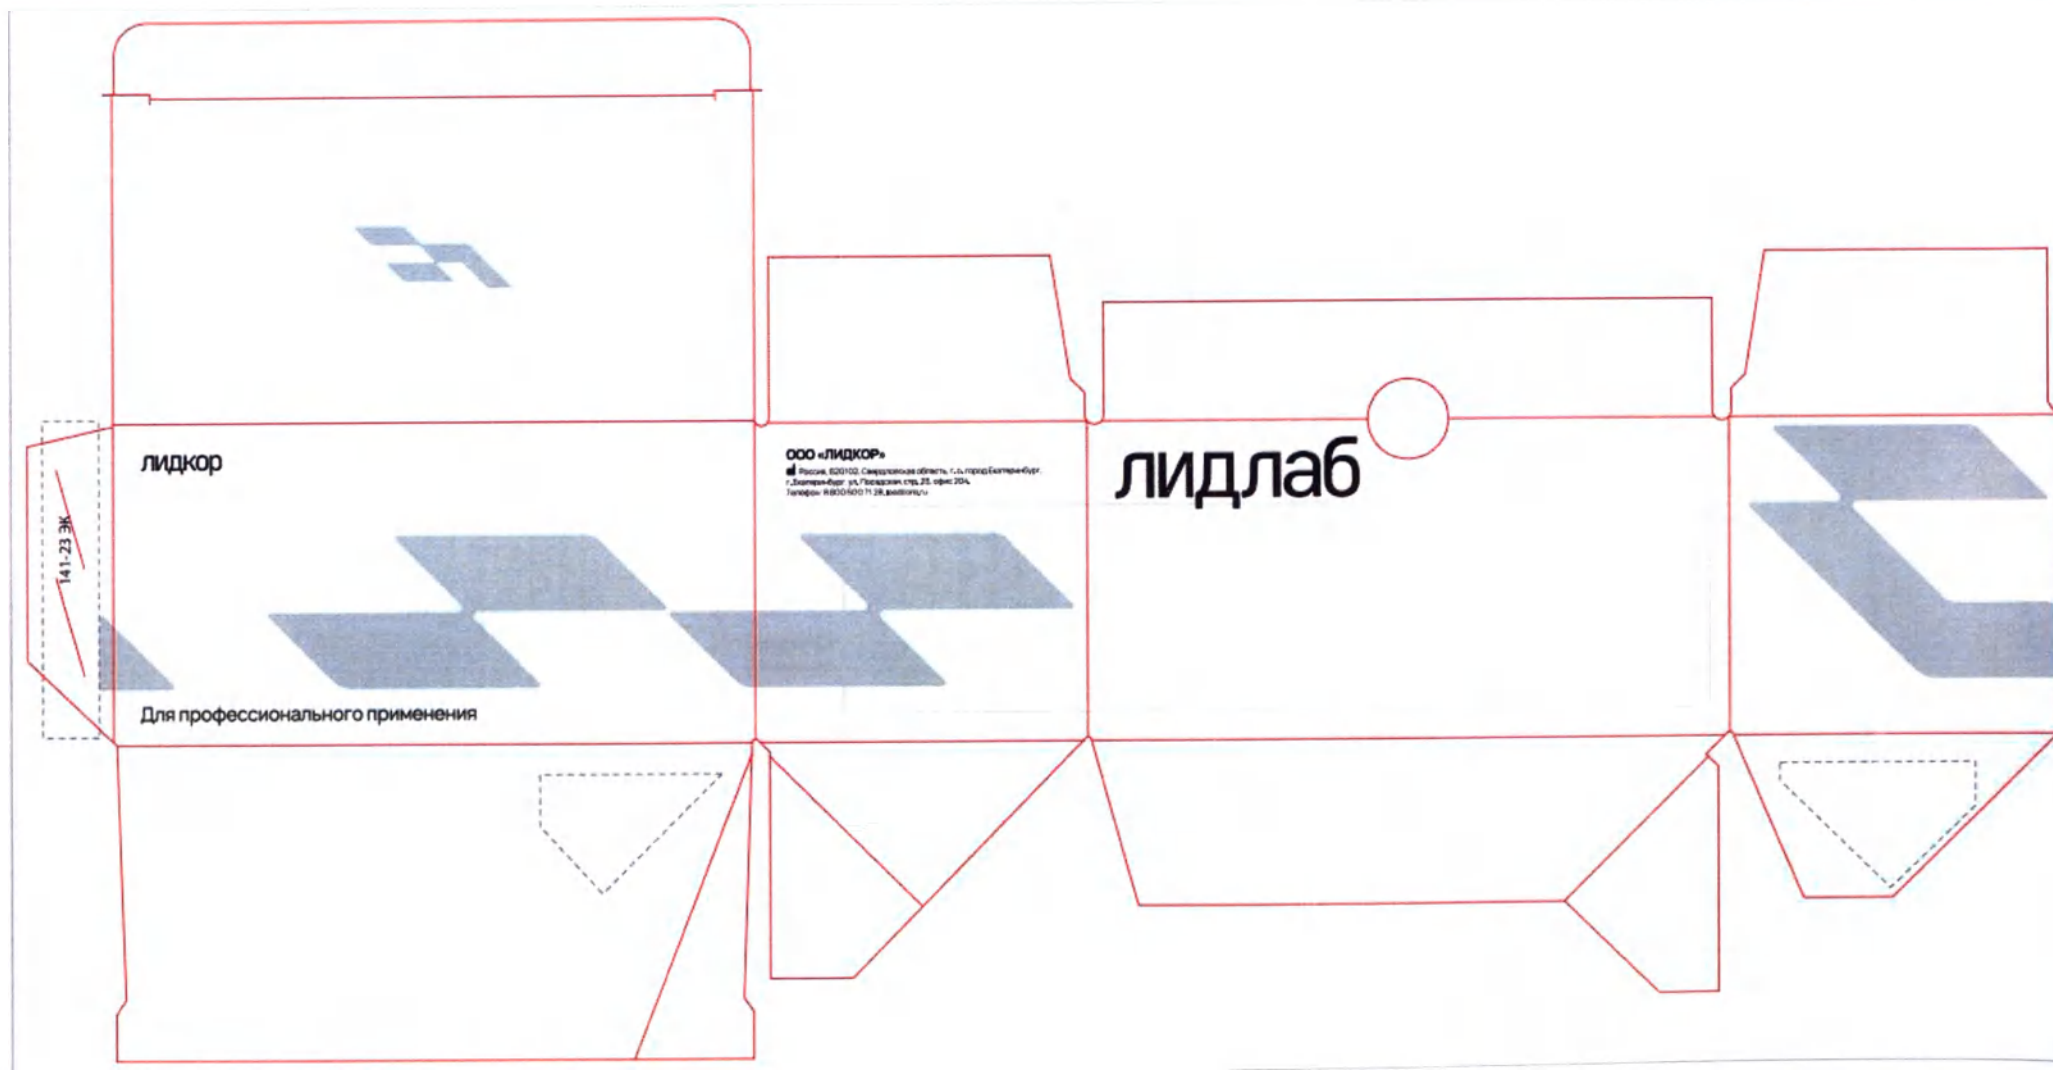

Макет транспортной маркировки



Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-259-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C88035G		



Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-259-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C88035G		



Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-259-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C88035G		



Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-259-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C88035G		

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.	 XXX
Наименование изделия	 MM.GGGГ
 XXXXXXX	
 XXXXXXXXX	 Только для in vitro диагностики Для профессионального применения
	
	
	
	GHS07  

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (666666) л.



/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«19» октября 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для количественного
определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу краснухи в
сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ
21.20.23-259-65614693-2022»**

2023


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп., Реагент биотинилированных антигенов (R3), 3,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R4), 6,5 мл/уп.)




Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

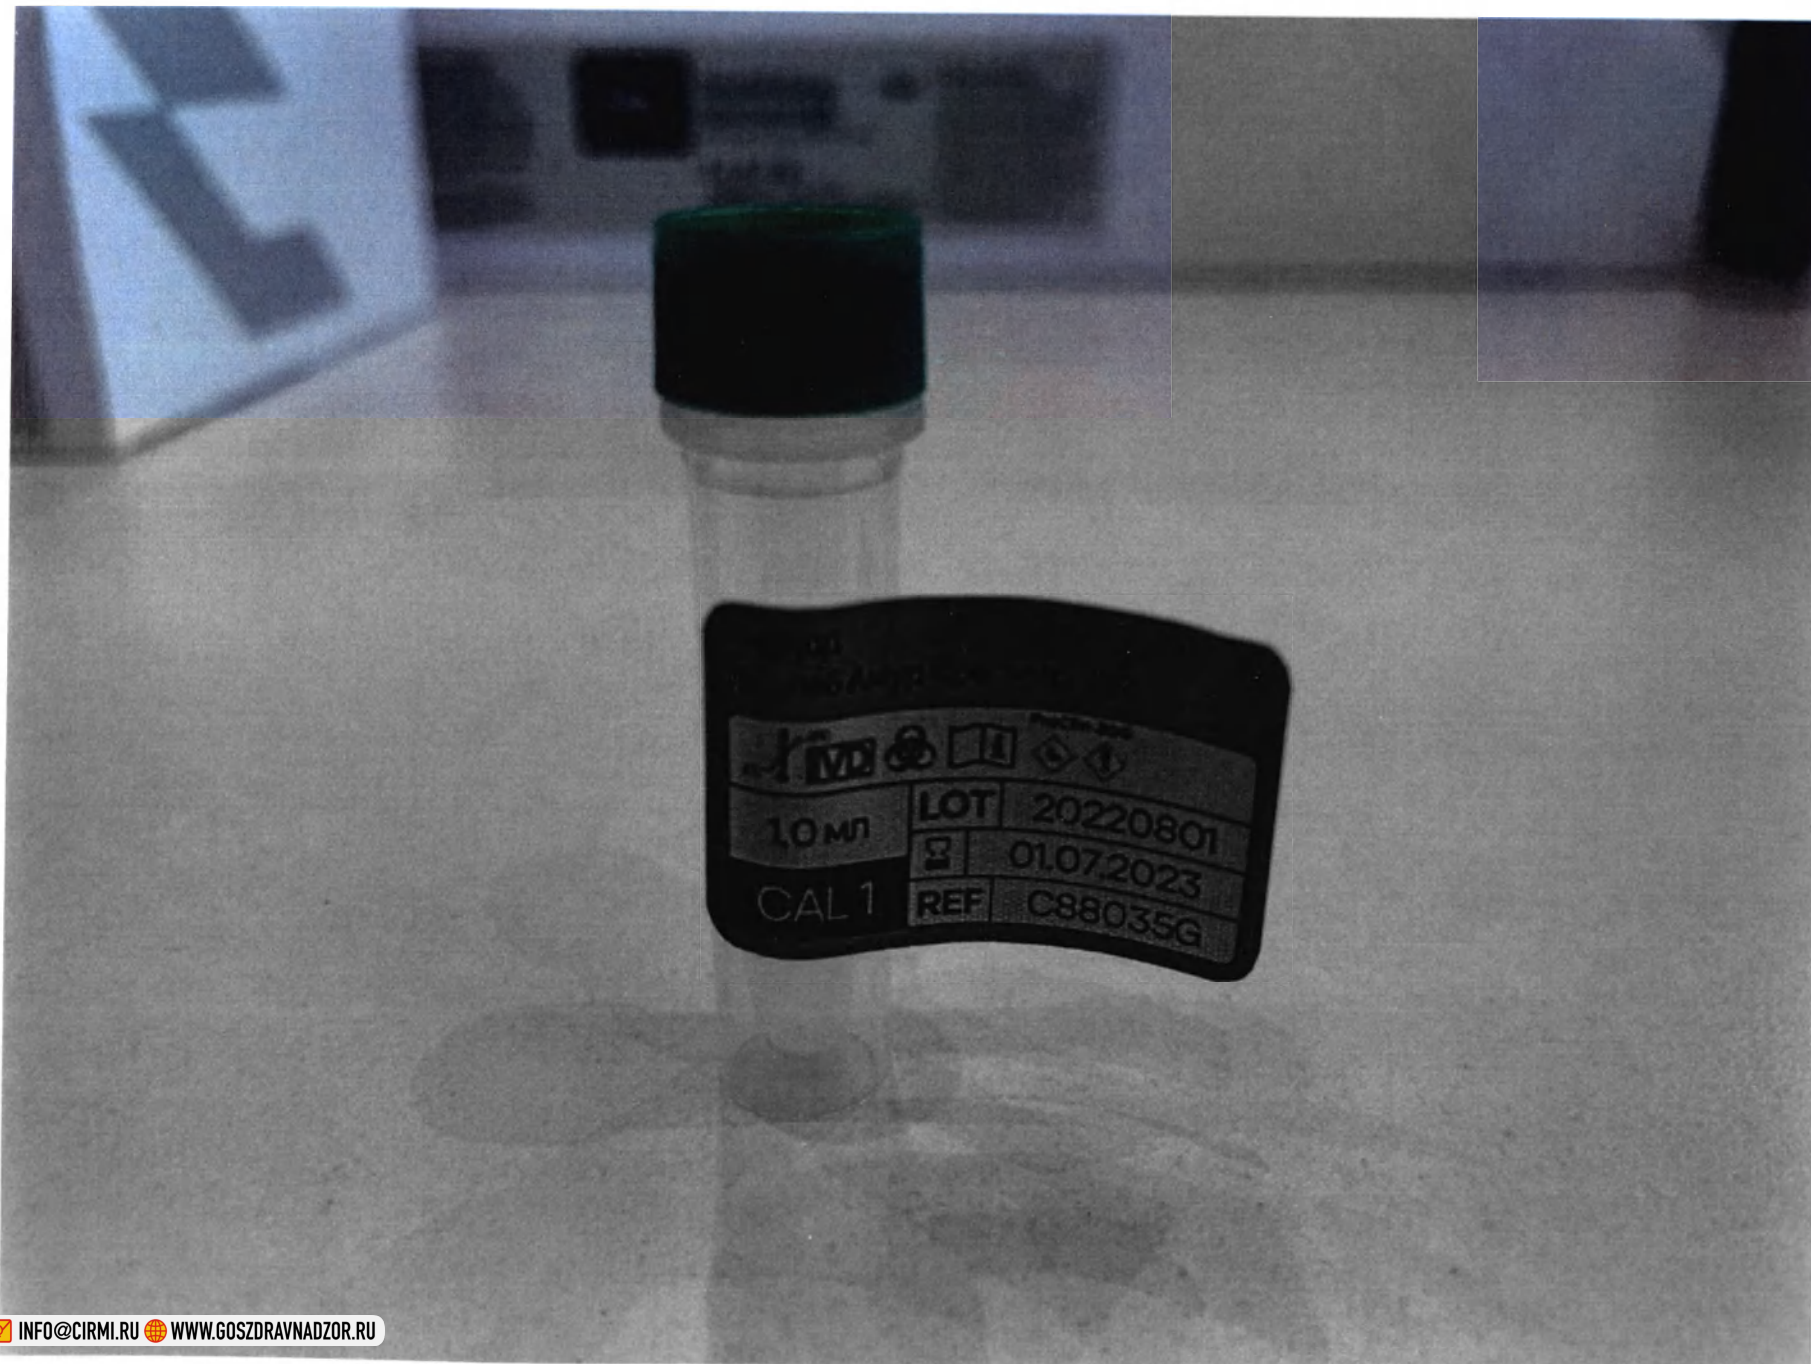


Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

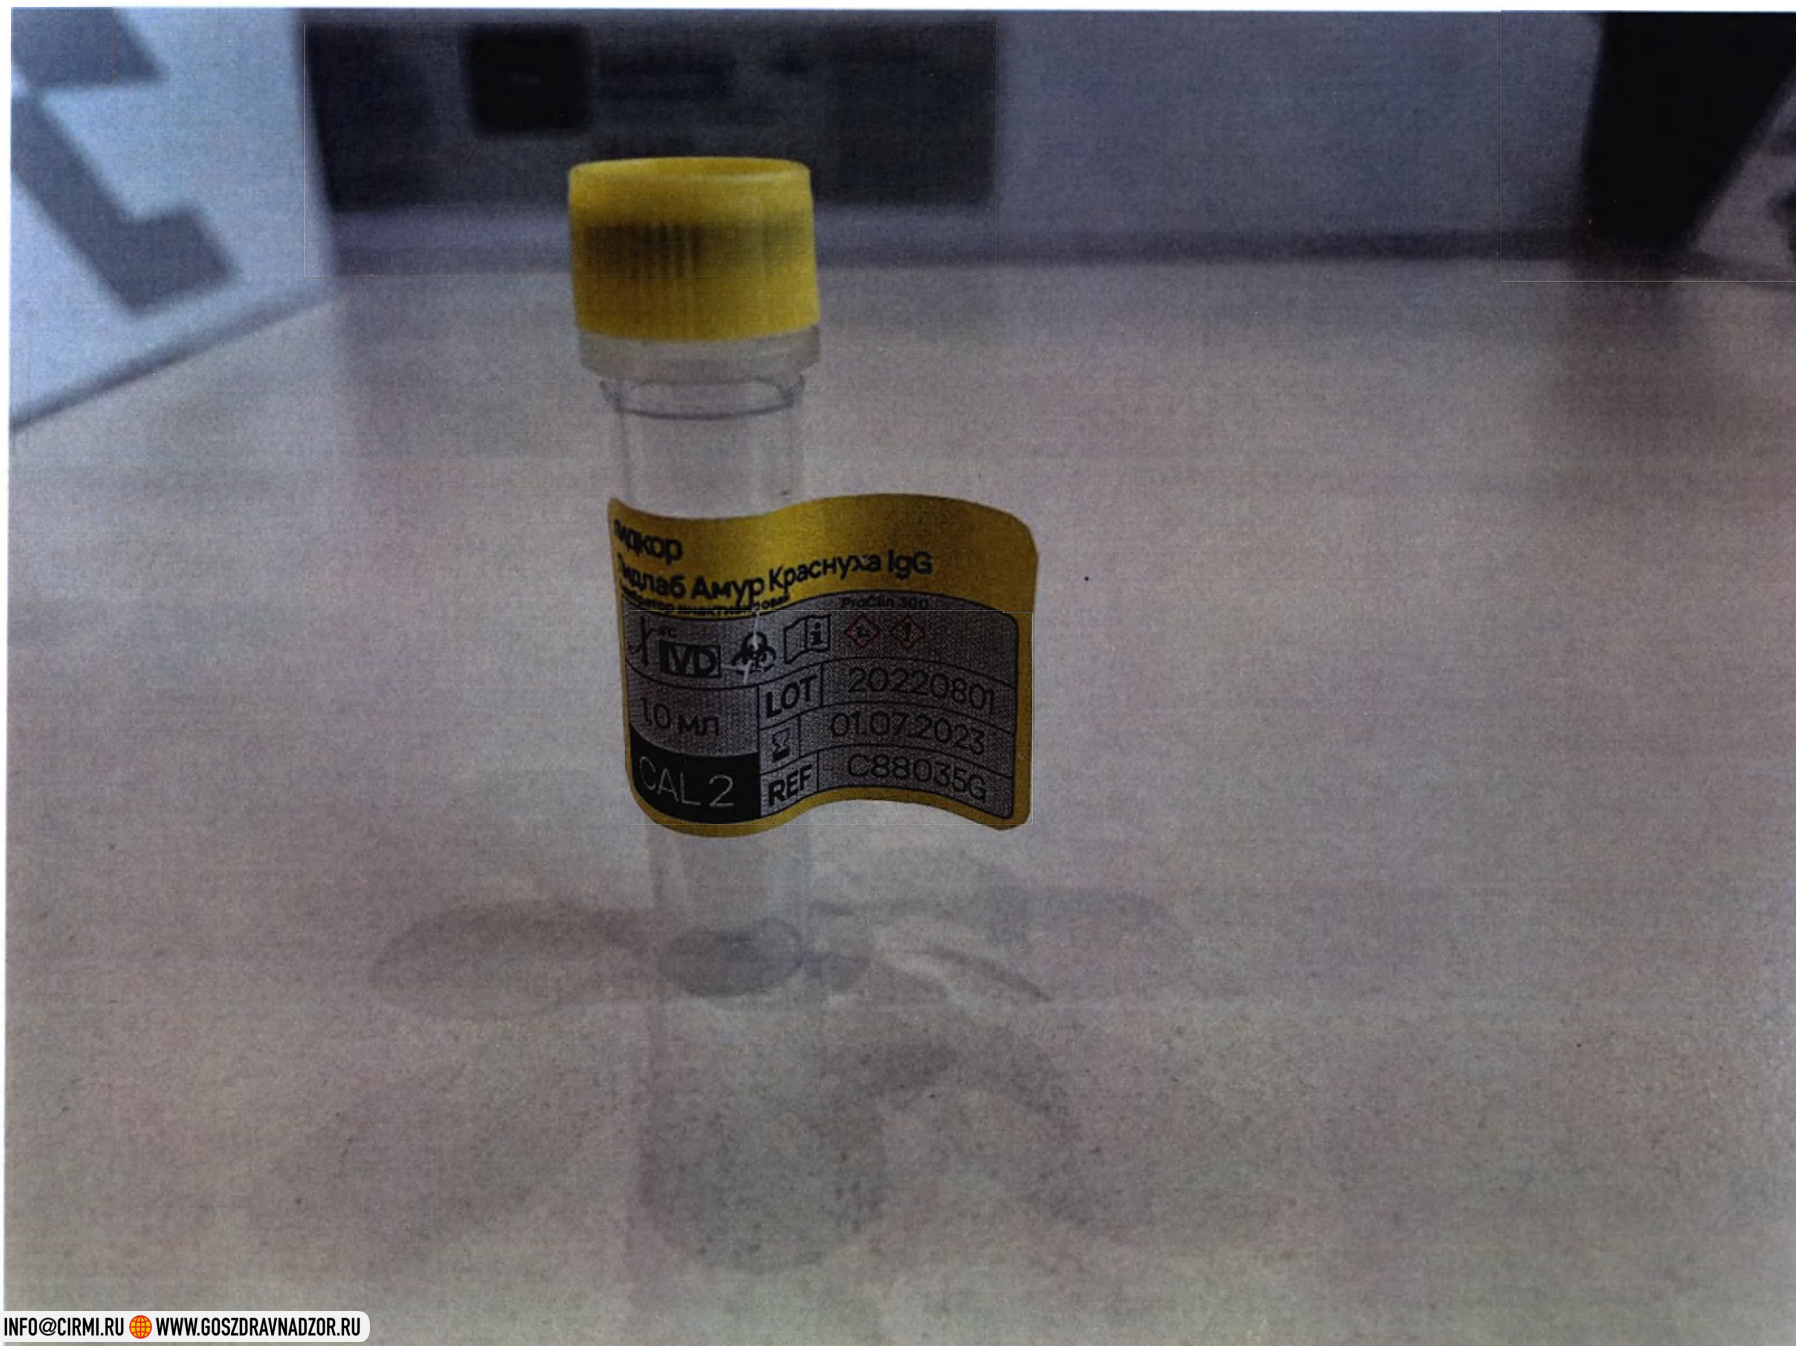


Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

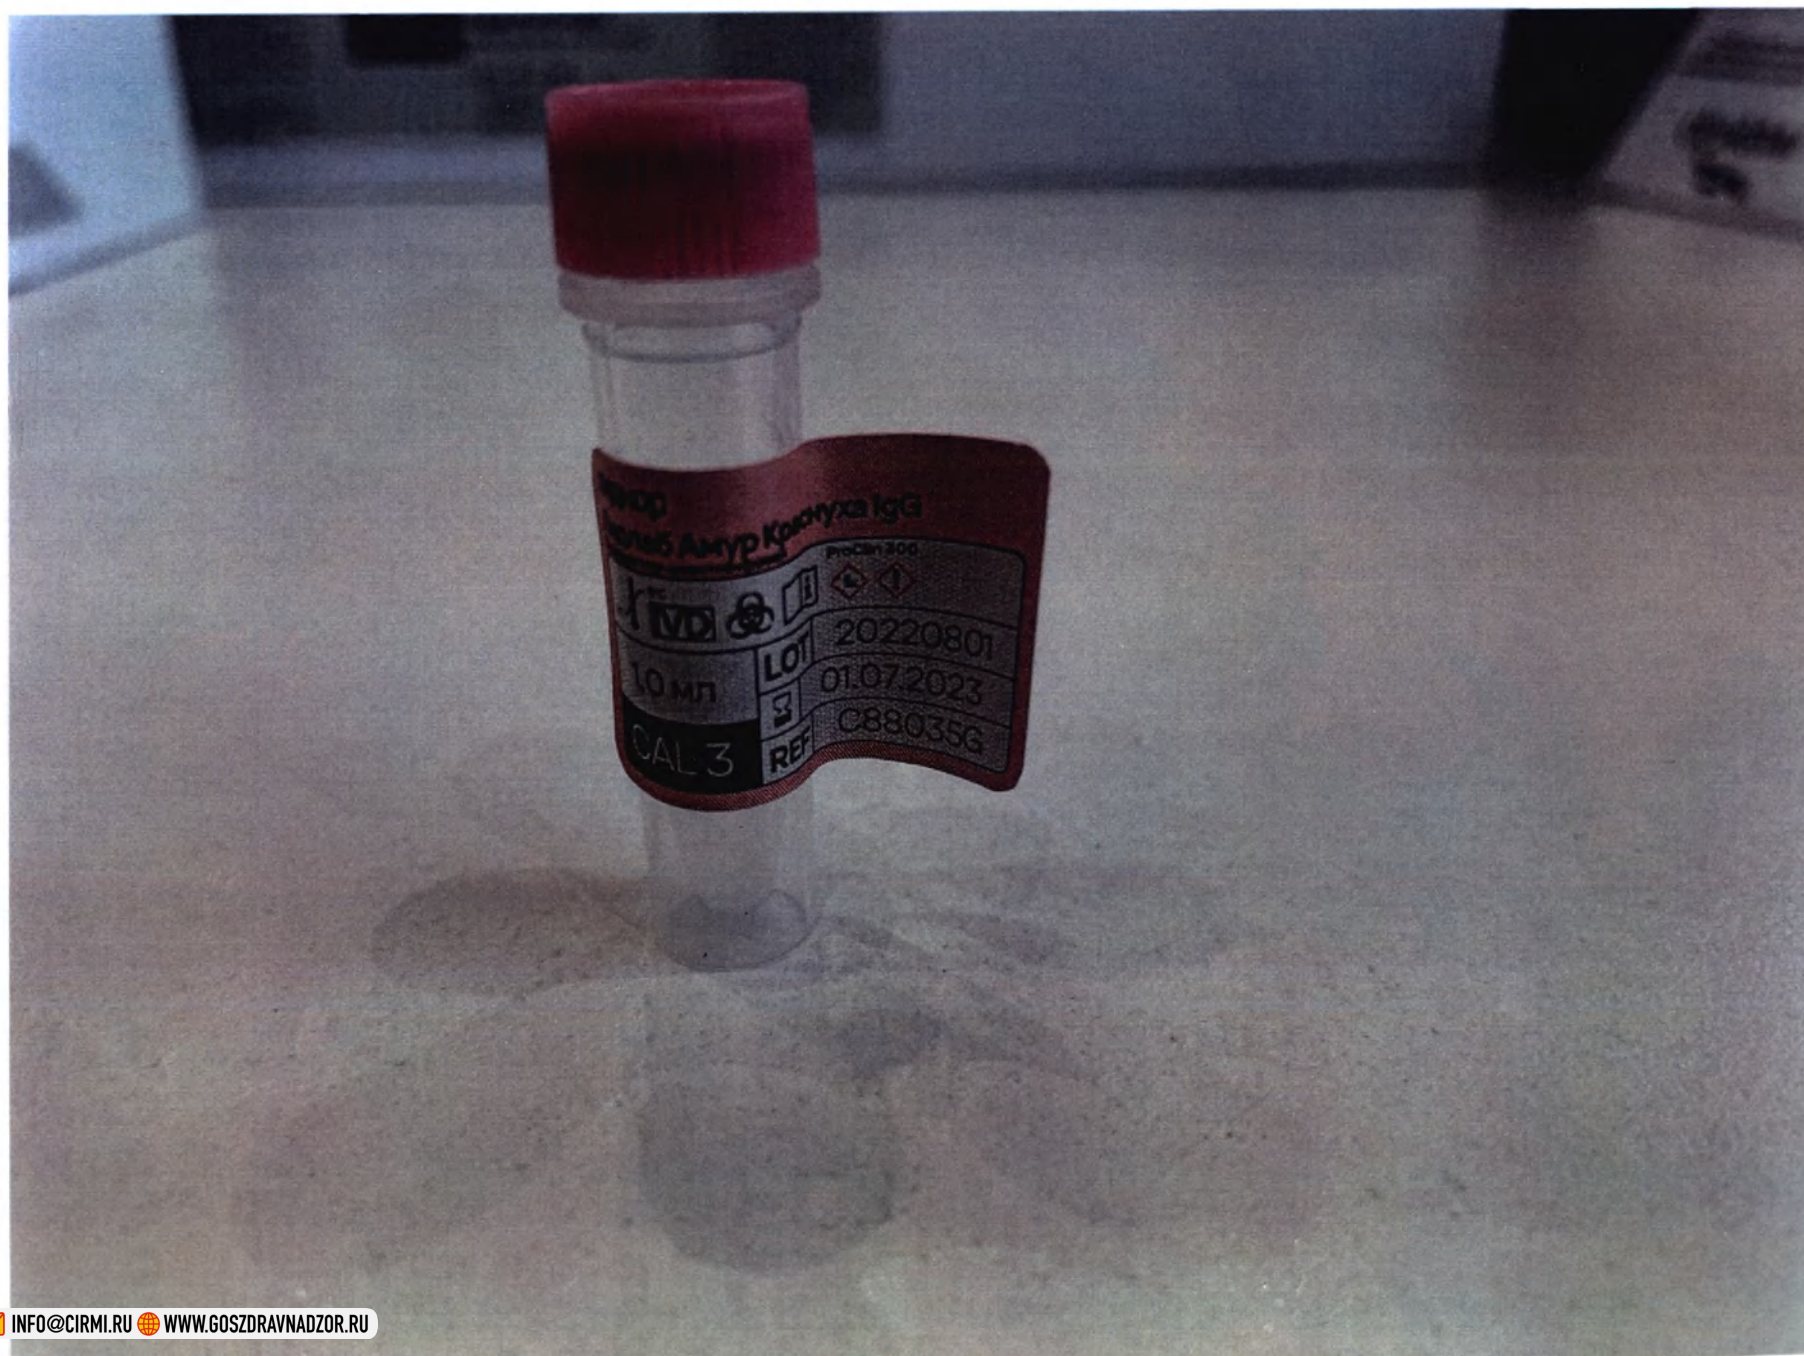

Набор реагентов на 100 тестов

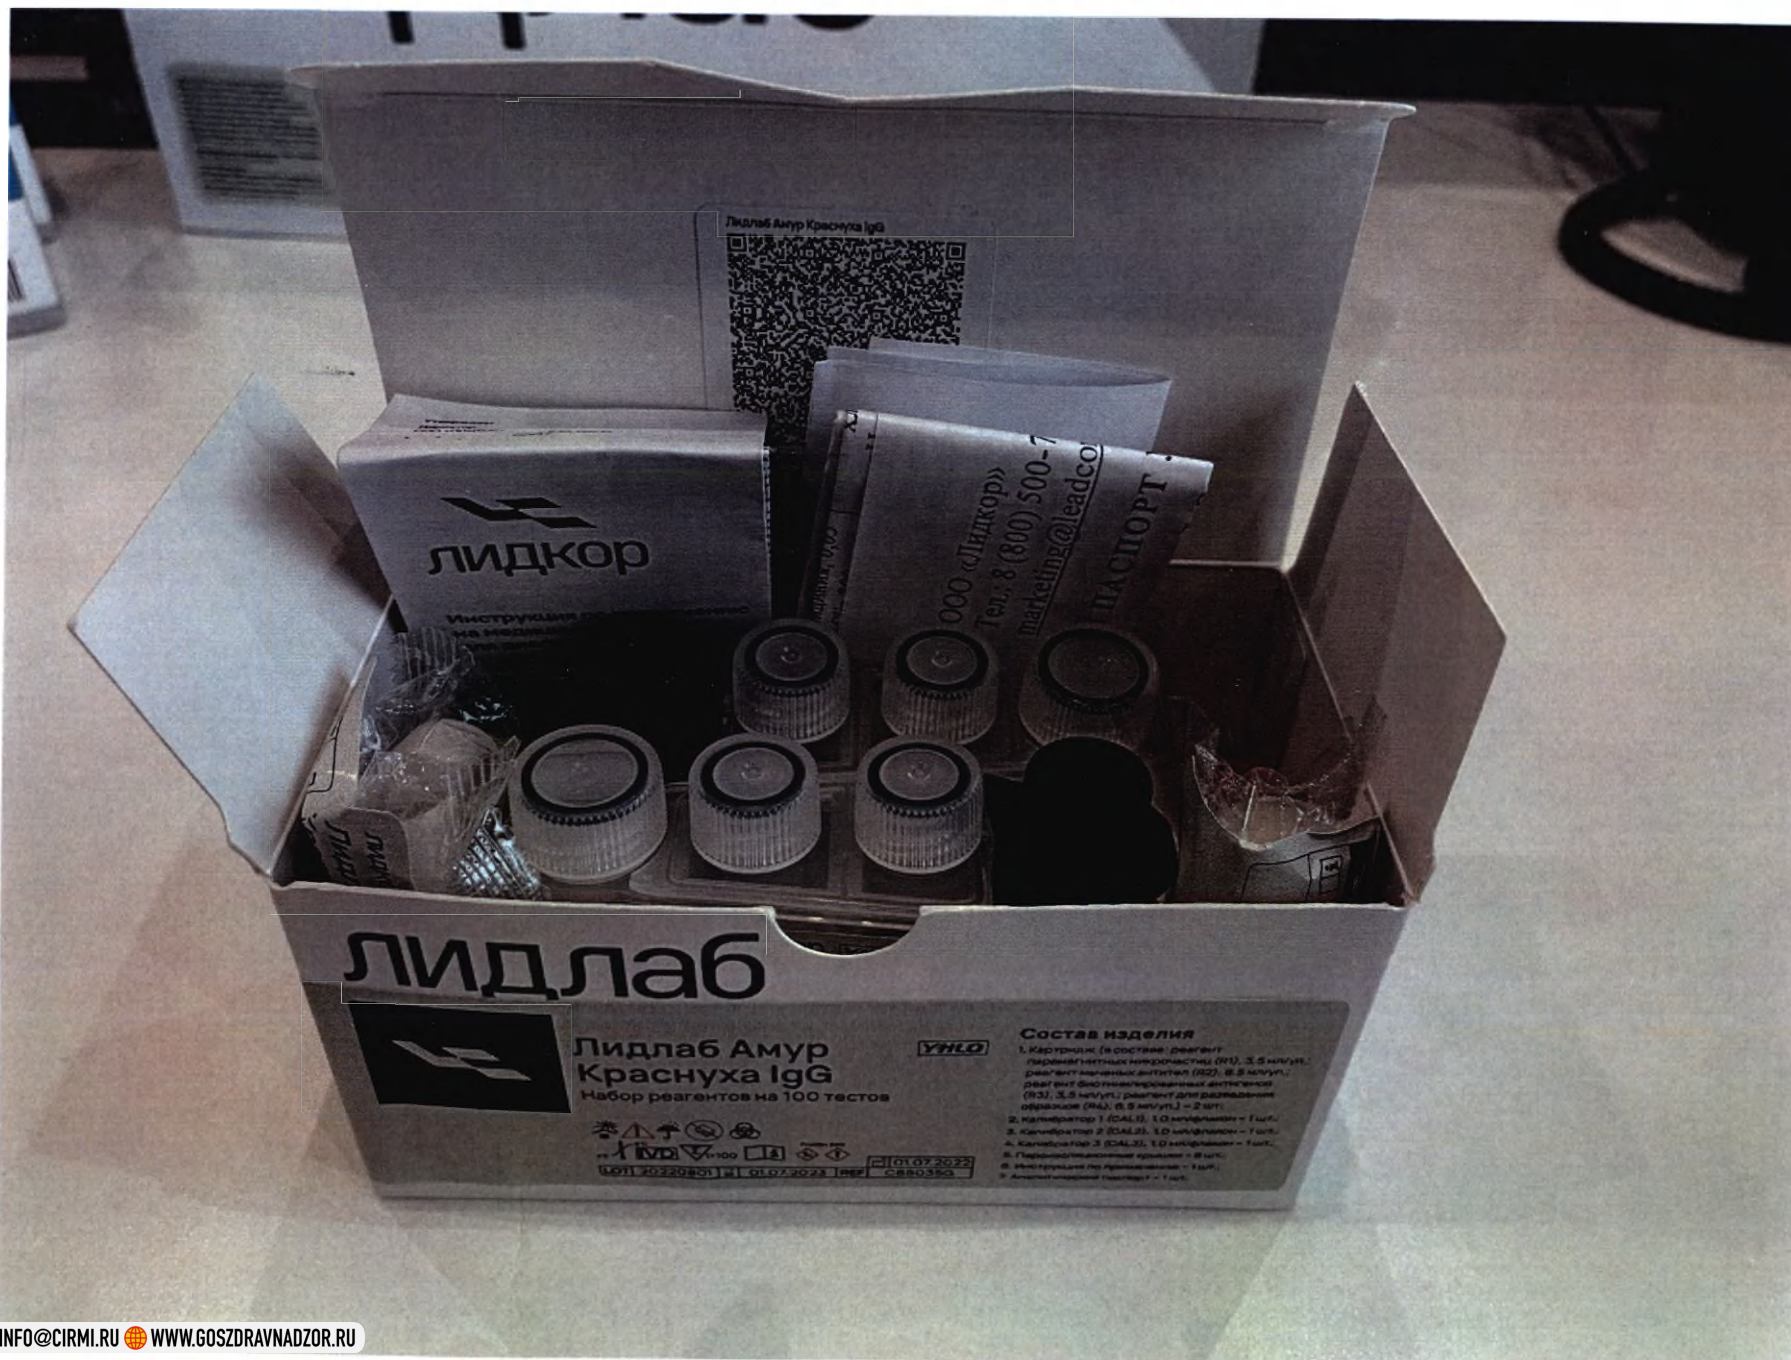

Набор реагентов на 100 тестов (вид сзади)

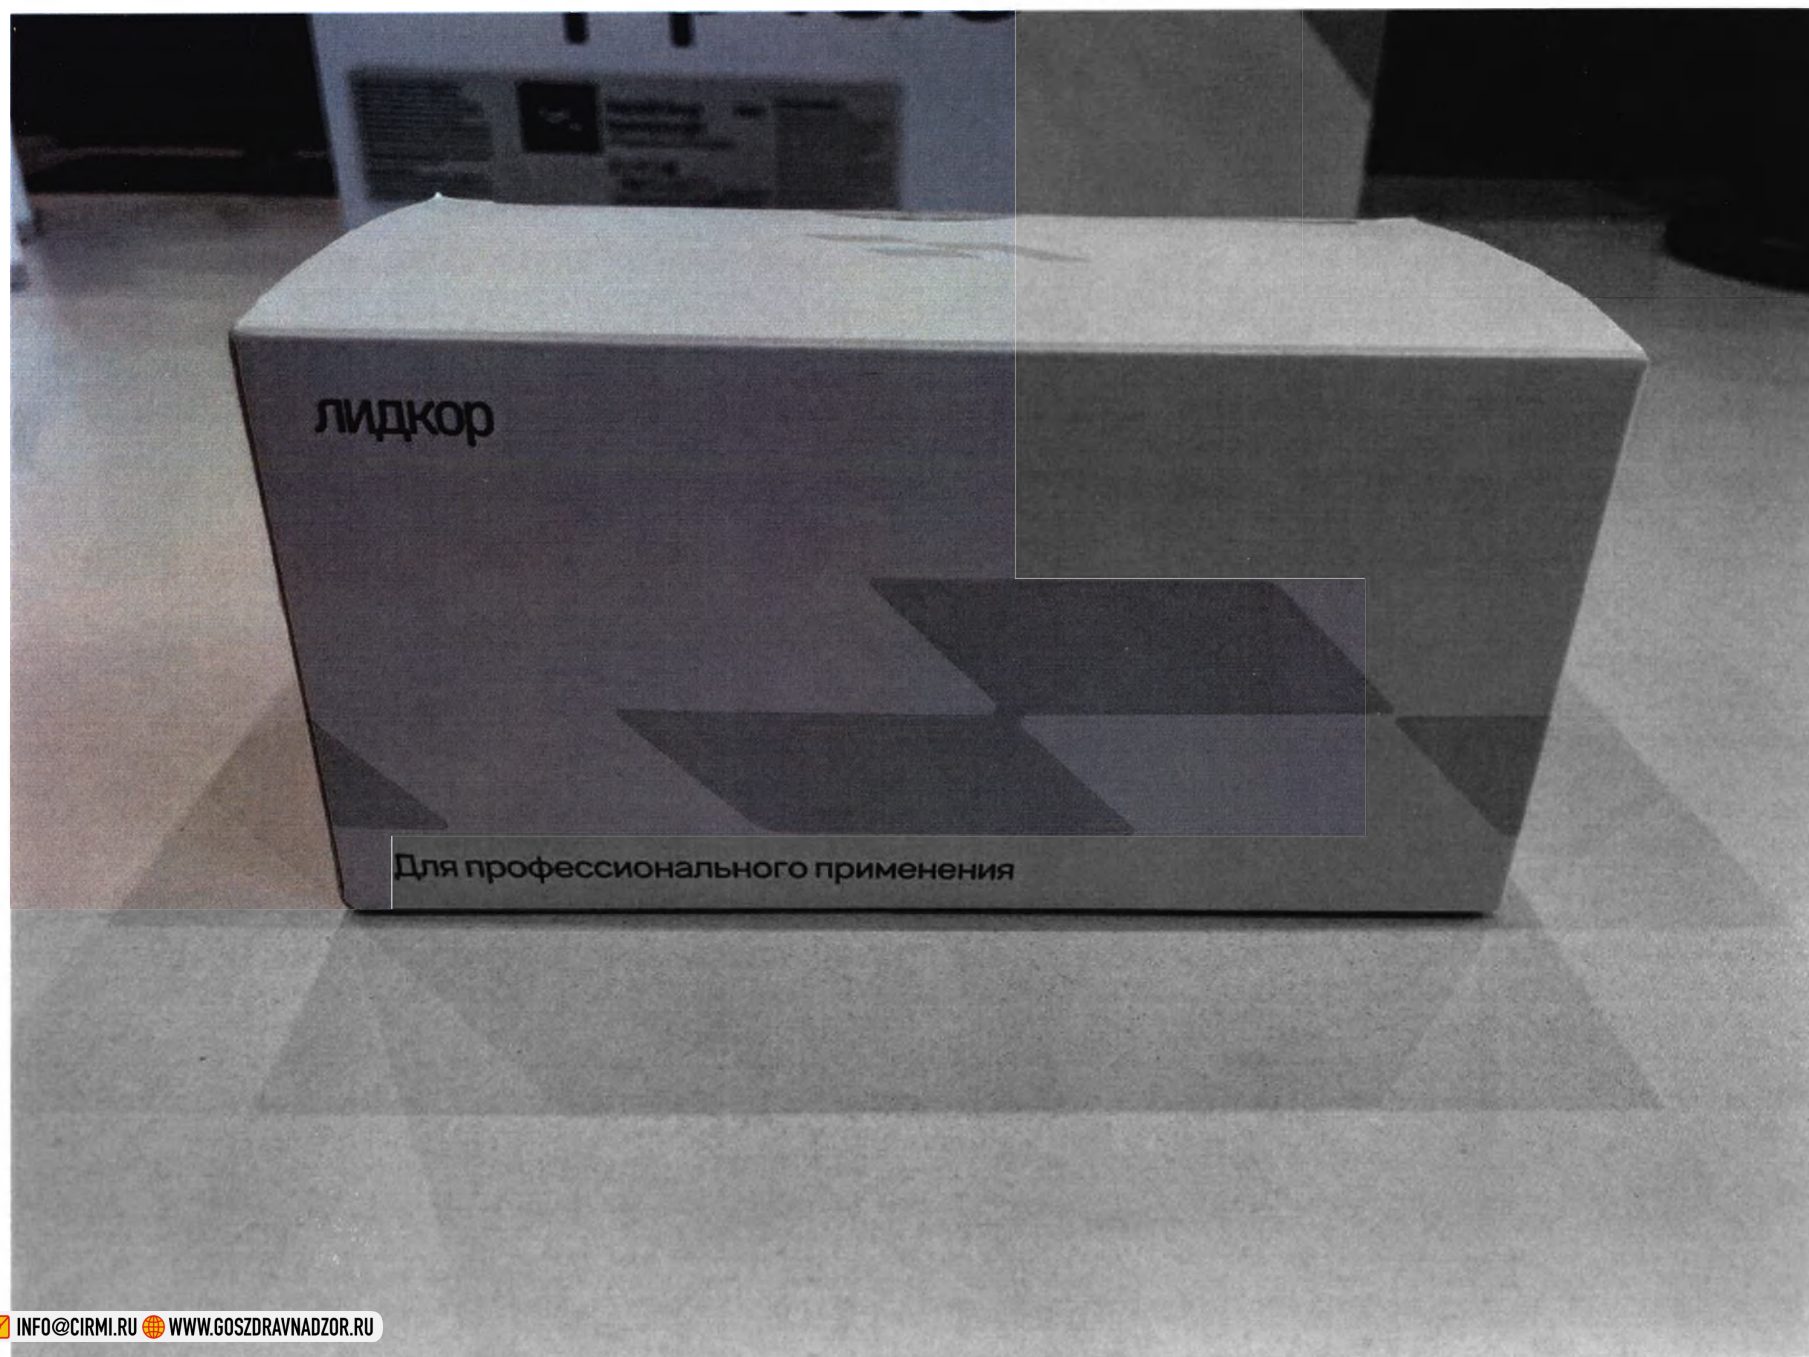

Набор реагентов на 100 тестов (вид сбоку)








Набор реагентов на 200 тестов (вид сбоку)



Набор реагентов на 500 тестов

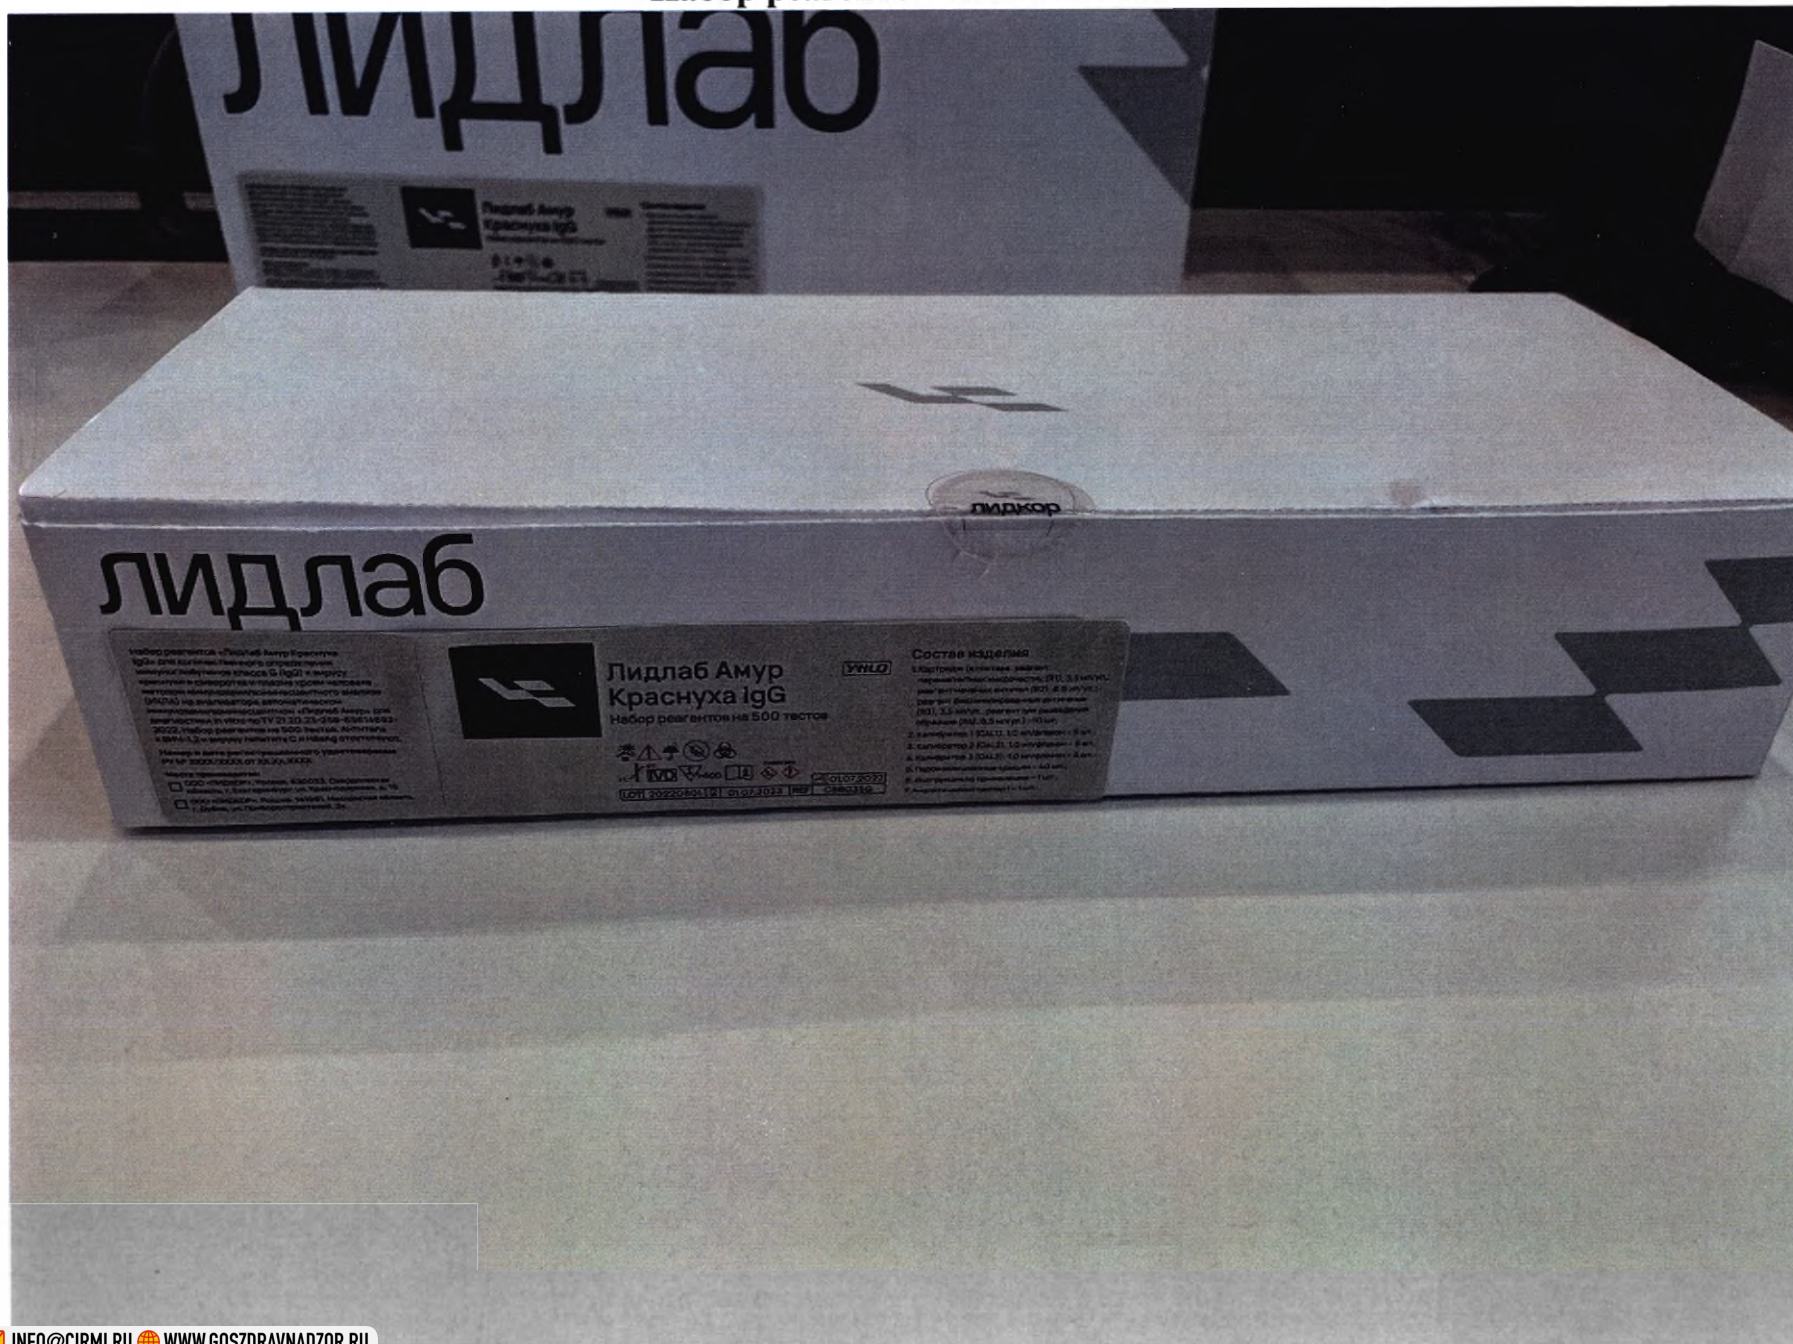


лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» для выявления антител к вирусу краснухи (IgG) и вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» на автоматизированном анализаторе «Лидлаб Амур» для автоматизированного выявления антител к вирусу краснухи (IgG) в сыворотке и плазме крови человека. Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG» на автоматизированном анализаторе «Лидлаб Амур» для автоматизированного выявления антител к вирусу краснухи (IgG) в сыворотке и плазме крови человека.




**Лидлаб Амур
Краснуха IgG**
Набор реагентов на 500 тестов




Состав изделия
1. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
2. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
3. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
4. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
5. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
6. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
7. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
8. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
9. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)
10. Карtridge (с тестовыми реактивами) (20 шт.)

Набор реагентов на 500 тестов (вид сзади)

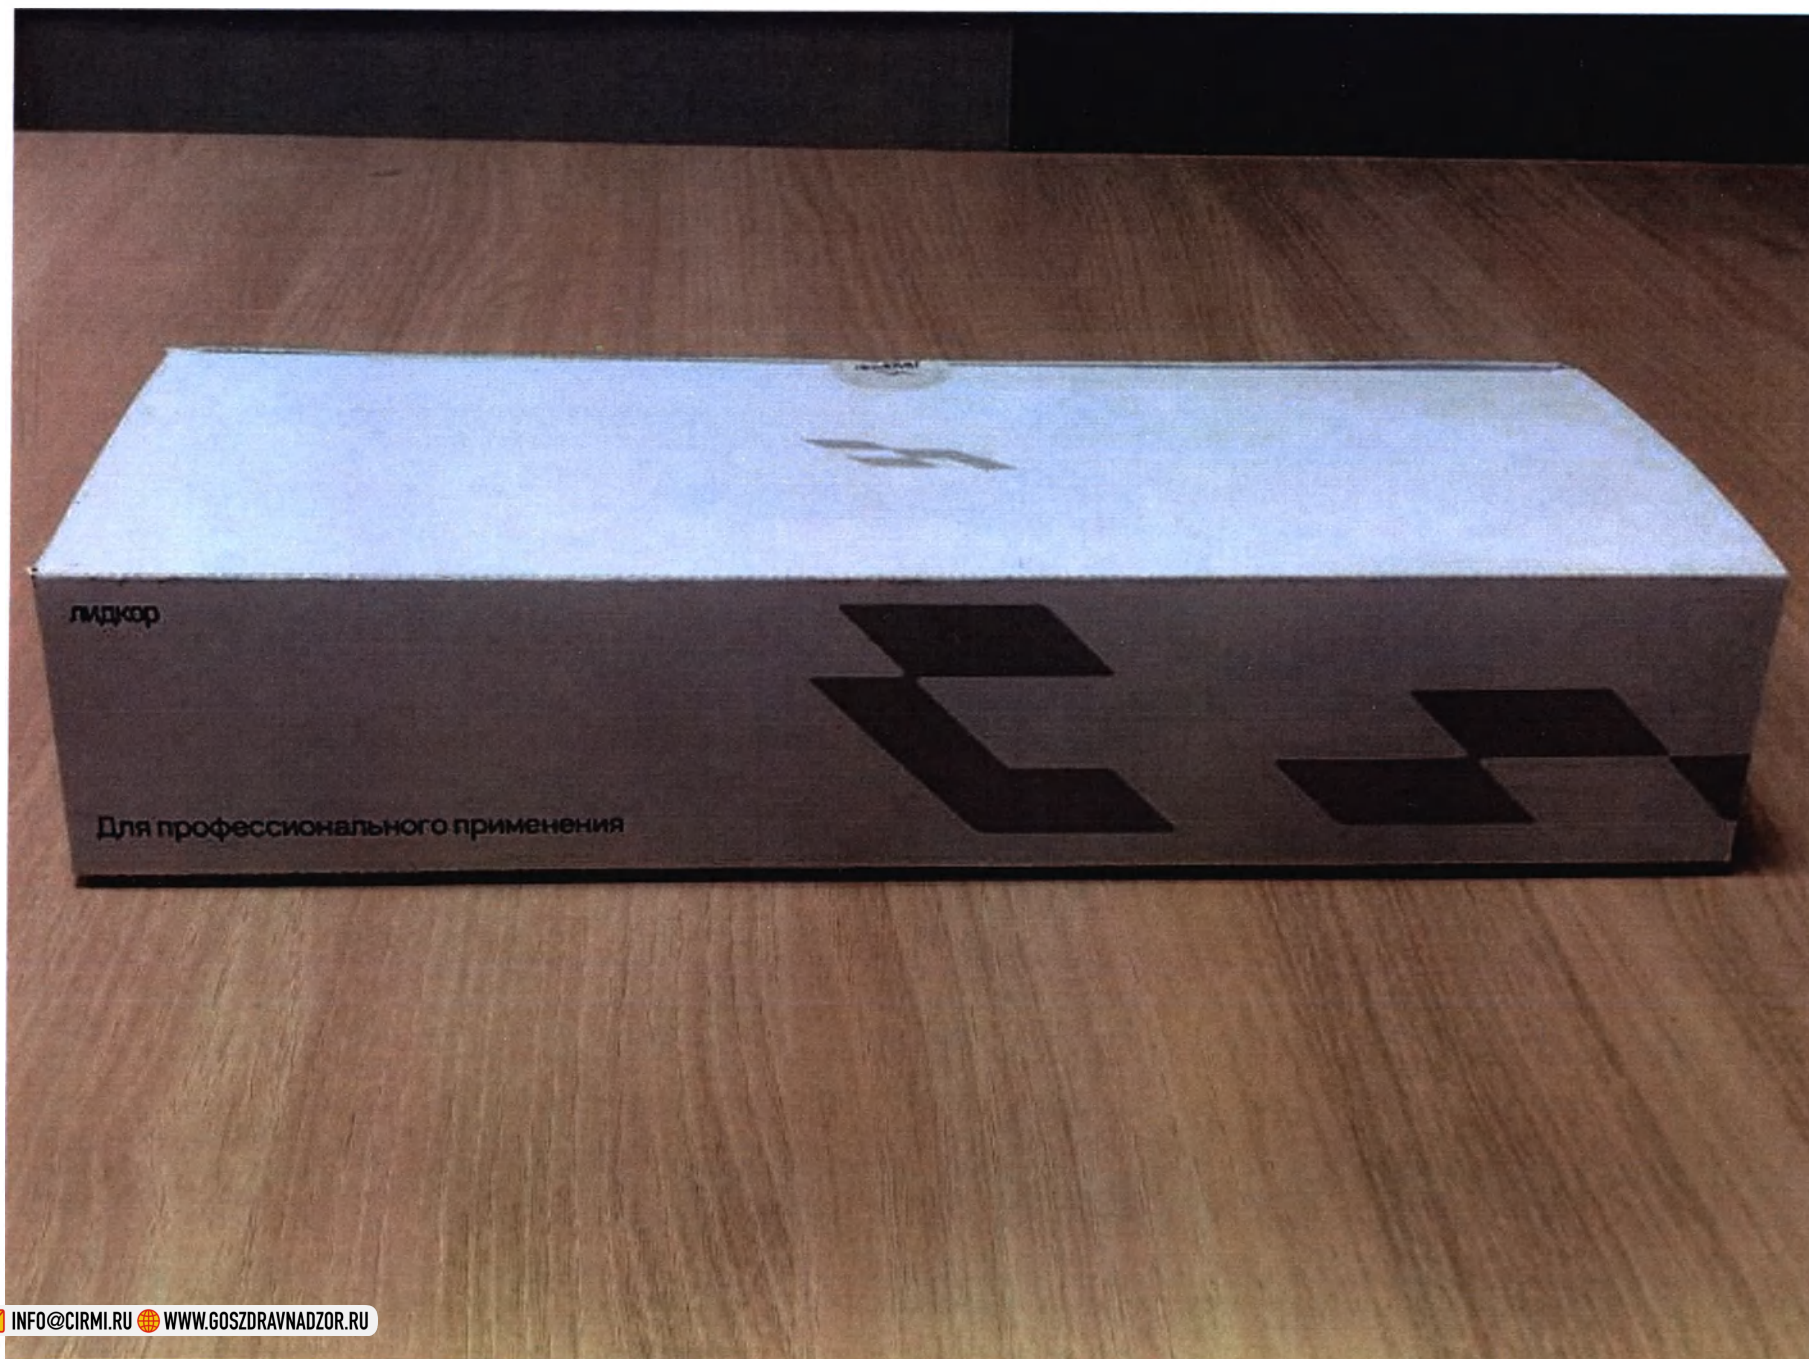


Набор реагентов на 500 тестов (вид сбоку)

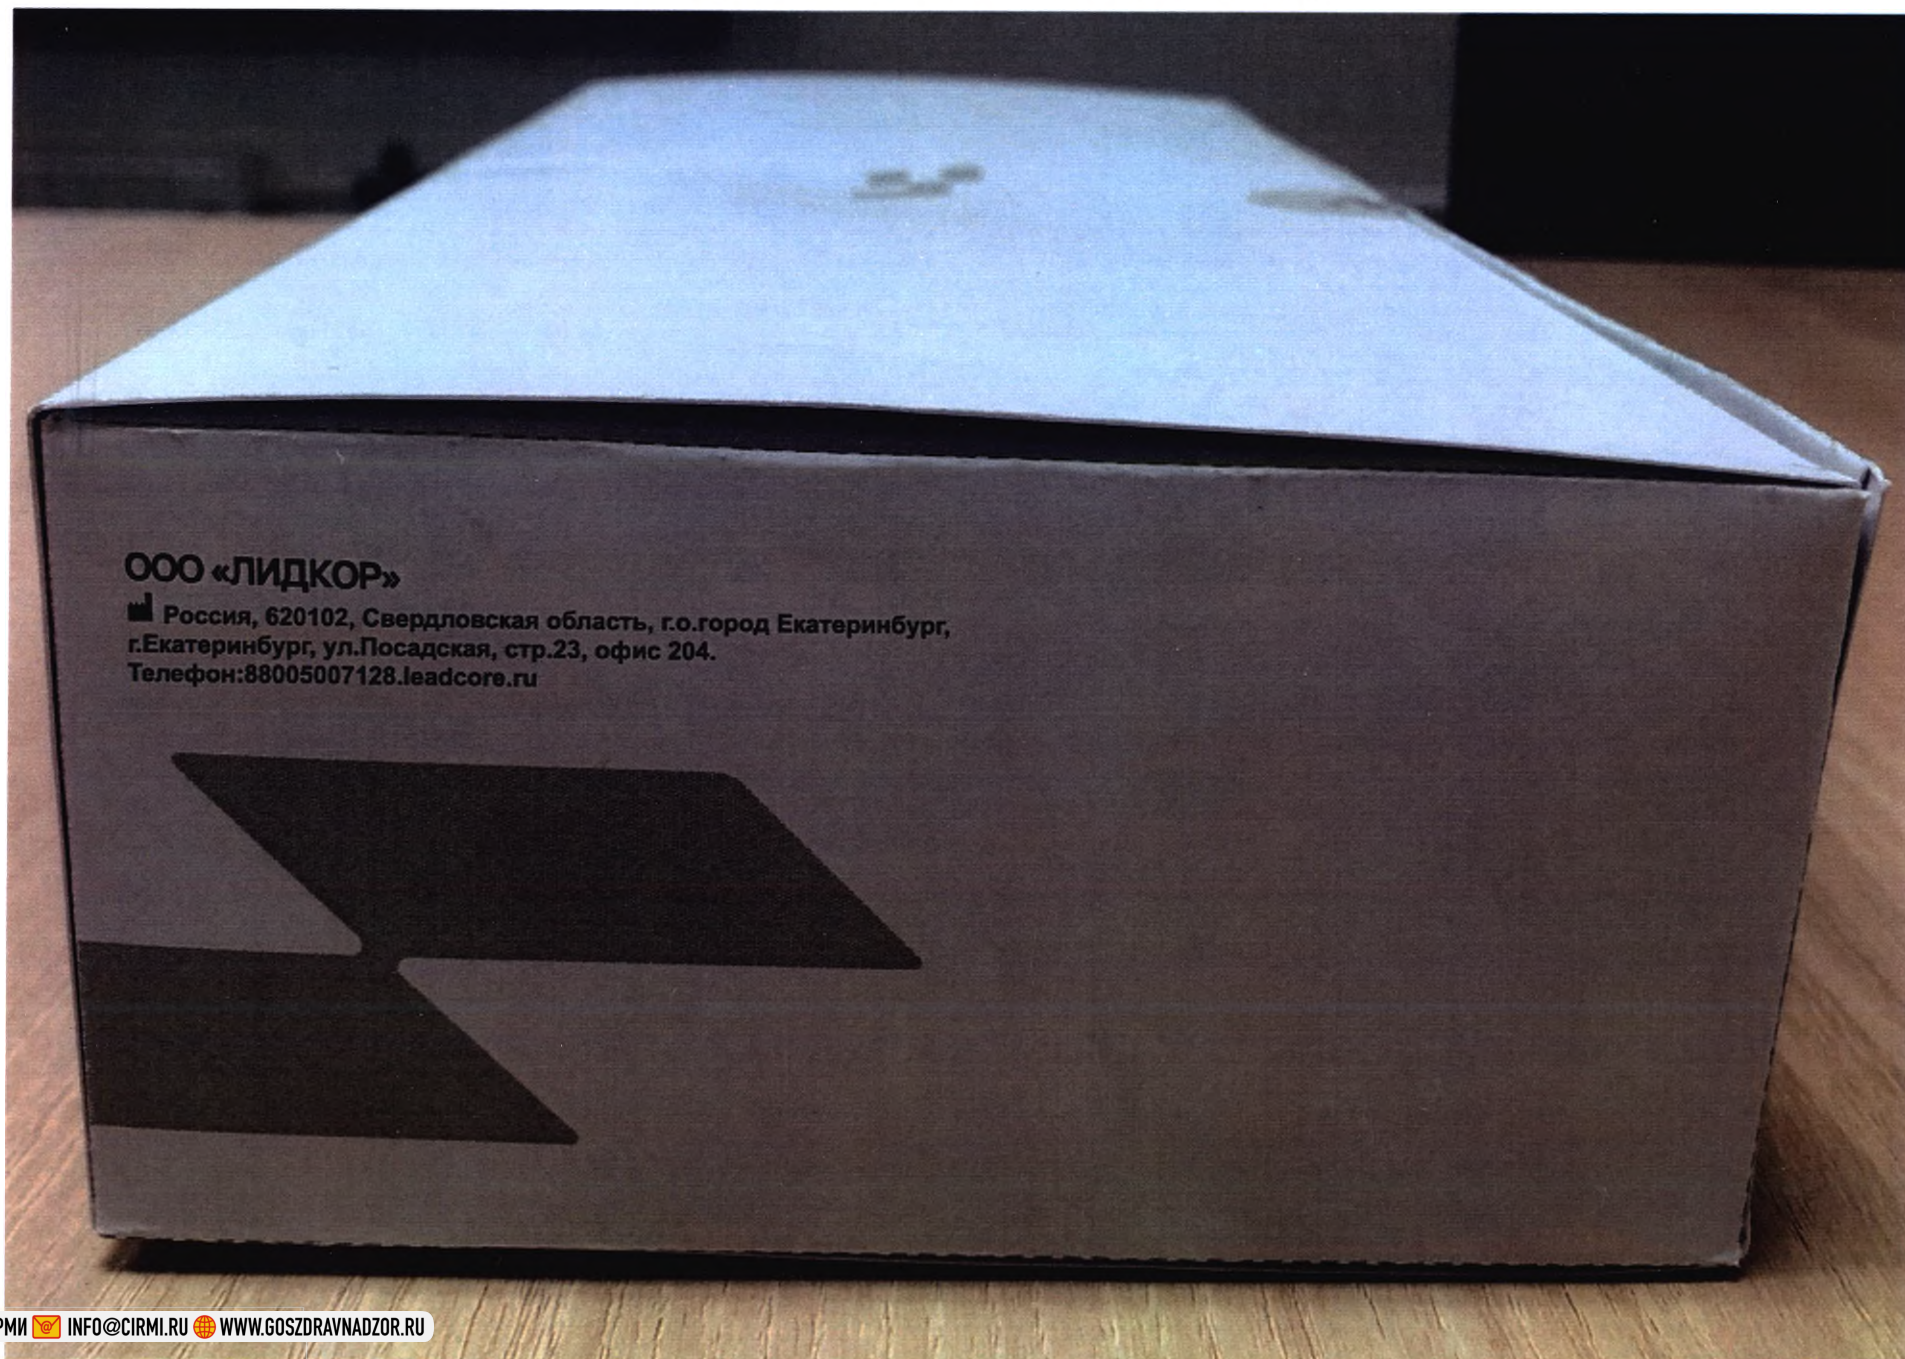

Набор реагентов на 1000 тестов


лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG»
для диагностики острой и перенесенной
инфекции вирусом краснухи (ВКР) в сыворотке
крови человека. Набор реагентов «Лидлаб Амур
Краснуха IgG» на 1000 тестов. Набор реагентов
для диагностики острой и перенесенной инфекции
вирусом краснухи (ВКР) в сыворотке крови человека.
Диагностика острой и перенесенной инфекции
вирусом краснухи (ВКР) в сыворотке крови человека.
2-х-фазный набор реагентов на 1000 тестов. В наборе
входят: 1.0 л. раствора реагента А, 1.0 л. раствора реагента Б.
Набор реагентов «Лидлаб Амур Краснуха IgG»
для диагностики острой и перенесенной инфекции
вирусом краснухи (ВКР) в сыворотке крови человека.
Диагностика острой и перенесенной инфекции
вирусом краснухи (ВКР) в сыворотке крови человека.
2-х-фазный набор реагентов на 1000 тестов. В наборе
входят: 1.0 л. раствора реагента А, 1.0 л. раствора реагента Б.



**Лидлаб Амур
Краснуха IgG**
Набор реагентов на 1000 тестов

УНКО




01.07.2022

СОСТАВ НАБОРА

1. Раствор реагента А (1.0 л.)
2. Раствор реагента Б (1.0 л.)
3. Раствор реагента В (1.0 л.)
4. Раствор реагента Г (1.0 л.)
5. Раствор реагента Д (1.0 л.)
6. Раствор реагента Е (1.0 л.)
7. Раствор реагента Ж (1.0 л.)


Набор реагентов на 1000 (вид сзади)

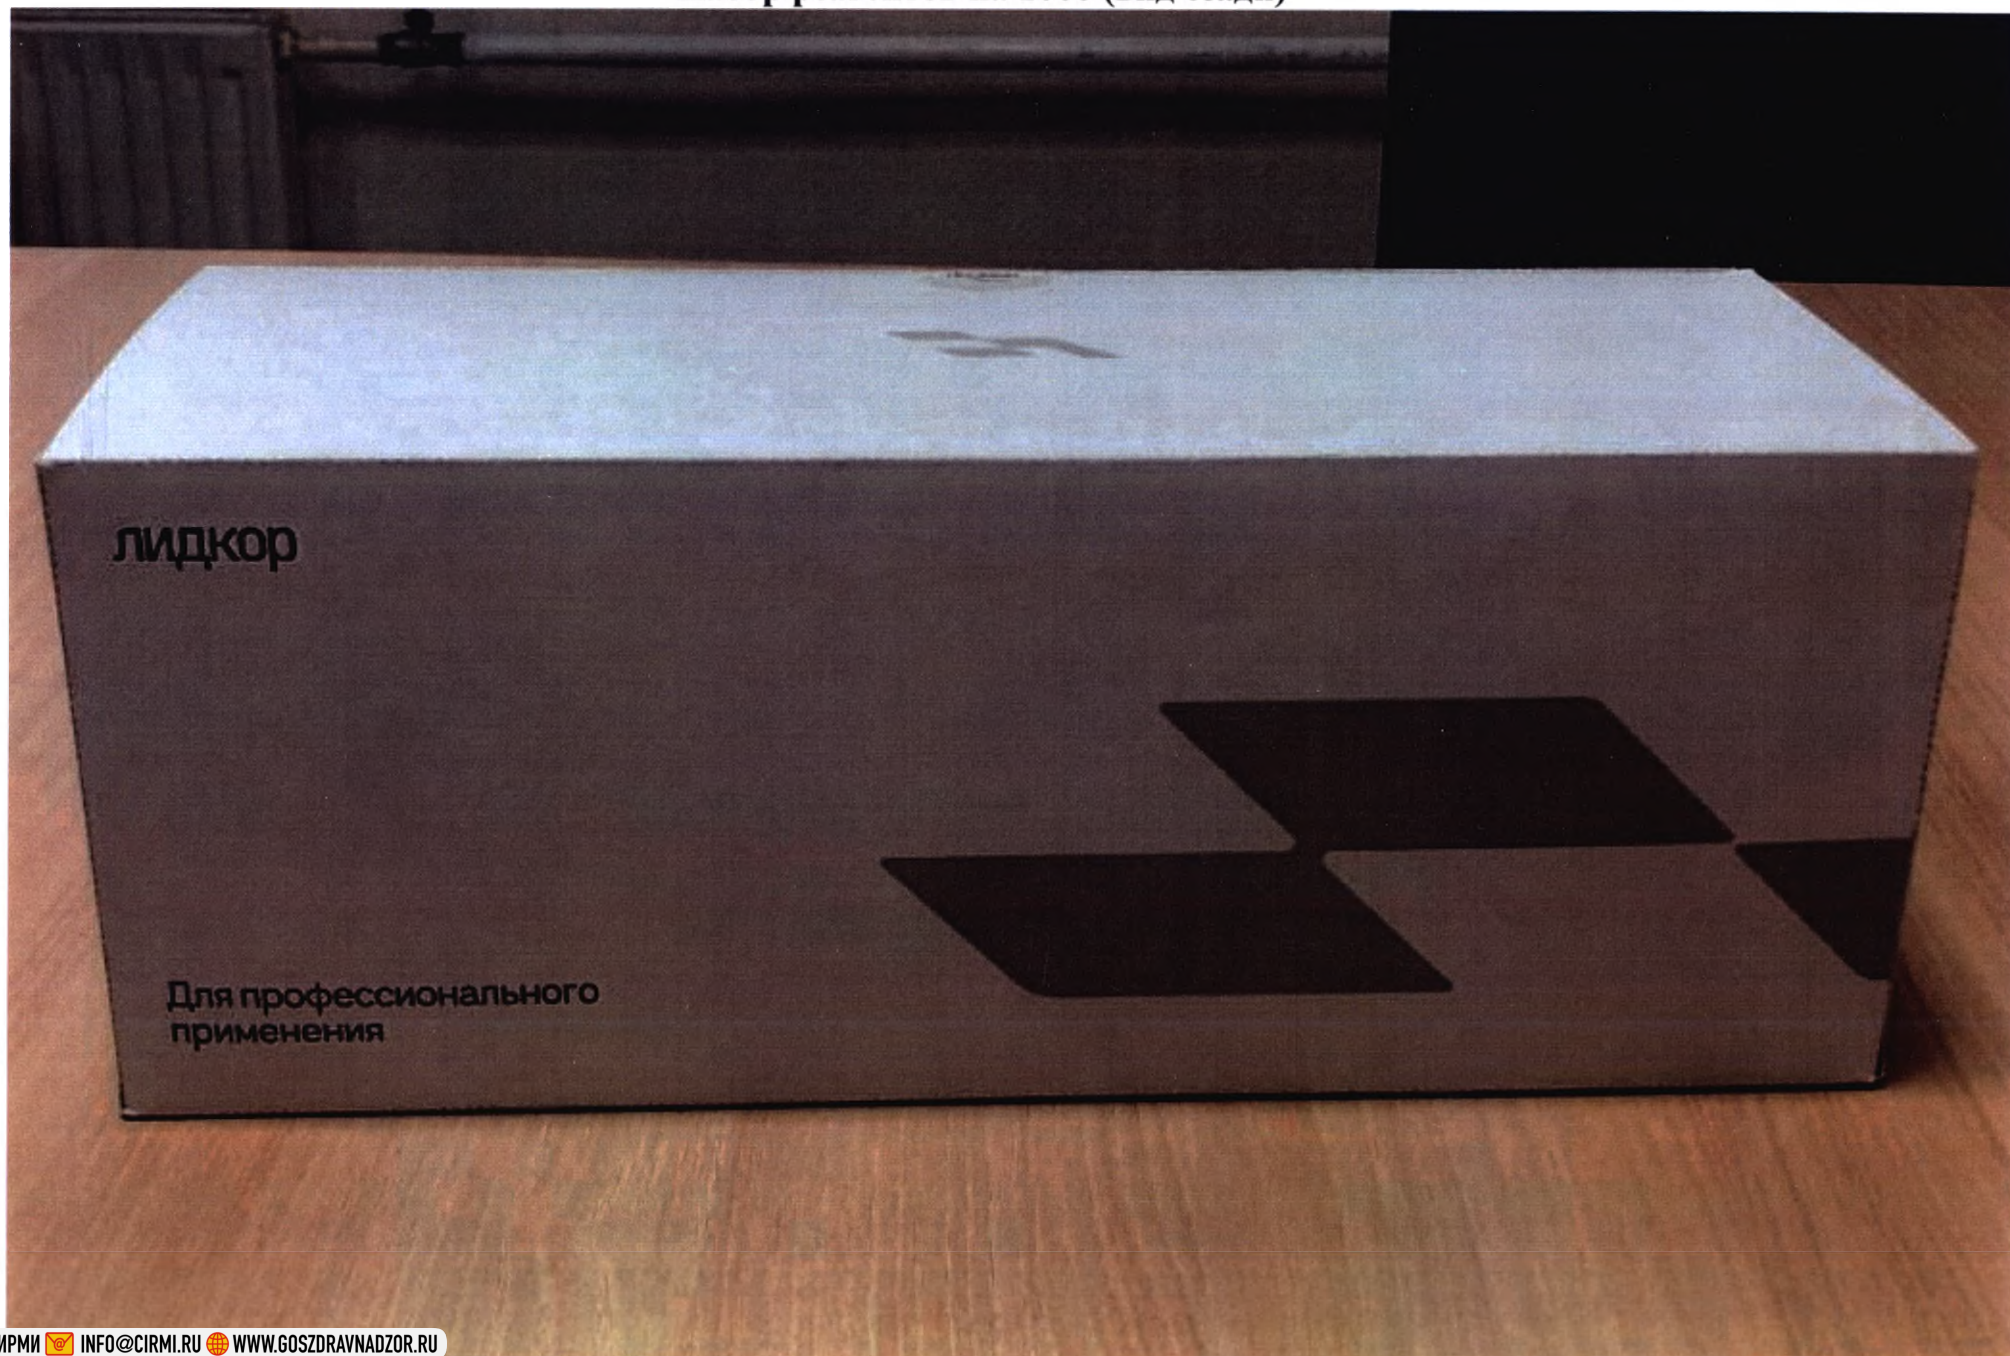

Набор реагентов на 1000 тестов (вид сбоку)

ООО «ЛИДКОР»

■ Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.
Телефон:88005007128.leadcore.ru

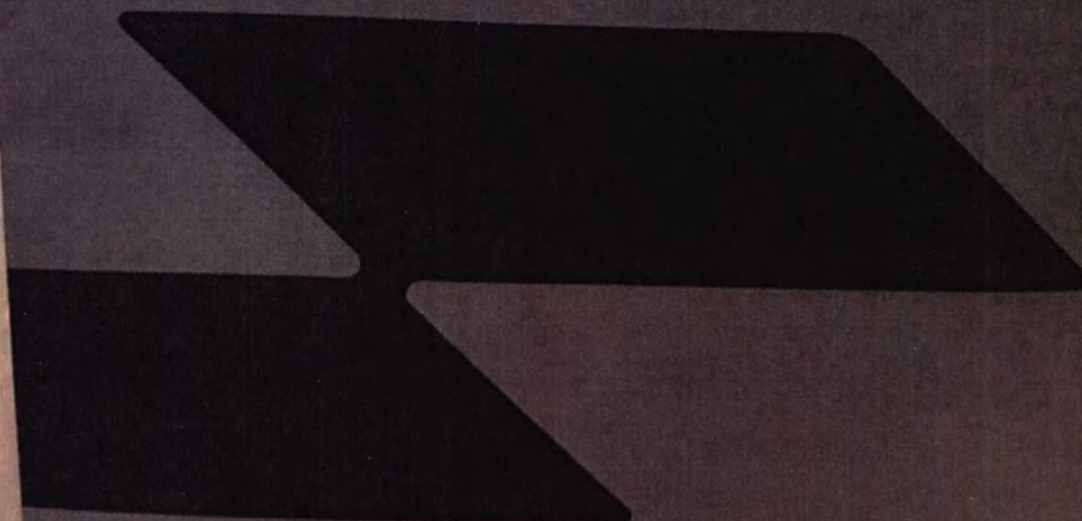



Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

19 декабря 2016

) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/