




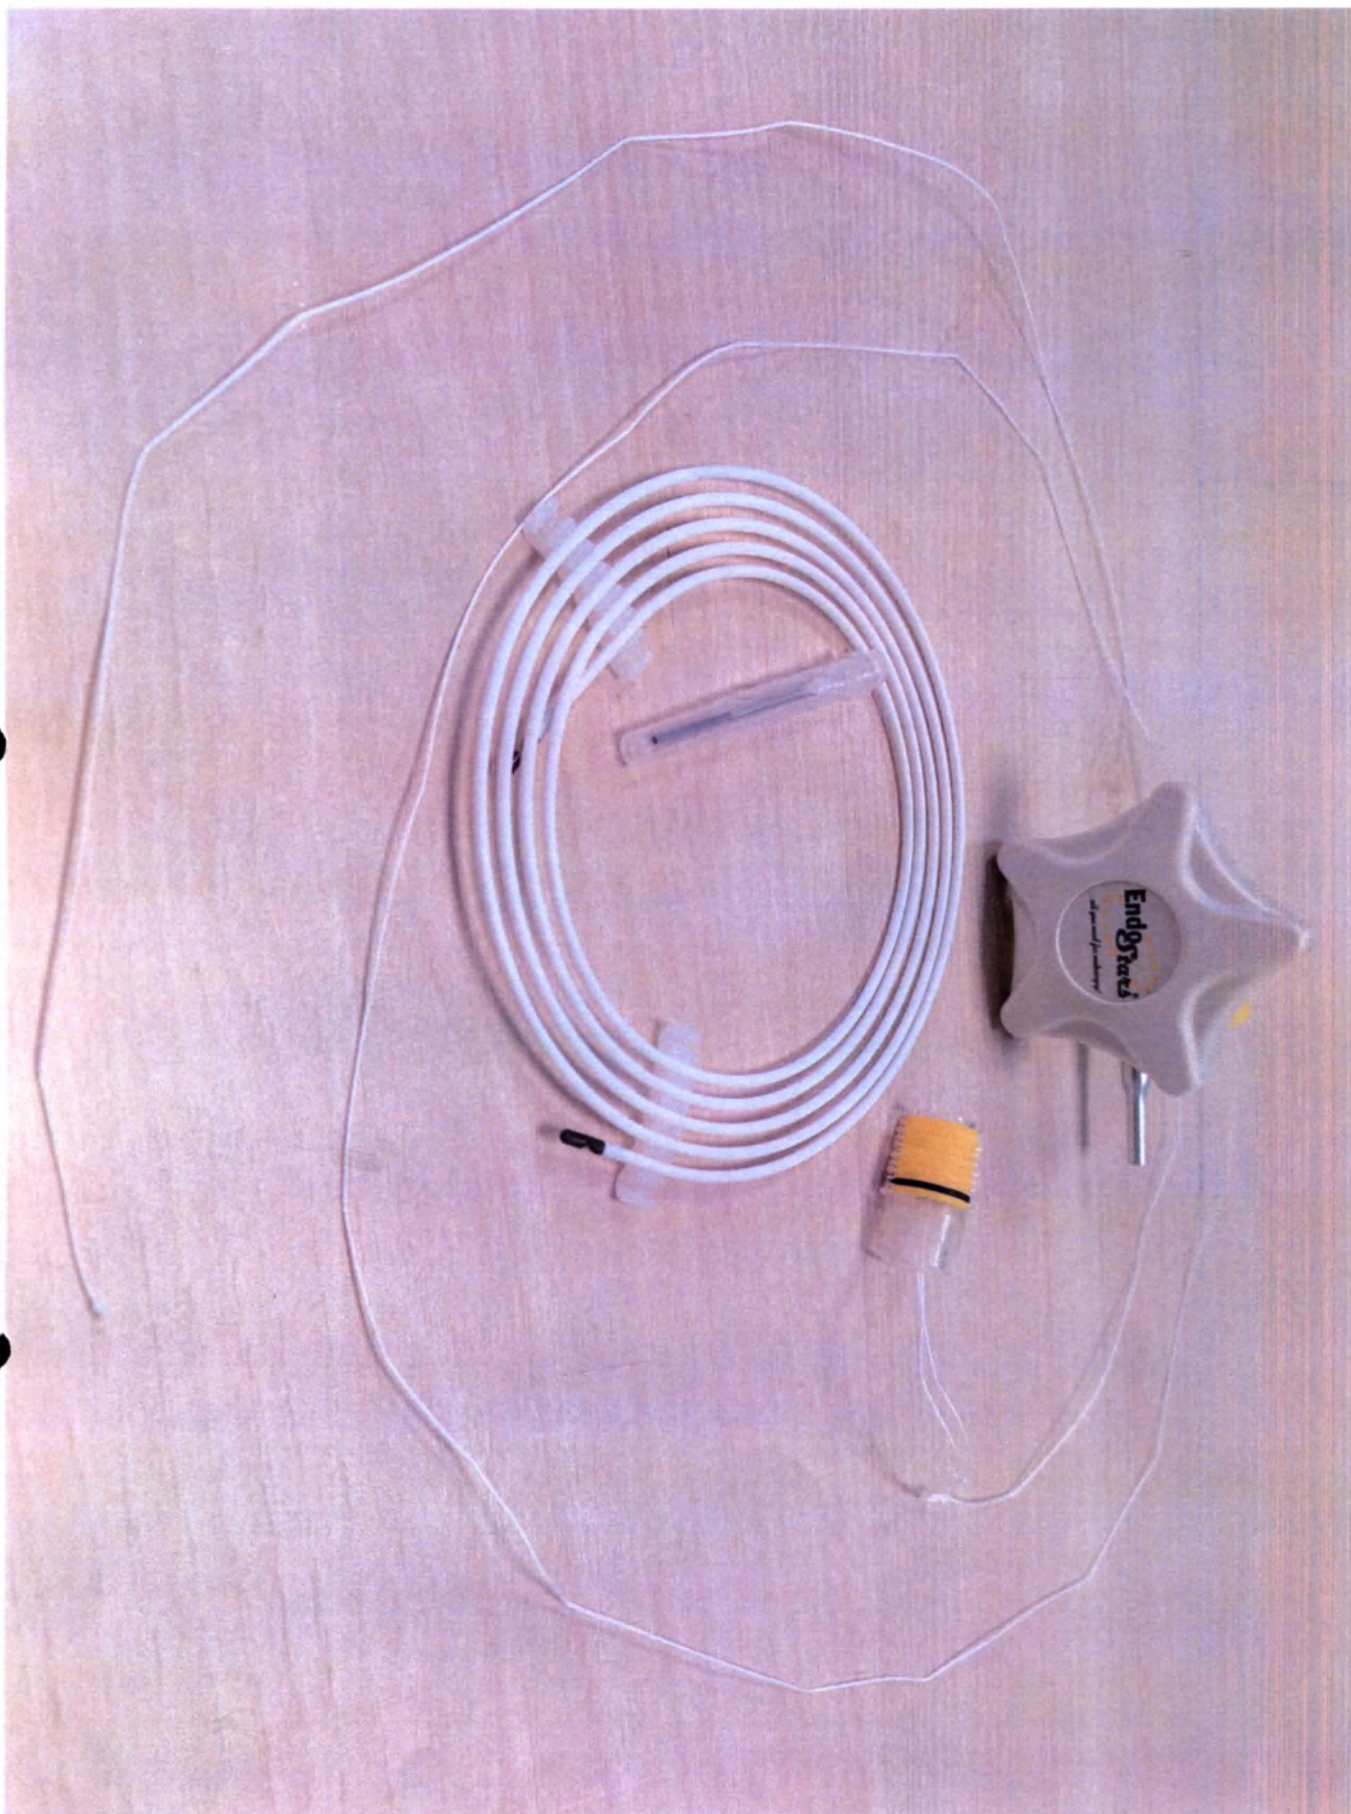


Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-226-89134710-2022 (Артикул: L010.1).

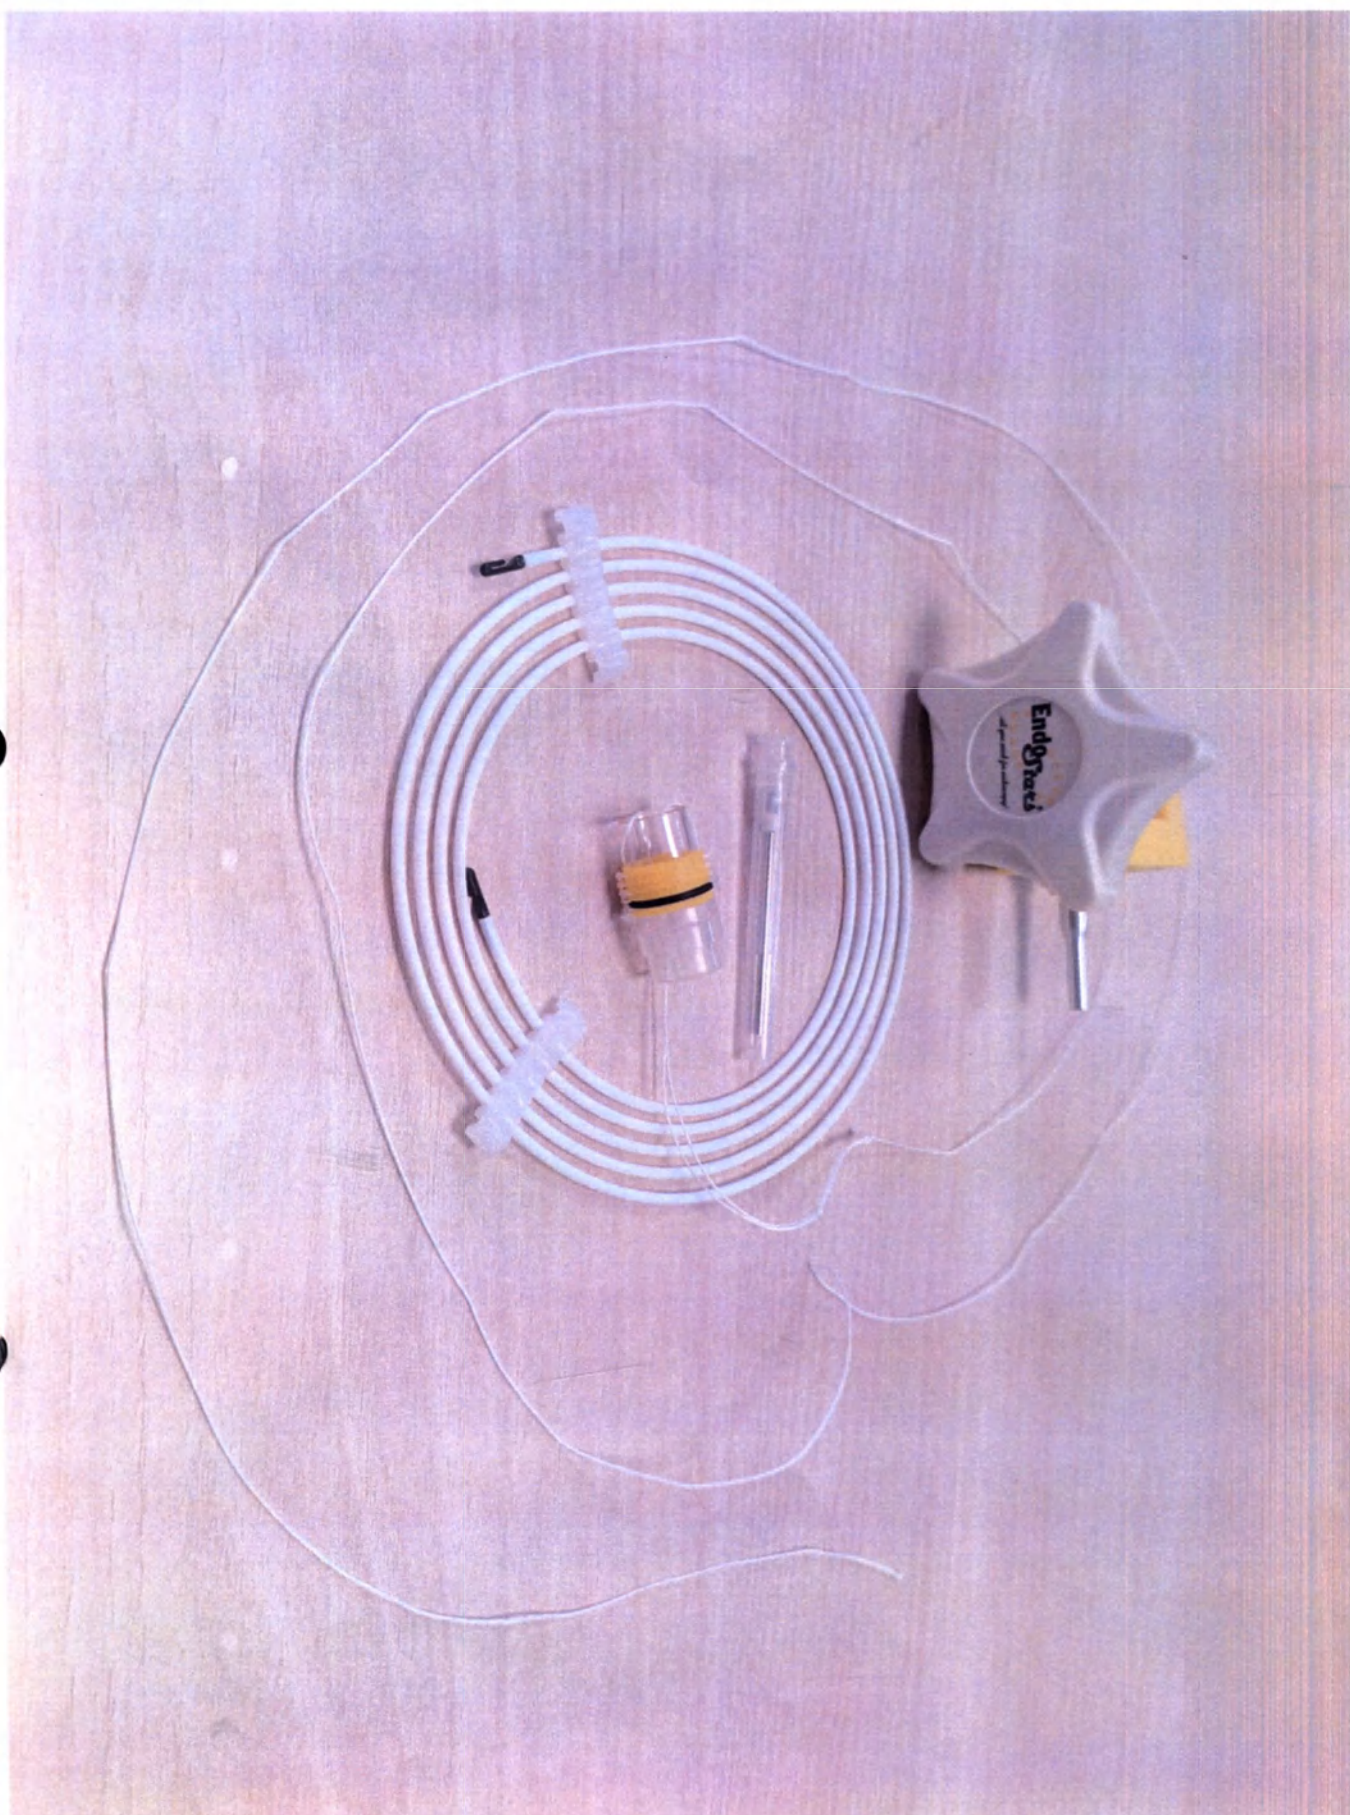

Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-226-89134710-2022 (Артикул: L007.1).

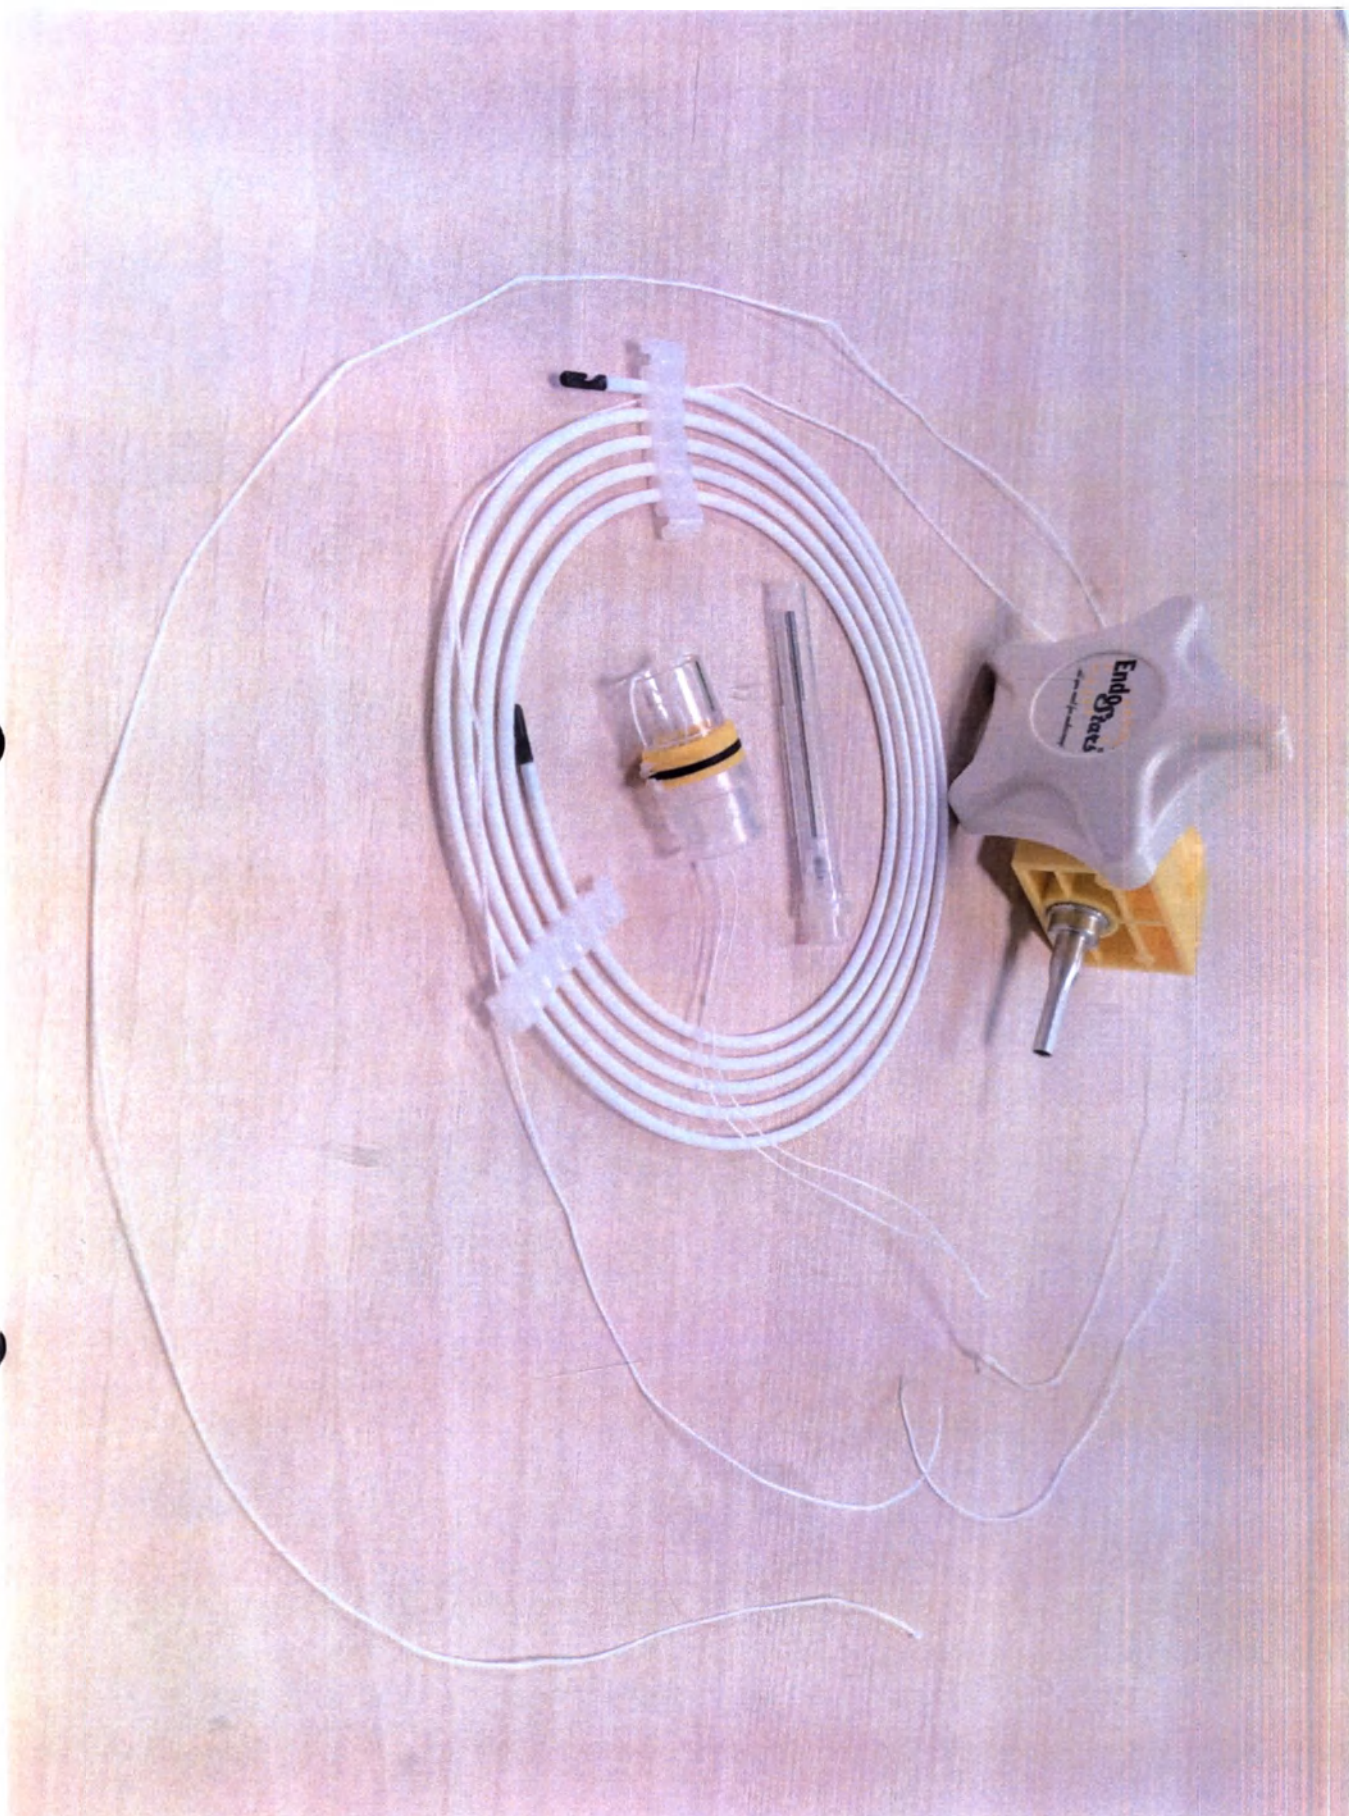

Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-226-89134710-2022 (Артикул: L004.1).

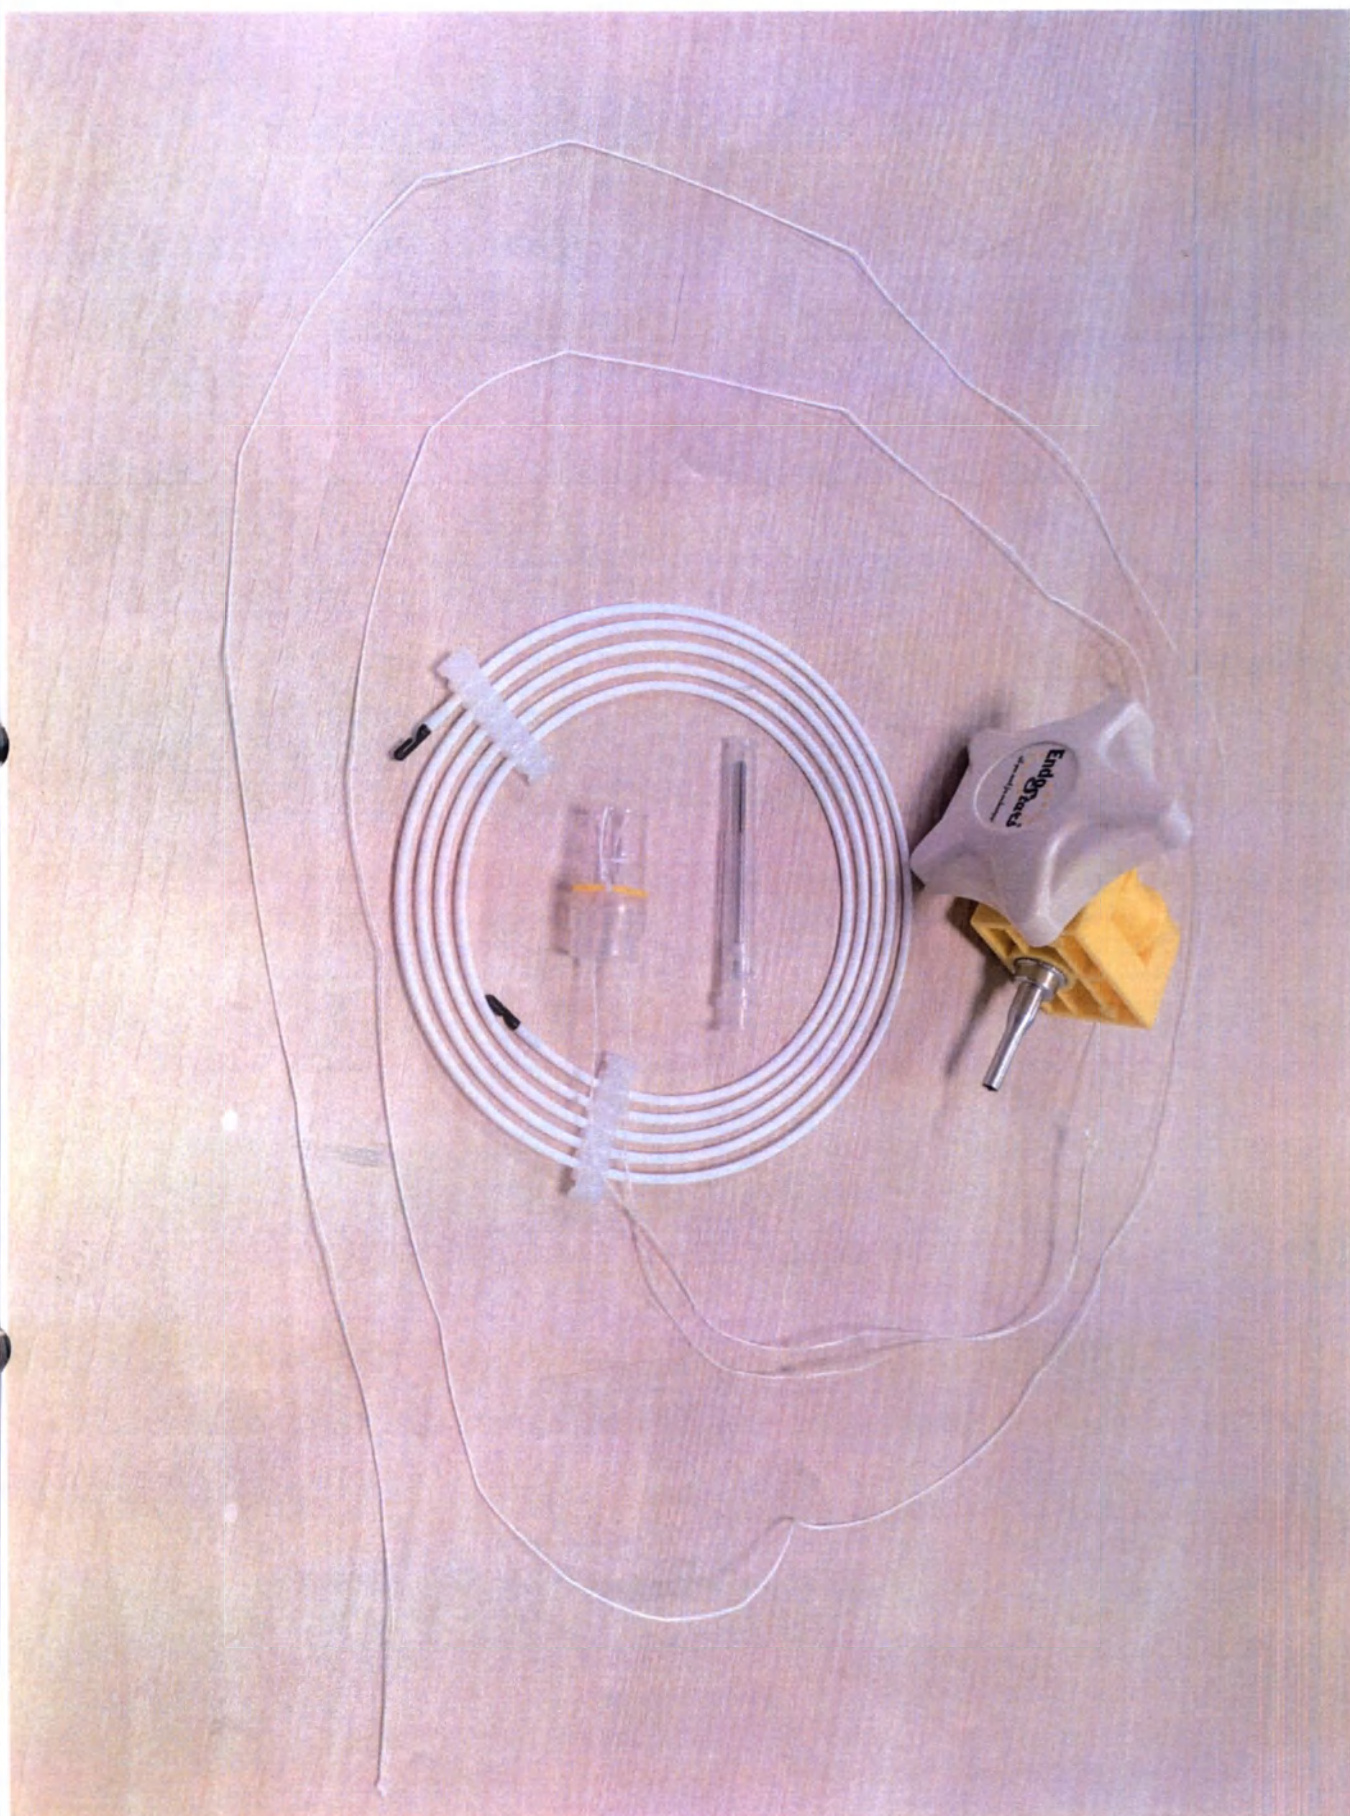


Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-226-89134710-2022 (Артикул: L001.1).

8 (800) 555-56-57

ЛИГАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ

Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по
ТУ 32.50.13-276-89134710-2022, РЗН XXXX/XXXXX от XX XX XXXX г

7 установленных
колец



REF L007.1

2023-06

LOT 2306035146N

2024-11

СДЕЛАНО
В РОССИИ

STERILE EO



L007.1

ООО "Эндо Старс" (Россия)
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.27А, 12Н
тел.: 8(800)555-56-57, 8(812)800-25-28; e-mail: info@endo-stars.ru; www.endo-stars.ru

EndoStars®

...all you need for endoscopy!

Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-226-89134710-2022 (Пример маркировки).




Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-226-89134710-2022 (Клапан биопсийный, для эндоскопов Pentax).



Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-226-89134710-2022 (Клапан биопсийный, для эндоскопов Olympus, Fujinon).



Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-226-89134710-2022 (Пример стерильной упаковки)

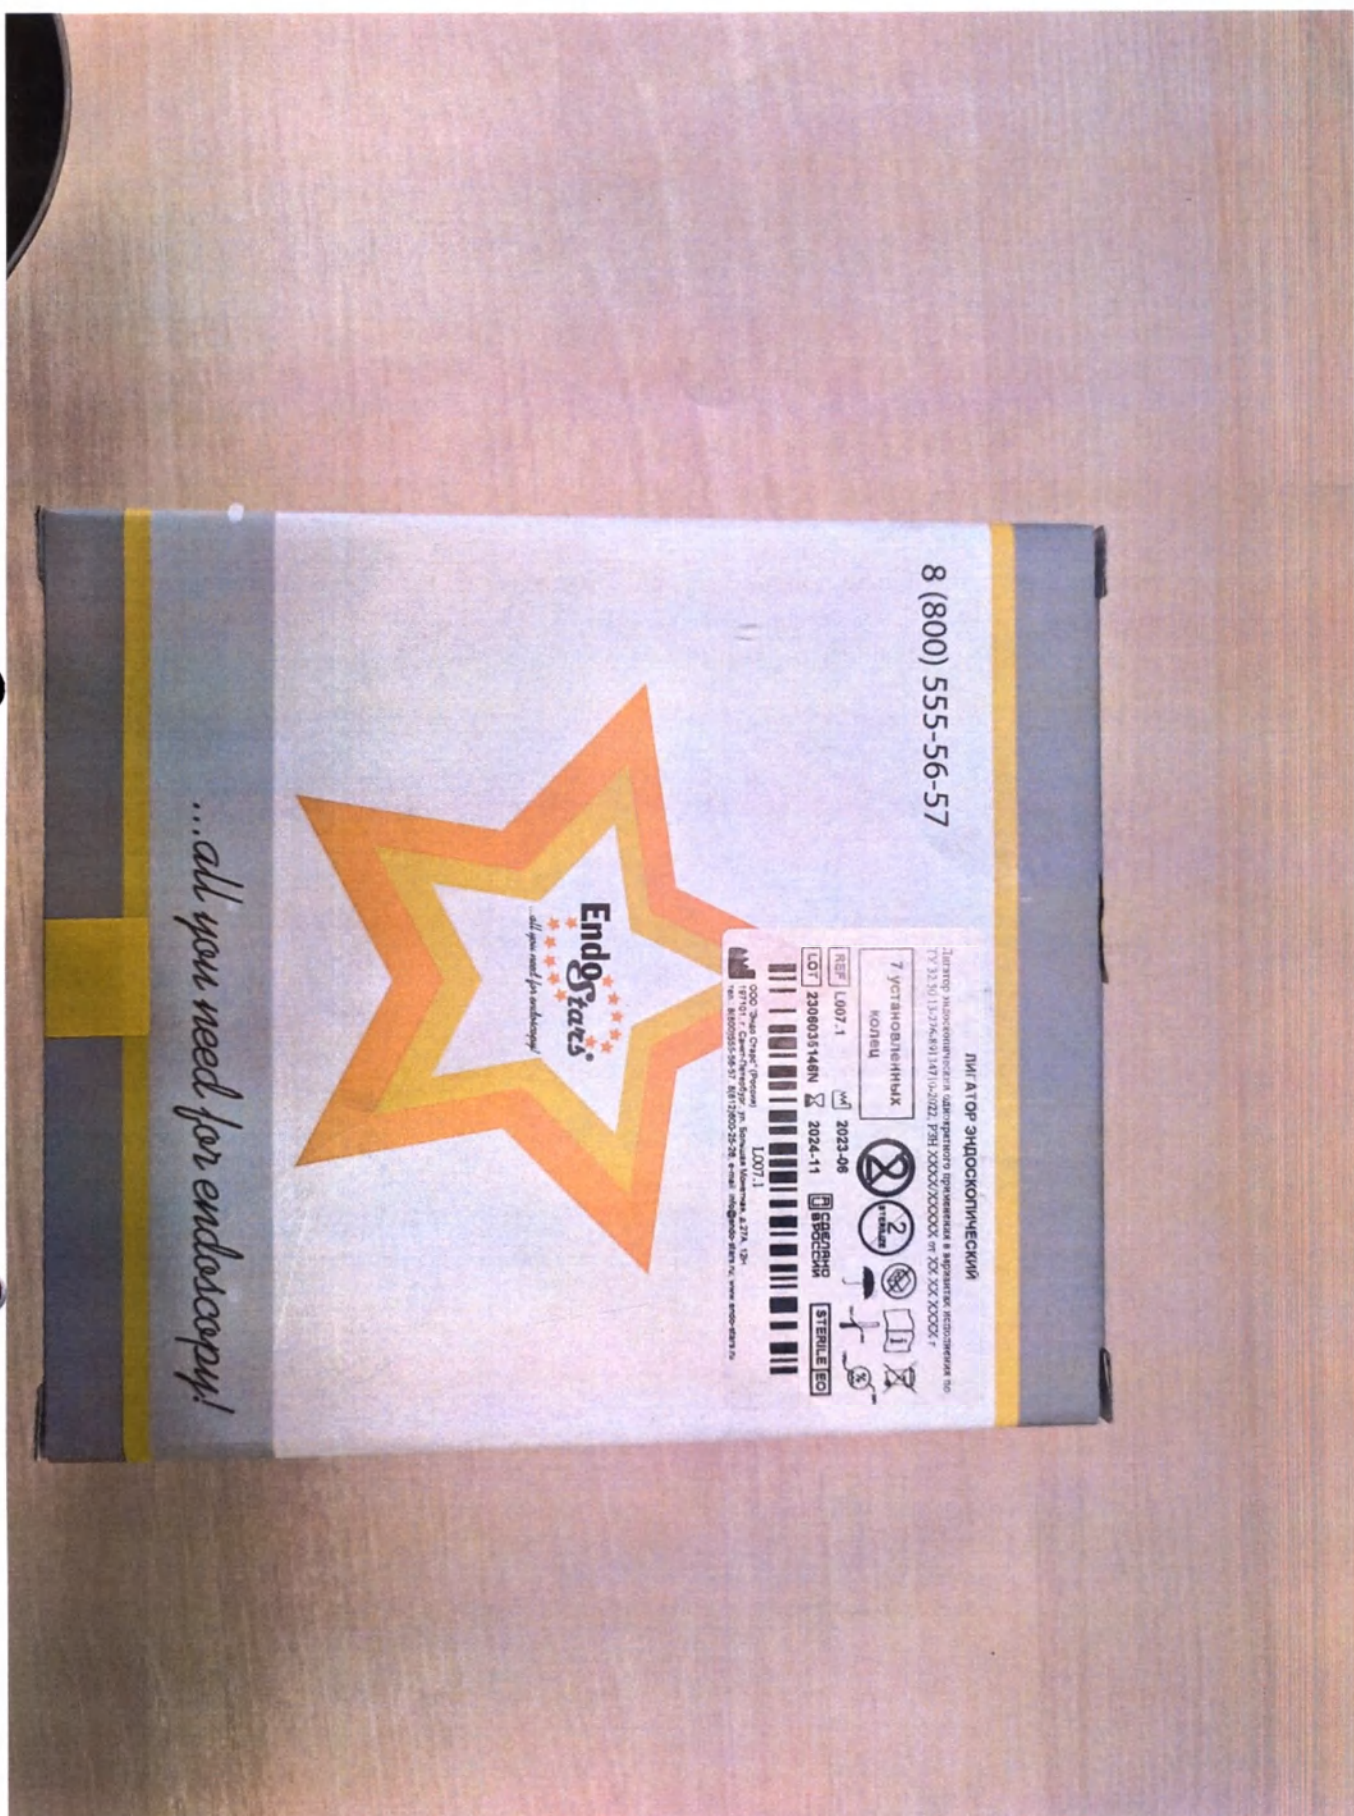

Лигатор эндоскопический однократного применения в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13–226–89134710–2022 (Пример упаковки)

11
ООО «Эндо Старт»

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью

девятого 3 листа(ов)
Генеральный директор
Самарец В.С.

