

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к Helicobacter pylori
(MAGLUMI[®] H. pylori IgG (CLIA)),
методом иммунохемилюминесцентного анализа
на автоматических анализаторах MAGLUMI[®],
в вариантах исполнения***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КПС»




Смирнов Э.А.


2023 г.

***Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к Helicobacter pylori
(MAGLUMI[®] H. pylori IgG (CLIA)),
методом иммунохемилюминесцентного анализа
на автоматических анализаторах MAGLUMI[®],
в вариантах исполнения***

Вариант исполнения 1


***Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к Helicobacter pylori
(MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)),
методом иммунохемилюминесцентного анализа
на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 30 тестов***

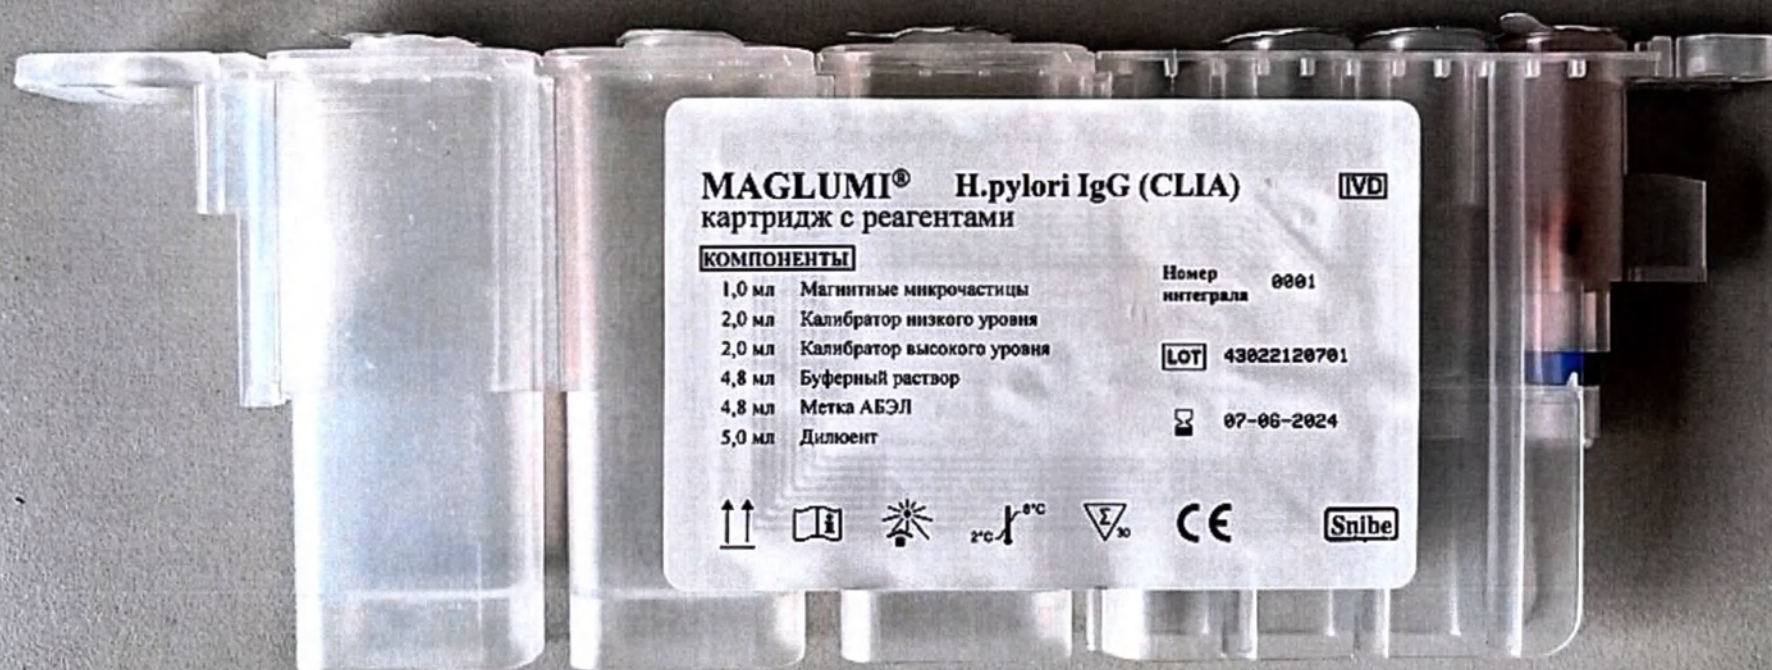

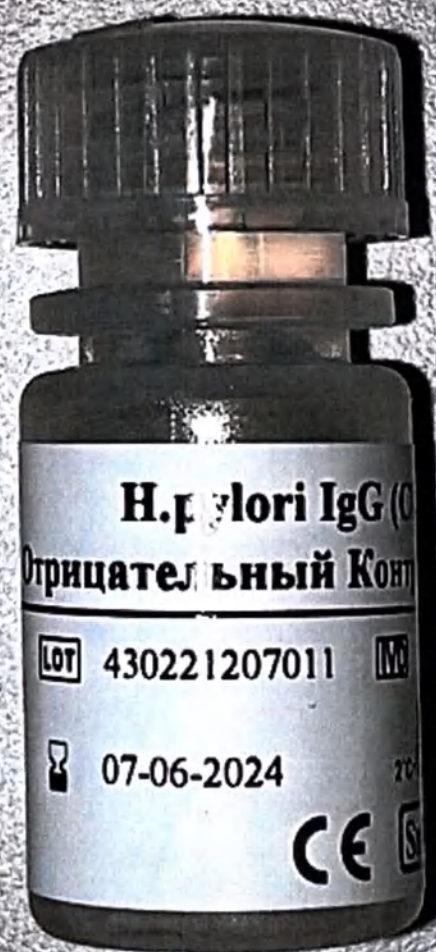





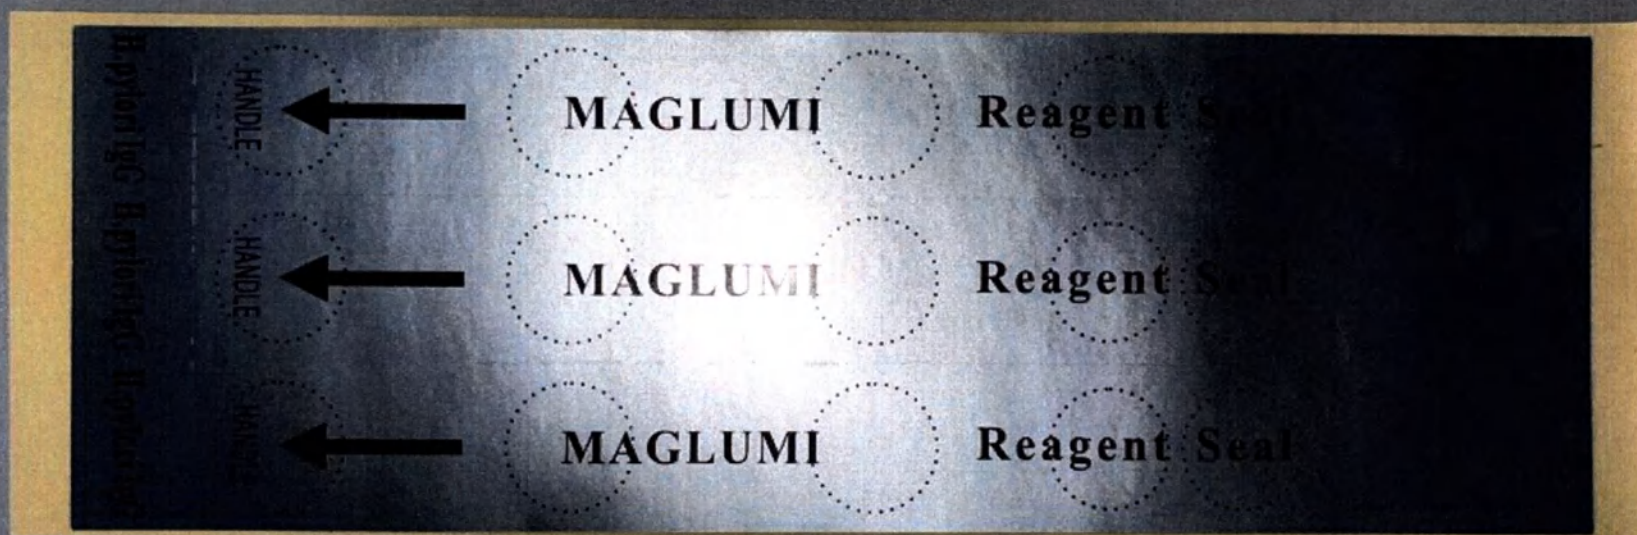



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2

CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

Inspection Completed & Approved
For Release

Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.

PLAZMA VEGETATION

Набір реактивів in vitro для кількісного визначення антитіл класу IgG у *Helicobacter pylori* у сироватці і інших органах людини на аналізаторі MAGNUM®. Результати дослідження призначені для діагностики інфекцій, викликаних *Helicobacter pylori* у людей, в комбинації з іншими клінічними і лабораторними даними.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

[illegible]

Присутствие *H. pylori* было обнаружено с использованием как инвизивных, так и неинвазивных методов. Инвазивные методы включают гистоскопию, гистологию и экспресс-тест на уреазу, проводимые на образцах тканей⁴. Многие серологические тесты, в основном на основе иммуноглобулинов G (IgG), были подтверждены с инвазивными методами. Уровни антител IgG к *H. pylori* обычно повышены и могут влиять на использование специфических антител для маркеров инфекции *H. pylori*⁵. Тест на антитела IgA является хорошим и надежным тестом для выявления антител к *H. pylori* и как признак инфекции *H. pylori*. Определенные антитела IgA к сыноватому могут быть использованы в качестве теста, который доказывает тест на антитела IgG⁶.

PRESENTI A PAG. 102

Стандарт-метод вычисления коэффициента потерь

Образцы, буфер, матричные поликарбонаты, покрытые нитридом Н-рубина, тщательно перемешивают, инкубируют и выщелачивают цинк при помощи фосла осаждаемого в матричных пленках. Затем добавляют метил АЭОЛ и выщелачивают ион Hg^{2+} раствором, реагирующим с образцовыми соединениями цинка и инкубируют. После осадившегося в матричных пленках нитридом Н-рубина жидкость сливают, и затем проводят такой процесс. Последующим добавляют стирол 142 для полимеризации комплексно-ионного раствора. Световой сигнал является флуоресценцией в отстоявшихся составных единицах (RLU), которые пропорциональны концентрации N. rubini Hg^{2+} присутствующий в образце.

СОСТАВ ЖЕЛЕЗЫ

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения титров класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохемилуминесцентного анализа на оптимизированной платформе MAGLUMI®, в формате планшетной системы.

Восстановление исторической памяти

Набор реагентов в виде для количественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохимическо-моллекулярного анализа на автоматическом анализаторе MAGLUMI®, 30 тестов, в комплекте

Картриджи с реагентами	1 шт.
Оценочный контроль	2,0 мл
Положительный контроль	2,0 мл

DOI: 10.1002/eqe.2003-09

KIMBLE, 1968, p. 17, 4750.

430 H. *et al.* / *Journal of Great Lakes Research* 36 (2010) 425–434

Показательный контроль 2

Положительный контроль 2	2,0 мин
Лента для записываемого картриджа с рингсетом	3 шт
Наклейки со внутри-кодами для отрицательного контроля	4 шт
Наклейки со внутри-кодами для положительного контроля 1	4 шт
Наклейки со внутри-кодами для положительного контроля 2	4 шт
Сертификат оценки контроля производителя	1 шт
Инструменты по применению	1 шт

Вариант № 2

Набор предназначен *in vitro* для качественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® IL *pylori* IgG (CLIA)), с помощью иммунохроматографического анализа на иммунохимических мембранах MAGLUMI®, 50 тестов, в составе:

Контроль за реактивом	1 мин
Структурный контроль	2 мин
Помеховый контроль 1	2,5 мин
Помеховый контроль 2	2,5 мин
Лента для многоканальной записи за реактивом	3 мин
Накладной со штрих-кодом для структурного контроля	4 мин
Накладной со штрих-кодом для помехового контроля 1	4 мин
Накладной со штрих-кодом для помехового контроля 2	4 мин
Сертификат отчета контроля производителя	1 мин
Сортировка по количеству	1 мин

РАСЧЕТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 3

Набор реактивов in vitro для количественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® IL *pylori* IgG (CLIA)), методом иммунохемилуминесцентного анализа на автоматизированных анализаторах MAGLUMI®, 100 тестов, в составе:

Контроль с реактивом	1 шт
Отрицательный контроль	2,0
Положительный контроль 1	2,0
Положительный контроль 2	2,0
Лента для электрохимического контроля с реактивом	3 шт
Надпись со штрих-кодом для отрицательного контроля	4 шт
Надпись со штрих-кодом для положительного контроля 1	4 шт
Надпись со штрих-кодом для положительного контроля 2	4 шт
Сертификат анализа контроля производителя	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

КОМПОНЕНТЫ КАБОРА

Компоненты раствора		Система	100 тестов	50 тестов	30 тестов
Кальций с фосфором	Компонент	Магнитные концентраты, активирован <i>H. pylori</i> (-4,00 мкг/мл) в буфере PBS, NaH ₂ PO ₄ (<0,1%)	2,5 мкс	2,0 мкс	1,0 мкс
	Кальций	Низкая активация <i>H. pylori</i> IgG в буфере PBS, NaH ₂ PO ₄ (<0,1%)	2,5 мкс	2,0 мкс	2,0 мкс
	Кальций	Высокая активация <i>H. pylori</i> IgG в буфере PBS, NaH ₂ PO ₄ (<0,1%)	2,5 мкс	2,0 мкс	2,0 мкс
	Фосфор	BSA, NaH ₂ PO ₄ (<0,1%)	12,5 мкс	7,5 мкс	4,0 мкс
	Матрица АБЭЛ	Матрица АБЭЛ с активирован IgG (матрица) (-20,0 мкг/мл) в буфере Tris-HCl, NaH ₂ PO ₄ (<0,1%)	12,5 мкс	7,5 мкс	4,0 мкс
	Диссоциант	0,9% NaCl	15,0 мкс	10,0 мкс	5,0 мкс
	Относительный	Буфер PBS, NaH ₂ PO ₄ (<0,1%)	2,0 мкс	2,0 мкс	2,0 мкс

430 H. J. Janssen et al.

200

MAGLUMI®

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	2,0 мл
Положительный контроль 1	2,0 мл
Положительный контроль 2	2,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 1	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 2	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

REF 130701521M

LOT 43022120701

 07-06-2024


P3H P3H XXXX/XXXXXX



Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный
представитель
по РФ

ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597



Для профессионального применения

Snibe
Diagnostic

MAGLUMI®

H. pylori IgG

REF

130701521M

LOT

43022120701



07-06-2024



01

MAGLUMI®

СОСТАВ

Картридж с реагентами

Отрицательный контроль

Положительный контроль 1

Положительный контроль 2

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля

Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 1

Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 2

Сертификат отдела контроля производителя

Инструкция по применению



Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.

№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,

518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный
представитель
по РФ

ООО «КЛС» (LLC CLS),

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58

Тел.: +7-495-9469597

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD

1 шт.

2,0 мл

2,0 мл

2,0 мл

3 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

REF

130701521M

LOT

43022120701



07-06-2024

P3H

P3H XXXX/XXXXXX



8°C

2°C





CE

Для профессионального применения

Вариант исполнения 2


***Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к Helicobacter pylori
(MAGLUMI[®] H. pylori IgG (CLIA)),
методом иммунохемилюминесцентного анализа
на автоматических анализаторах MAGLUMI[®], 50 тестов***

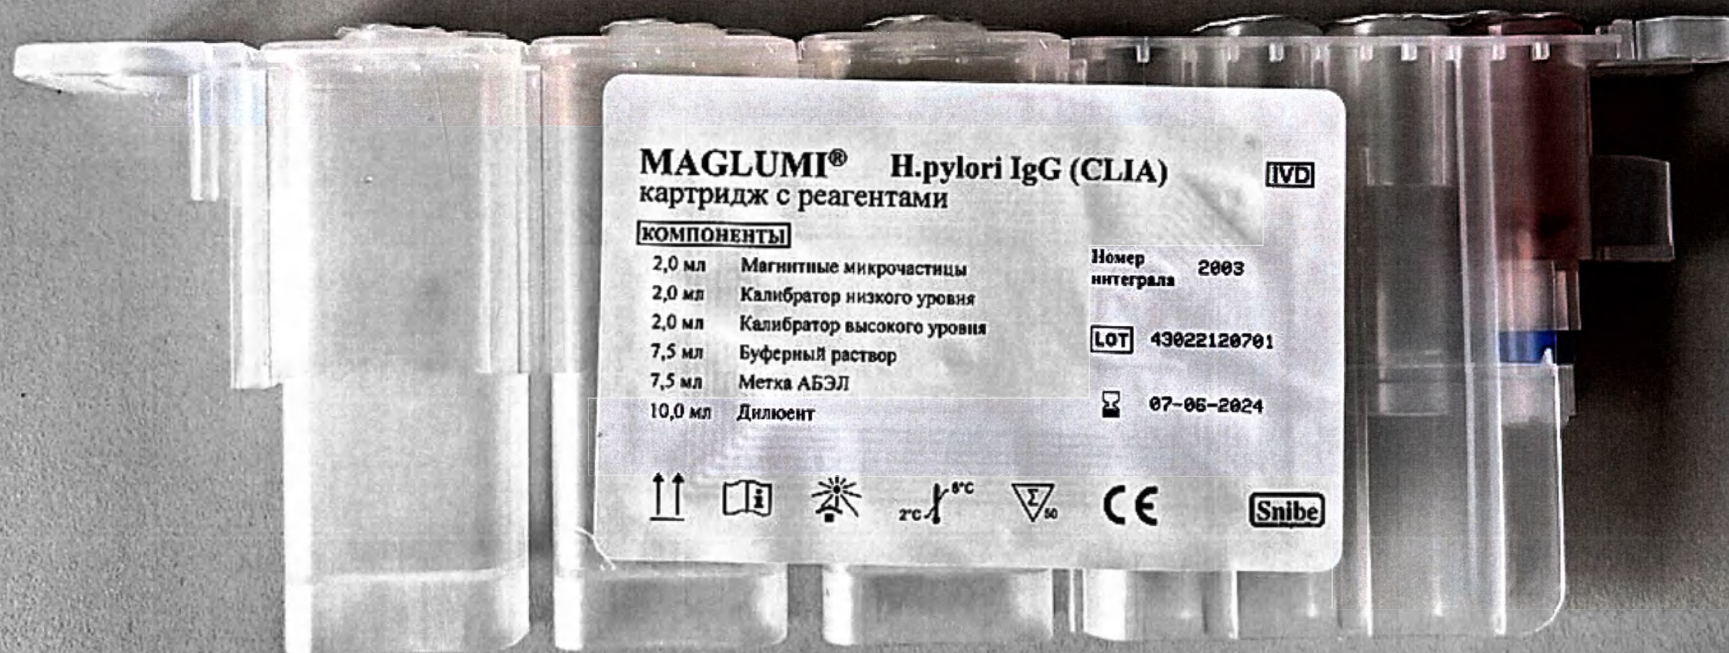

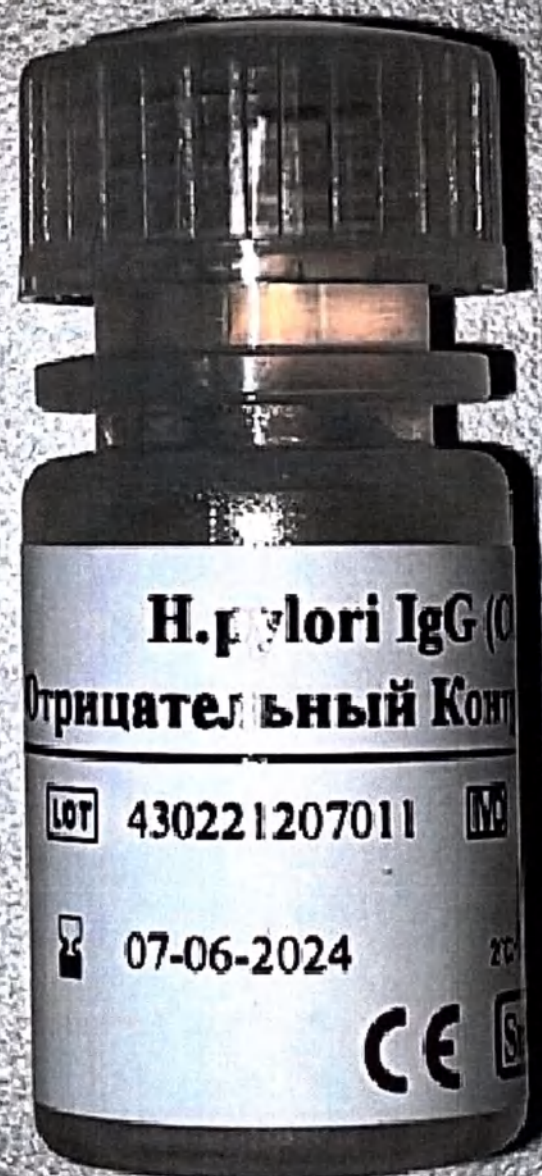





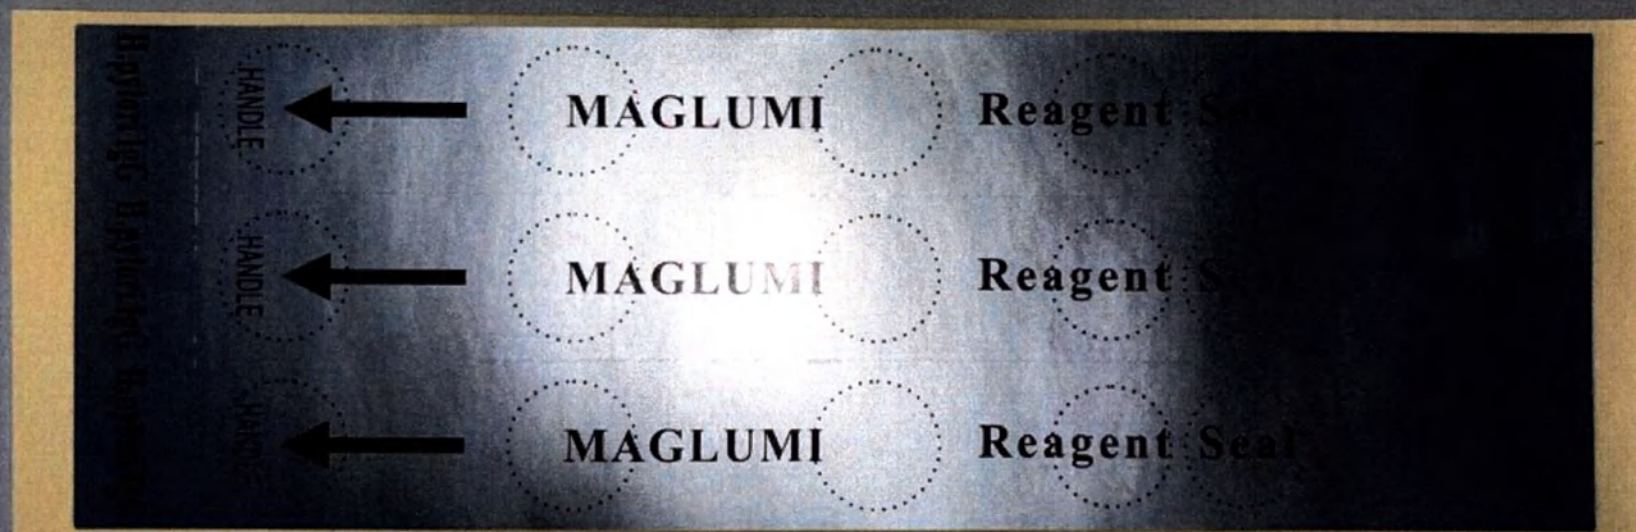



#430221207011#

H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#

H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#

H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#

H.pylori IgG Negative Control



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#
H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2

CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Completed & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**

Надоно препаративно в vitro дано известностно соопштение авторот којане леги и Hesth-bacter pph (MAGLINT® H, pph) лег (CULM), известноа магистратскаа магистратскаа анализа на магистратскаа магистратскаа MAGLINT®, а магистратскаа магистратскаа

CASTLE VINTAGE

[illegible]

НАТКОЕ ОДИНАКОВЕ АНАТОМ

[illegible]

Применение *Н. р. р.* было обобщено с использованием как индикатора, так и индикатора действия. В настоящее время *Н. р. р.* используется в агроэкологии на практике, применяясь на объектах биосферы. В настоящее время *Н. р. р.* используется в агроэкологии на практике, применяясь на объектах биосферы. В настоящее время *Н. р. р.* используется в агроэкологии на практике, применяясь на объектах биосферы.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

[illegible]

COCTA **INDUSTRIES**

Podany preparat jest w tym celu przeznaczony szczególnie dla pacjentów z nadciśnieniem tętna i nadciśnieniem tętna. **MACLINET** jest preparatem, który jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętna. **MACLINET** jest preparatem, który jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętna.

Важнейшие результаты

[illegible]

Крыжакі з прэстыжам
Організмаматэрыялы
Тэмаграфічныя матэрыялы

4000 N. 10th Ave., Suite 100
 Minneapolis, MN 55412
 Tel: 612-338-1111
 Fax: 612-338-1112
 Email: info@minneapolisfed.org

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

Другие источники

[illegible]

Reptiles and amphibians

Уровень развития территории	Плотность населения	Плотность населения	Плотность населения
1	21	22	23
2	24	25	26
3	27	28	29
4	30	31	32
5	33	34	35
6	36	37	38
7	39	40	41
8	42	43	44
9	45	46	47
10	48	49	50
11	51	52	53
12	54	55	56
13	57	58	59
14	60	61	62
15	63	64	65
16	66	67	68
17	69	70	71
18	72	73	74
19	75	76	77
20	78	79	80
21	81	82	83
22	84	85	86
23	87	88	89
24	90	91	92
25	93	94	95
26	96	97	98
27	99	100	101
28	102	103	104
29	105	106	107
30	108	109	110
31	111	112	113
32	114	115	116
33	117	118	119
34	120	121	122
35	123	124	125
36	126	127	128
37	129	130	131
38	132	133	134
39	135	136	137
40	138	139	140
41	141	142	143
42	144	145	146
43	147	148	149
44	150	151	152
45	153	154	155
46	156	157	158
47	159	160	161
48	162	163	164
49	165	166	167
50	168	169	170
51	171	172	173
52	174	175	176
53	177	178	179
54	180	181	182
55	183	184	185
56	186	187	188
57	189	190	191
58	192	193	194
59	195	196	197
60	198	199	200
61	201	202	203
62	204	205	206
63	207	208	209
64	210	211	212
65	213	214	215
66	216	217	218
67	219	220	221
68	222	223	224
69	225	226	227
70	228	229	230
71	231	232	233
72	234	235	236
73	237	238	239
74	240	241	242
75	243	244	245
76	246	247	248
77	249	250	251
78	252	253	254
79	255	256	257
80	258	259	260
81	261	262	263
82	264	265	266
83	267	268	269
84	270	271	272
85	273	274	275
86	276	277	278
87	279	280	281
88	282	283	284
89	285	286	287
90	288	289	290
91	291	292	293
92	294	295	296
93	297	298	299
94	300	301	302
95	303	304	305
96	306	307	308
97	309	310	311
98	312	313	314

Максимум со временем

Средства отъема имущества

...on the other hand, the

Важнейшие результаты

[illegible]

Одговарајуће је познати

Организационный менеджмент
Персональный менеджмент 1
Психологический менеджмент 2

Начебъи едъи нъиъи

Начинаю со второго вопроса для рассмотрения вопроса 1
Начинаю со второго вопроса для рассмотрения вопроса 2

Many women are injured

КОМПОНЕНТЫ РАБОТА

Marketing

Классификация	металлический сплав (Fe, 0,00 мас.%) и Fe-0,00 мас.%
Химический состав	Fe, 0,00 мас.%

Kenneth J. Ryan

Electrode	PBS, NaOH (eq. 10)
Reference	PBS, NaOH (eq. 10)

1541

Medium A (50 ml)	medium A (50 ml) + 100 mg/ml (100 mg/ml)
Resistant	0.9% NaCl

100

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible][illegible]

4

MAGLUMI®

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	2,0 мл
Положительный контроль 1	2,0 мл
Положительный контроль 2	2,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 1	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 2	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

REF 130601521M

LOT 43022120701

 07-06-2024


P3H P3H XXXXX/XXXXXX



Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный
представитель
по РФ

ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597



Для профессионального применения

Snibe
Diagnostic

MAGLUMI®

H. pylori IgG

REF

130601521M

LOT

43022120701



07-06-2024



01

MAGLUMI®

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	2,0 мл
Положительный контроль 1	2,0 мл
Положительный контроль 2	2,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 1	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 2	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.



Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный представитель по РФ ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD

REF

130601521M

LOT

43022120701



07-06-2024

P3H

P3H XXXX/XXXXXX



2°C 8°C



CE

Для профессионального применения

Вариант исполнения 3


***Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к Helicobacter pylori
(MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)),
методом иммунохемилюминесцентного анализа
на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 100 тестов***









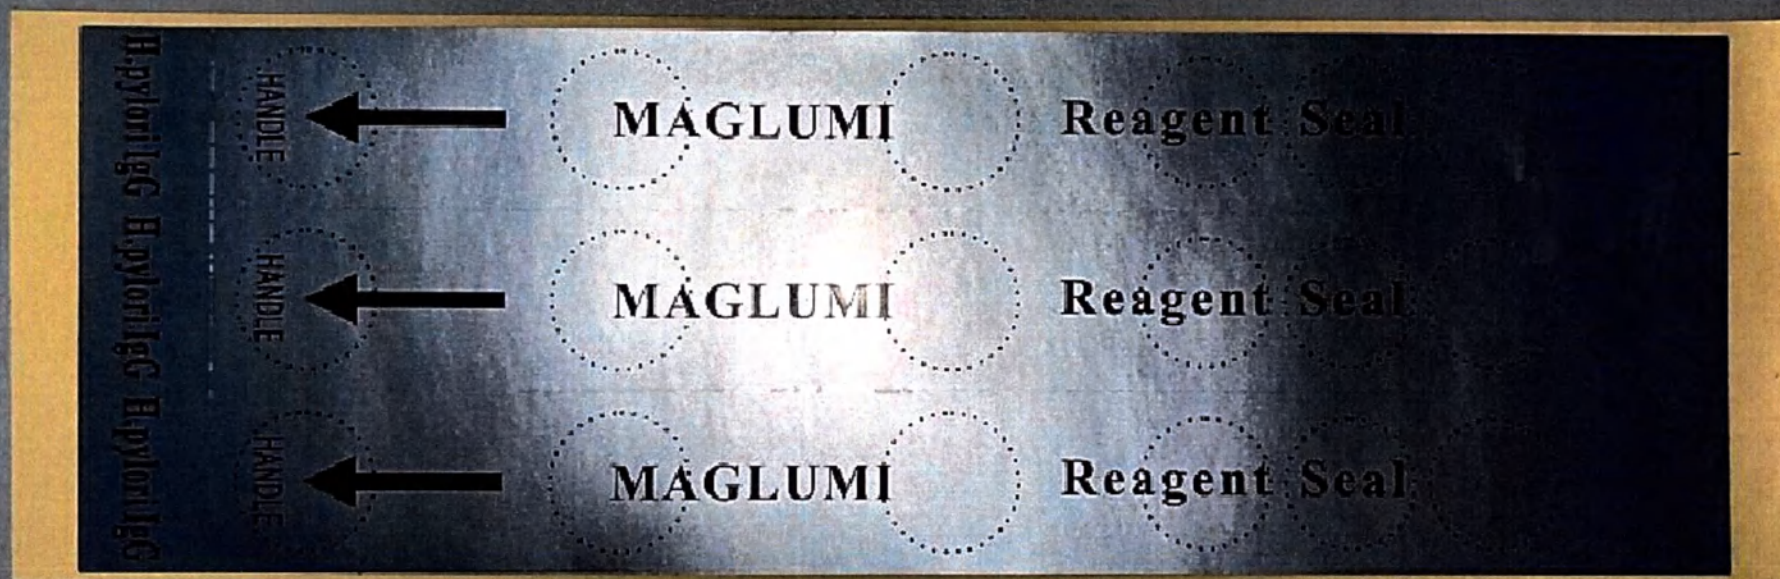



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207011#
H.pylori IgG Negative Control



#430221207012#

H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#

H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#

H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207012#

H.pylori IgG Positive Control 1



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2



#430221207013#
H.pylori IgG Positive Control 2

CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Completed & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130201 621M 100 meters
130201 621M 60 meters
130201 621M 50 meters

Полное решение задачи для нестационарного распространения источника I_0 в Пеллеловской плоти (MAGLUMAT II, $\rho = 1.27 \text{ г/см}^3$, $I_0 = 0$), начавшем двигаться из неподвижного состояния на расстоянии $z = 0$ от поверхности МАГЛУМАТ II, в моменте истечения

STUDIA WILEWIA

Набір реактивів та відео для кількісного опромінення антигена IgG + Haptobacter rufoi в експерименті на пацієнтах з ревматоїдним артритом, на пацієнтах з остеоартритом та на здорових волонтерах. Реактивом опромінення є препарат, який містить антиген Haptobacter rufoi у лійках, в комбінації з другими специфічними антитілами.

РАТНОЕ ОФИЦИАНТСТВО

Творческие способности и творчество — это не врожденное свойство, а приобретенный навык. Творчество — это способность находить новые решения старых проблем. Творчество — это способность видеть возможности там, где другие видят трудности. Творчество — это способность создавать что-то новое из ничего. Творчество — это способность мыслить нестандартно. Творчество — это способность видеть красоту в простом. Творчество — это способность находить радость в творчестве. Творчество — это способность создавать мир, в котором хочется жить. Творчество — это способность видеть мир таким, каким он есть, и при этом видеть возможности для его улучшения. Творчество — это способность создавать что-то новое, что приносит радость и пользу другим людям. Творчество — это способность видеть мир таким, каким он есть, и при этом видеть возможности для его улучшения. Творчество — это способность создавать что-то новое, что приносит радость и пользу другим людям.

[illegible]

DEFINITION 1

Важнейшим из них является исследование влияния температуры на скорость протекания реакции. Для этого были проведены эксперименты при различных температурах. Результаты показали, что скорость реакции увеличивается с повышением температуры. Это объясняется тем, что при более высокой температуре увеличивается энергия молекул, что приводит к более частым и эффективным столкновениям. Кроме того, при более высокой температуре увеличивается концентрация активных центров на поверхности катализатора, что также способствует увеличению скорости реакции.

DISCLAIMER

1990-1991

Business Development

[illegible]

	1 шт.	2,0 шт	2,8 шт
Картон в упаковке			
Оформитель картон			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

0800-977-6677

www.merck.com

© 1994 by the American Psychological Association, 0893-3200/94/\$04.00 DOI: 10.1037/0893-3200.10.4.488

三

Площадь, кв. м	Возраст, лет
2,0 кв.	3 лет
3 кв.	4 кв.
4 кв.	4 кв.
4 кв.	4 кв.
1 кв.	1 кв.
1 кв.	1 кв.

[illegible]

Курение и алкоголь	1
Отравление свинцом	2
Отравление угарным газом	3
Психический стресс	4
Лекарства, взаимодействующие с растениями	5
Наличие на участке скотины для сельскохозяйственных нужд	6
Наличие на участке скотины для сельскохозяйственных нужд	7
Наличие на участке скотины для сельскохозяйственных нужд	8
Средства для уничтожения вредителей	9
Использование удобрений	10

[illegible][illegible]

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

[illegible]



Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохемилуминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®



COCTAB



Картридж с реагентами	1 шт.				
Отрицательный контроль	2,0 мл	REF	130201521M		
Положительный контроль 1	2,0 мл				
Положительный контроль 2	2,0 мл	LOT	43022120701		
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.				
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.		07-06-2024		
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 1	4 шт.				
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 2	4 шт.		XXXX/XXXXX		
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.				
Инструкция по применению	1 шт.				



Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740







Уполномоченный представитель по РФ

ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597

Для профессионального применения

MAGLUMI

H. pylori IgG

REF 130201521M

LOT 43022120701

07-06-2024

01

MAGLUMI

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	2,0 мл
Положительный контроль 1	2,0 мл
Положительный контроль 2	2,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 1	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля 2	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
 № 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
 518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
 Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный представитель по РФ: ООО «КЛС» (LLC CLS),
 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
 Тел.: +7-495-9469597

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к *Helicobacter pylori* (MAGLUMI® H. pylori IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD

REF 130201521M

LOT 43022120701

07-06-2024

P3H P3H XXXX/XXXXX

2°C 8°C

Σ 100

CE

Для профессионального применения

Всего прошнуровано и
скреплено 44 лист «об»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.

