

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorgc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@ooorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), прямой кончик, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@ooorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа BARNH, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа BARNH, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorgc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Bern, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Bern, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Bern, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Bern, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), - 5 шт./ уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Beig, эффективная длина 40 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Beig, эффективная длина 40 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Beig, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Beig, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа H1, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа H1, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Н1, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Н1, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM1, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM1, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для однократного использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM1, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM1, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@ooorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM2, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM2, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM2, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM2, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), - 5 шт./ уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-labeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM3, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SIM3, эффективная длина 100 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Алирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oootc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Chg B, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Chg B, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа C1, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа C1, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа C2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа C2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа C2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа C2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа МІК, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа МІК, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа MIK, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа MIK, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,035 дюйма (0,89 мм), - 5 шт./ уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SHK 1.0, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа SHK 1.0, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для однократного использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа RC2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа RC2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oortc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа RDC, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа RDC, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./ уп.;

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для одноразового использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorgc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней

Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Contra 2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), в составе:

- 1. Катетер ангиографический Imager II селективный, наружный диаметр 5F (1,70 мм), кончик типа Contra 2, эффективная длина 65 см, максимальный внешний диаметр совместимого проводника 0,038 дюйма (0,97 мм), - 5 шт./уп.;**
- 2. Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

Только для однократного использования

Стерильно

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней


ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
27 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Катетер ангиографический Imager II селективный, варианты исполнения

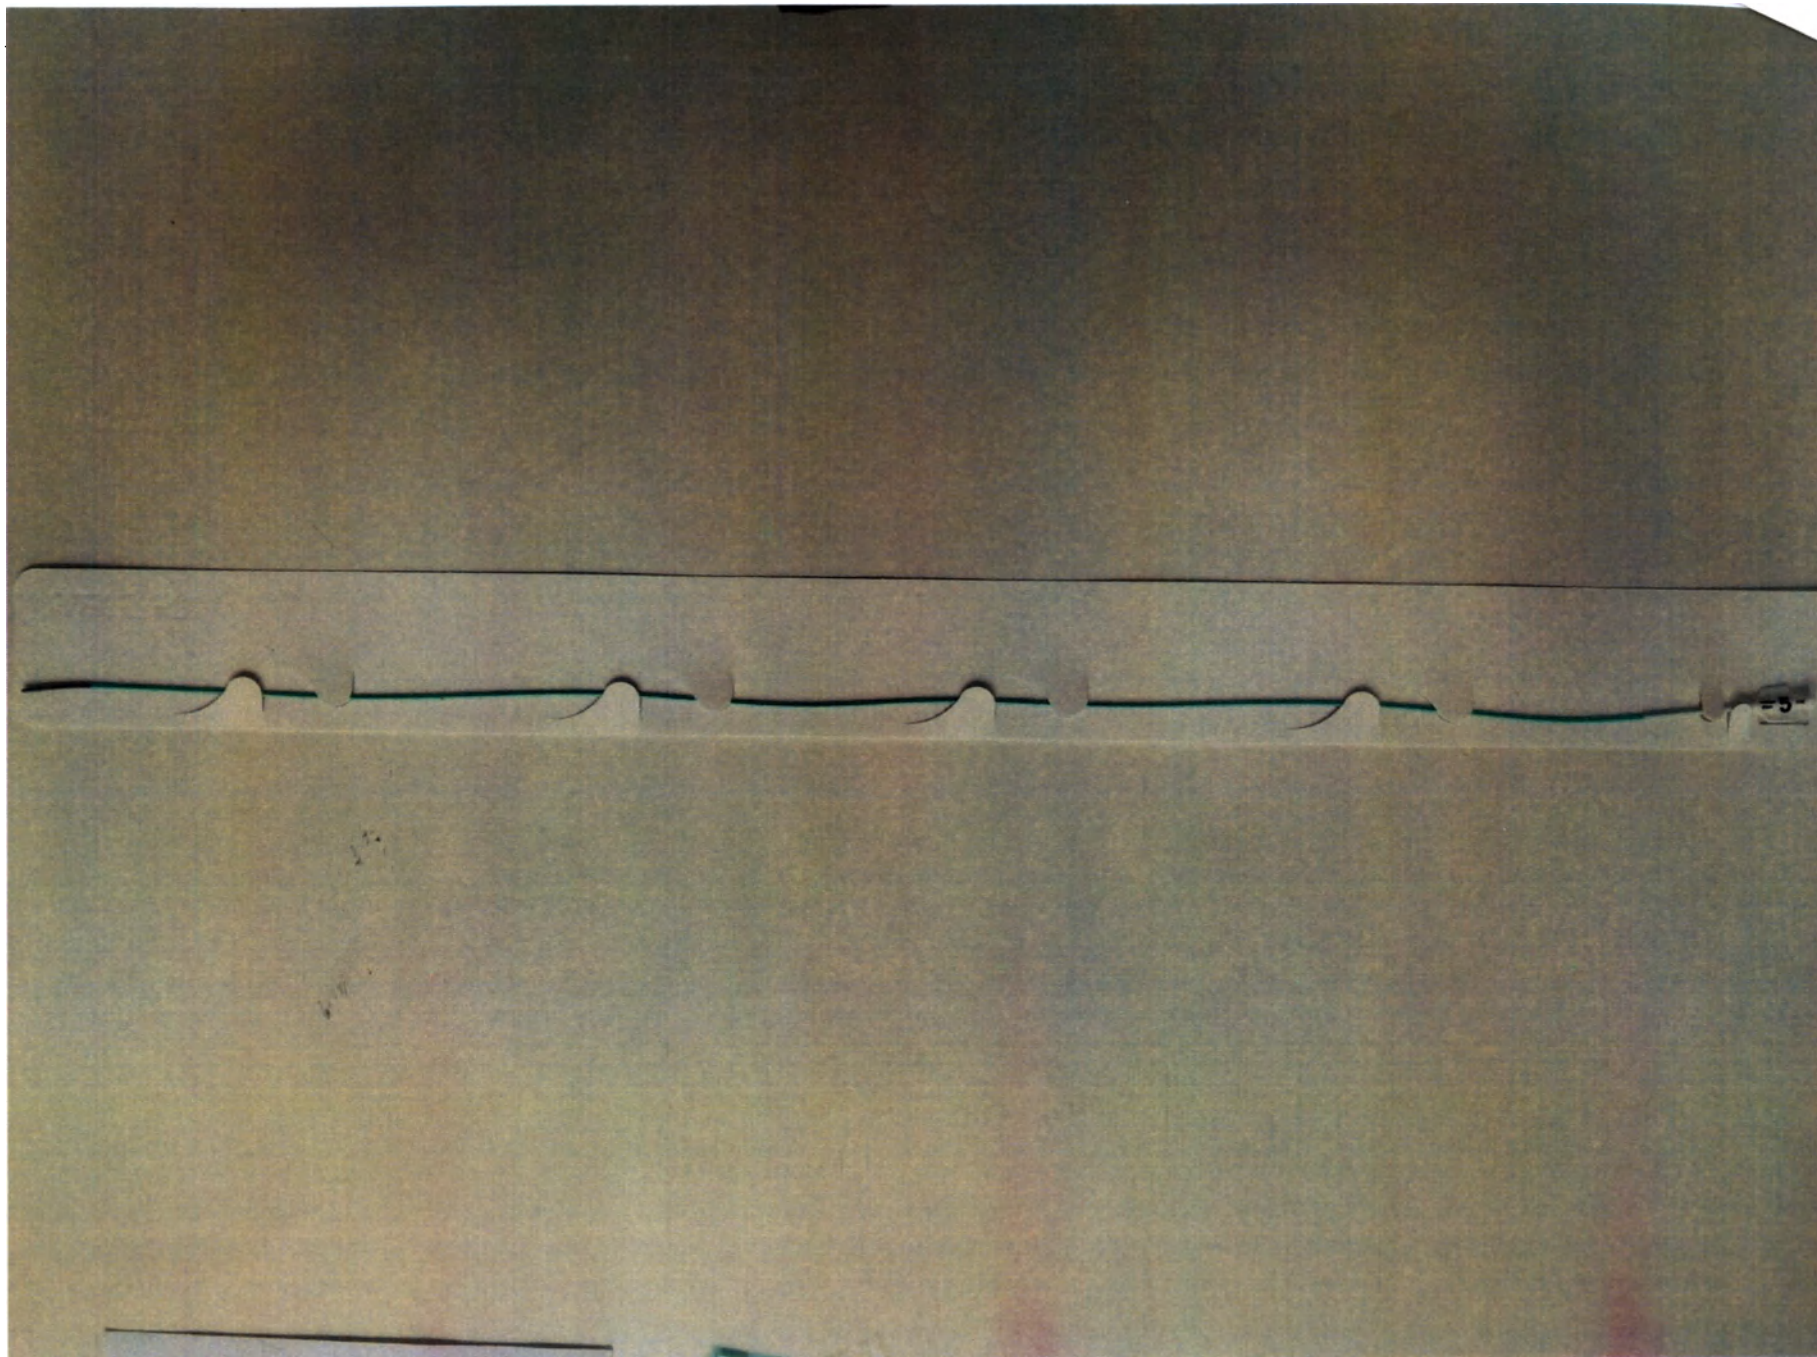


Катетер ангиографический Imager II селективный в упаковочной подложке

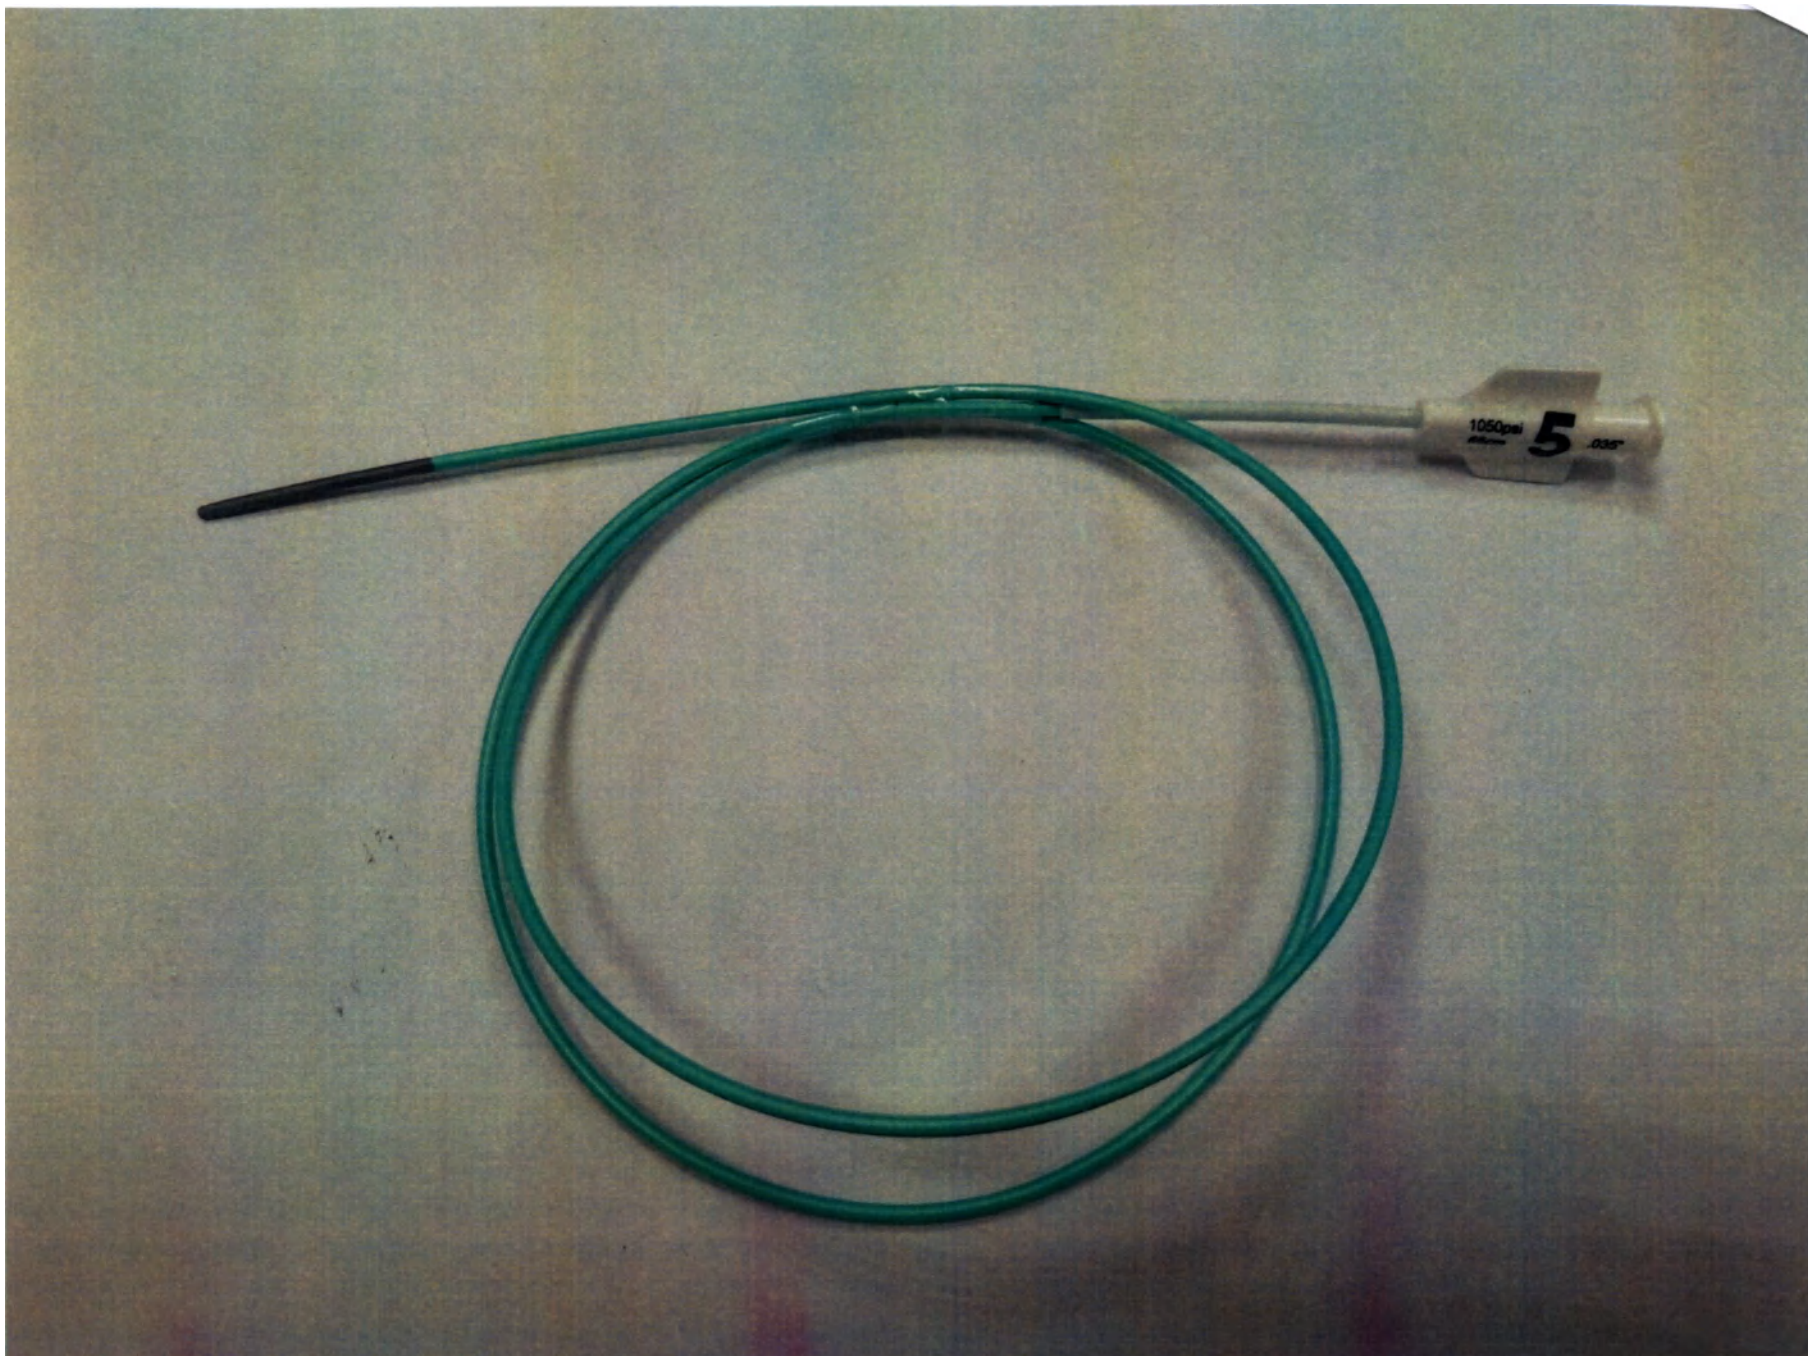


Катетер ангиографический Imager II селективный

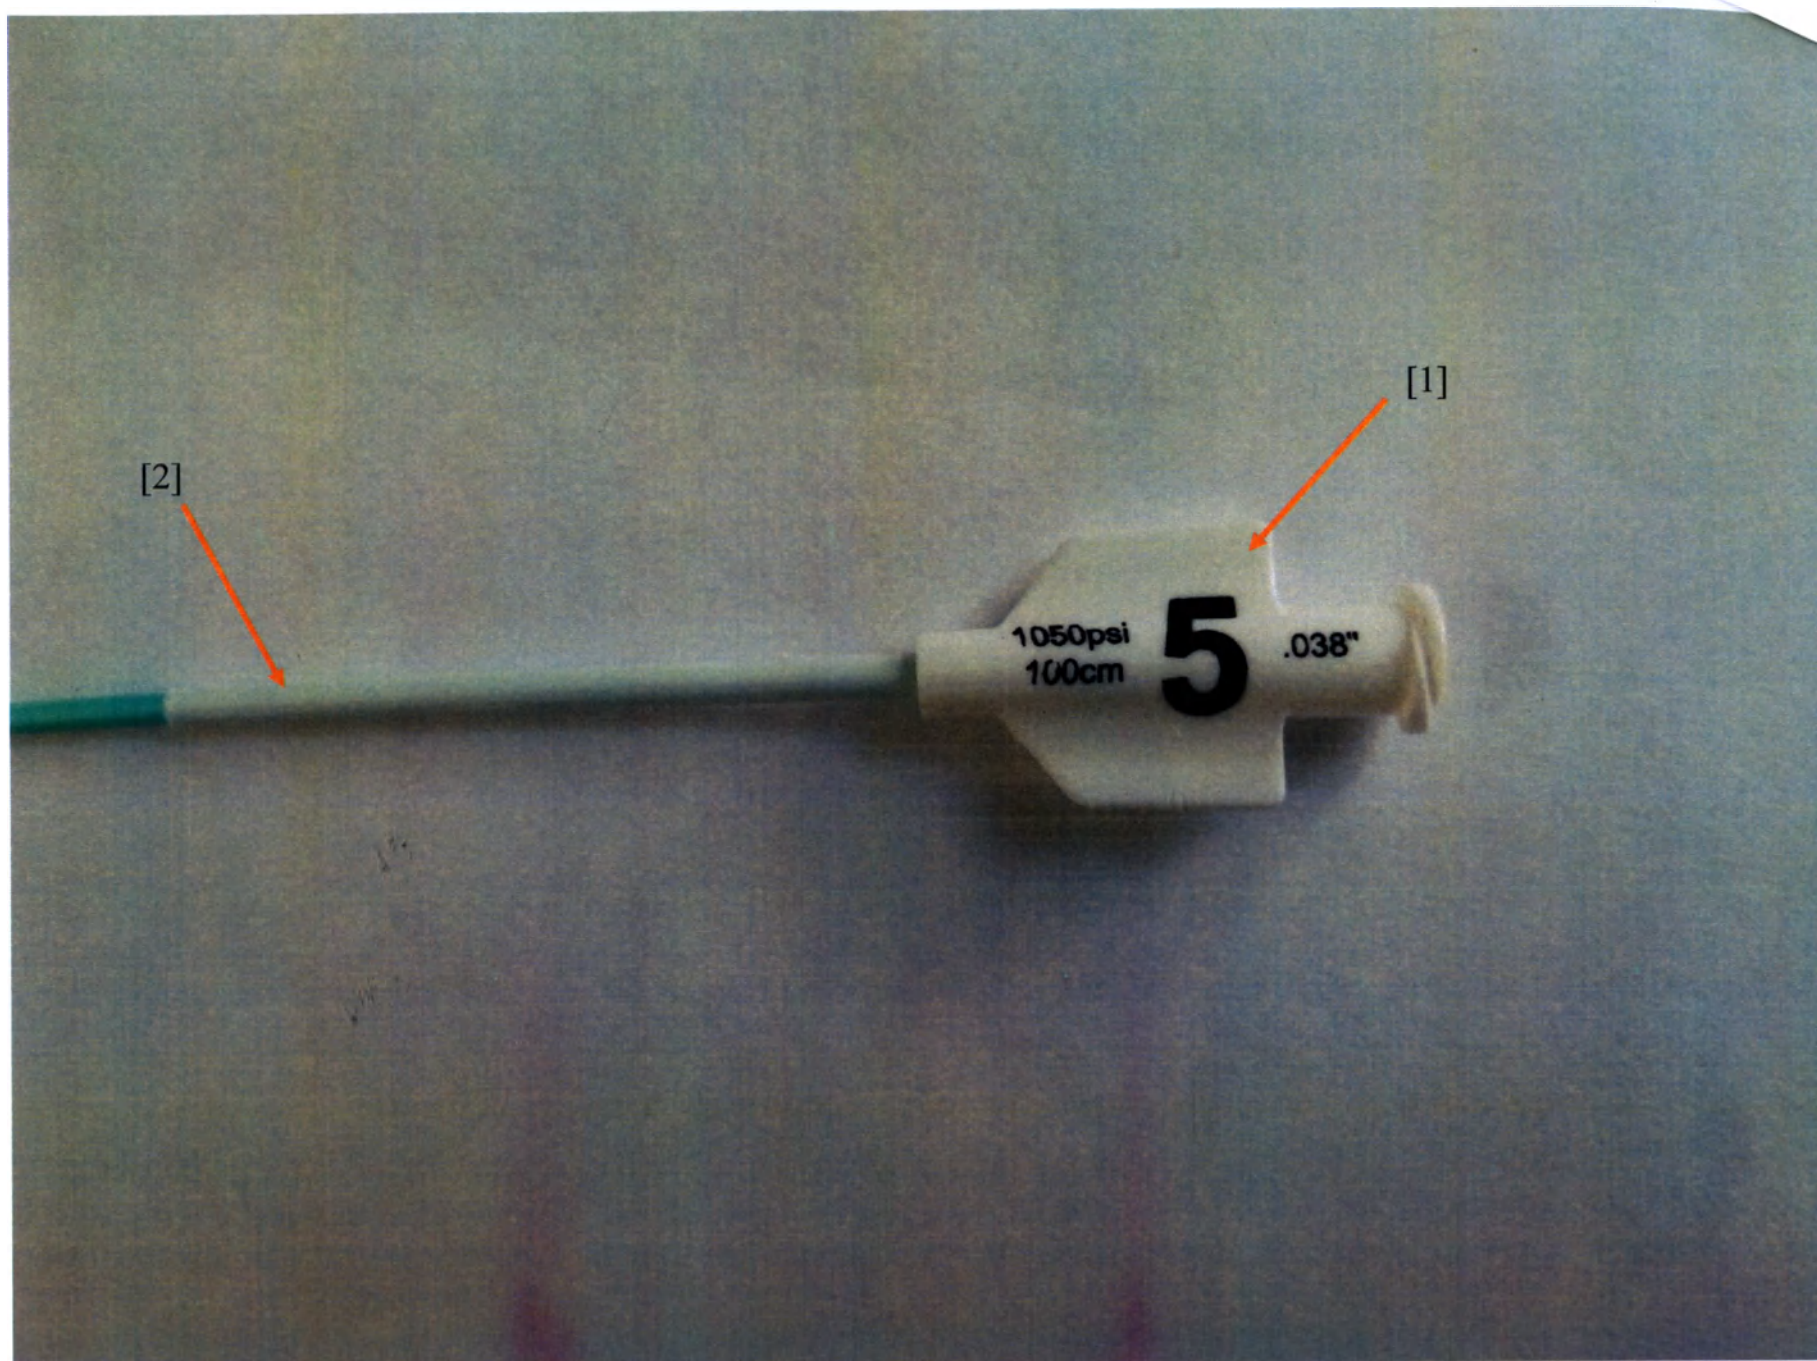


Хаб [1] и разгрузочная муфта [2]

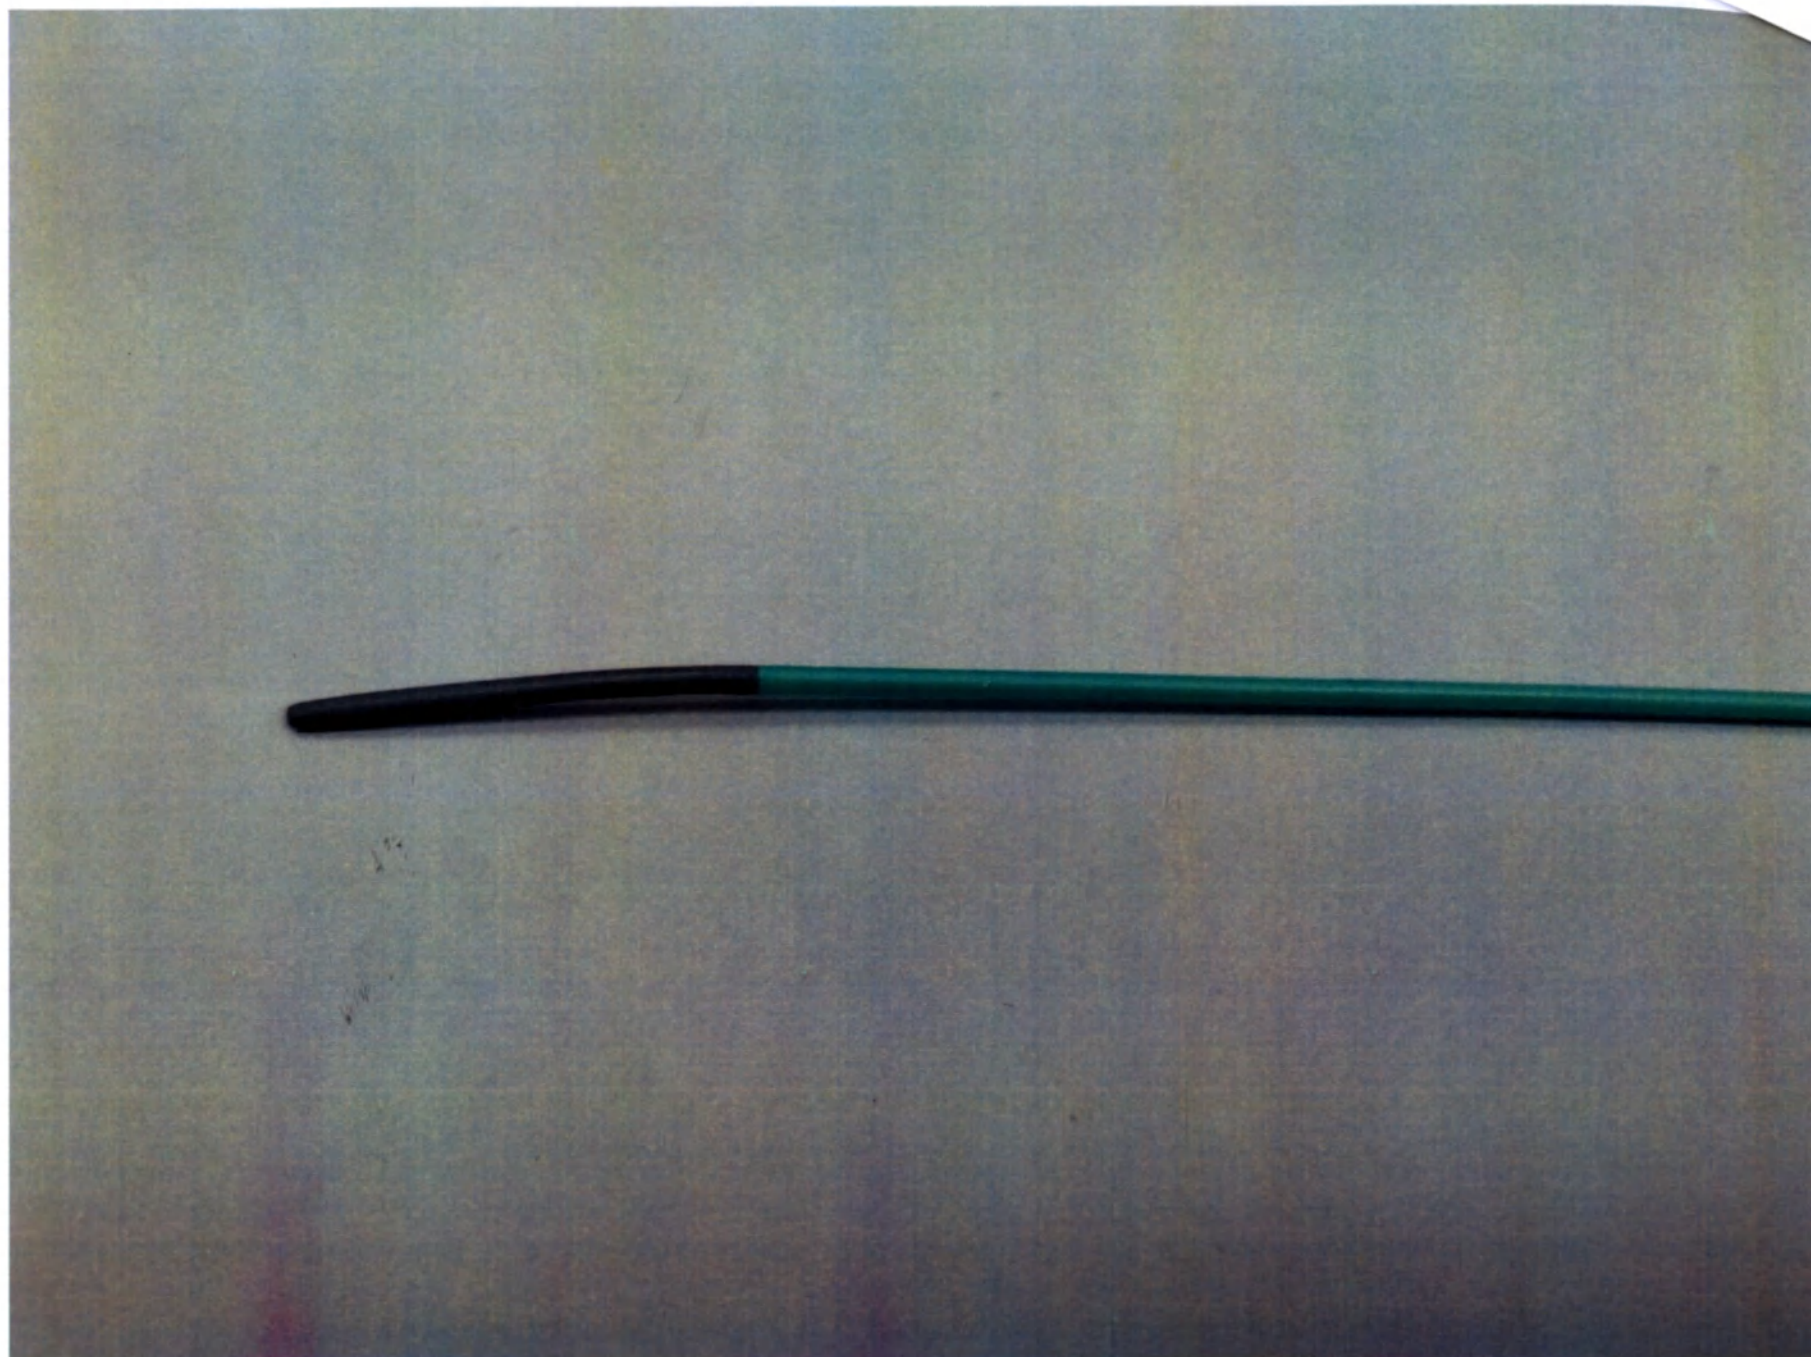


Прямой кончик

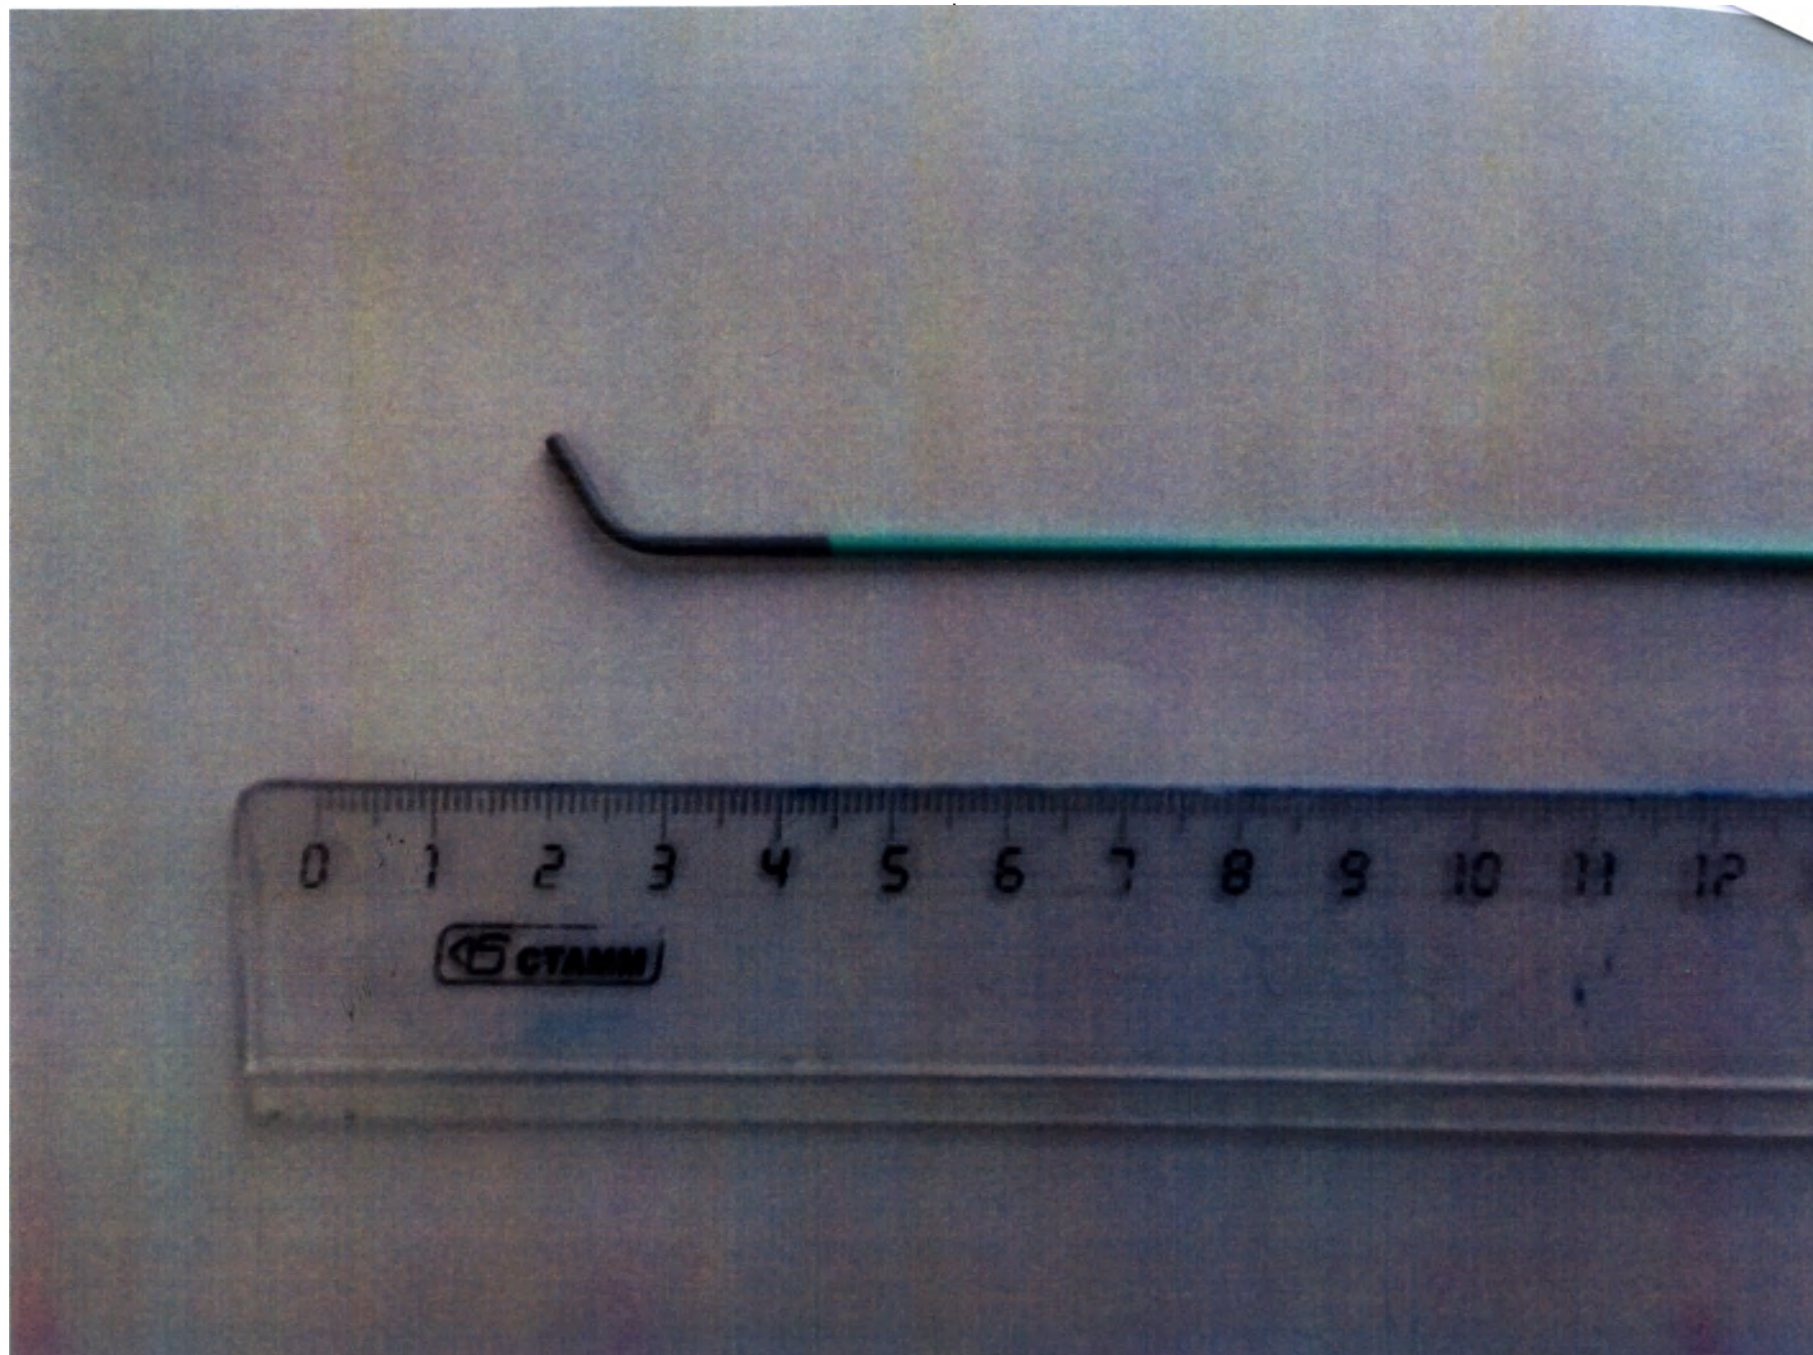


Кончик типа Вега

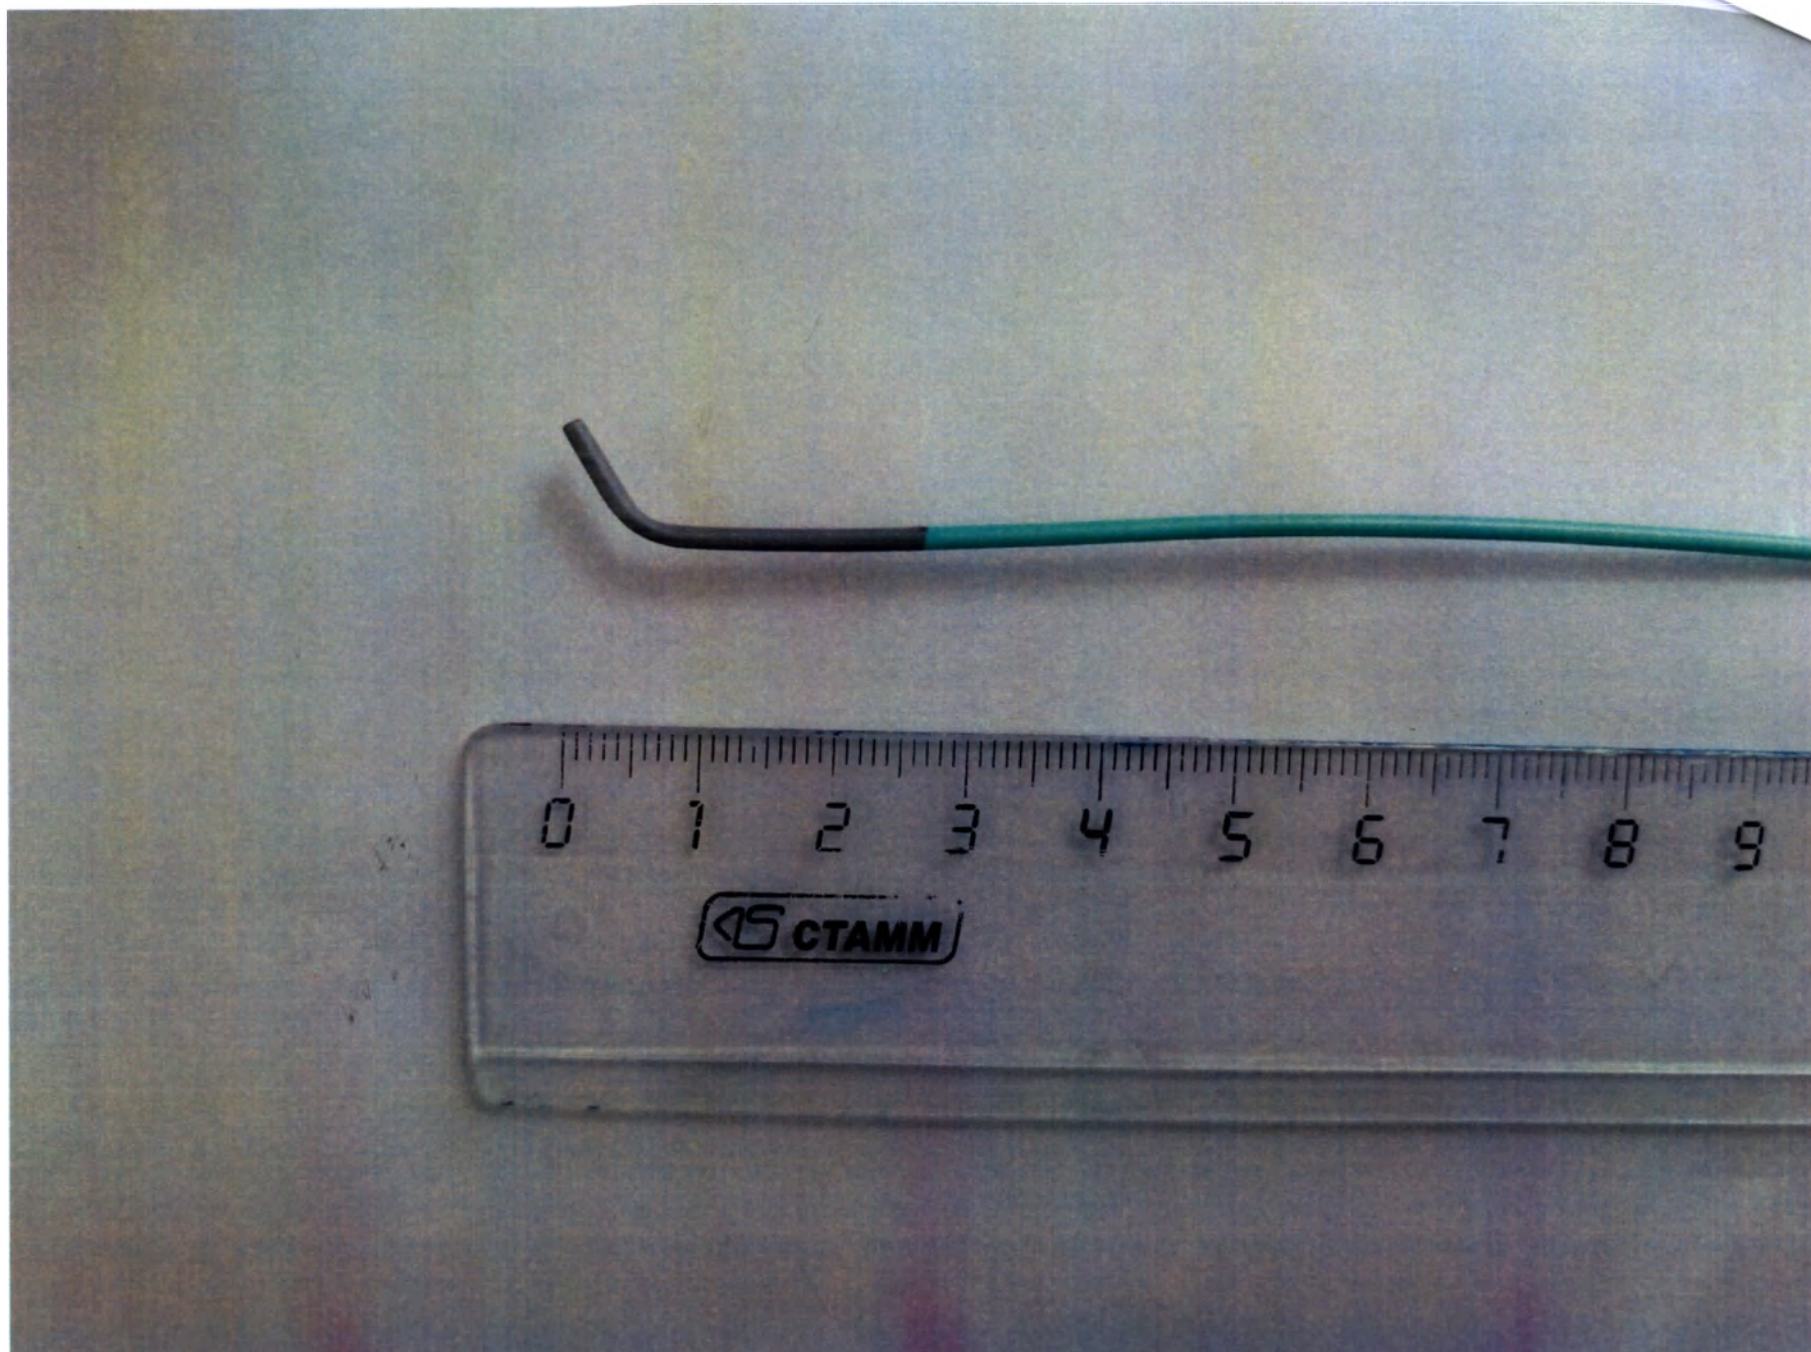

Кончик типа BARNH

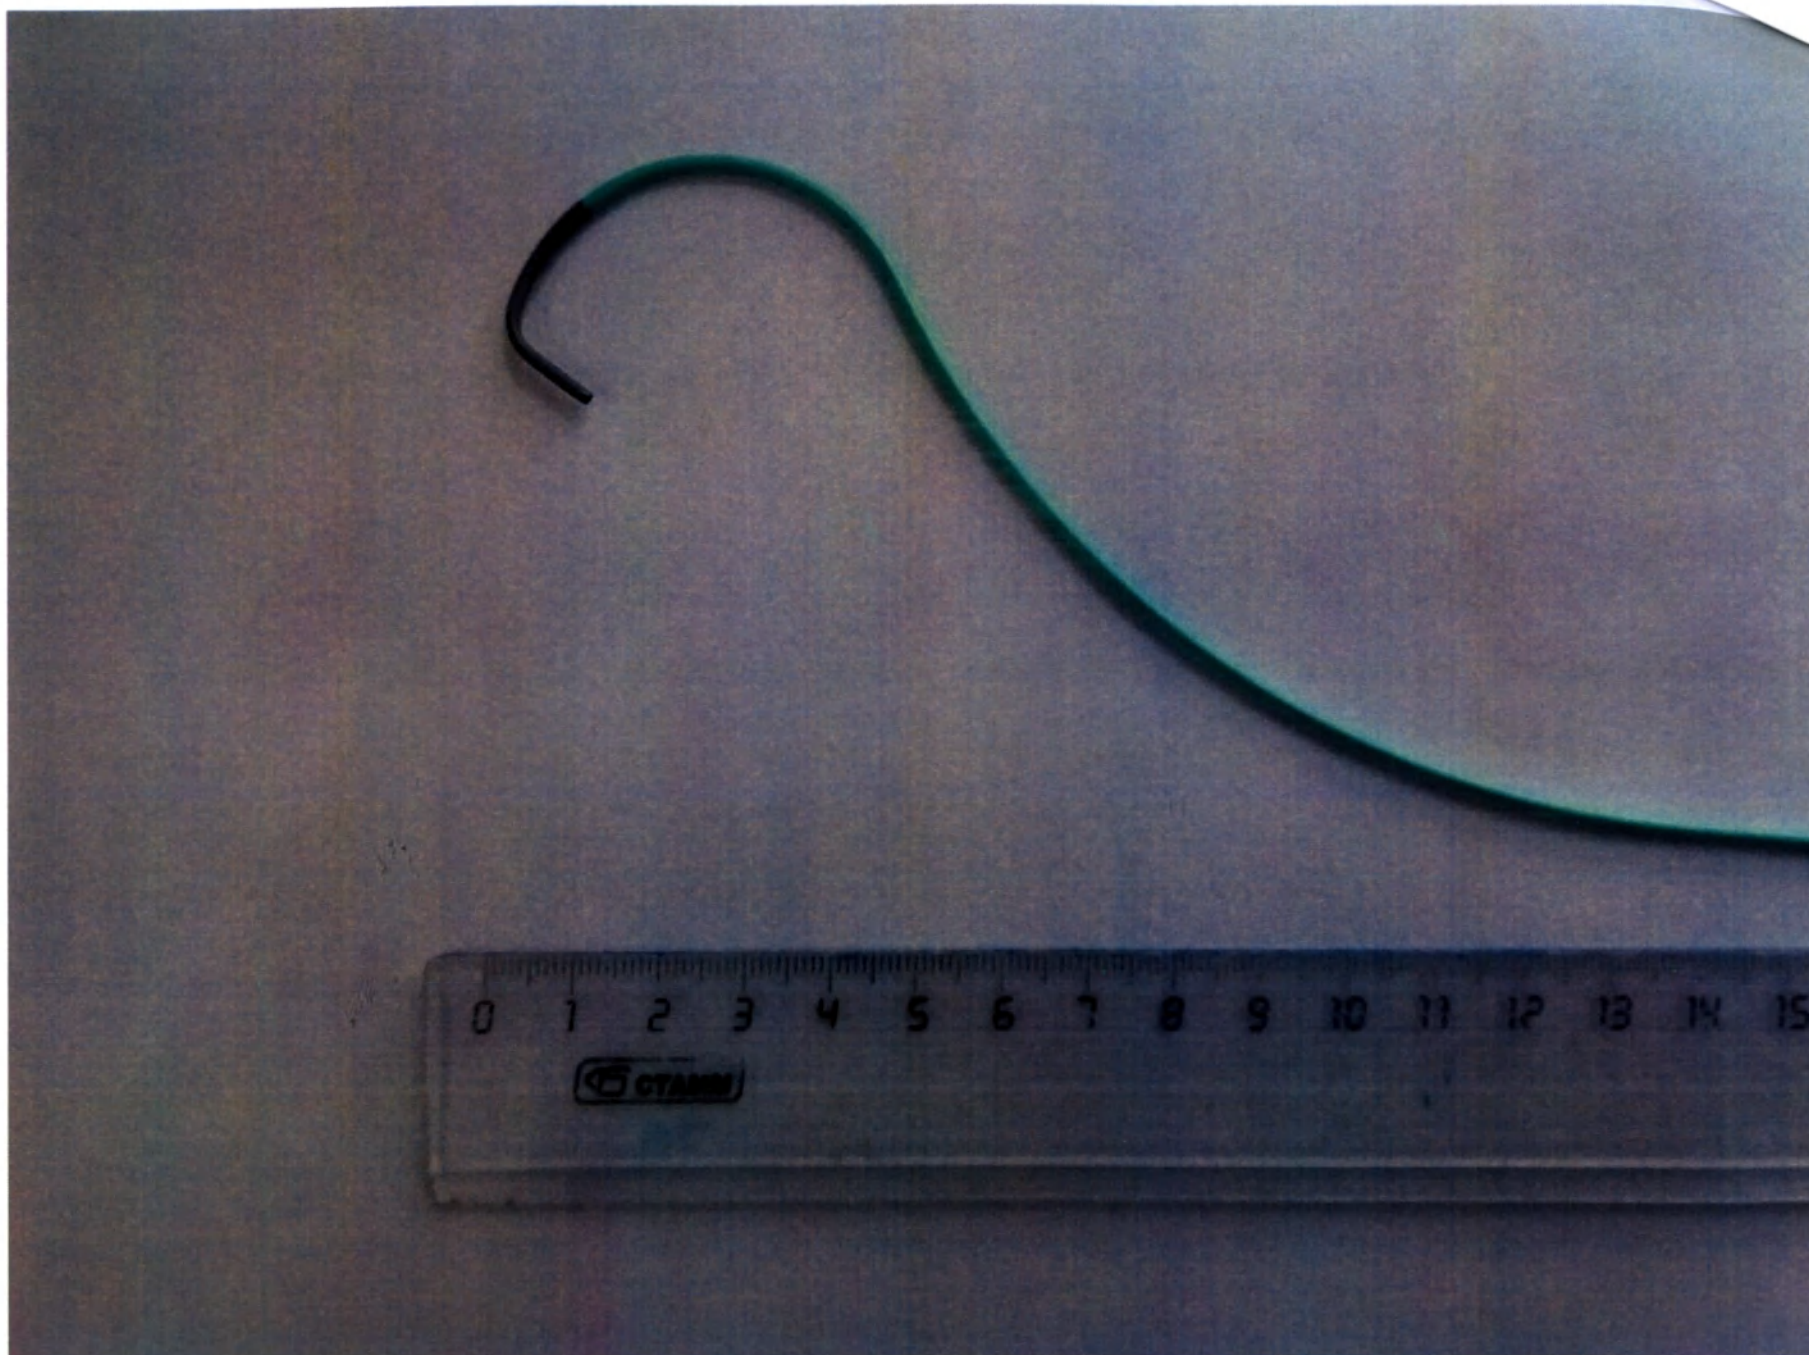



Кончик типа С1

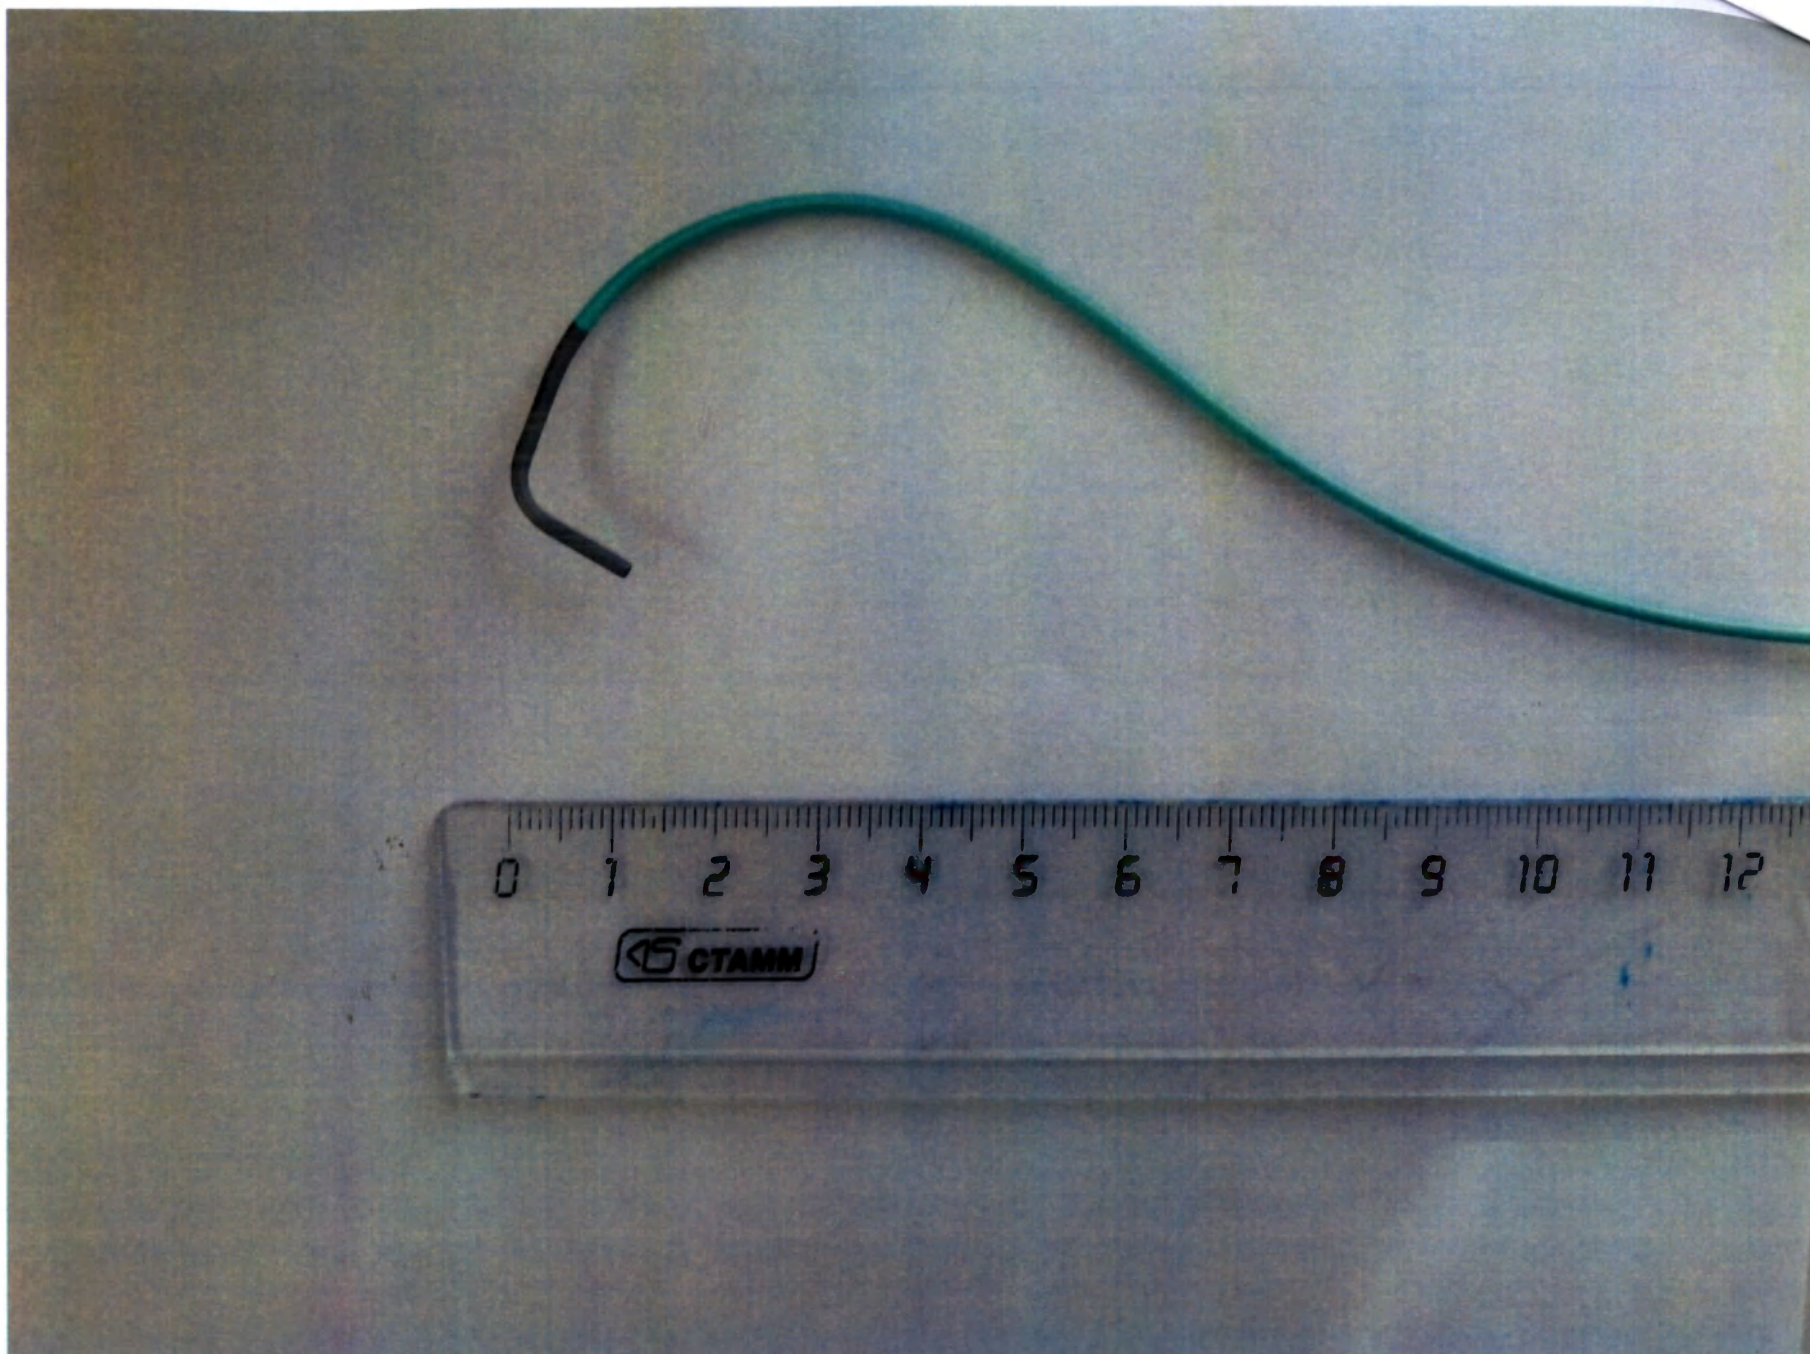


Кончик типа С2

Кончик типа Н1

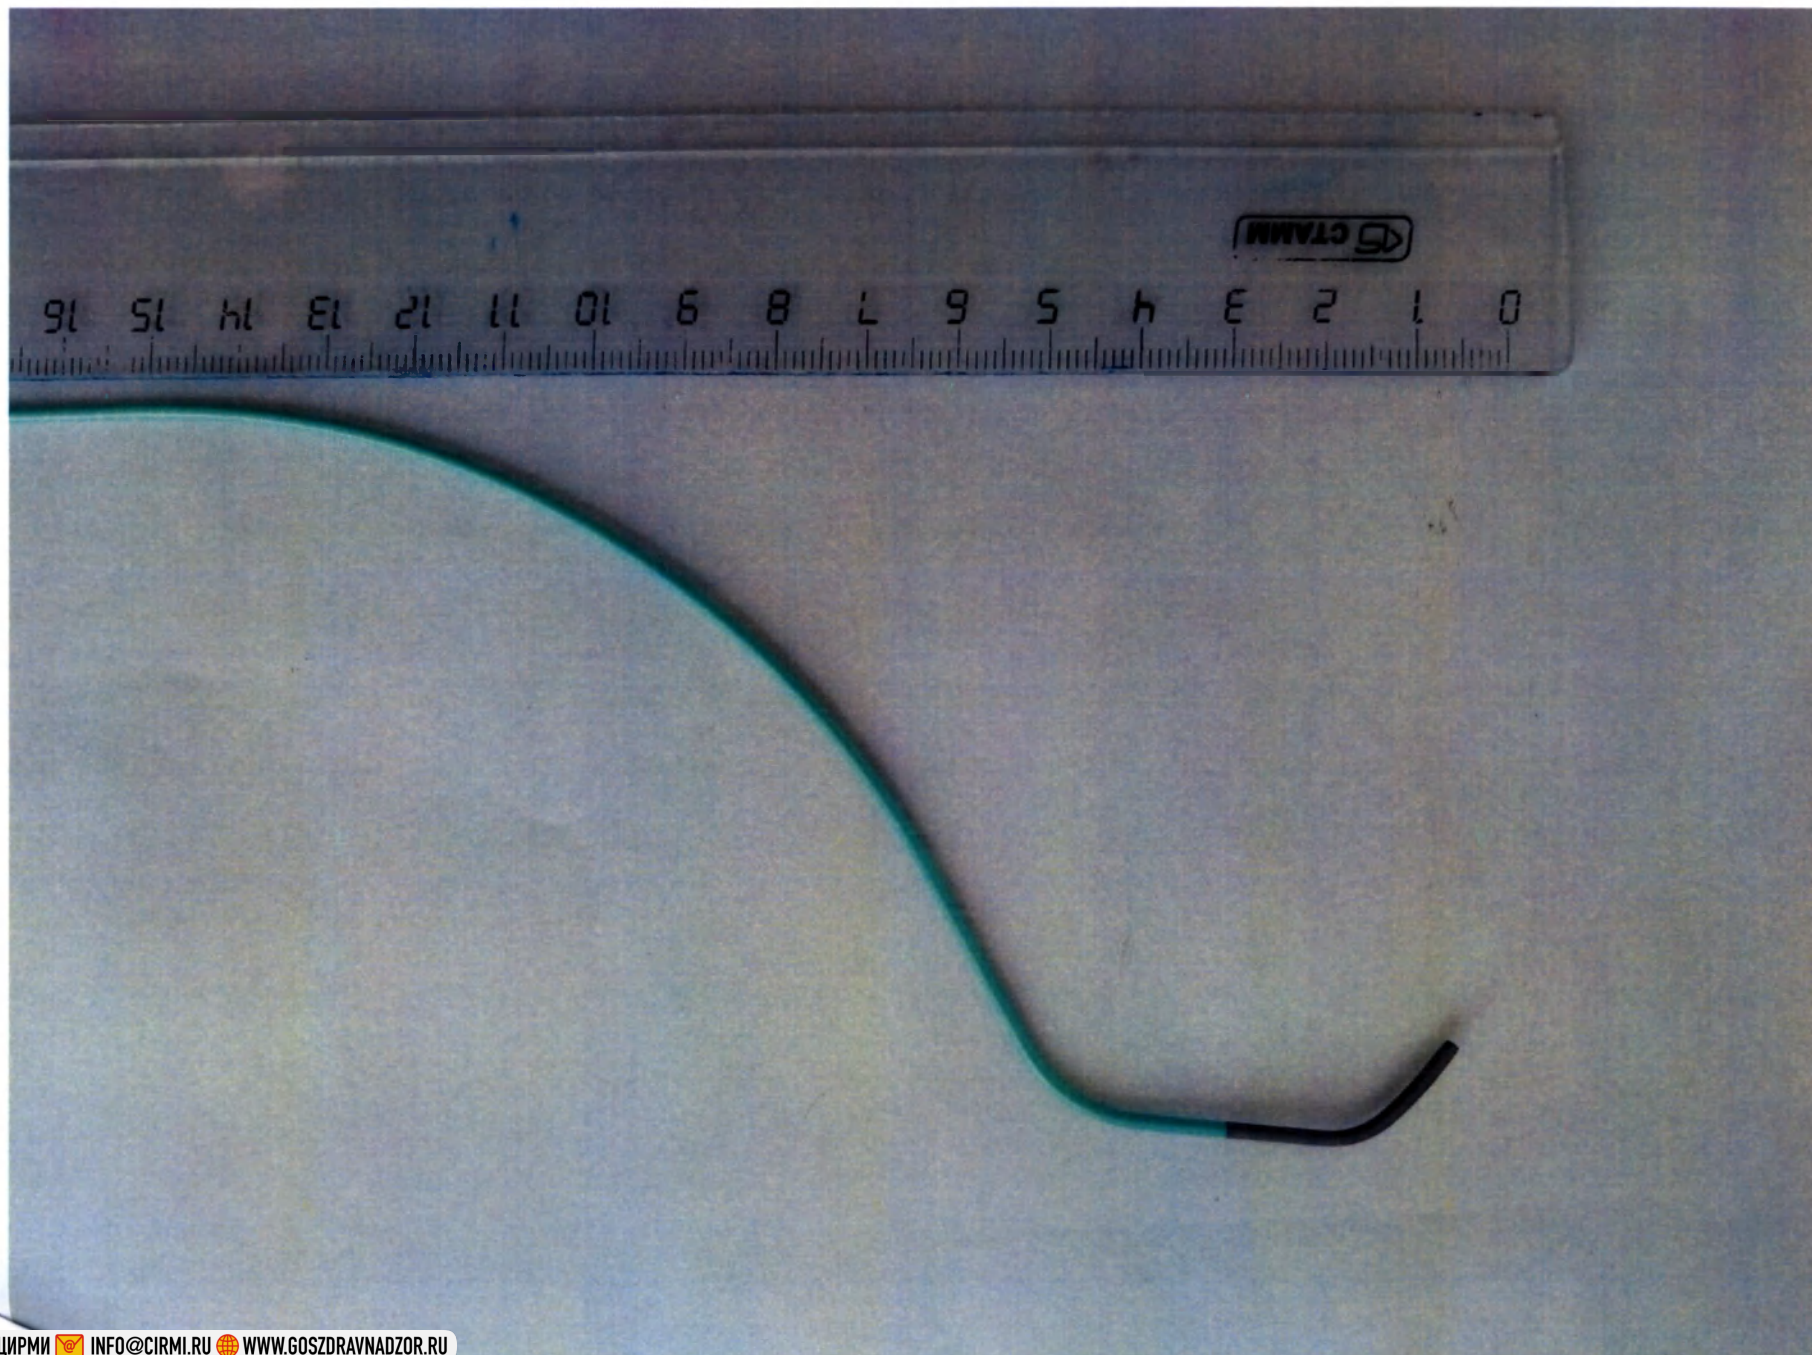


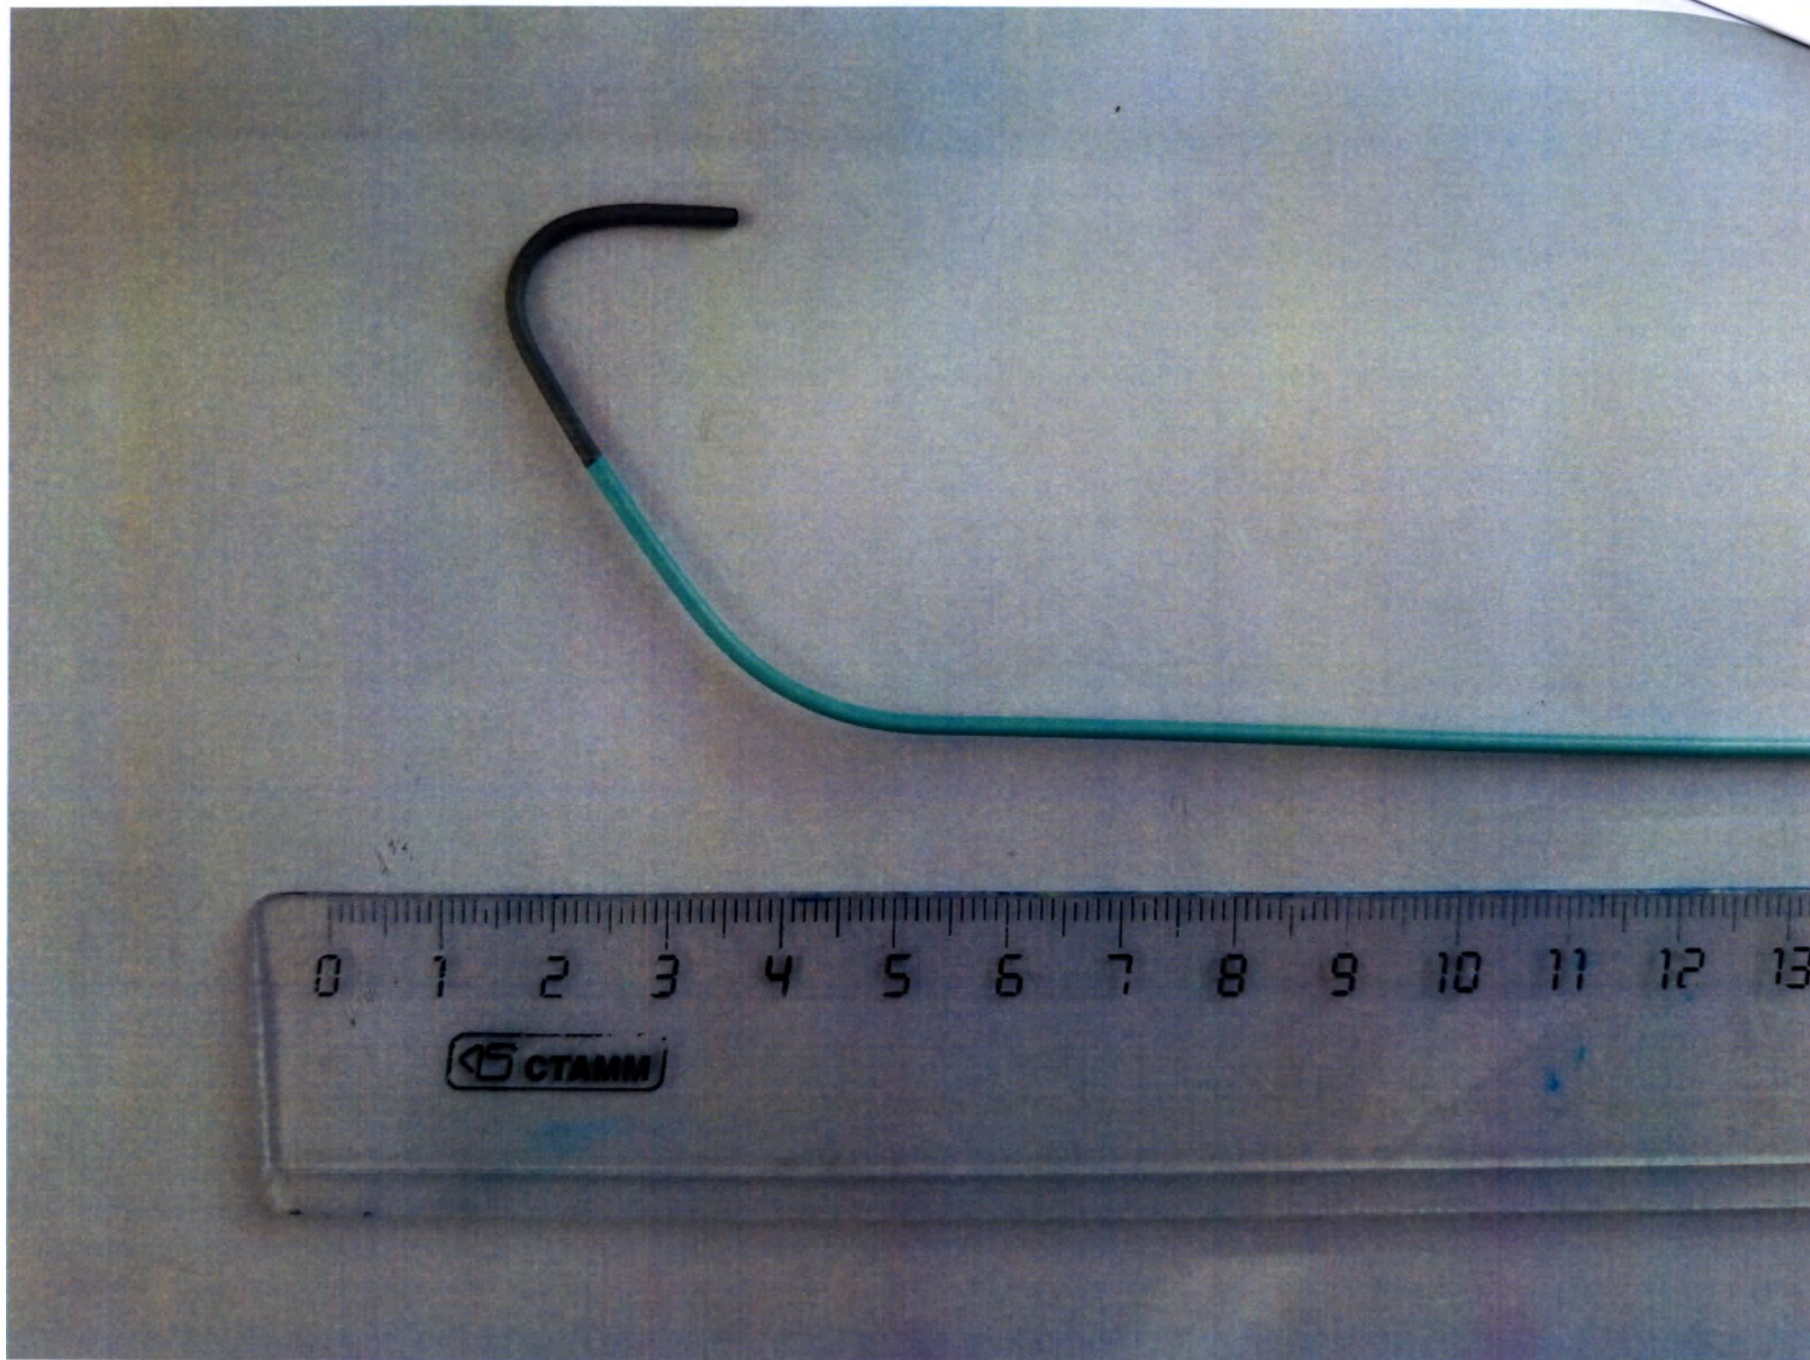


Кончик типа RDC

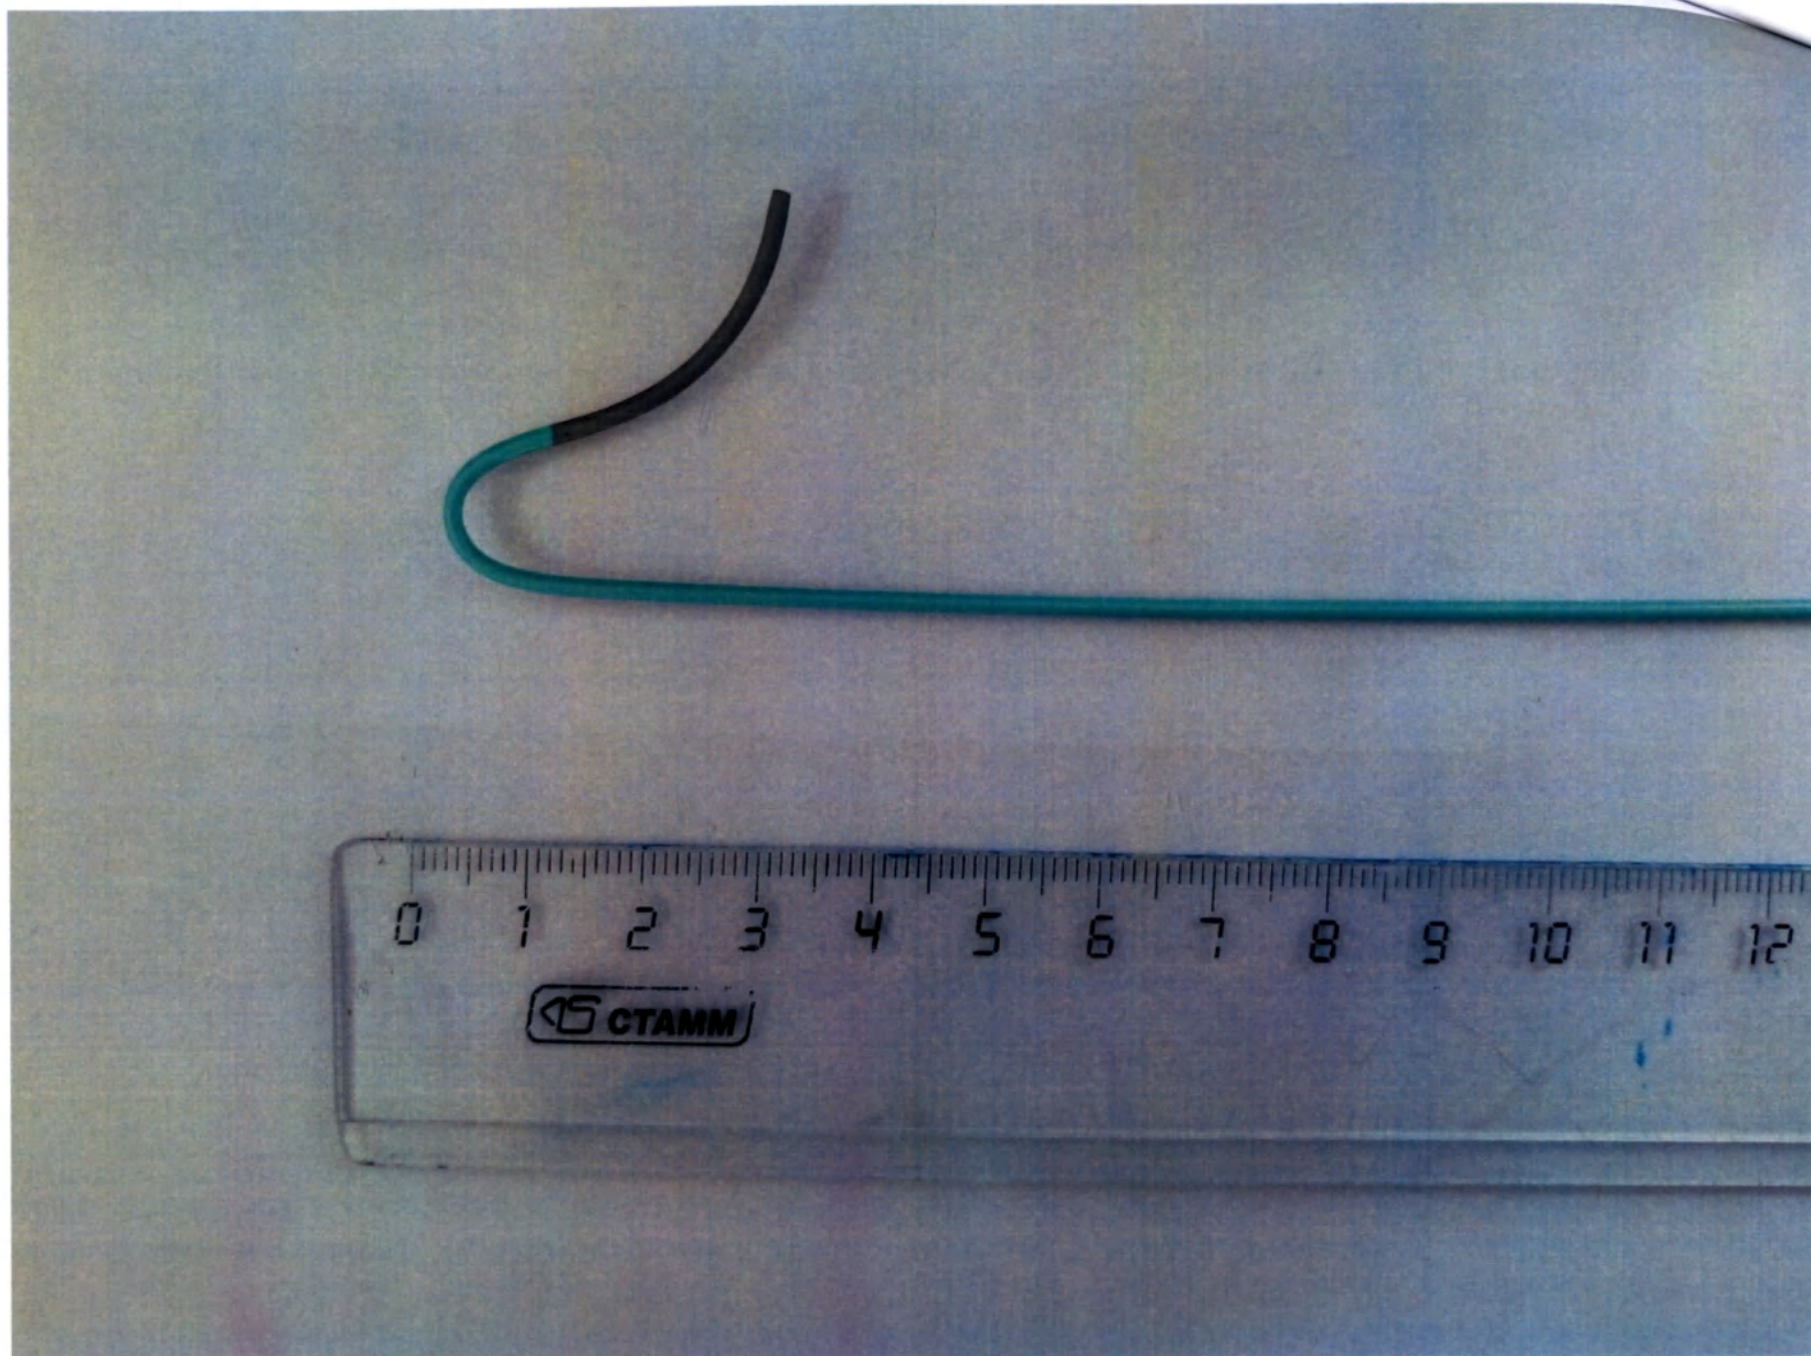


Кончик типа SIM1

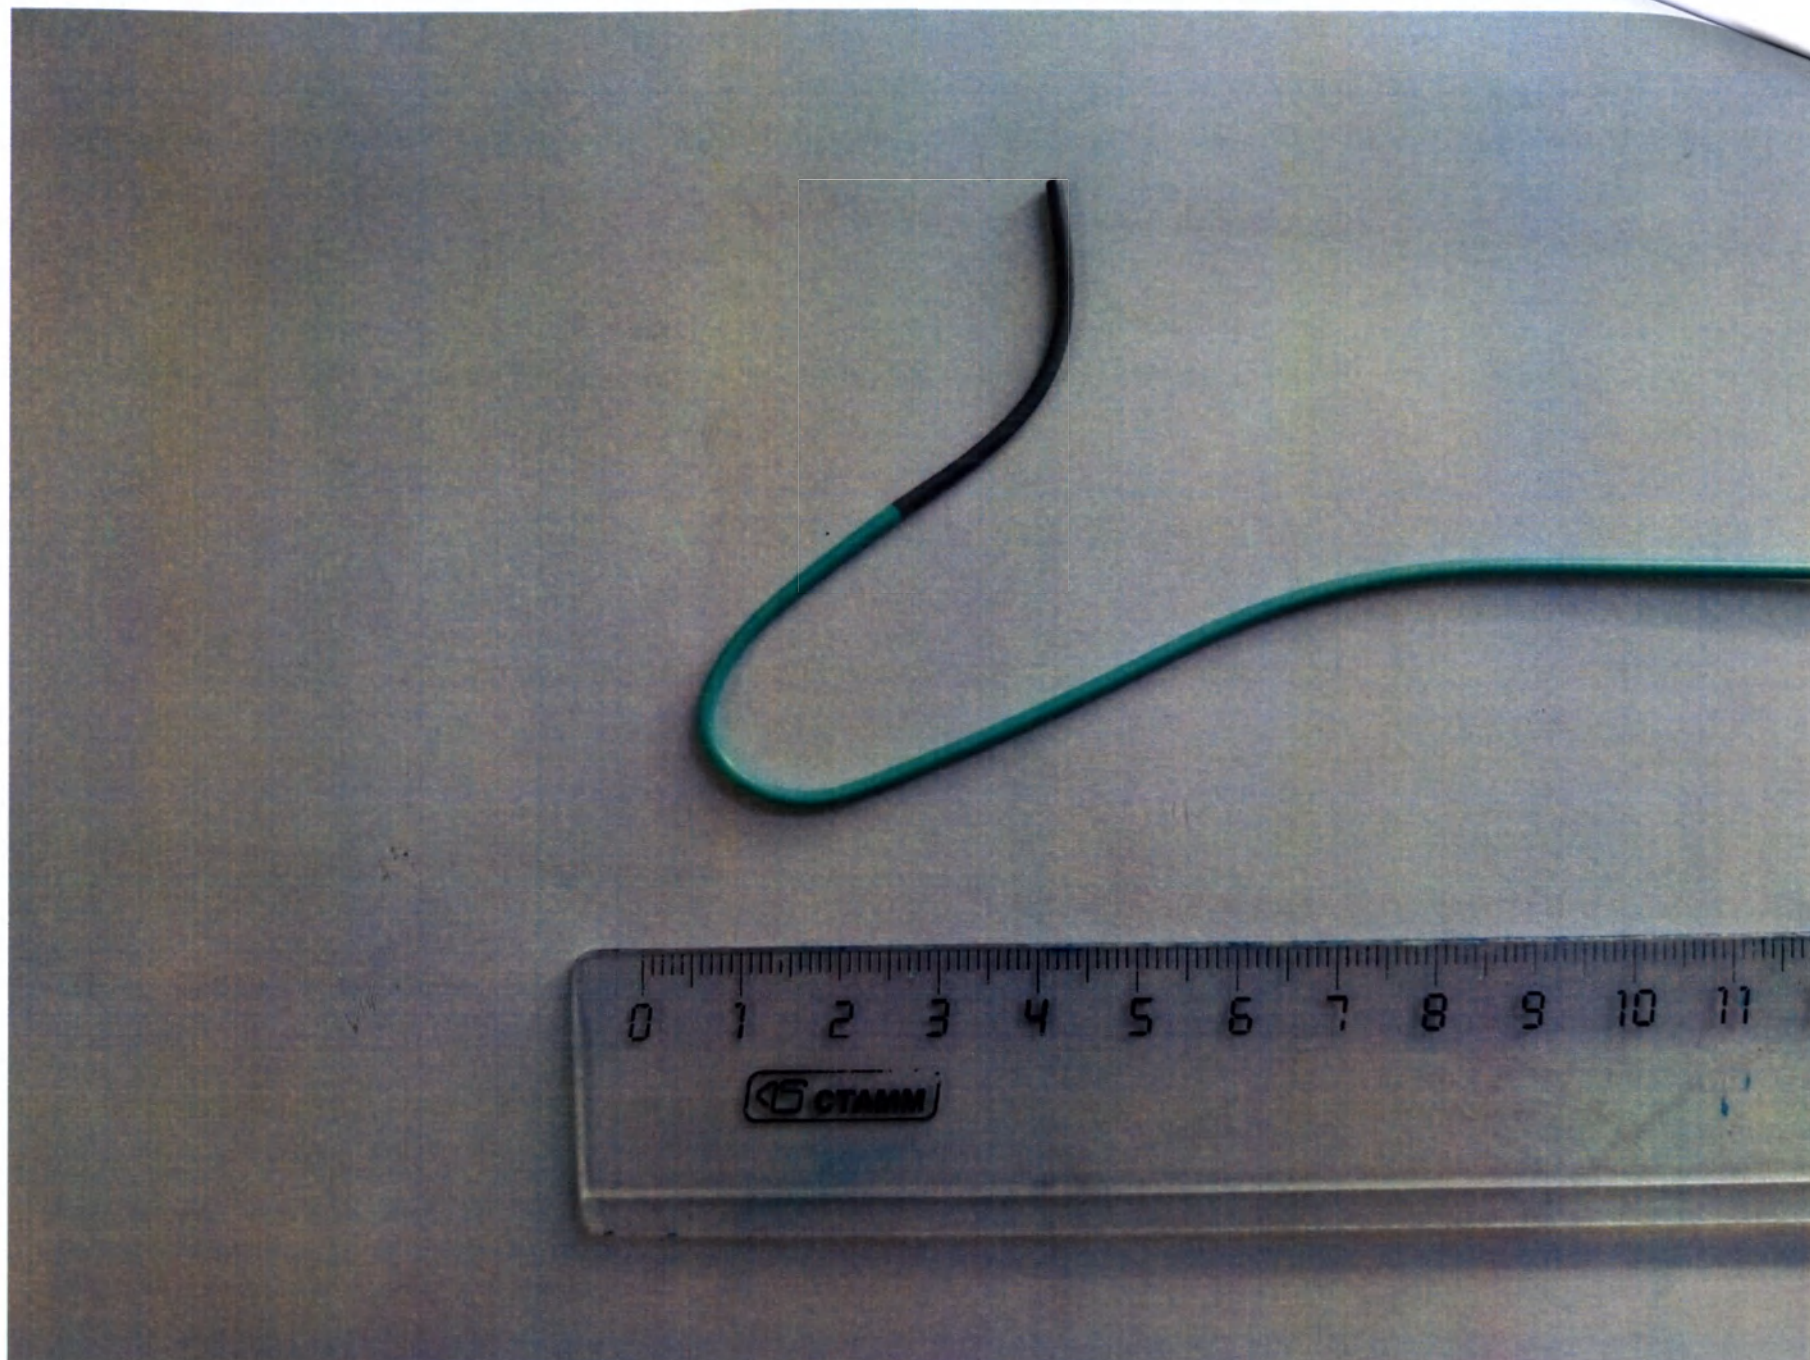


Кончик типа SIM2

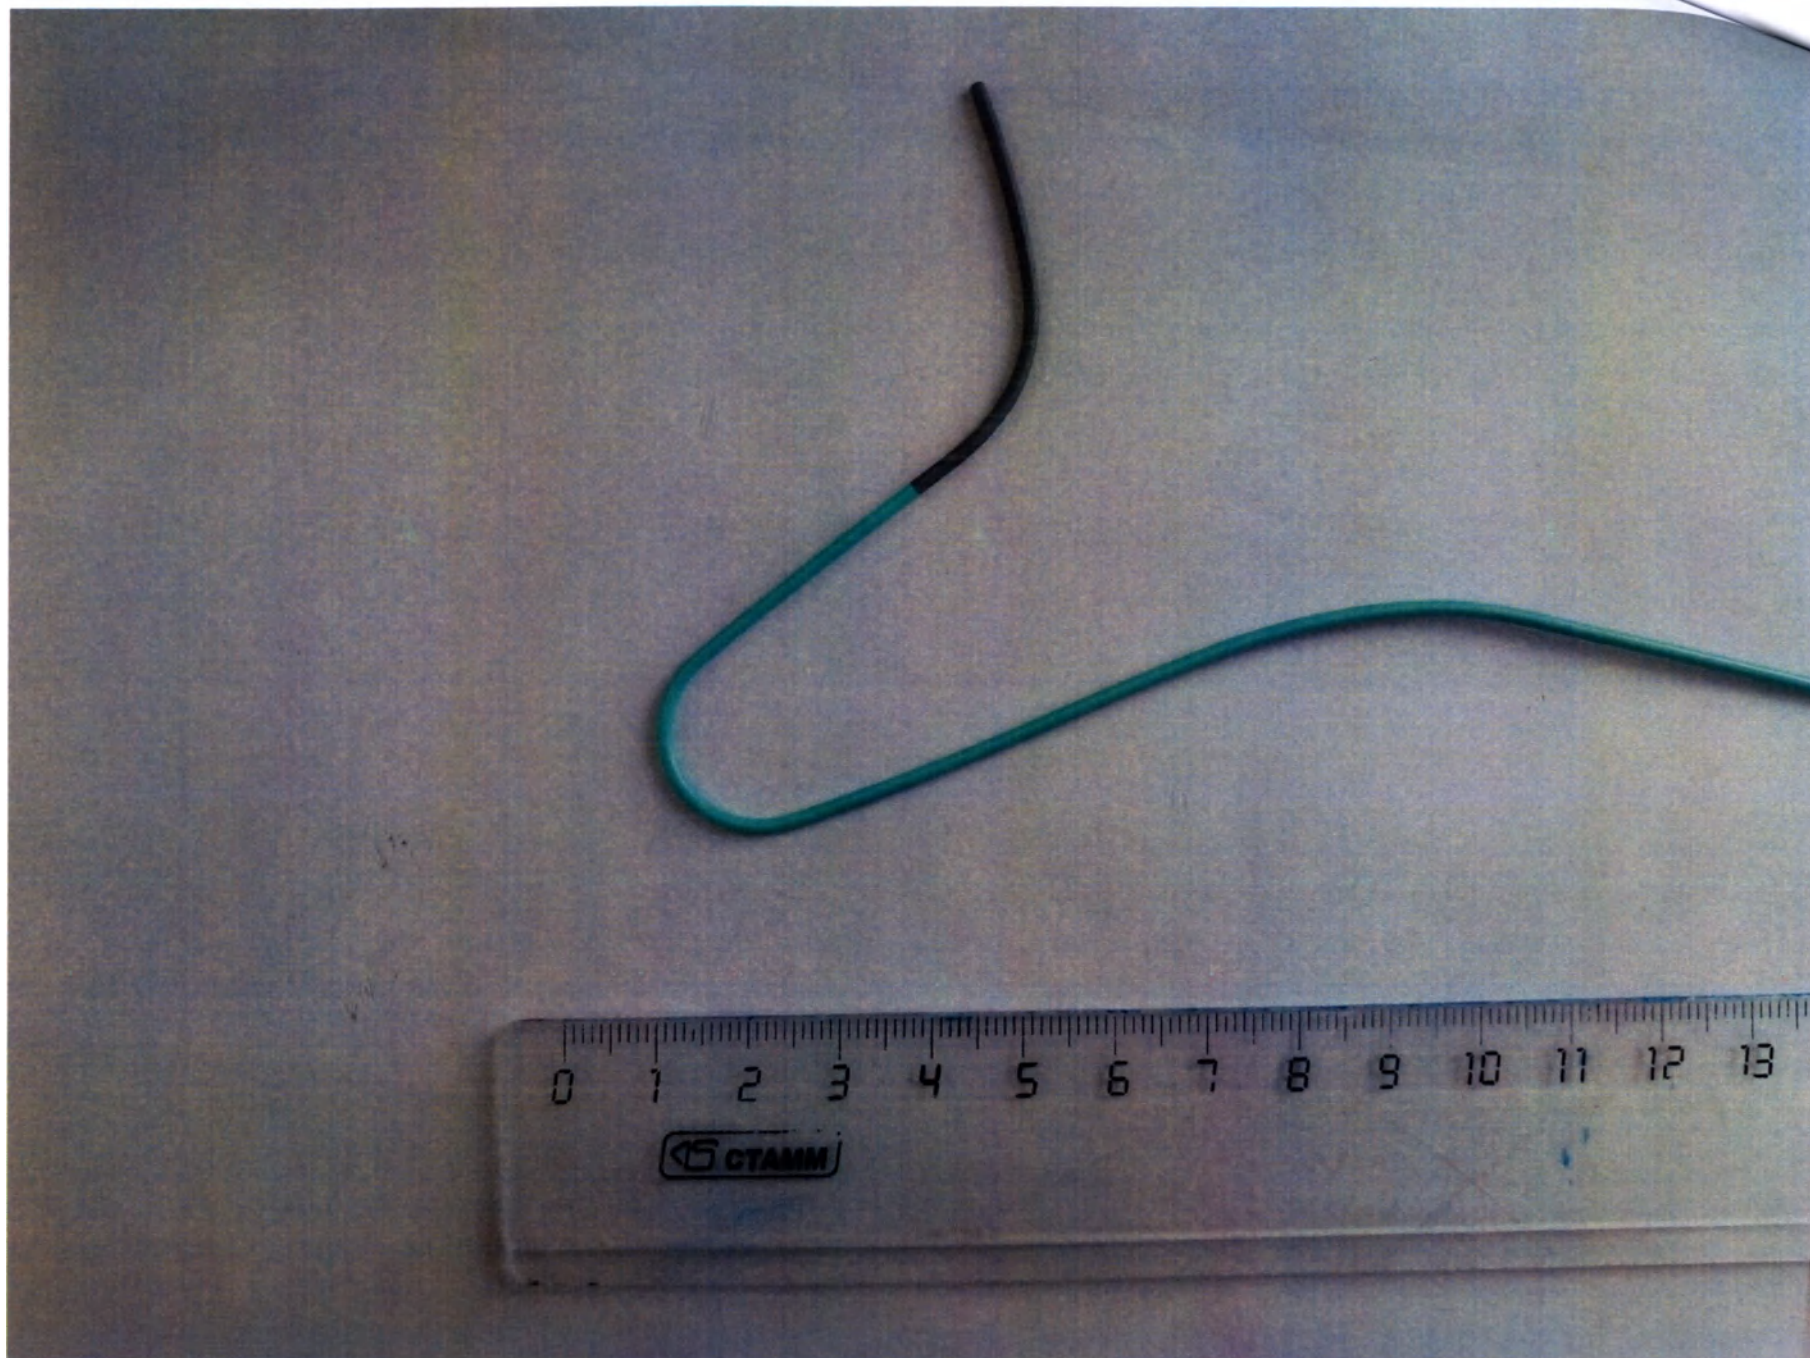


Кончик типа SIM3

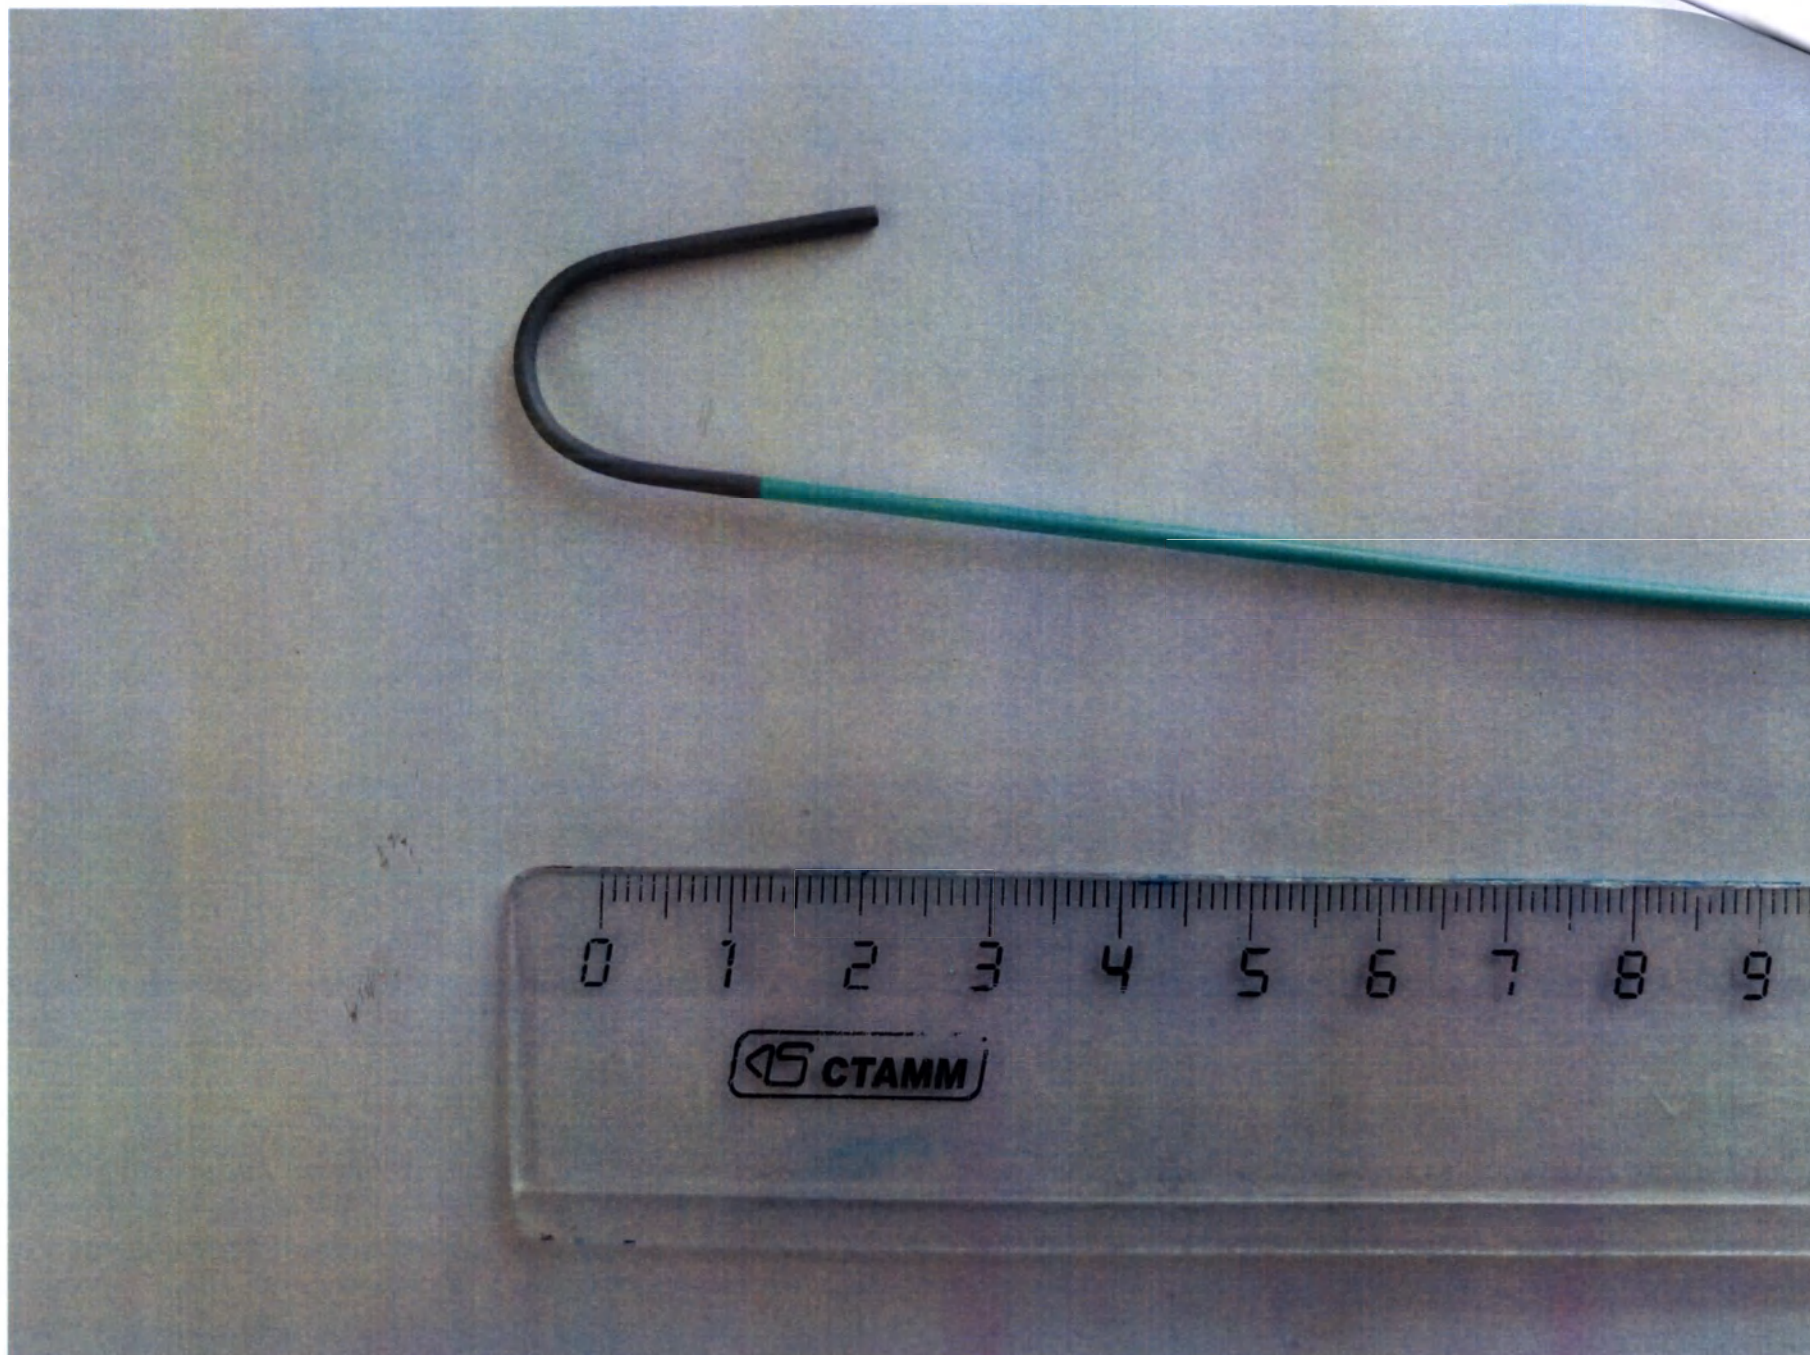

Кончик типа Chg B

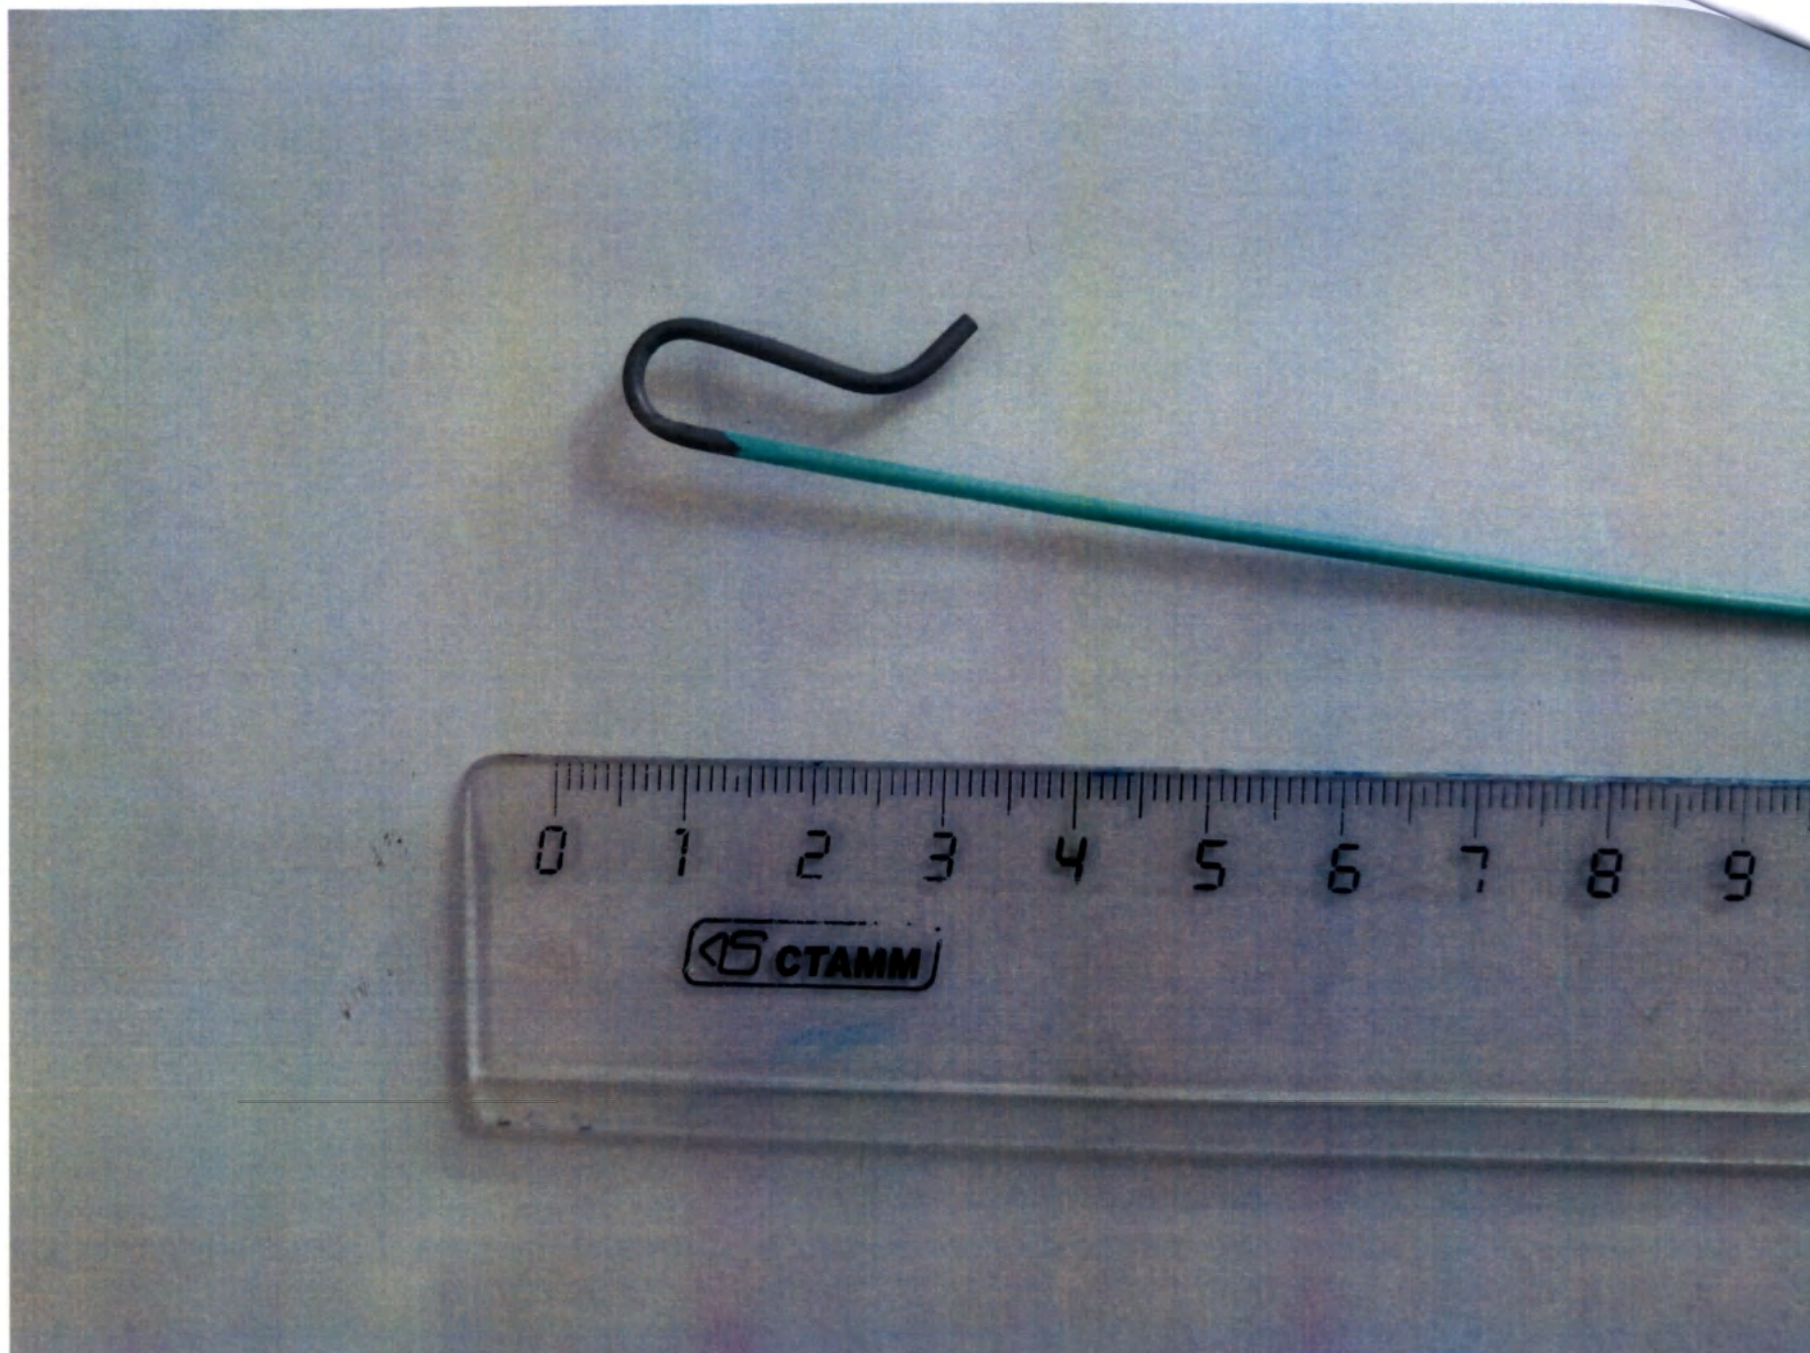


Кончик типа Contra 2

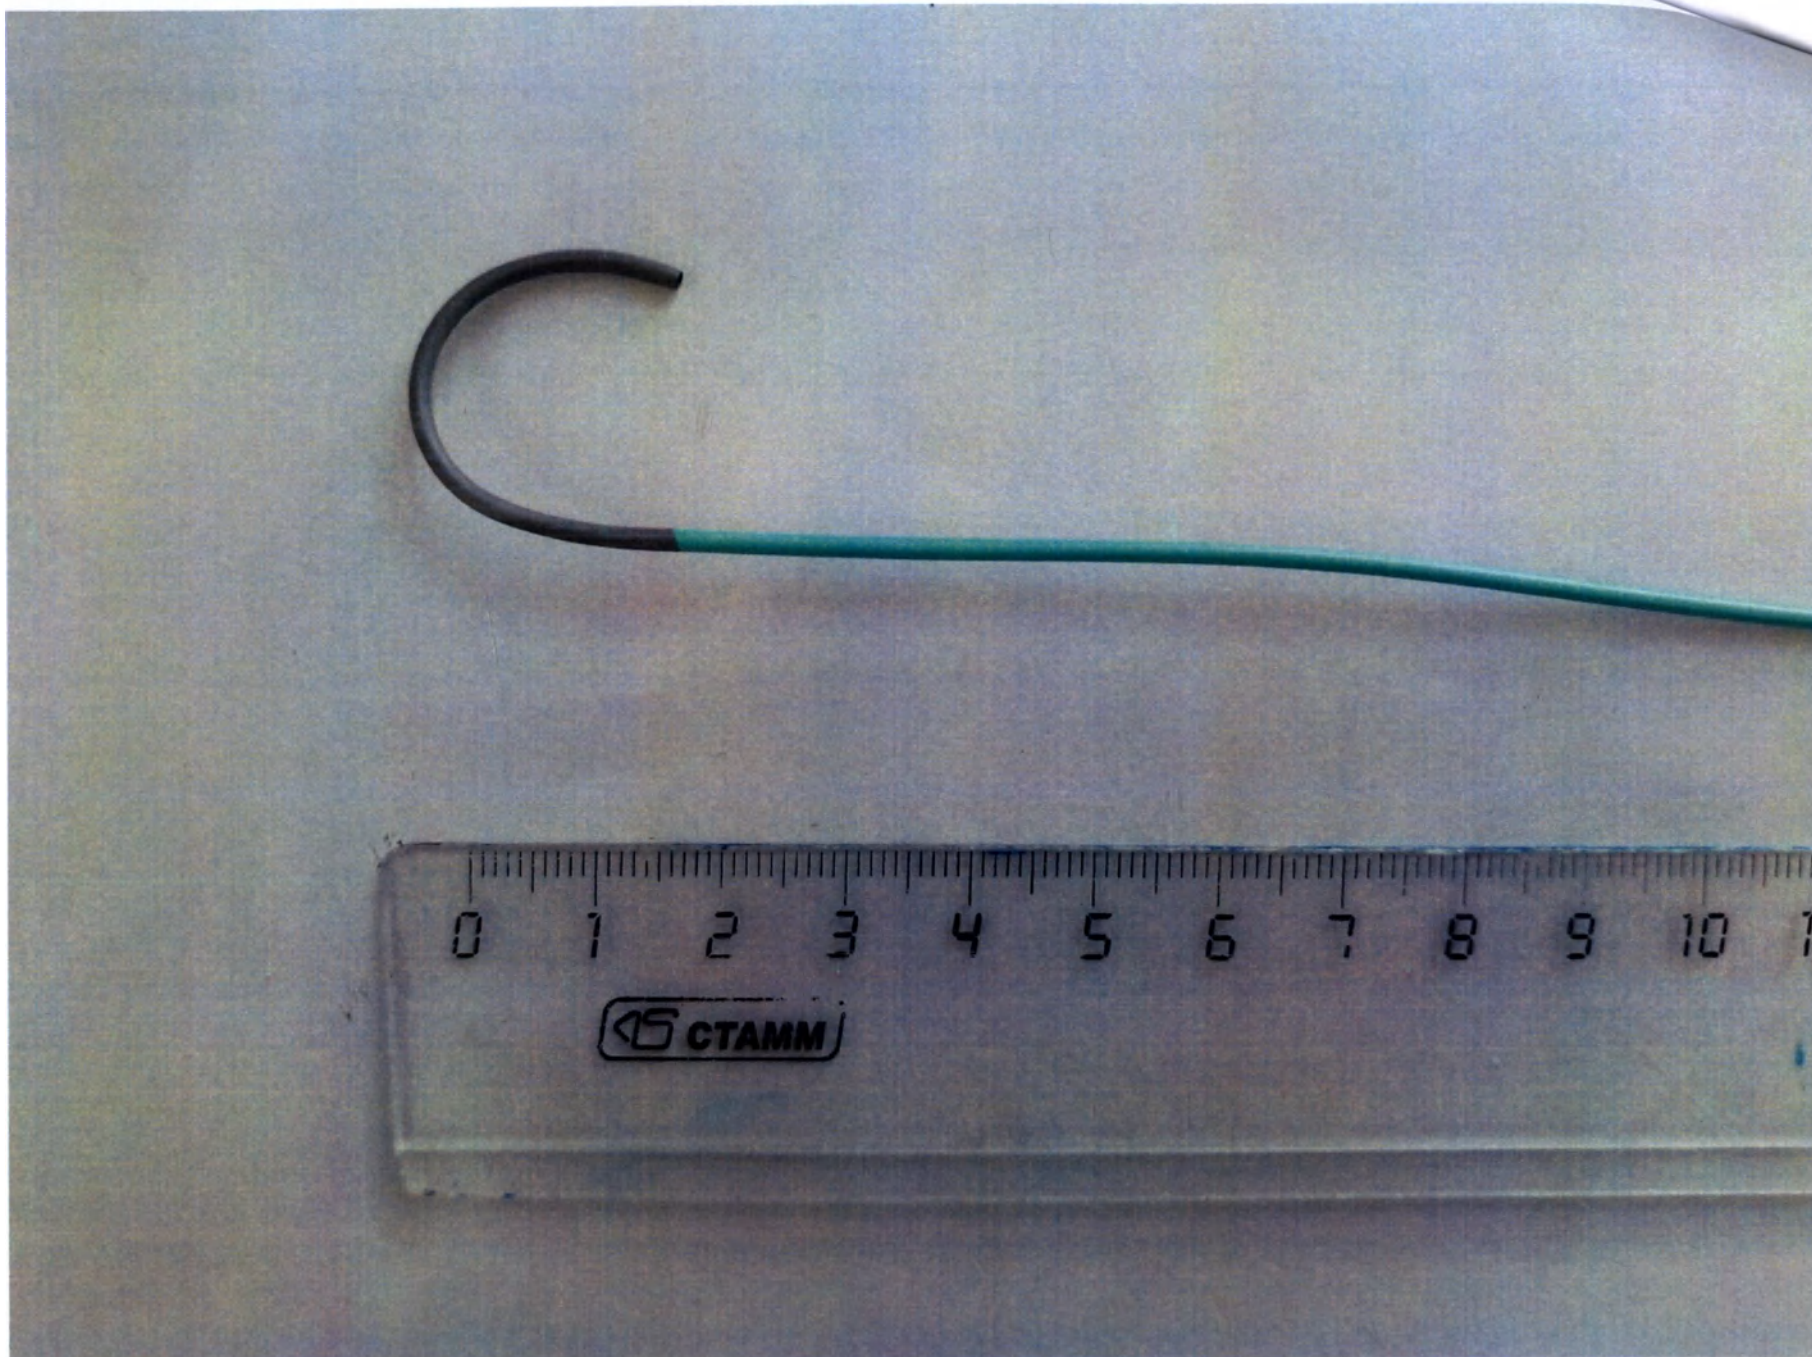



Кончик типа RC2

Кончик типа SHK 1.0

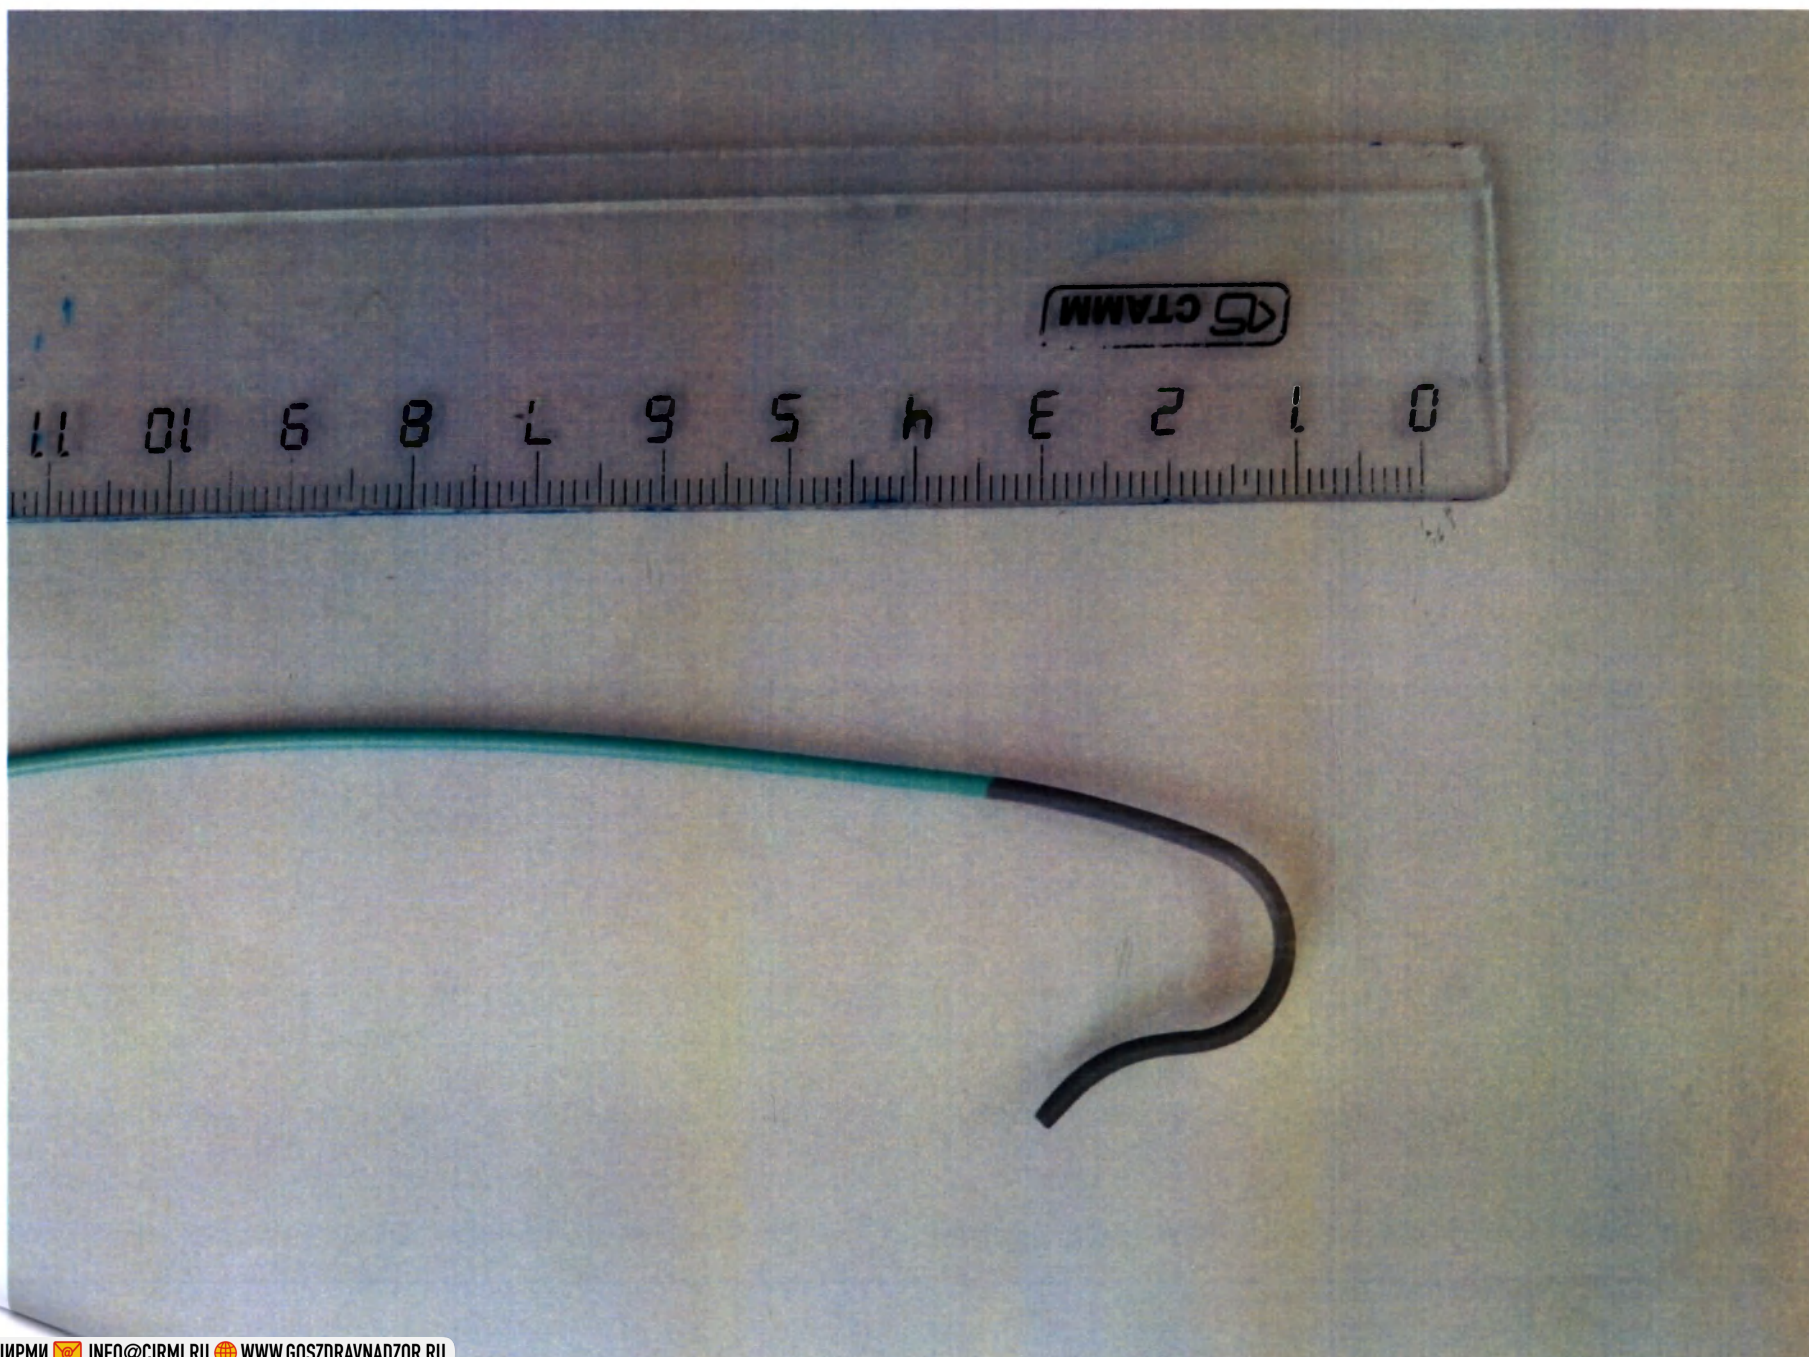

Кончик типа MIK

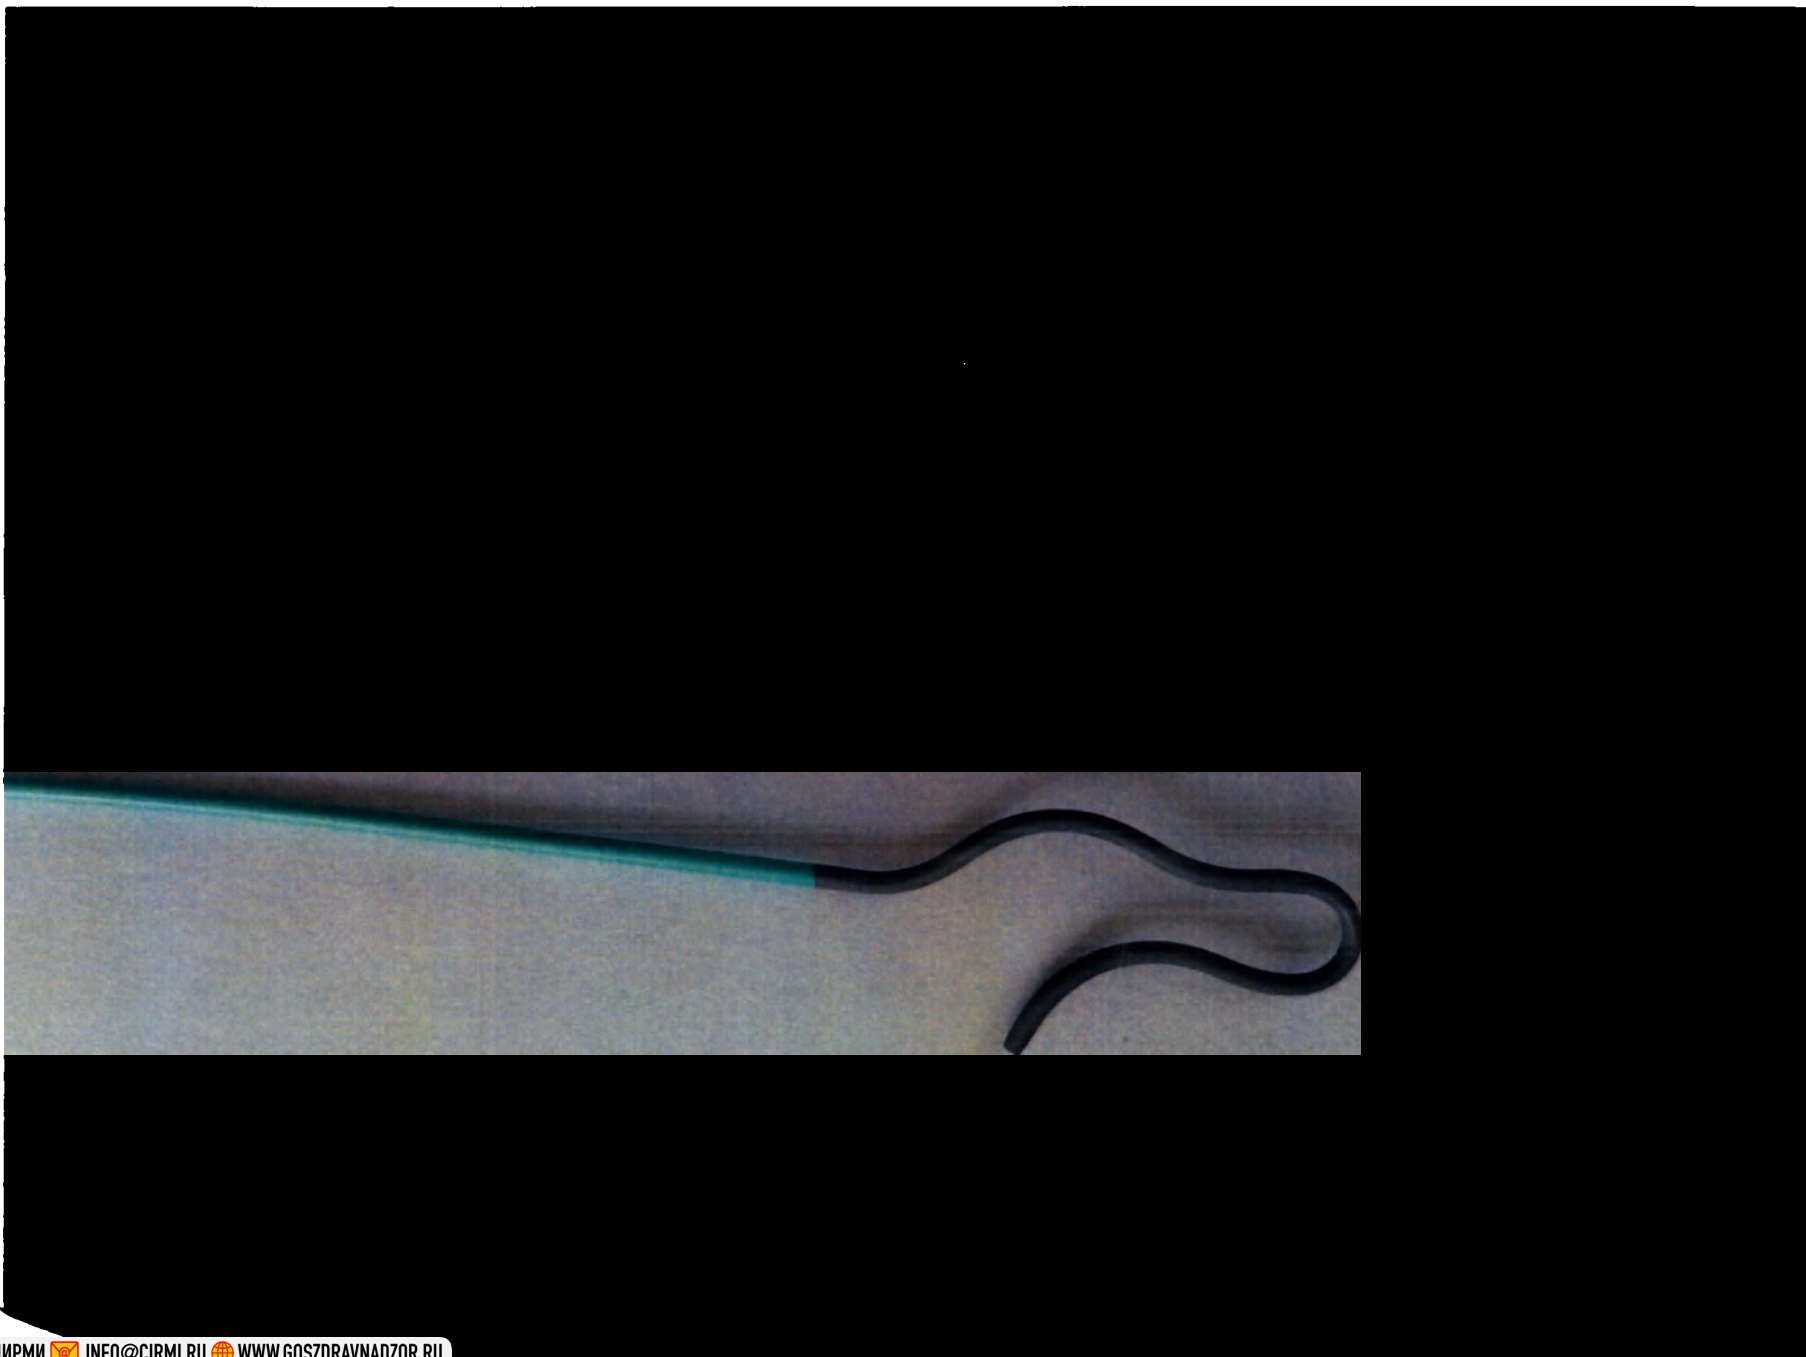

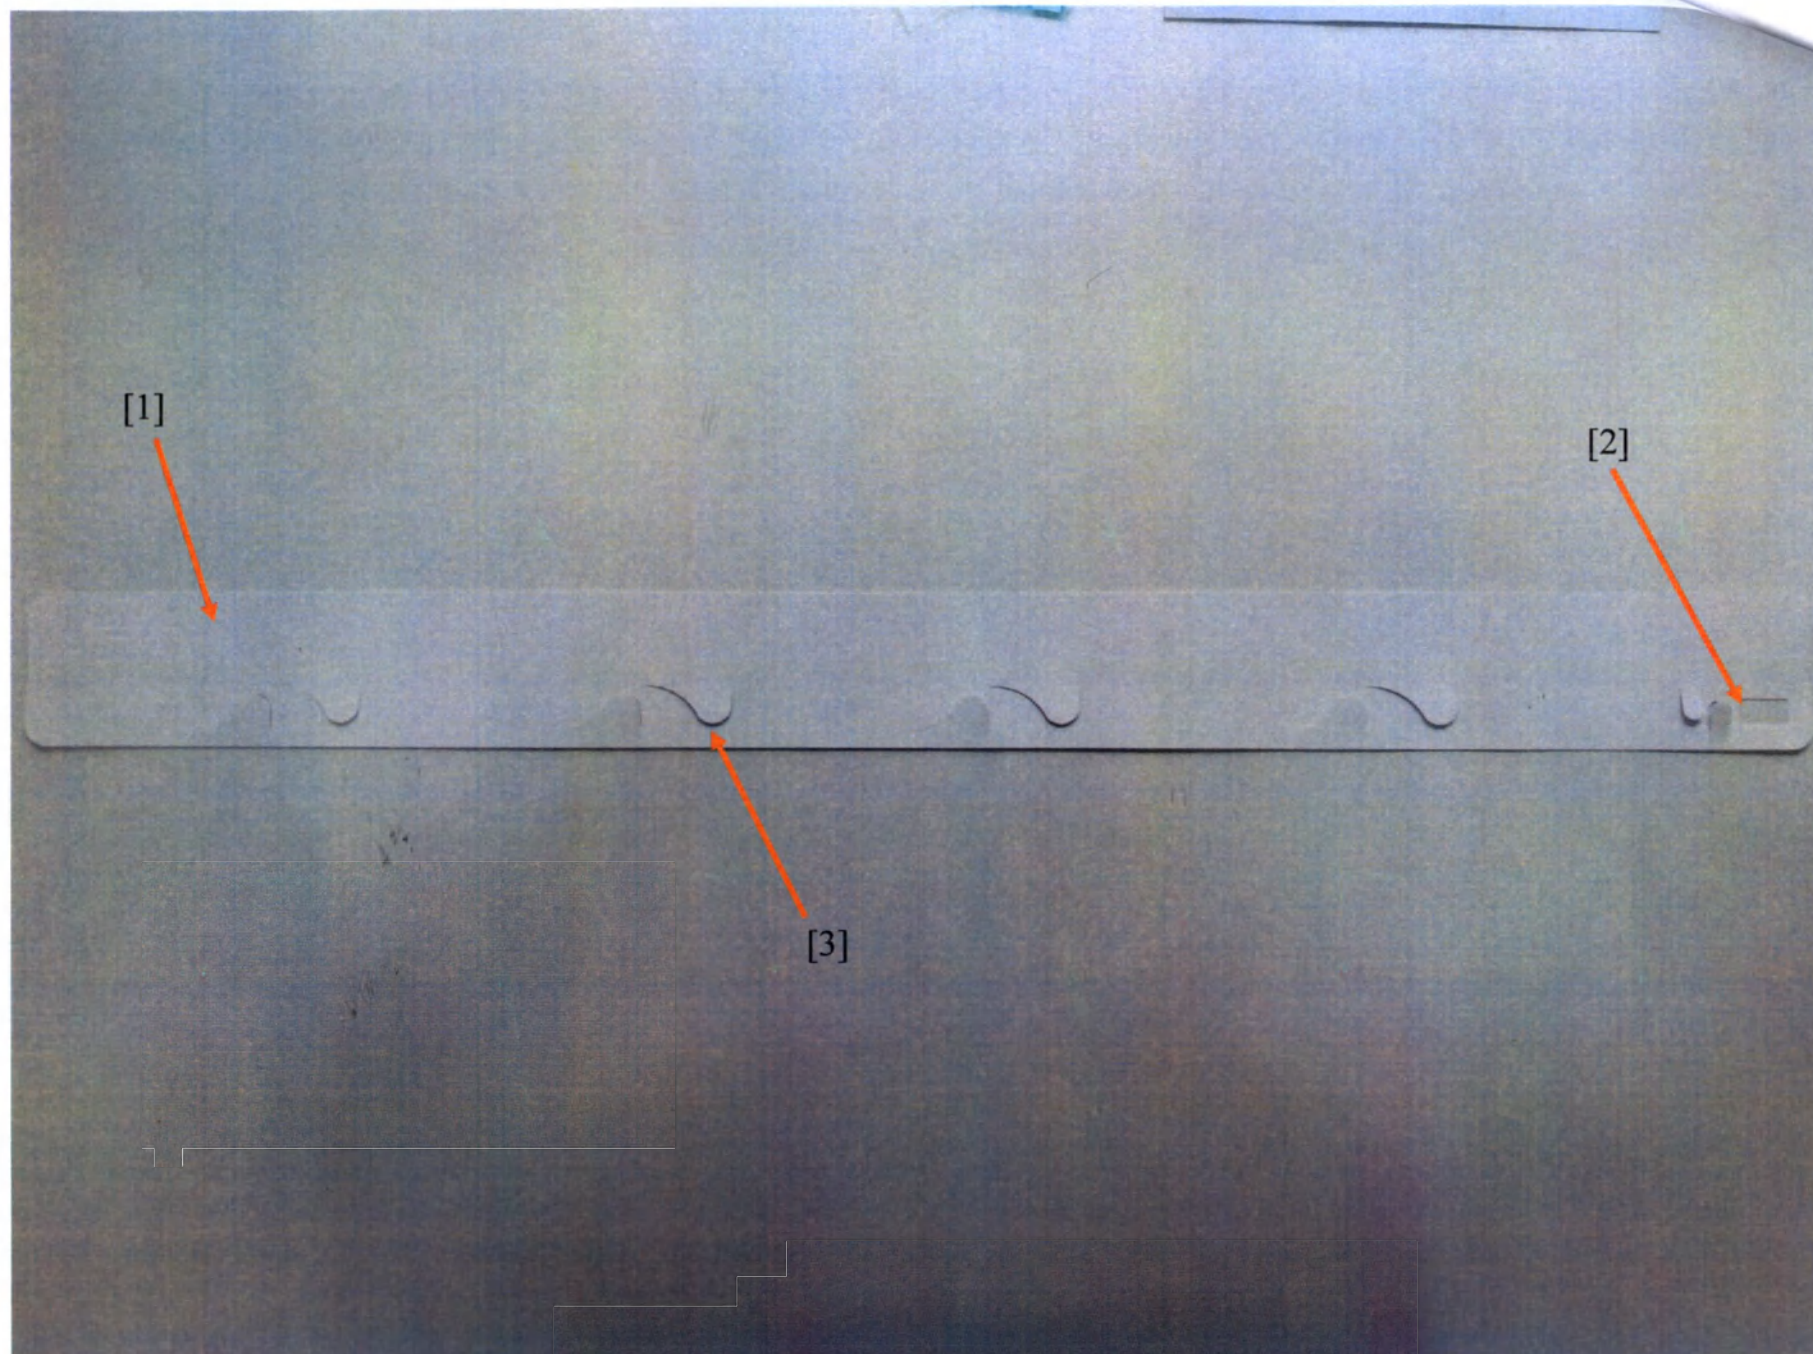

Упаковочная подложка [1], фиксатор хаба [2] и набор язычков [3]



Запечатываемый пакет



IMAGET-11

Technical specifications and other information in Russian and English.

Н1 Selective (1,75 mm)

ВР 5 GTIN 184 mm

Характеристики и другие данные.

Технические характеристики.

Свойства и другие данные.

Технические характеристики.

Свойства и другие данные.

Технические характеристики.

Свойства и другие данные.

Технические характеристики.

Свойства и другие данные.

Технические характеристики.

Свойства и другие данные.

Коробка для хранения

5F Sel. C2
08714729736691
M001314670
00180970

Boston Scientific
IMAGER™ II

Angiographic Catheter
Catéter angiográfico, Cathéter pour angiographie, Angiographiekatheter, Catetere angiografico, Angiografiekatheter, 血管造影用カテーテル, Angiografikateter, Αγγειογραφικός καθετήρας, Cateter Angiográfico, Angiografisk kateter, Angiográfás katéter, Angiografický katér, Cewnik angiograficzny, Angiografikateter, Anjiyografi Kateteri.

C2 Selective
5 F (1.70 mm)

Contents 1 **GTIN** 08714729736691

SL Shaft Length 65 cm

GW Maximum Guidewire OD .035 in (0.89 mm)

SH Side Holes 0

PO Maximum Pressure 7240 kPa 1050 psi

MAX FLOW
Flujo máximo Débit max. Max. Durchfluss Fluss maxime Max. disarmping 最大流量 Max. flow maximum pour Flux Max. Max. Side Maximum Anemia Max. prietok Maks. przepływ Maks. flow Maks. Alqy 20 cm³/s

Catalog No. M001314670

00180970 Use By 2023-08-05

Consult instructions for use For single use only. Do not reuse.

Do Not Sterilize Sterilized using ethylene oxide.

Do not use if package is damaged.

Label Graphic: M014113 Rev 05

Boston Scientific

5F Sel. C2
08714729736691
M001314670
00180970

5F Sel. C2
08714729736691
M001314670
00180970

5F Sel. C2
08714729736691
M001314670
00180970

Legal Manufacturer
Manufactured by:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 800-272-1801

EC REP EU Authorized Representative
Boston Scientific Limited
Ballybri Business Park
Galway
IRELAND
Made in Ireland
Unit 7, 8 & 9 Annessey Business Park
Annessey
Co. Limerick, Ireland

CE2797

Rx ONLY

LC10003-01-01 Rev 08

08714729736691(117290900)(1000180970)

Boston Scientific IMAGER™ II

Angiographic Catheter

Catéter angiográfico, Cathéter pour angiographie, Angiographiekatheter, Catetere angiografico, Angiografiekateter, 血管造影用カテーテル, Angiografikateter, Αγγειογραφικός καθετήρ, Cateter Angiográfico, Angiografisk kateter, Angiográfás katéter, Angiografický katér, Cewnik angiograficzny, Angiografikateter, Anjiyografi Kateteri.

Chg B Selective
5 F (1.70 mm)

Contents 5

GTIN 08714729355342

SL Shaft Length

65 cm

GW Maximum Guidewire OD

.038 in
(0.97 mm)

SH Side Holes

0

P Maximum Pressure

7240 kPa
1050 psi

MAX FLOW

Flujo máximo Débit max. Max. Durchfluss Fluss
massimo Max. doorstroming 最大フロー Max. flow
Máximo por Flujo Máx. Max. Töde Maximális áramlás
Max. průtok Máx. przepływ Máx. flow Máx. Åkg

10 cm³/s

Catalog No. M001314521

LOT 00163713

Use By 2023-11-18

Consult instructions
for use

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Resterilize

STERILE EO Sterilized using
ethylene oxide.

Do not use if package
is damaged.

Boston Scientific STERILE No Reuse	GTIN	08714729355342
	REF	M001314521
	LOT	00163713
Boston Scientific STERILE No Reuse	GTIN	08714729355342
	REF	M001314521
	LOT	00163713
Boston Scientific STERILE No Reuse	GTIN	08714729355342
	REF	M001314521
	LOT	00163713

Legal Manufacturer

Manufactured for:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

EC REP EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Ballylinn Business Park
Galway
IRELAND
Made in Ireland
Unit 7, 8 & 9 Annacotty Business Park
Annacotty
Co. Limerick, Ireland

CE2797

Rx ONLY



LC10208-01-05 Rev 04

0108714729355342(17/231118)(10/0163713)

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
24 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

