

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения
свободного антимюллерова гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме
крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур»
для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022»**

Картридж (в составе: реагент парамагнитных частиц (R1), 3,5 мл/уп; реагент меченных антител (R2), 4,0 мл/уп.)

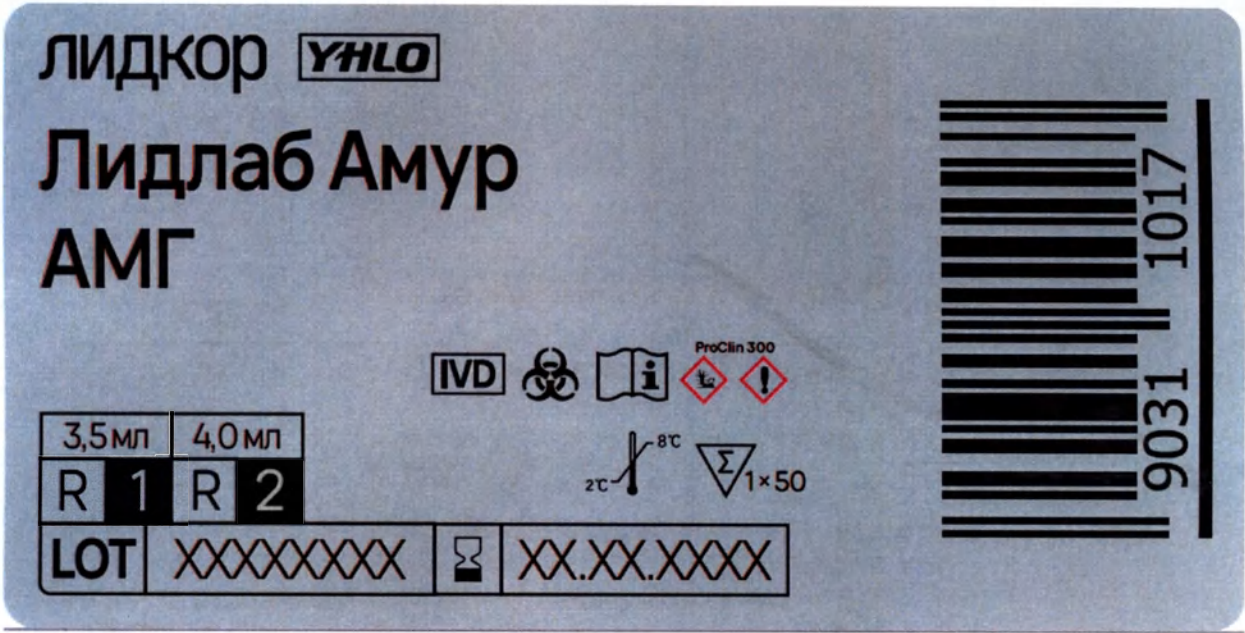

Калибратор 1 (CAL1)




Калибратор 2 (CAL2)




Калибратор 3 (CAL3)



Пароизоляционные крышки

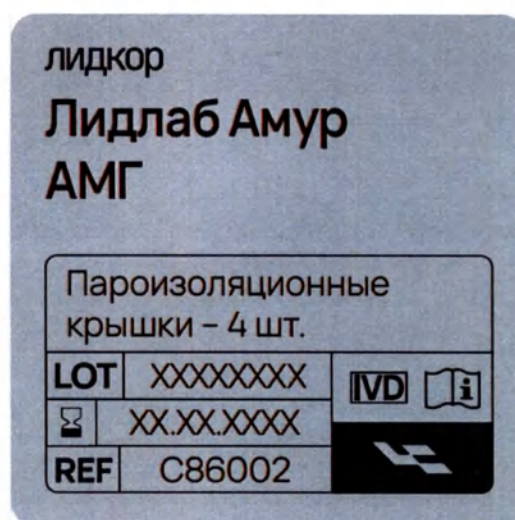





QR-code

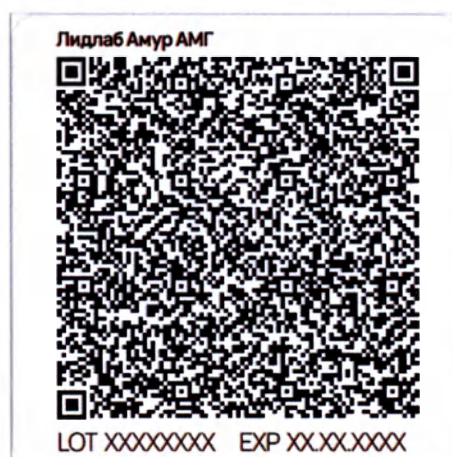


Наклейка




Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антигиперлоразов гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а	 Лидлаб Амур АМГ Набор реагентов на 100 тестов YHLO TC IVD 100 LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86002	Состав изделия 1. Картридж (в составе: реагент парамгнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.; 2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 1 флакон; 3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 1 флакон; 4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 1 флакон; 5. Паронизационные крышки – 8 шт.; 6. Инструкция по применению – 1 шт.; 7. Аналитический паспорт – 1 шт.
Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антигиперлоразов гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а	 Лидлаб Амур АМГ Набор реагентов на 200 тестов YHLO TC IVD 200 LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86002	Состав изделия 1. Картридж (в составе: реагент парамгнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.; 2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 2 флакона; 3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 2 флакона; 4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 2 флакона; 5. Паронизационные крышки – 16 шт.; 6. Инструкция по применению – 1 шт.; 7. Аналитический паспорт – 1 шт.
Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антигиперлоразов гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а	 Лидлаб Амур АМГ Набор реагентов на 500 тестов YHLO TC IVD 500 LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86002	Состав изделия 1. Картридж (в составе: реагент парамгнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.; 2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 5 флаконов; 3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 5 флаконов; 4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 5 флаконов; 5. Паронизационные крышки – 40 шт.; 6. Инструкция по применению – 1 шт.; 7. Аналитический паспорт – 1 шт.
Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антигиперлоразов гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а	 Лидлаб Амур АМГ Набор реагентов на 1000 тестов YHLO TC IVD 1000 LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86002	Состав изделия 1. Картридж (в составе: реагент парамгнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.; 2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 10 флаконов; 3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 10 флаконов; 4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 10 флаконов; 5. Паронизационные крышки – 80 шт.; 6. Инструкция по применению – 1 шт.; 7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская коробка

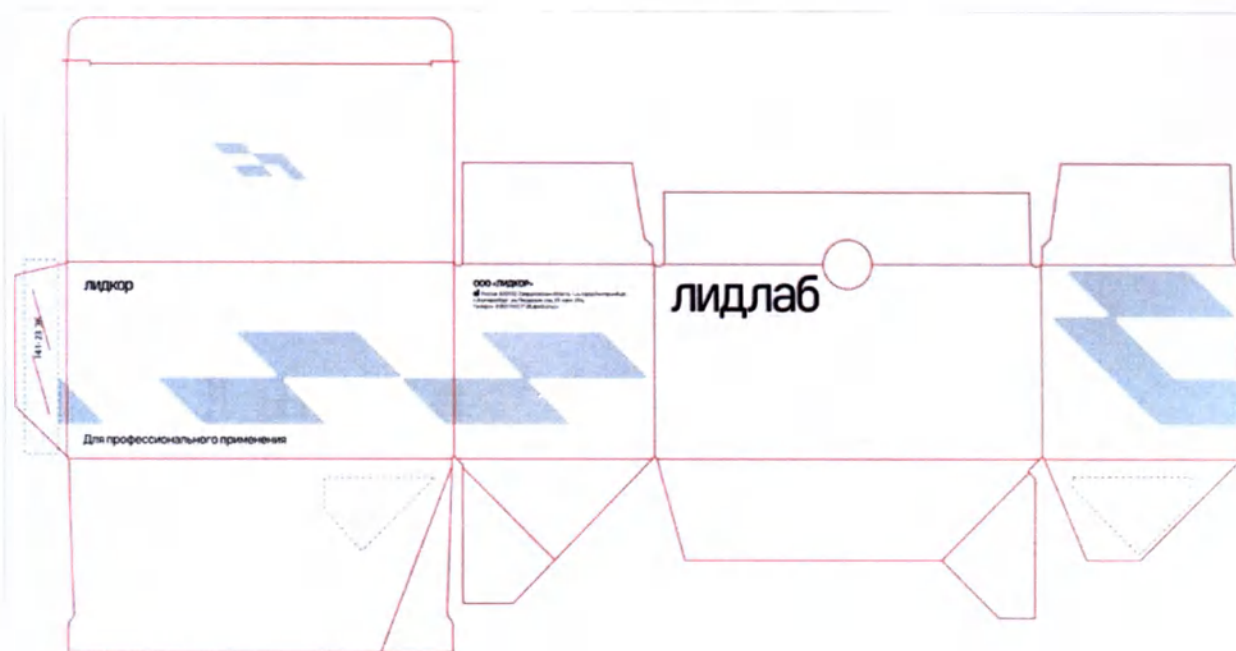

Транспортная упаковка



Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антиюллера гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro no TY 21.20.23 – 215-65614693-2022




Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX	
LOT	XXXXXXXXXX	XX.XX.XXXX	REF C86002



Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антиюллера гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022

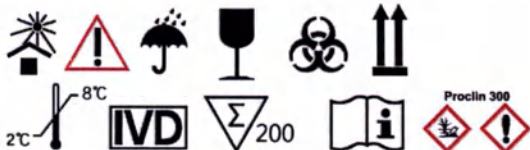


Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXX	XX.XX.XXXX	REF	C86002




Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антиюллера гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022

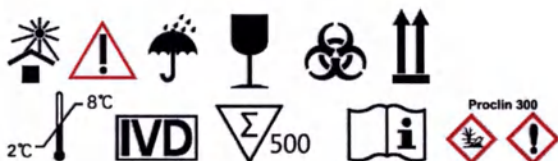


Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXX	XX.XX.XXXX	REF	C86002



Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антиюллера гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022

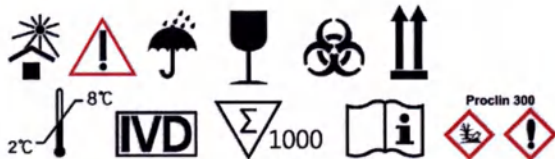

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXX	XX.XX.XXXX	REF	C86002

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью



Директор
ООО «ЛИДКОР»

_____ /Е. Ю. Гохгут/

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

2023 г.


М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур АМГ» для количественного определения свободного антимюллерова гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 215-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

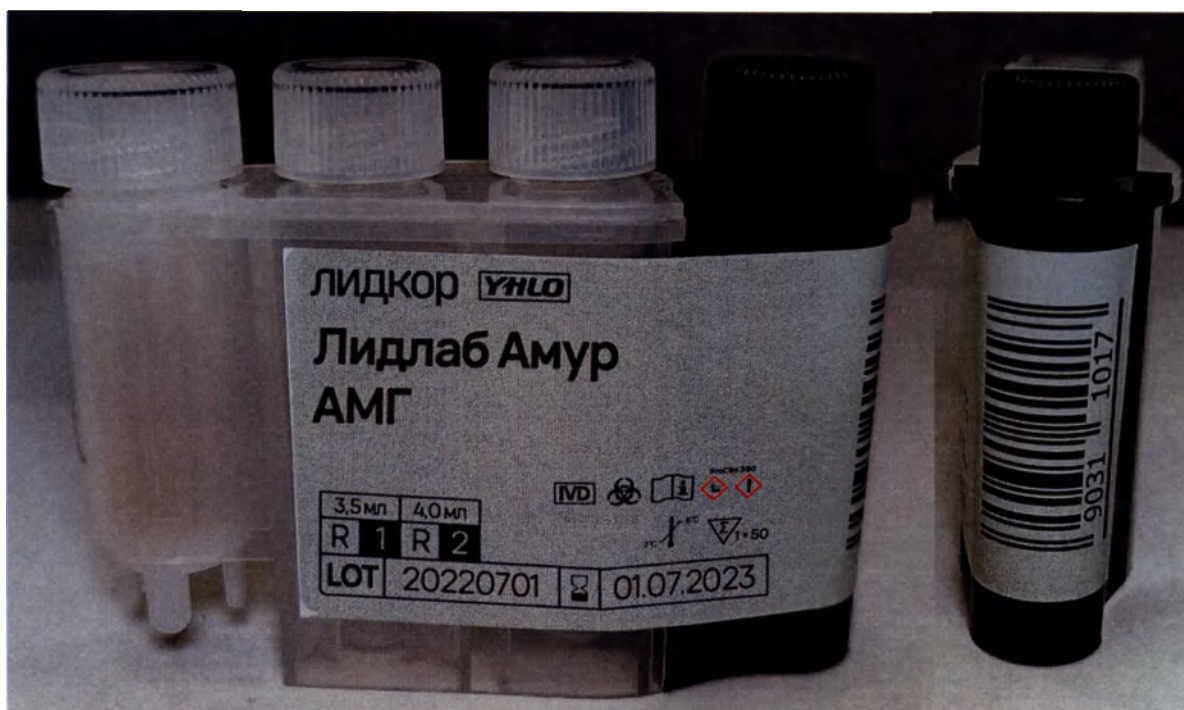


Пароизоляционные крышки




Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат




Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат

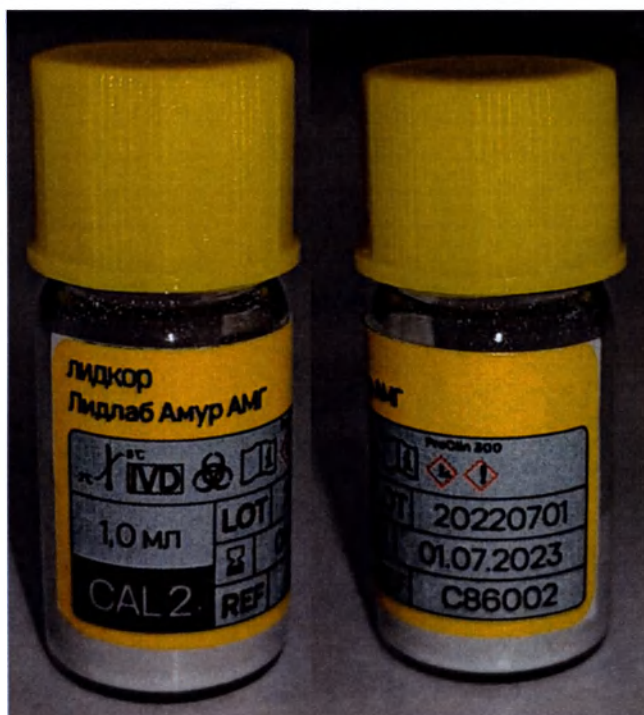


Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат

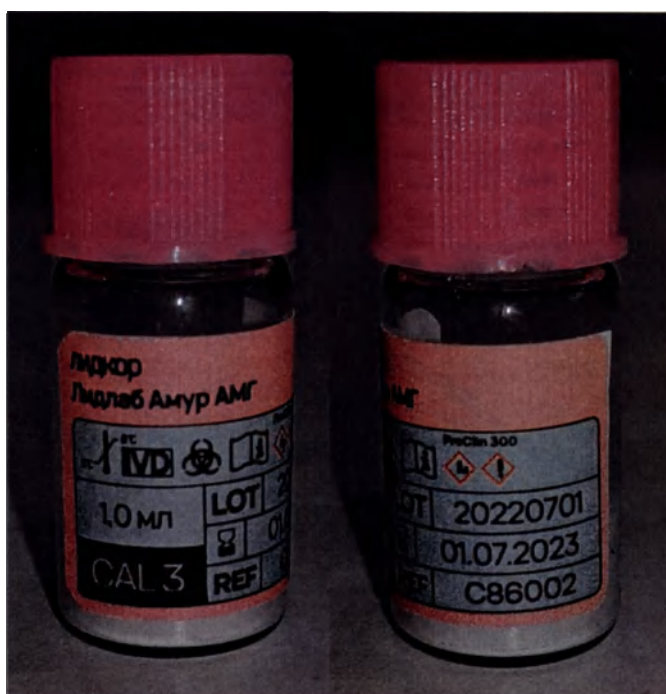

Потребительская упаковка

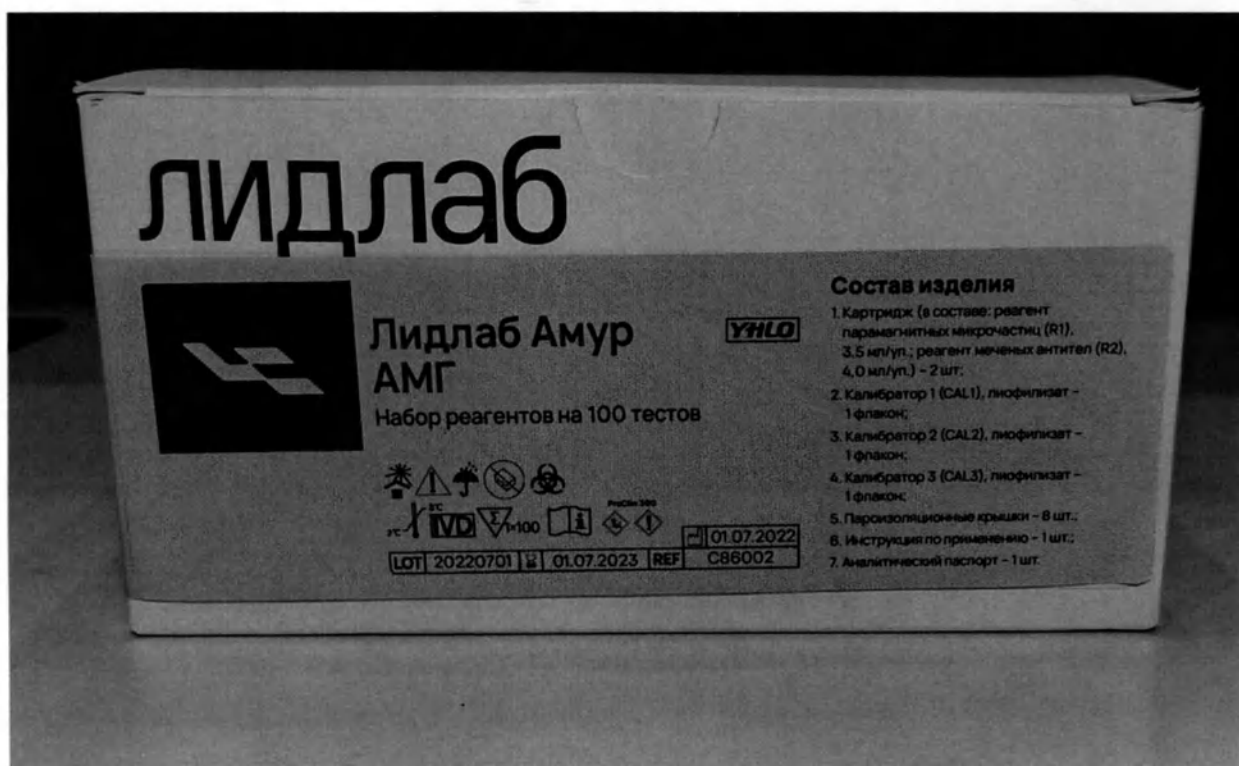


Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

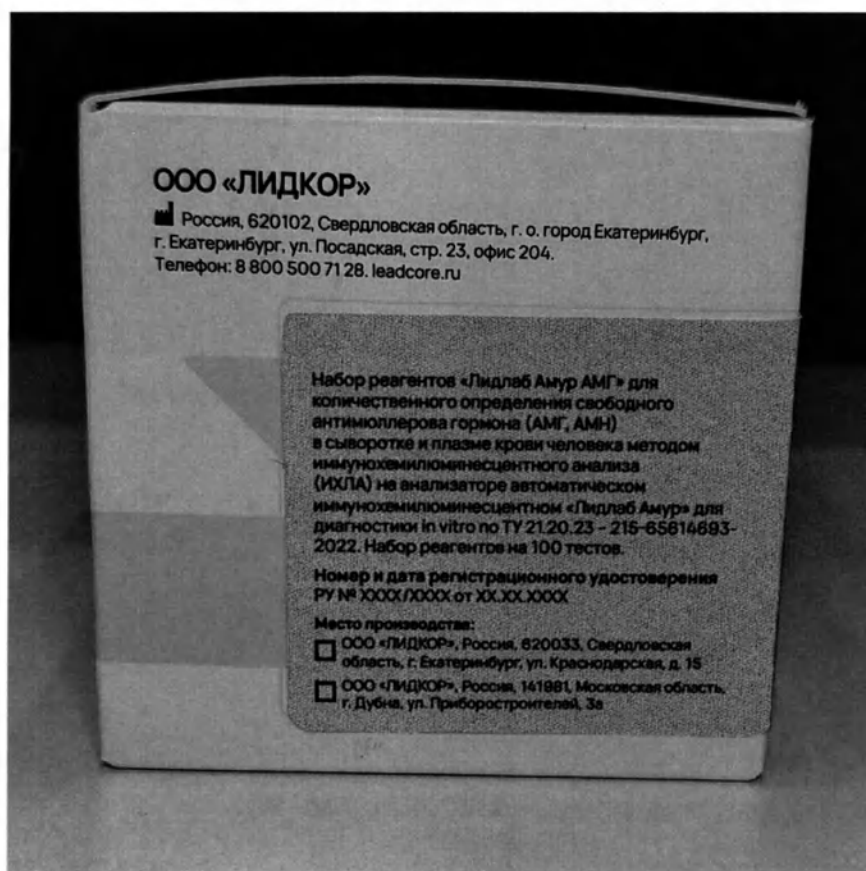


Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

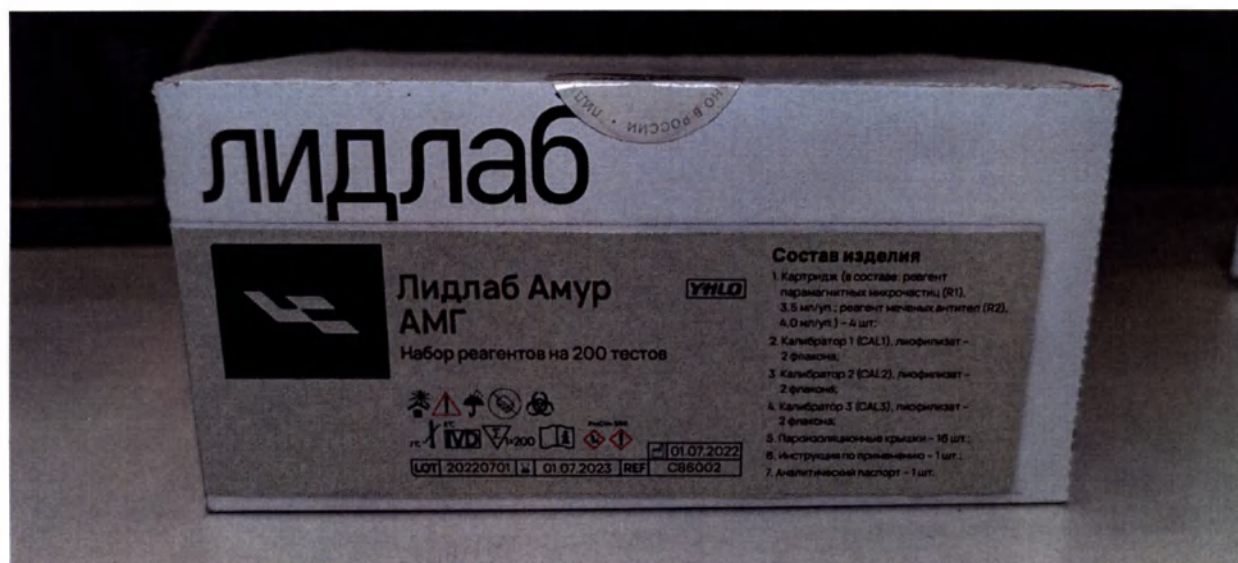


Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

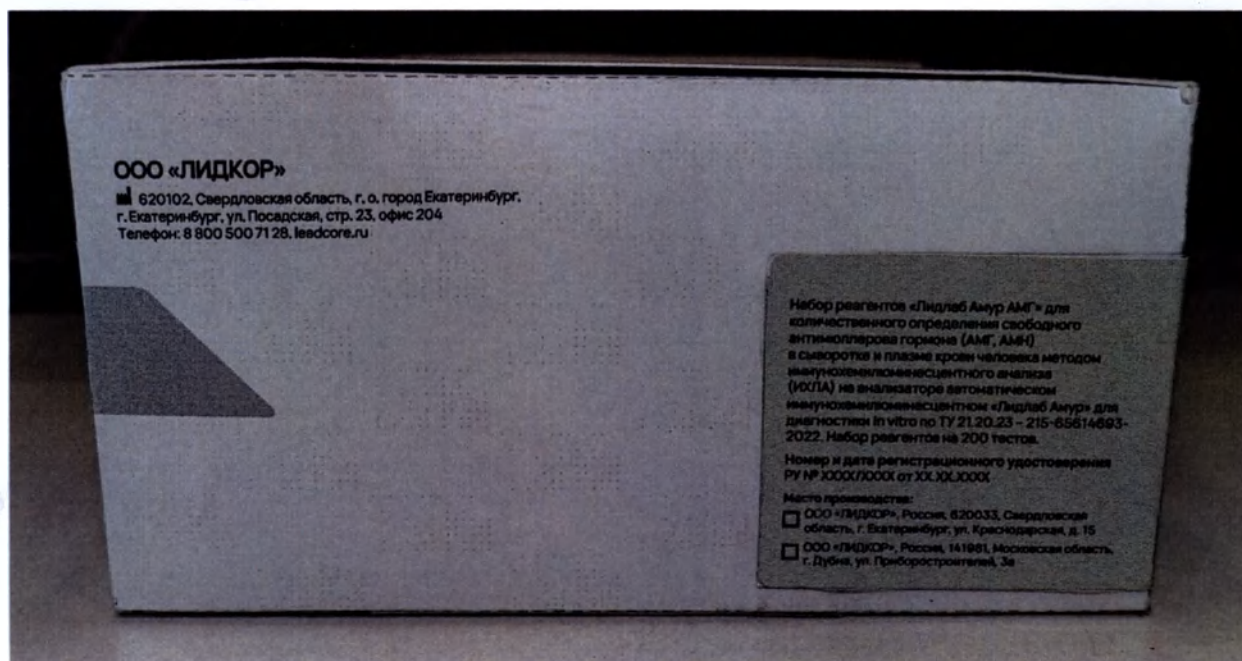


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)

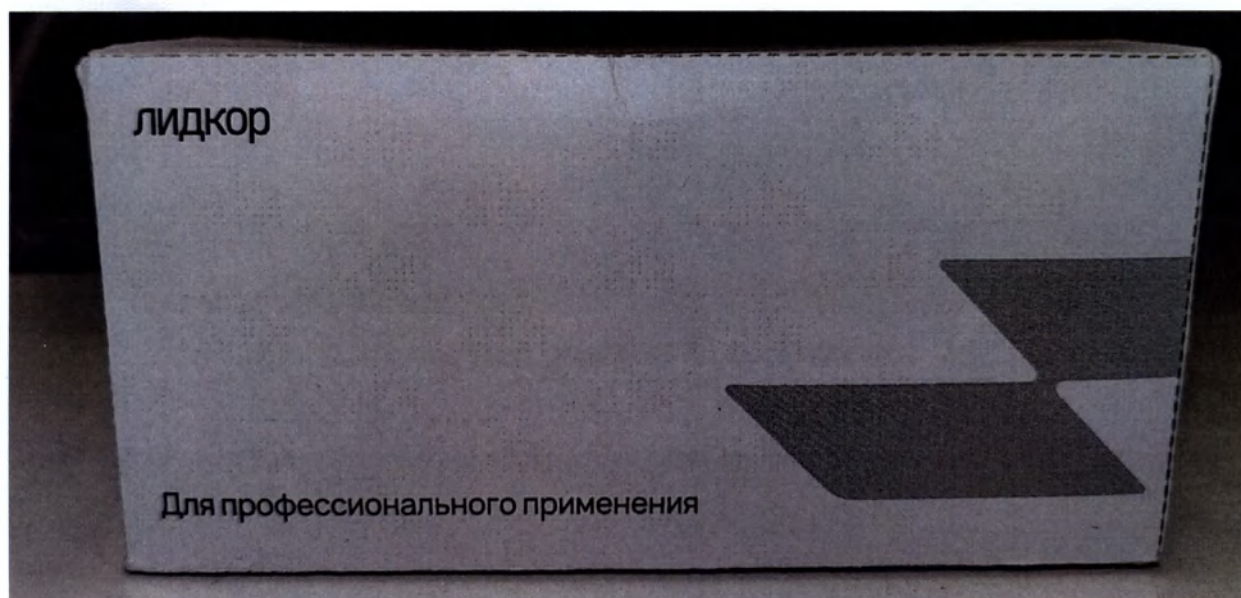

Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

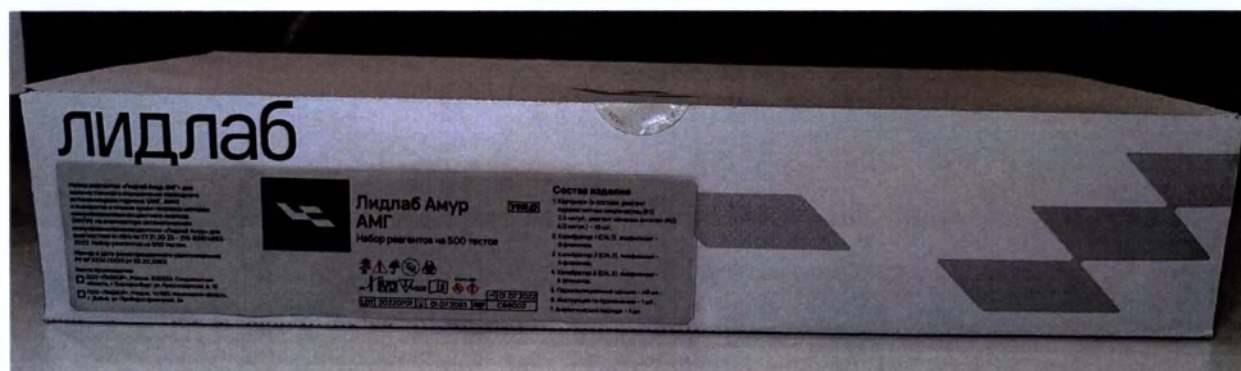

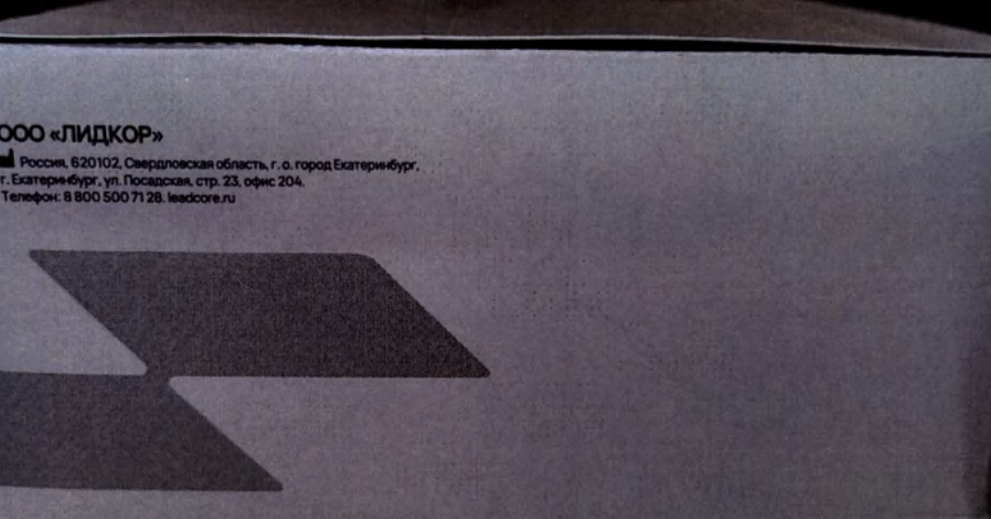

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)






Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.



Транспортная упаковка

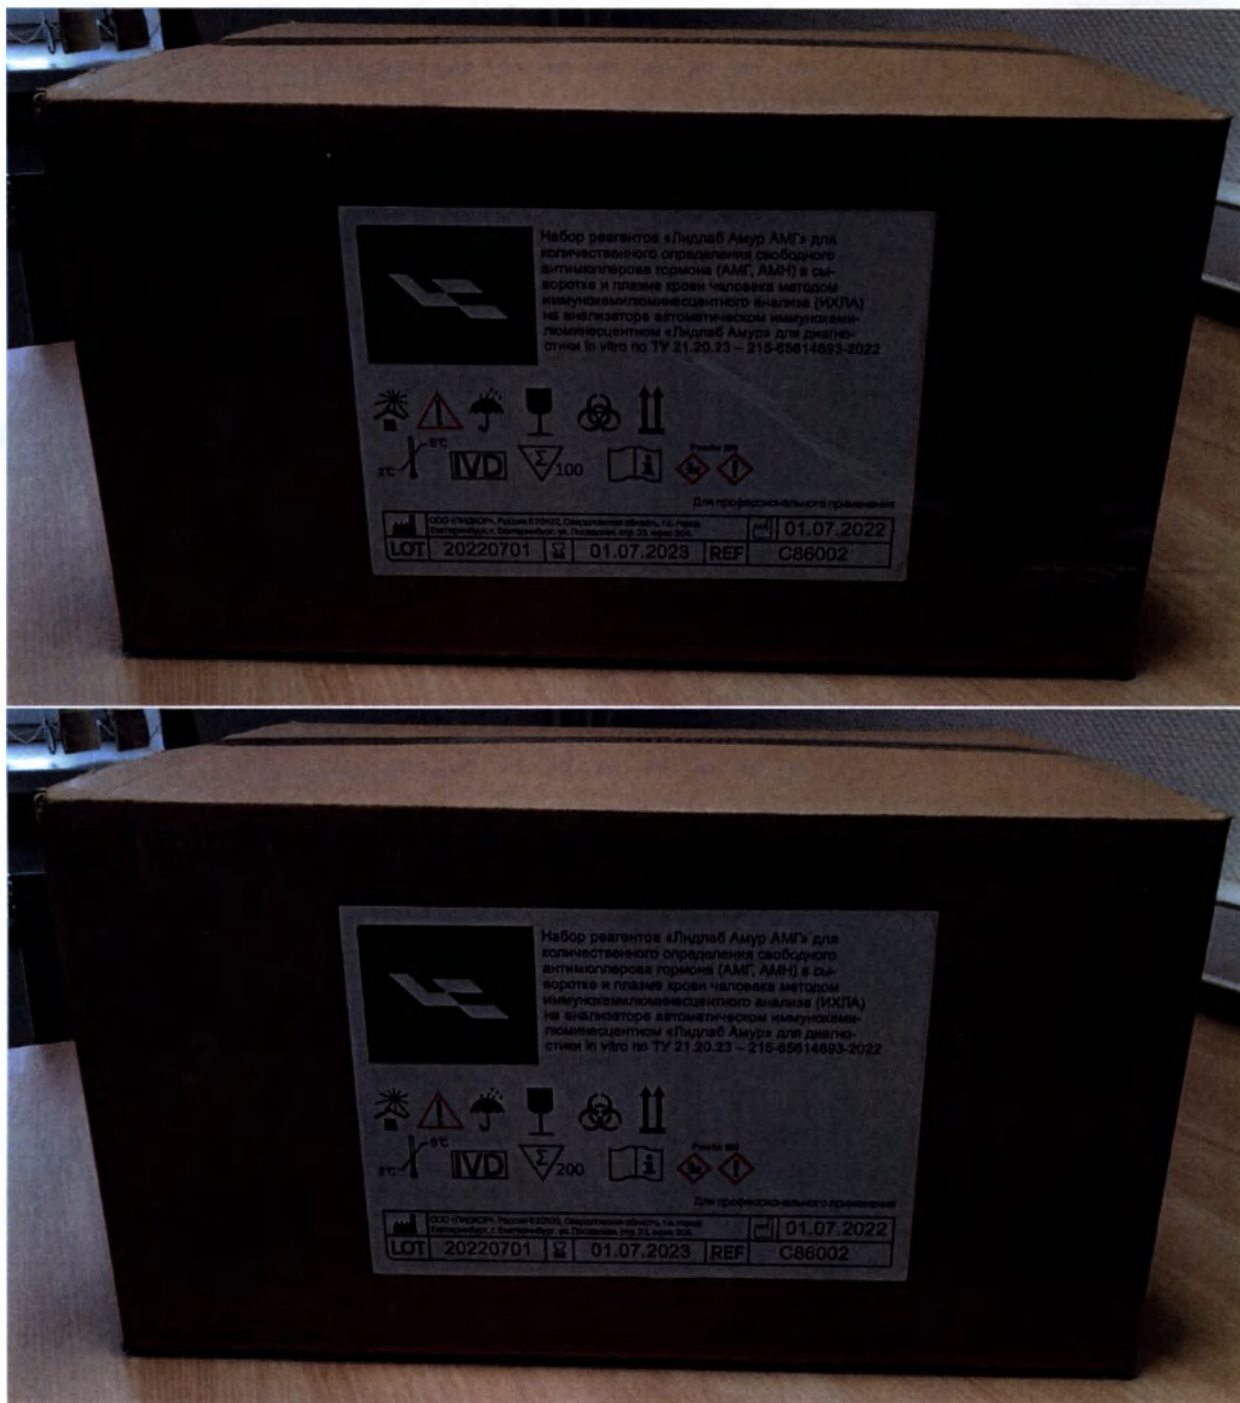

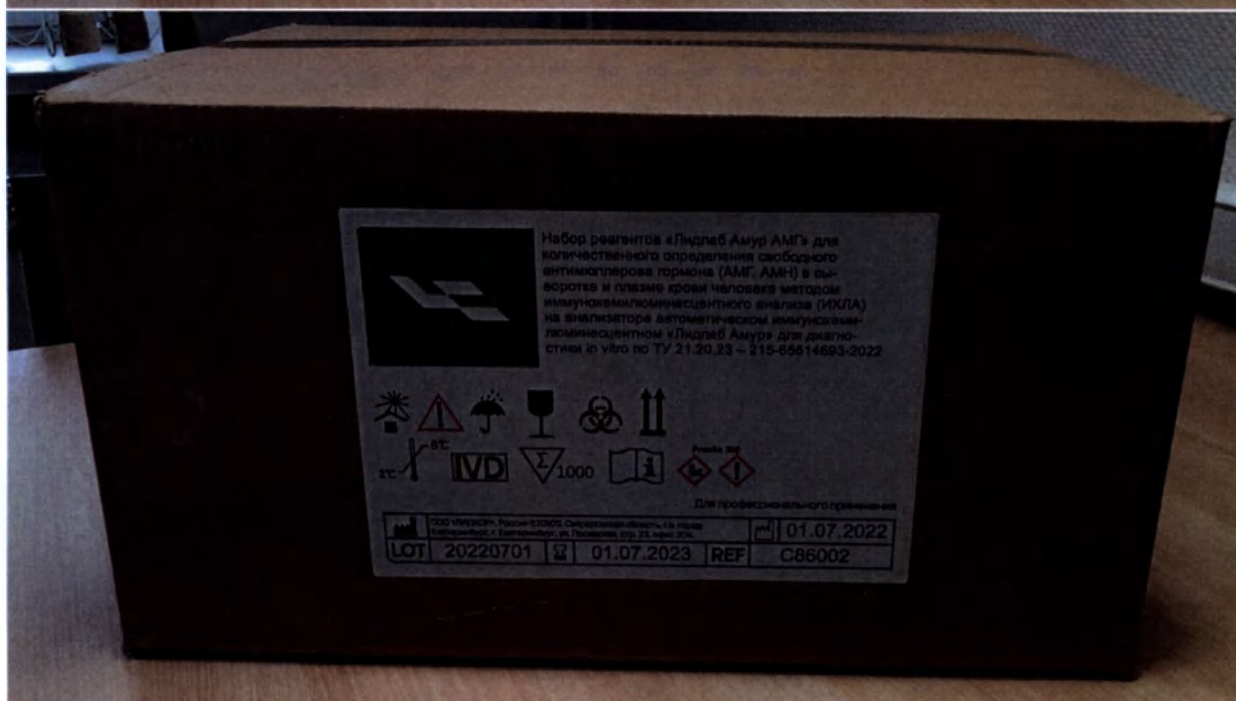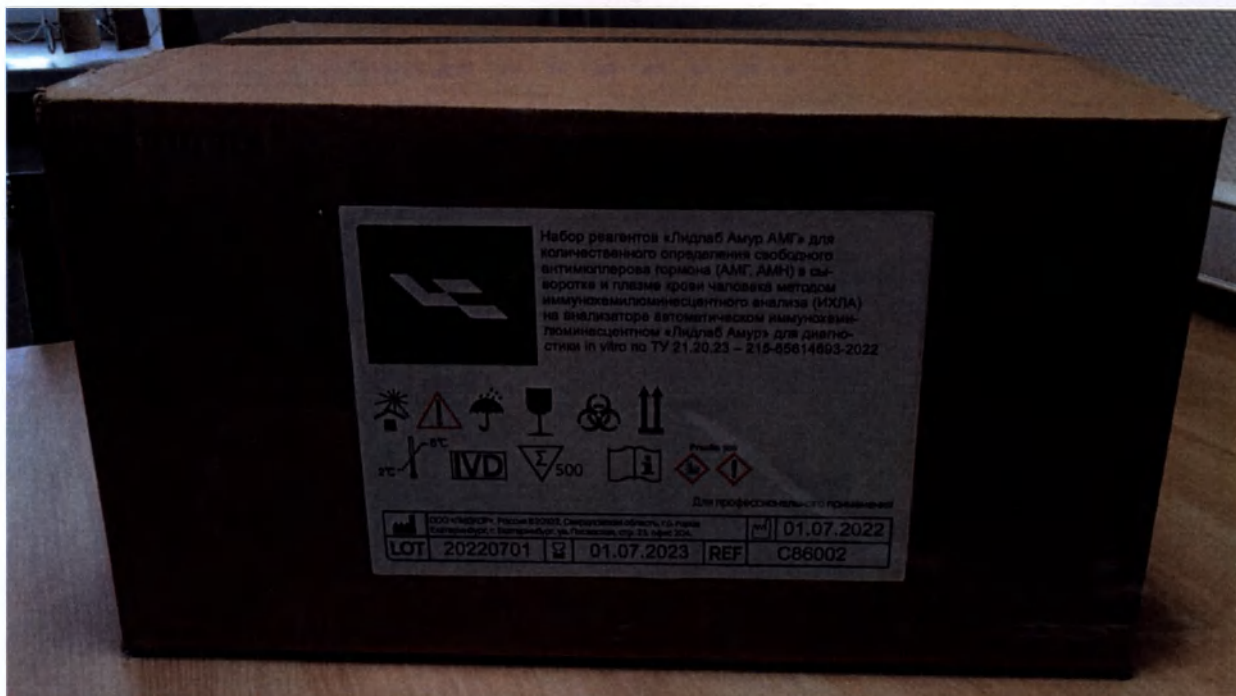

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать)) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/