

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«01» _____ 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур АМГ Контроль» для контроля качества количественного определения свободного антимюллерова гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 284-65614693-2022»

Потребительская упаковка

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур АМГ Контроль» для контроля качества количественного определения свободного антииоллерова гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 284-65614693-2022.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур АМГ Контроль

YHLO

LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX
REF CC818

Состав изделия

- Контрольный материал низкой концентрации, 3 мл/уп. – 2 флакона;
- Контрольный материал высокой концентрации, 3 мл/уп. – 2 флакона;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HbSAg отсутствуют

Контрольный материал высокой концентрации, 3 мл/уп

Лидлаб Амур АМГ Контроль

Контрольный материал высокой концентрации

лидкор

YHLO

3,0 мл	 			Контрольный материал инактивирован
Н	LOT XXXXXXXX	XX.XX.XXXX	REF CC818	

Контрольный материал низкой концентрации, 3 мл/уп

Лидлаб Амур АМГ Контроль

Контрольный материал низкой концентрации

лидкор


YHLO

3,0 мл	 			Контрольный материал инактивирован
L	LOT XXXXXXXX	XX.XX.XXXX	REF CC818	


Наклейка



Потребительская коробка

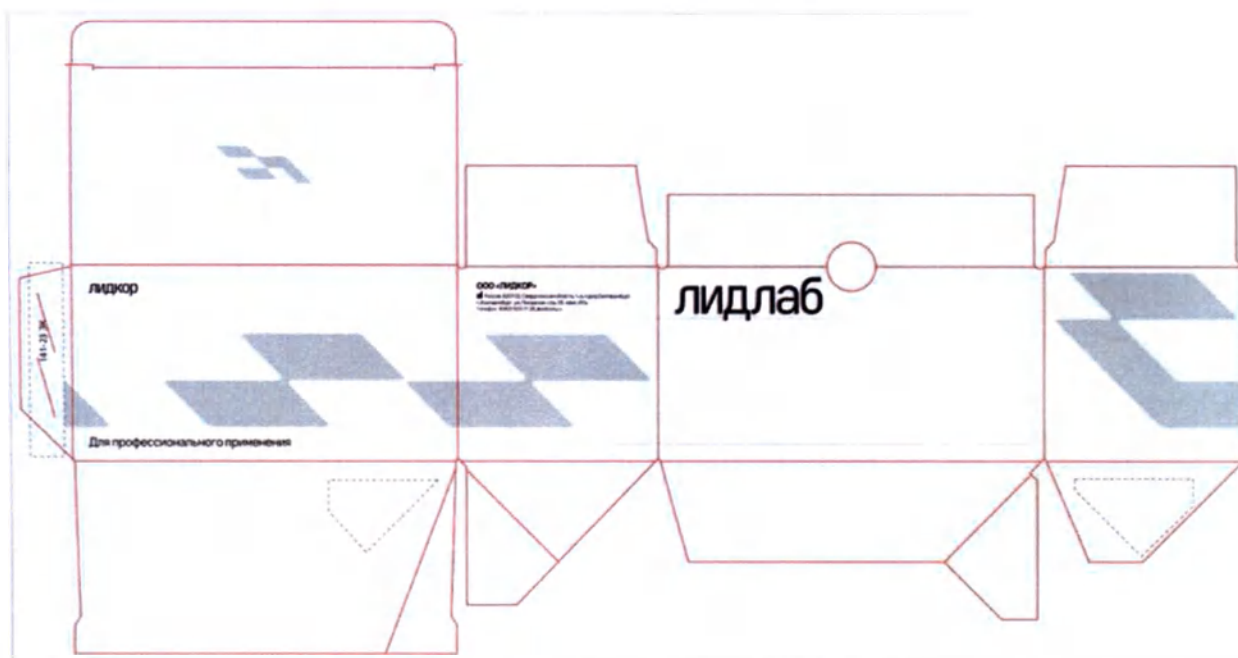

Транспортная упаковка



Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур АМГ Контроль» для контроля качества количественного определения свободного антимюллерова гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 284-65614693-2022



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX	
LOT	XXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	CC818

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____) л.



Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Еохгут

«01» февраля 2022 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур АМГ Контроль» для контроля качества количественного определения свободного антимюллерова гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 284-65614693-2022»

Контрольный материал высокой концентрации, 3 мл/уп




Контрольный материал низкой концентрации, 3 мл/уп




Потребительская упаковка



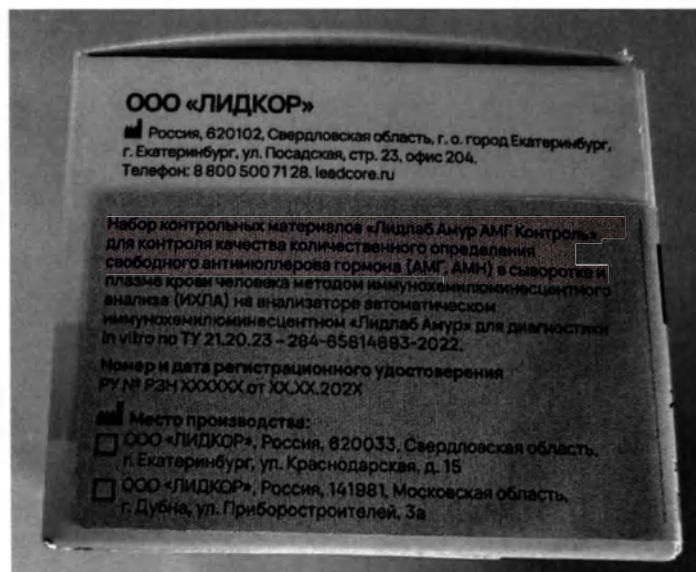

Фотографическое изображение общего вида

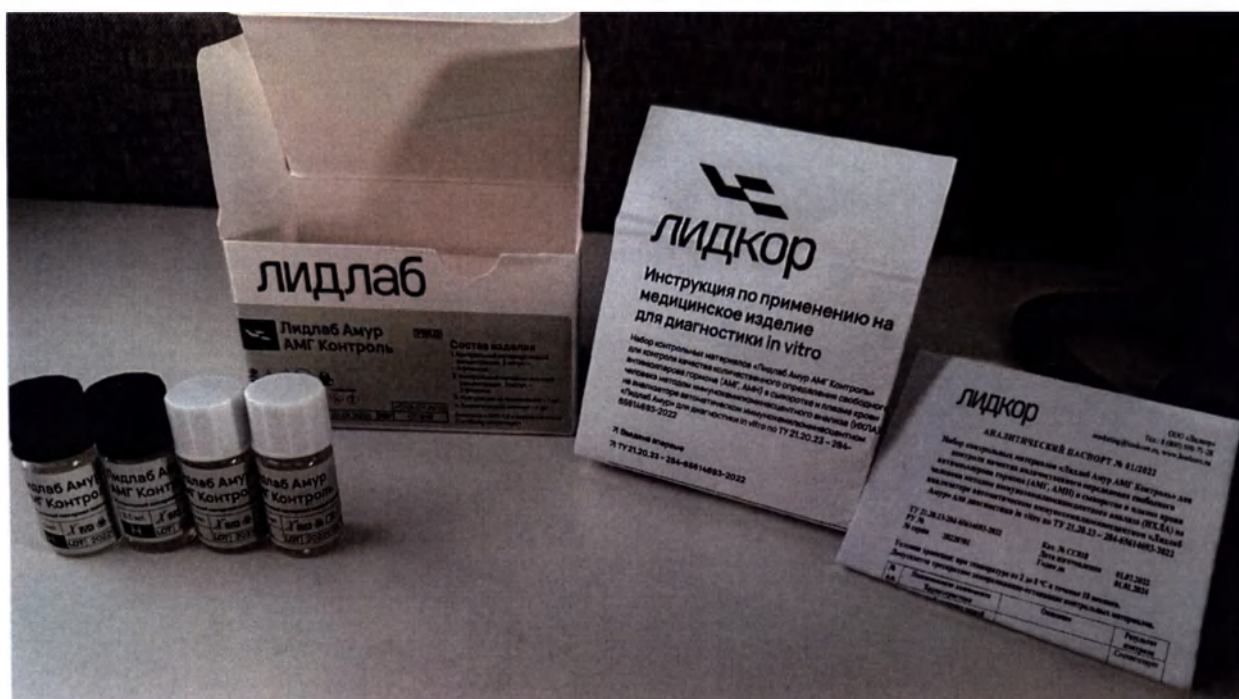

Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР» _____ Е. Ю. Гохгут/

