




Фотографическое изображение медицинского изделия «Маркер тканей молочных желез UltraCor Twirl при проведении биопсии, размер: 17G, длина 10 см» в стерильной упаковке

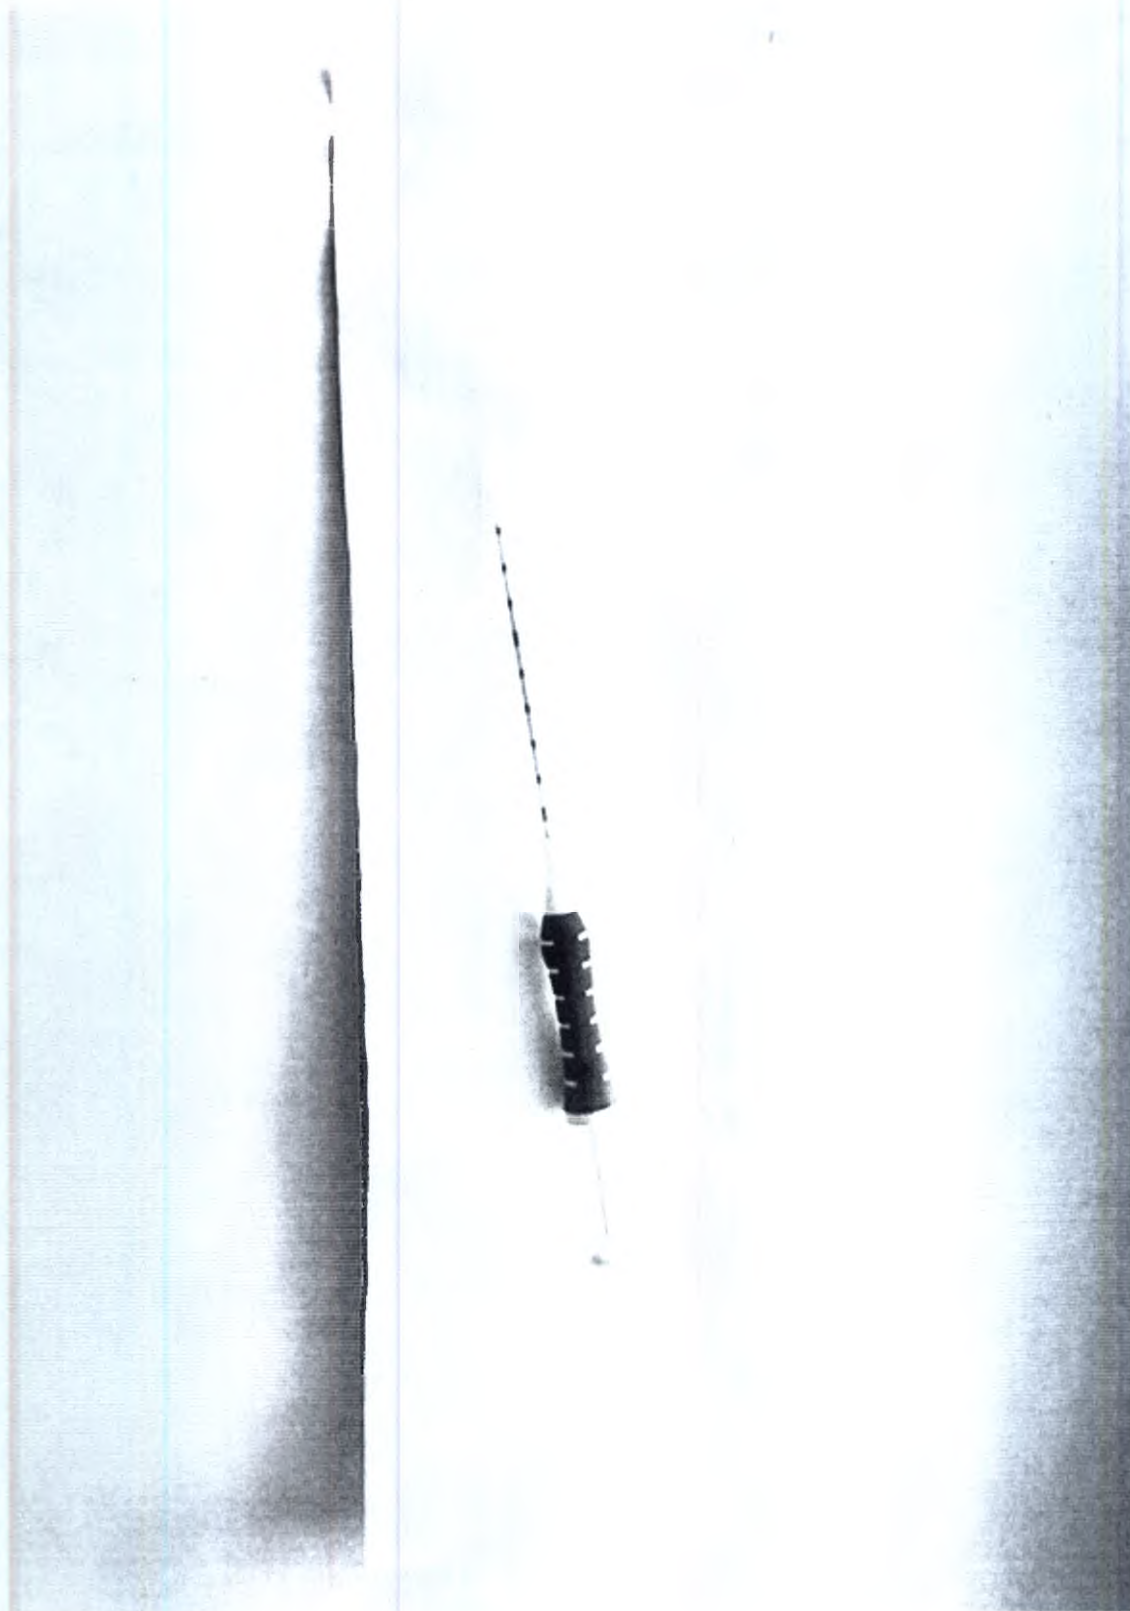

Фотографическое изображение оригинального лейбла на стерильной упаковке медицинского изделия «Маркер тканей молочных желез UltraCor Twirl при проведении биопсии, размер: 17G, длина 10 см»

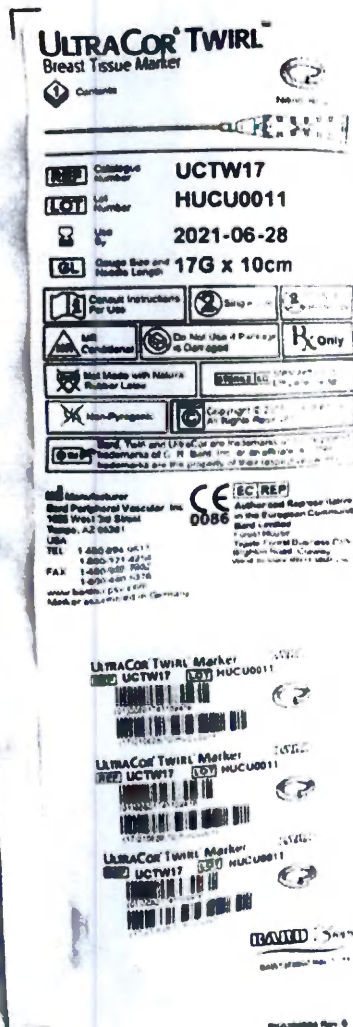

Фотографическое изображение вторичной упаковки для медицинского изделия «Маркер тканей молочных желез UltraCor Twirl при проведении биопсии, размер: 17G, длина 10 см»

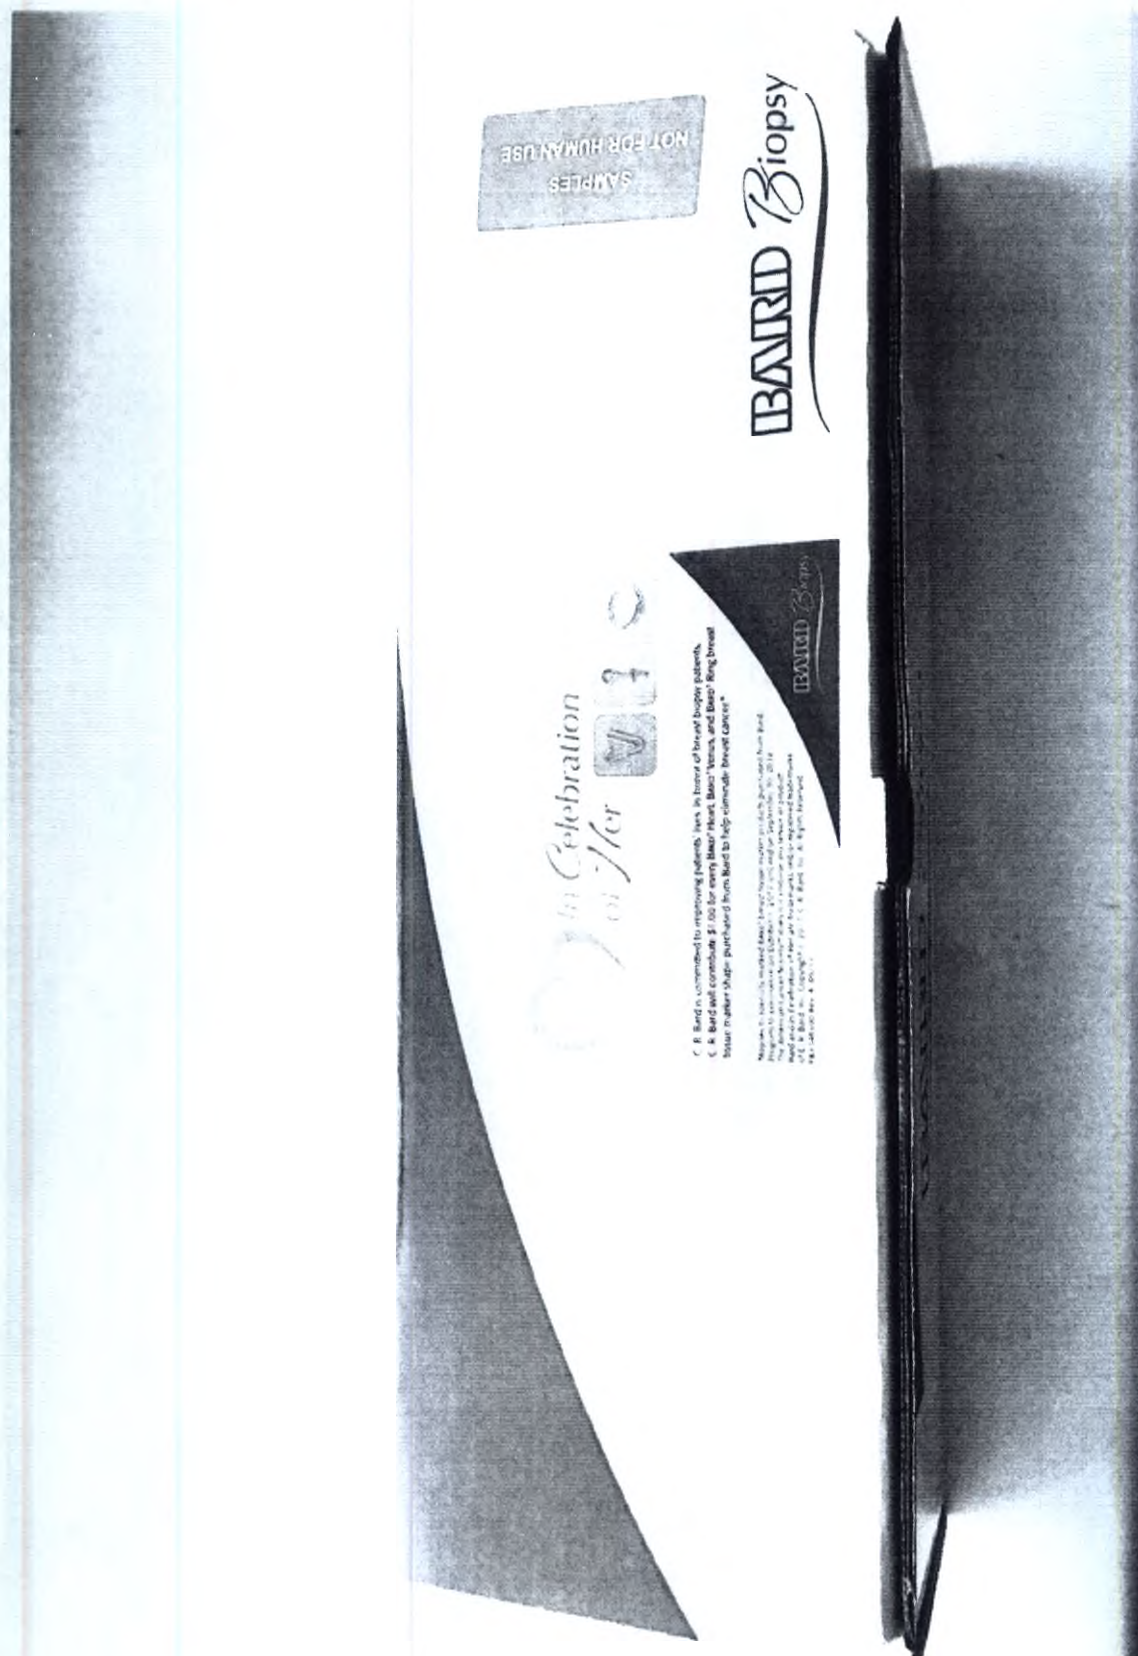

 **Manufacturer**
Bard Peripheral Vascular, Inc.
 1625 West 3rd Street
 Tempe, AZ 85281
 USA
 TEL: 1-480-894-9515
 1-800-321-4254
 FAX: 1-480-966-7062
 1-800-440-5376
www.bardbiopsy.com
 Marker assembled in Germany

 **0086** **EC REP**
 Authorised Representative
 in the European Community
Bard Limited
 Forest House
 Tilgate Forest Business Park
 Brighton Road, Crawley
 West Sussex RH11 9BP, UK

BAW1368500 Rev. 0 08/15

 Consult Instructions For Use	 Single Use	 Do Not Resterilize
 MR Conditional	 Do Not Use if Package is Damaged	Rx only
 Not Made with Natural Rubber Latex	STERILE EO Sterilized Using Ethylene Oxide	
 Non-Pyrogenic	 Copyright © 2015 C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.	
 Bard, Twirl and UltraCor are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc. or an affiliate. All other trademarks are the property of their respective owners.		

Фотографическое изображение оригинального лейбла на вторичной упаковке медицинского изделия «Маркер тканей молочных желез UltraCor Twirl при проведении биопсии, размер: 17G, длина 10 см»