

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для количественного определения адренокортикотропного гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для количественного определения адренокортикотропного гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур АКТГ

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86035

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченных антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 1 флакон;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 1 флакон;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 1 флакон;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для количественного определения адренокортикотропного гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур АКТГ

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86035

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченных антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 2 флакона;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 2 флакона;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 2 флакона;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для количественного определения адренокортикотропного гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур АКТГ

Набор реагентов на 500 тестов

YNLO



2°C

IVD

Σ 1x500

ProClin 300

01.07.2023

LOT

20230701

01.07.2024

REF

C86035

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченных антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 5 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 5 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 5 флаконов;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для количественного определения адренокортикотропного гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур АКТГ

Набор реагентов на 1000 тестов

YNLO



2°C

IVD

Σ 1x1000

ProClin 300

01.07.2023

LOT

20230701

01.07.2024

REF


C86035

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченных антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 10 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 10 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 10 флаконов;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
АКТГ



3,5мл	4,0мл
R 1	R 2



LOT	20230701		01.07.2024
-----	----------	---	------------



лидкор
Лидлаб Амур АКТГ

1,0 мл



ProClin 300



REF

C86035


CAL 1

LOT


20230701




01.07.2024



лидкор
Лидлаб Амур АКТГ

1,0 мл	8°C 2°C IVD B12 i ProClin 300				REF	C86035	
CAL 2	LOT	20230701			01.07.2024		

лидкор
Лидлаб Амур АКТГ

1,0 мл	8°C 2°C IVD B12 i ProClin 300				REF	C86035	
CAL 3	LOT	20230701			01.07.2024		




лидкор

**Лидлаб Амур
АКТГ**


Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



 01.07.2024


REF C86035




Лидлаб Амур АКТГ



LOT 20230701 EXP 01.07.2024

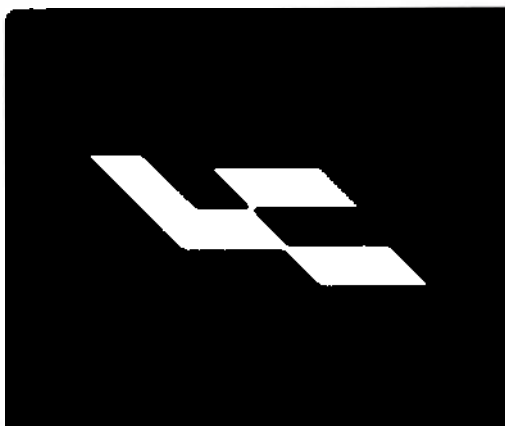


Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для
количественного определения адренокортикотропного
гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022

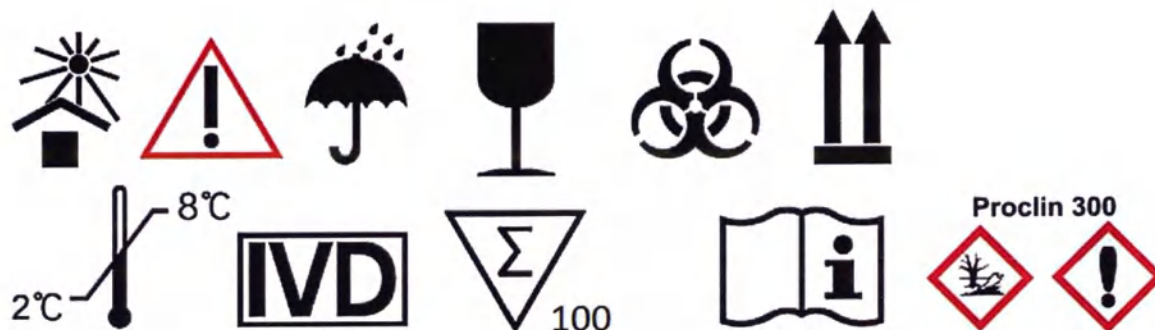


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86035

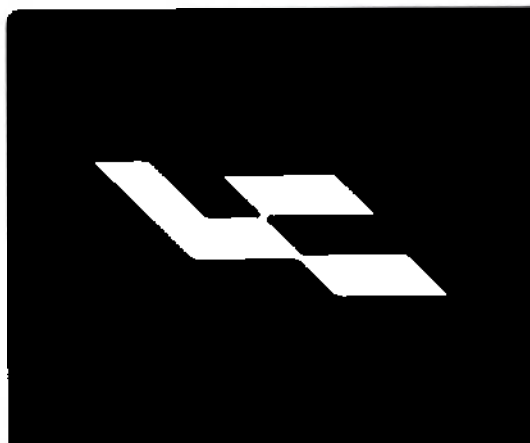


Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для
количественного определения адренокортикотропного
гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022

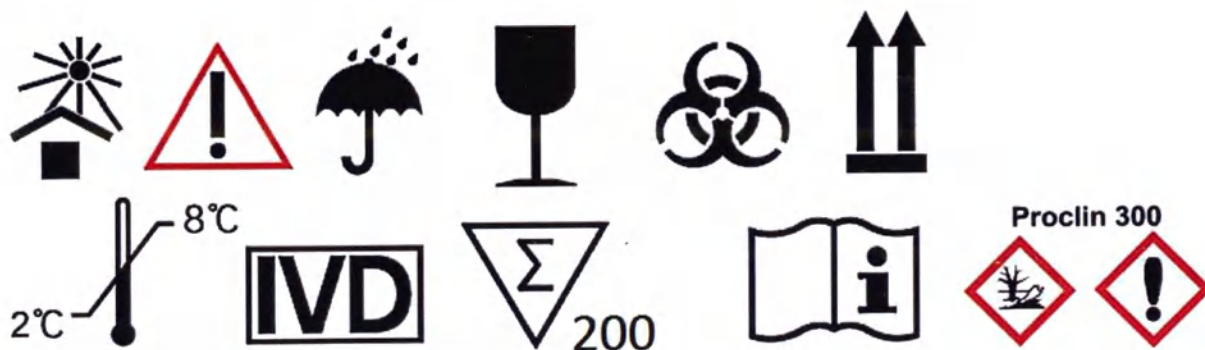


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86035

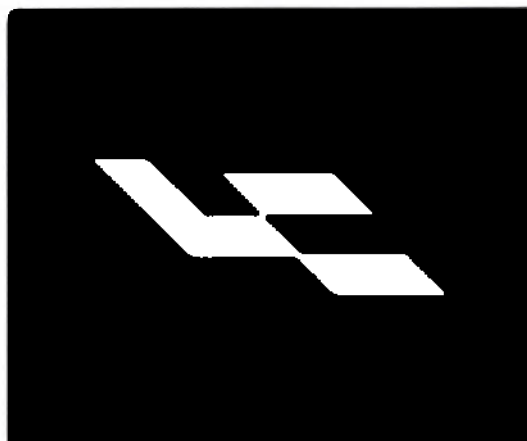


Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для
количественного определения адренокортикотропного
гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022

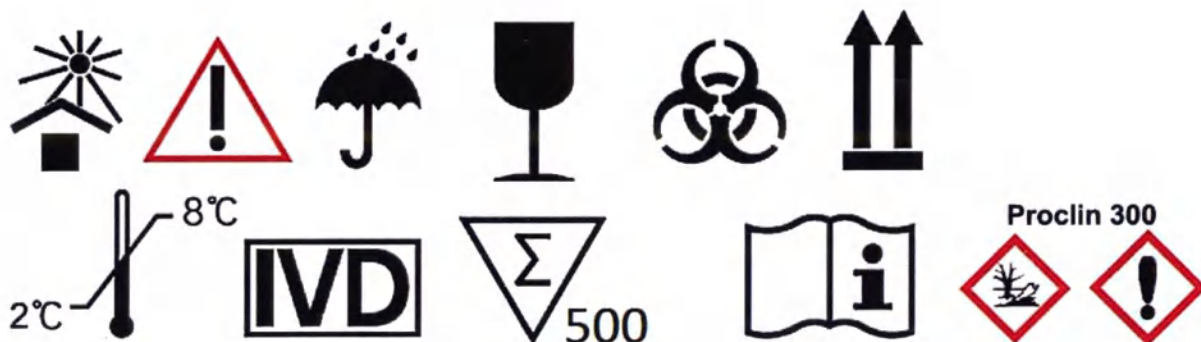


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86035

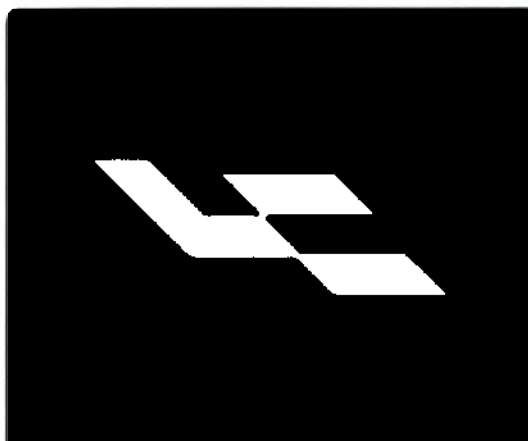



Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для
количественного определения адренокортикотропного
гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022

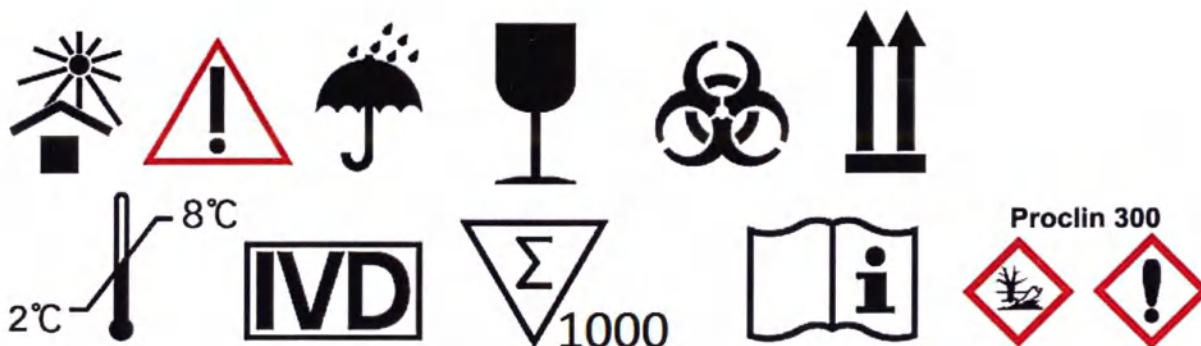

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86035

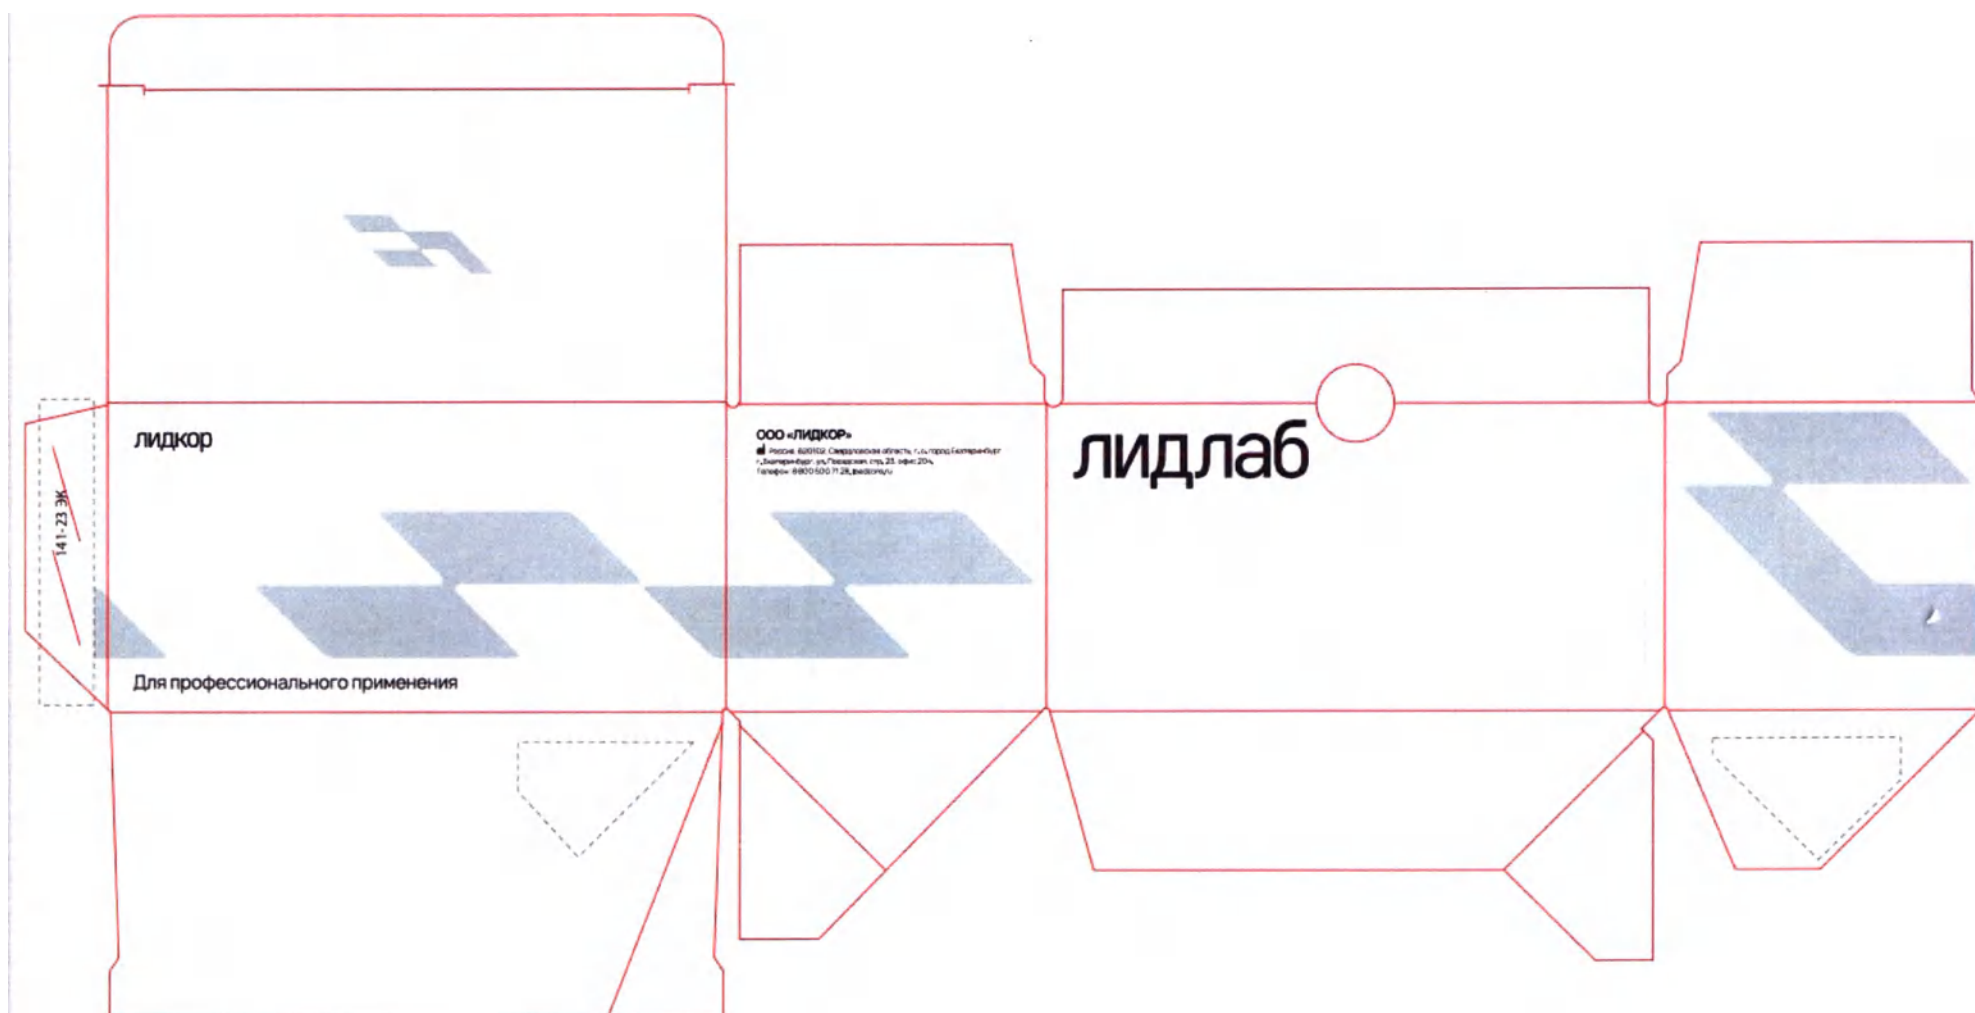

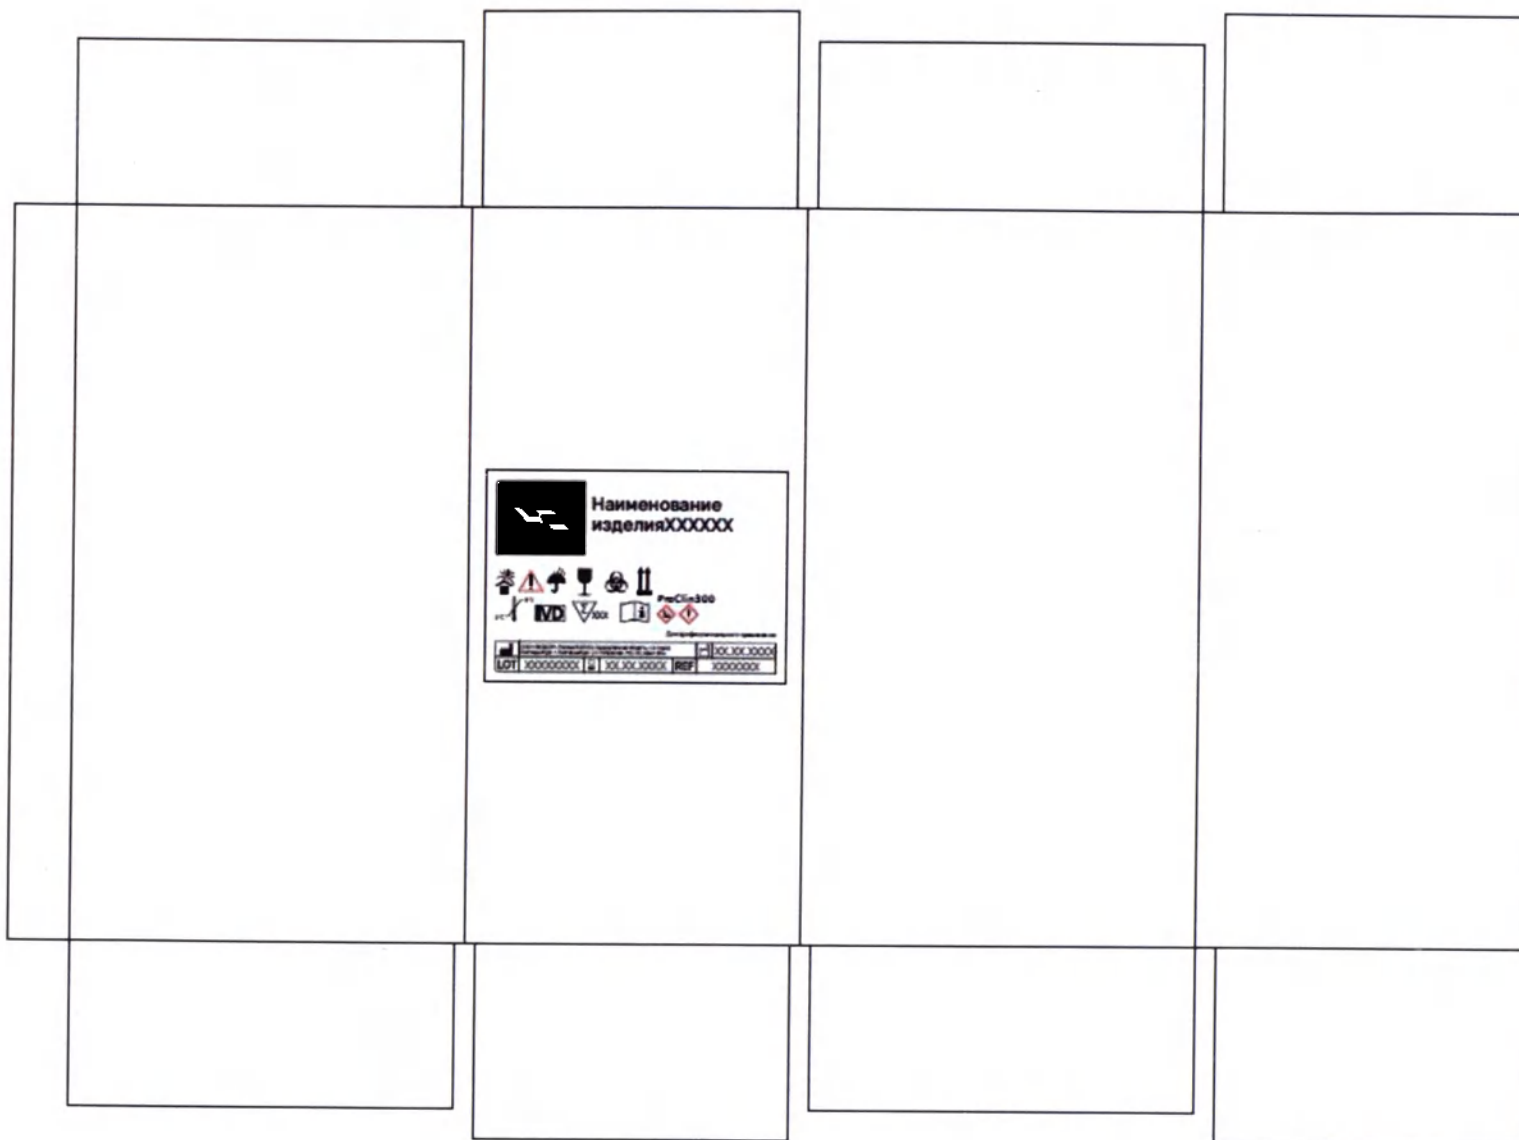

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
12 (двенадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
_____/Е. Ю. Гохгут/



Код ОКПД2 21.20.23.110




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ» для количественного определения адренокортикотропного гормона (АКТГ, АСТН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-2022

2023

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченных антител (R2) 4,0 мл/уп)

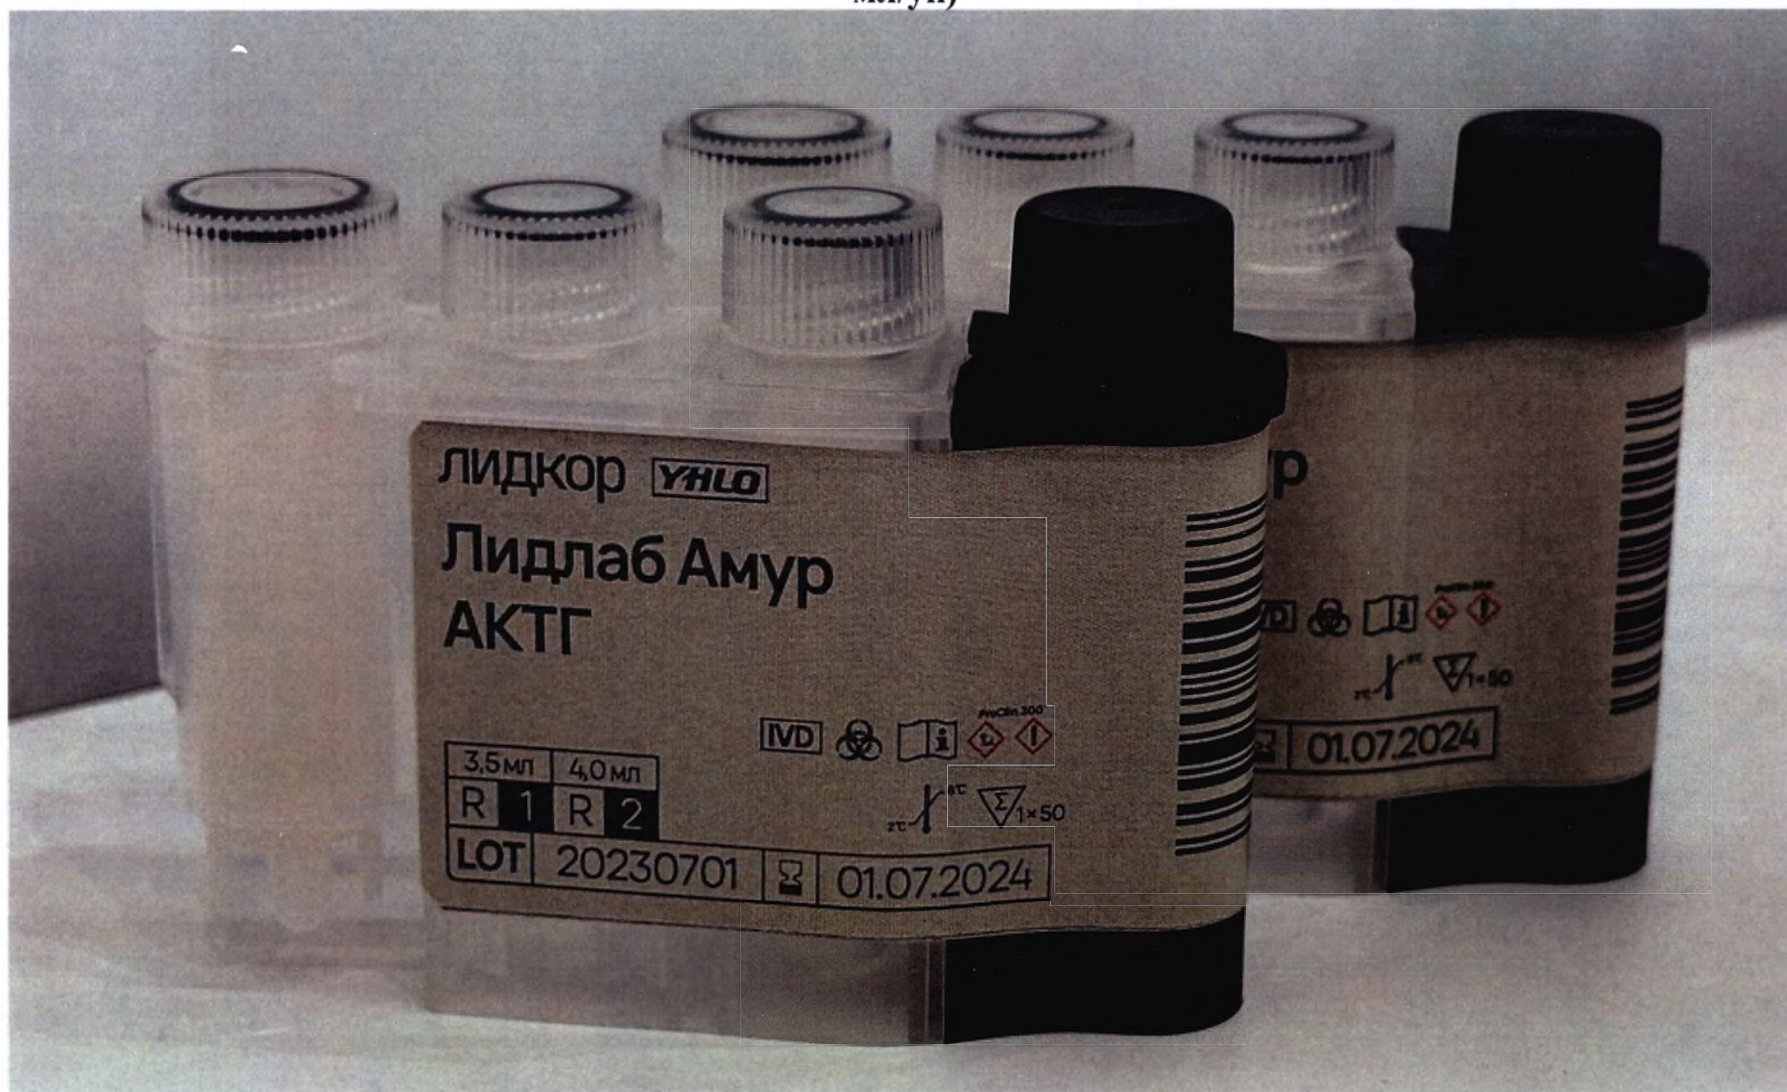

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат

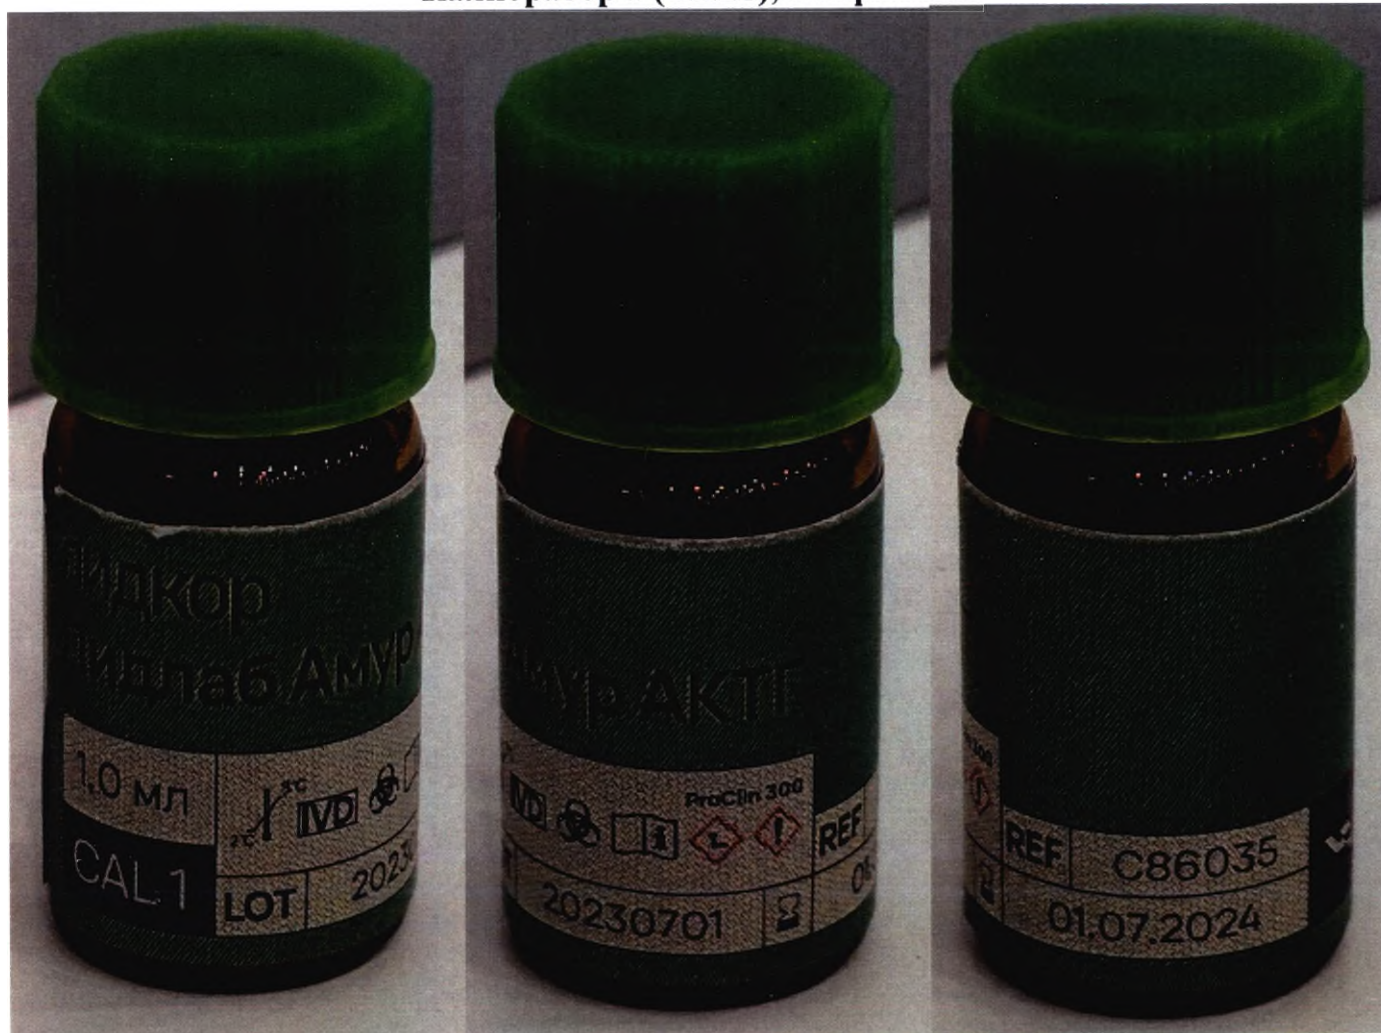

Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат




Пароизоляционные крышки




Набор реагентов на 100 тестов




Набор реагентов на 100 тестов. Вид сбоку

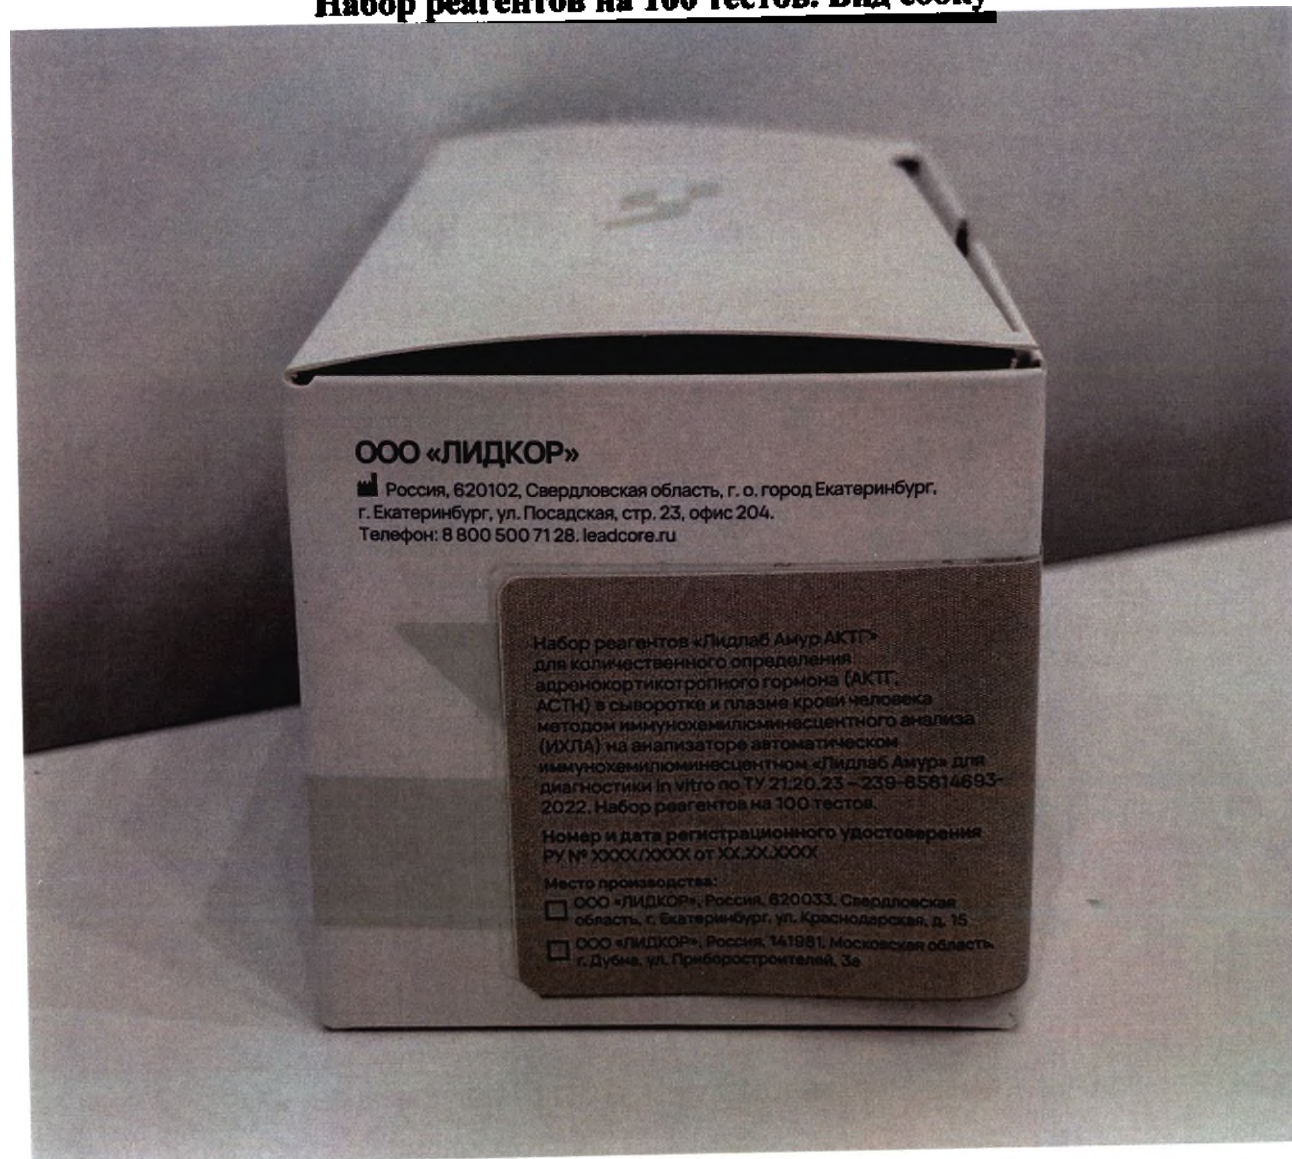

Набор реагентов на 100 тестов. Вид сзади

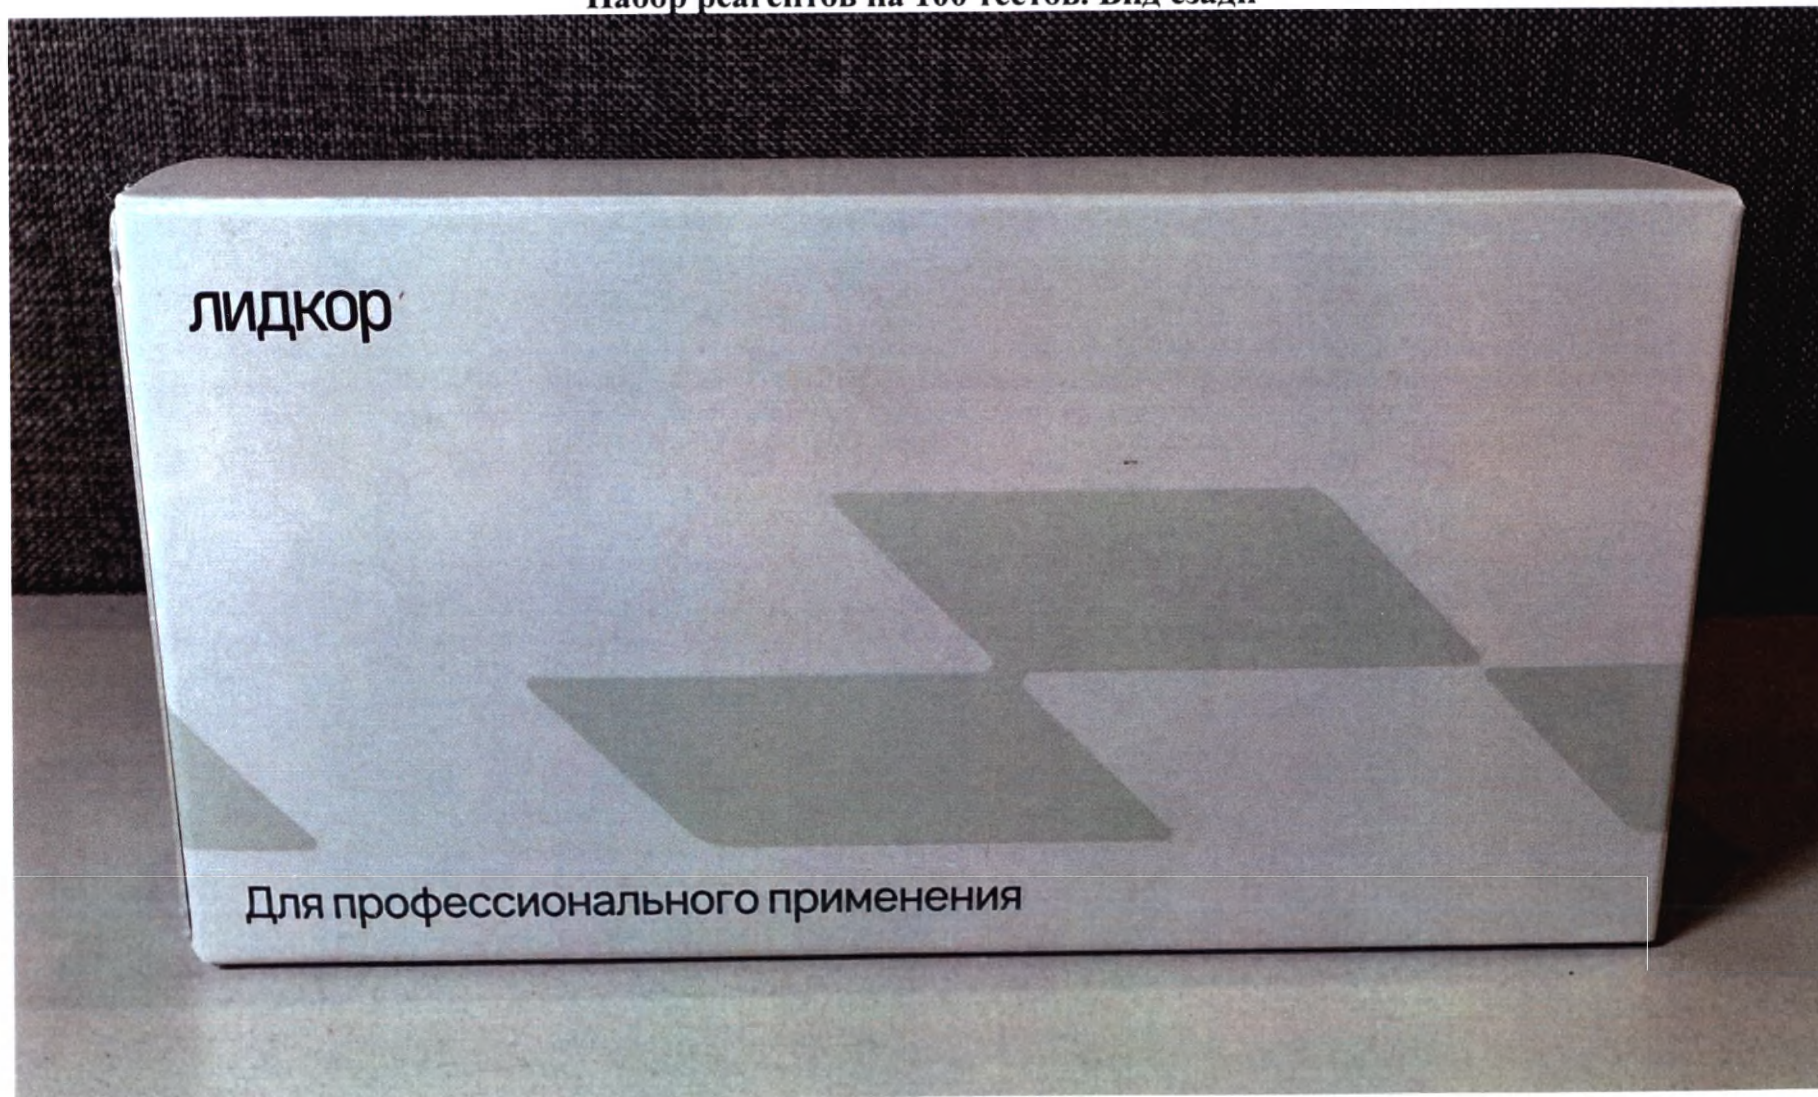

Набор реагентов на 200 тестов

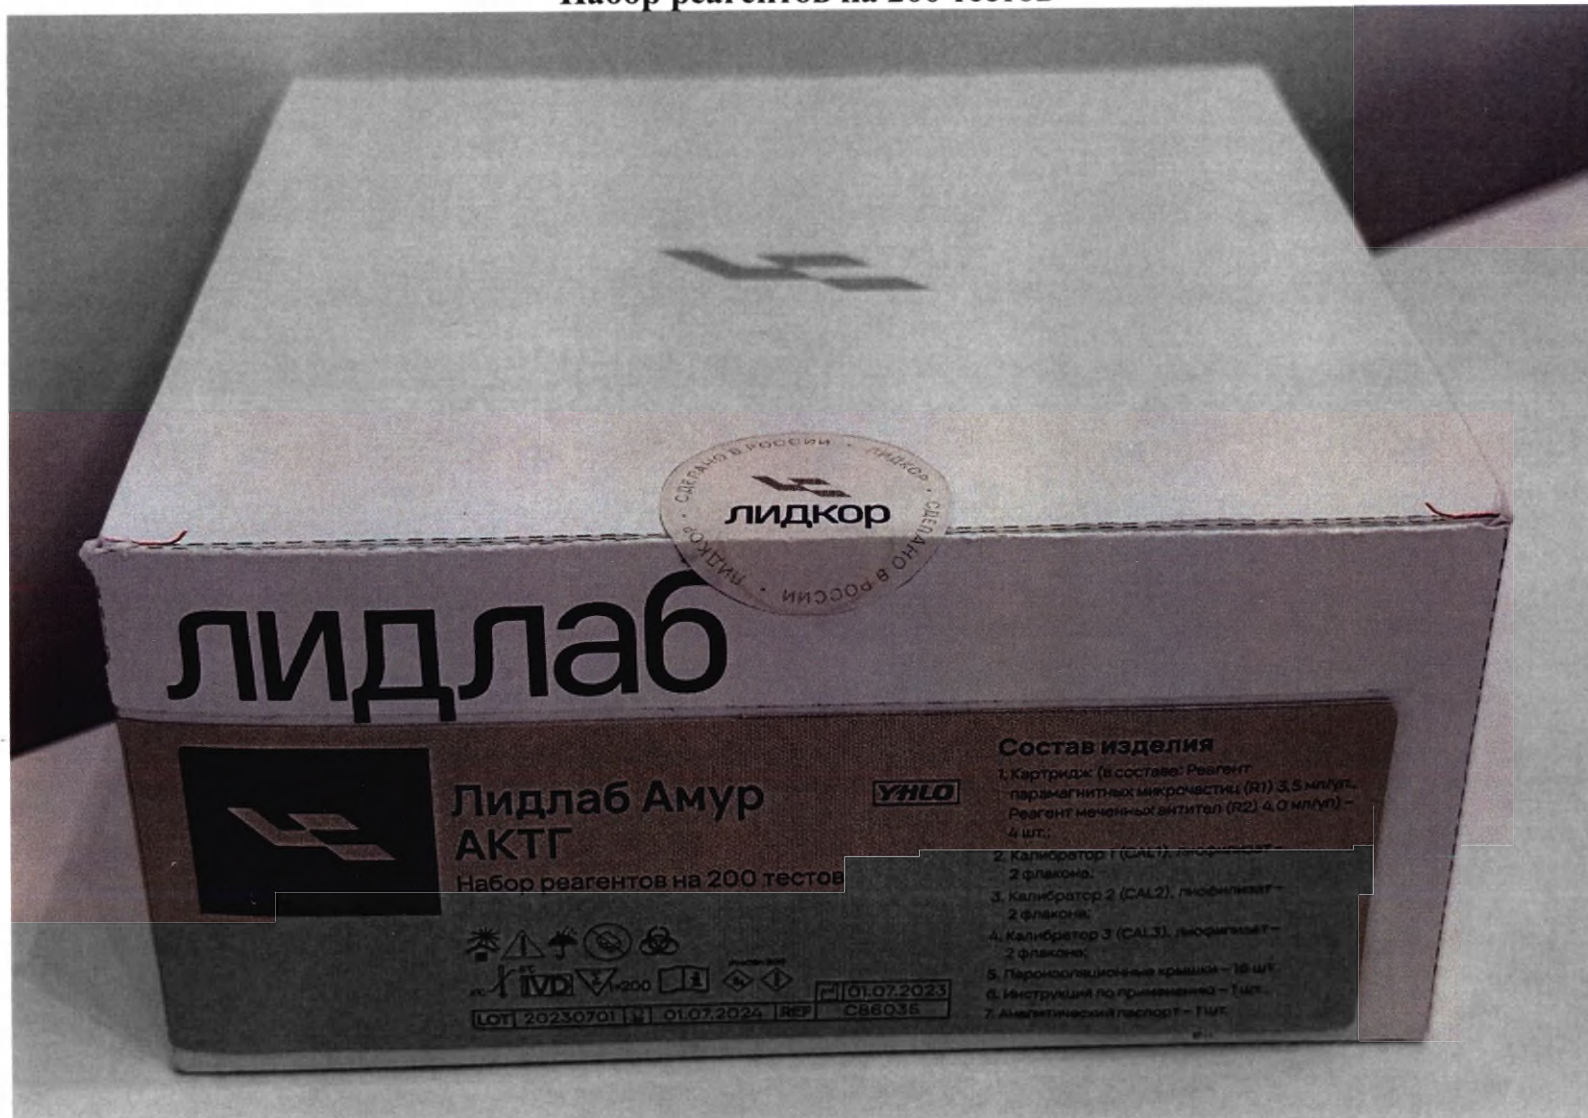

Набор реагентов на 200 тестов. Вид сбоку

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 7128. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур АКТГ»
для количественного определения
адренокортикотропного гормона (АКТГ,
АСТН) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 239-65614693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Набор реагентов на 200 тестов. Вид сзади



Набор реагентов на 500 тестов

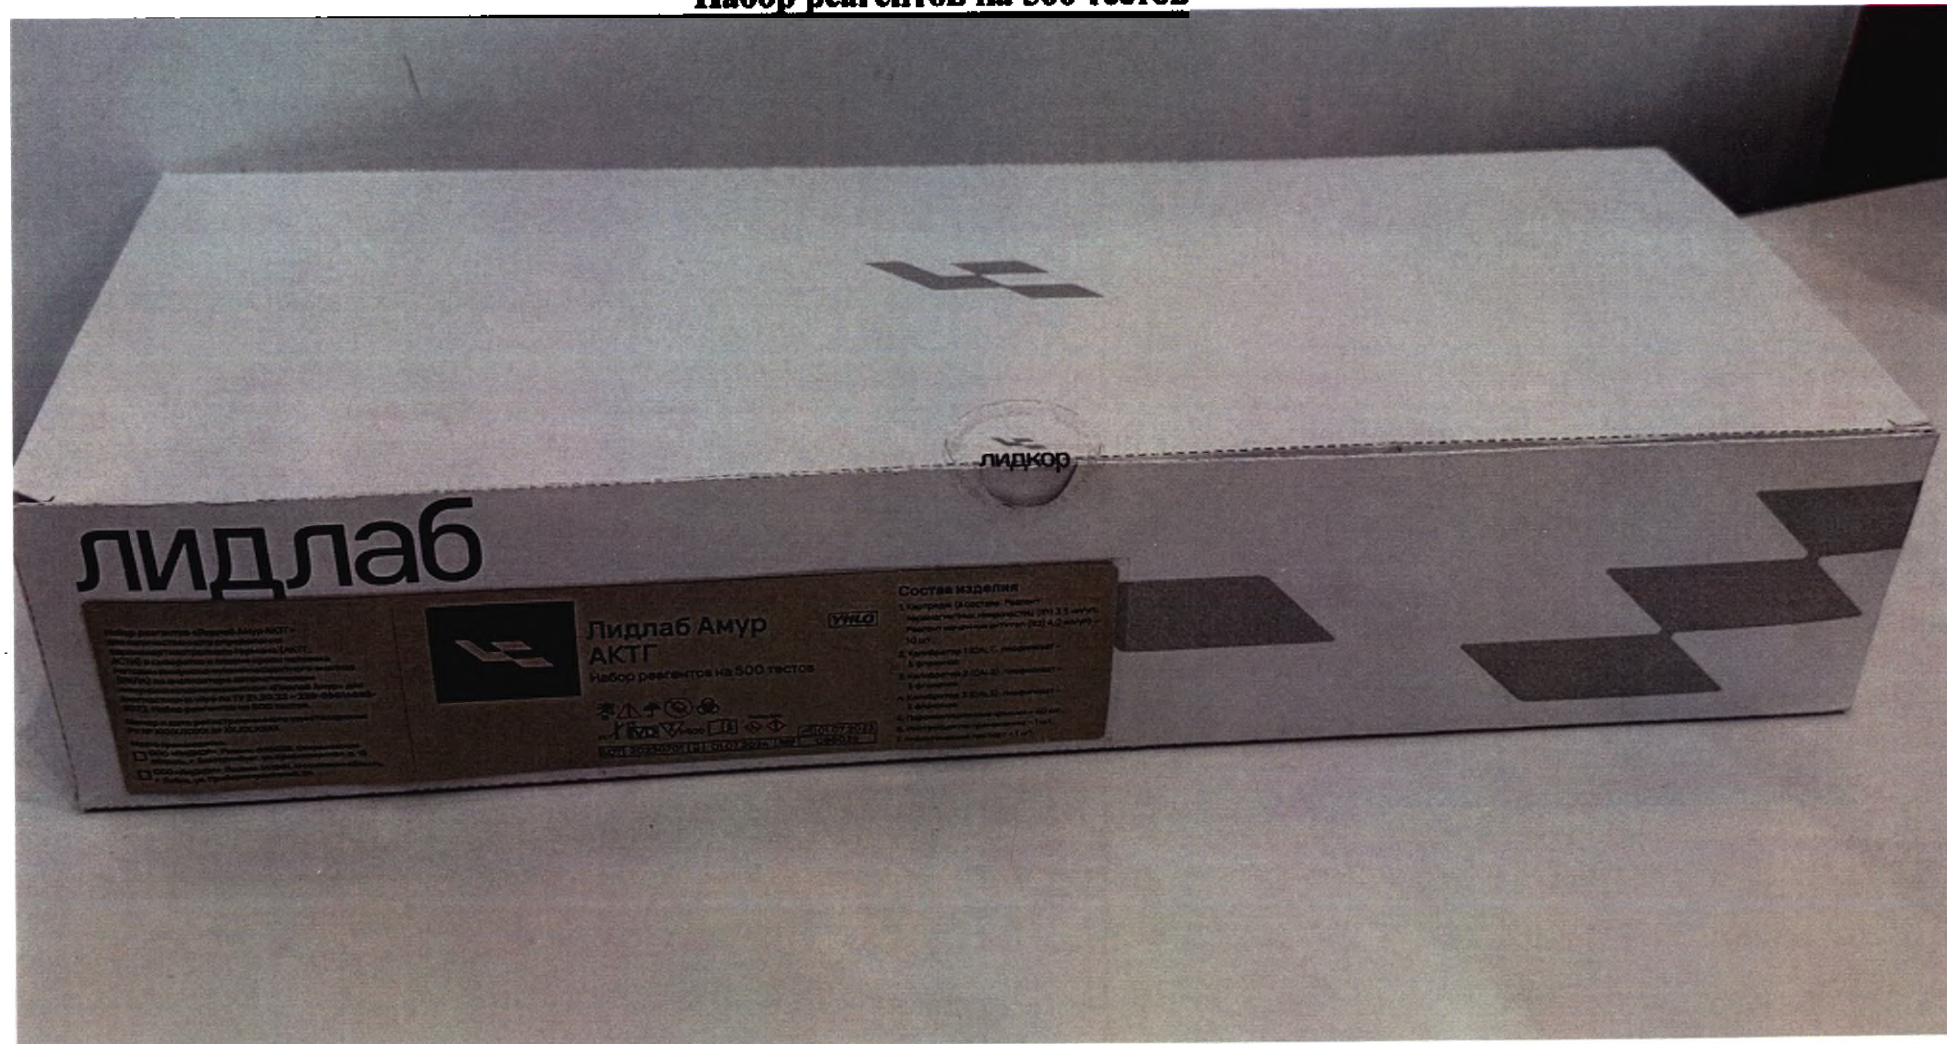


Набор реагентов на 500 тестов. Вид сбоку

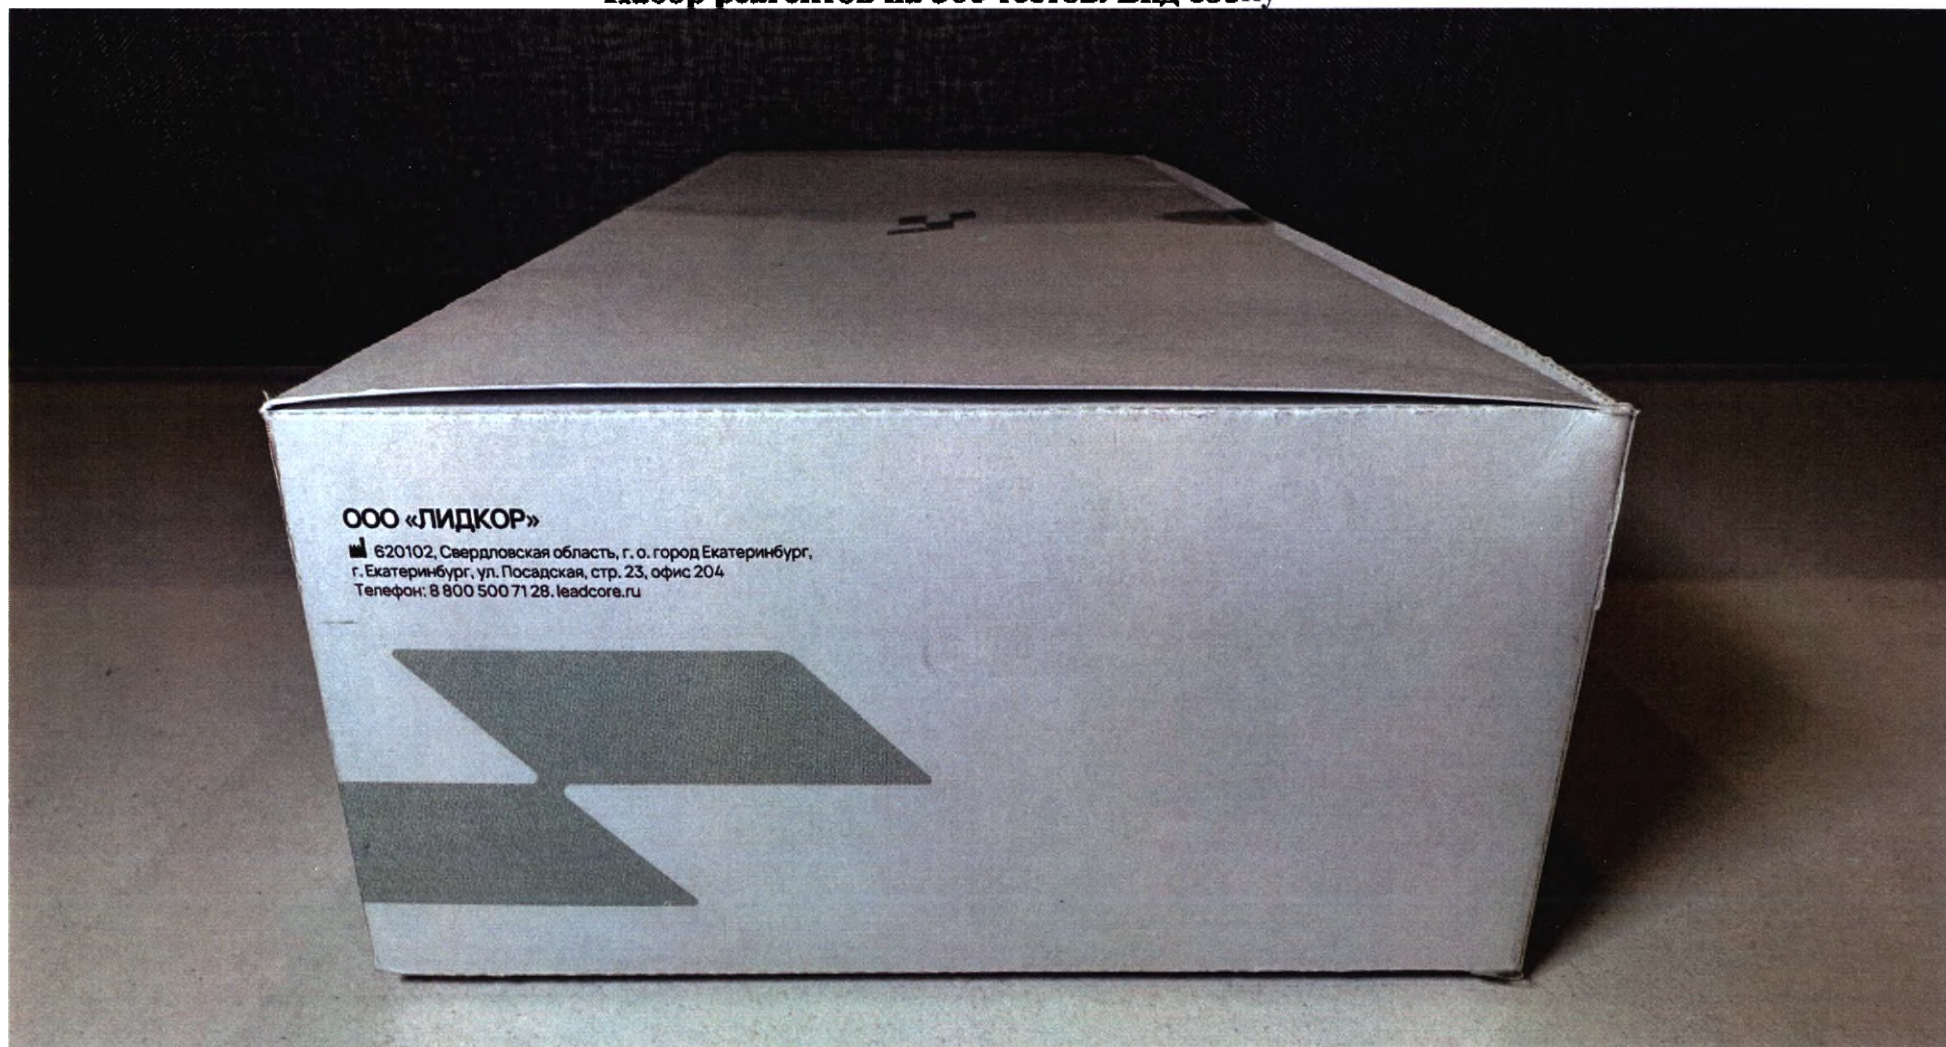

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов на 500 тестов. Вид сзади

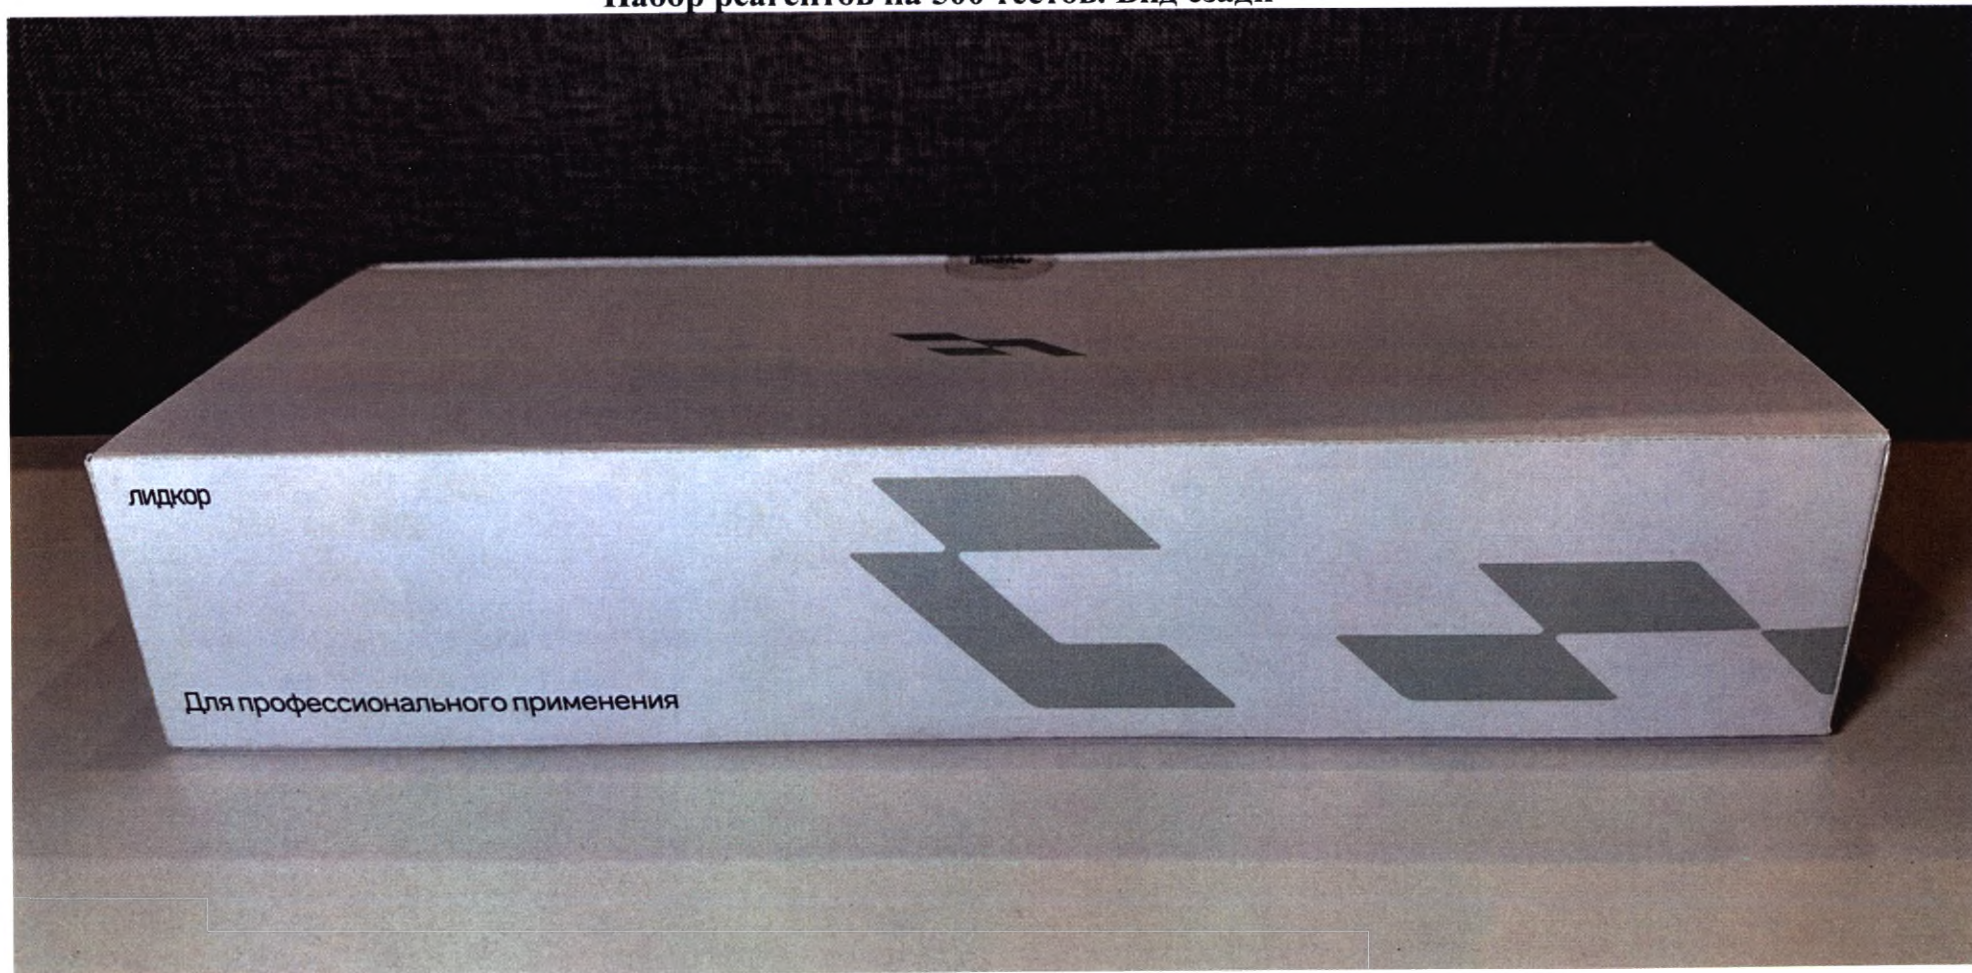


Набор реагентов на 1000 тестов



Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сбоку



Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сзади

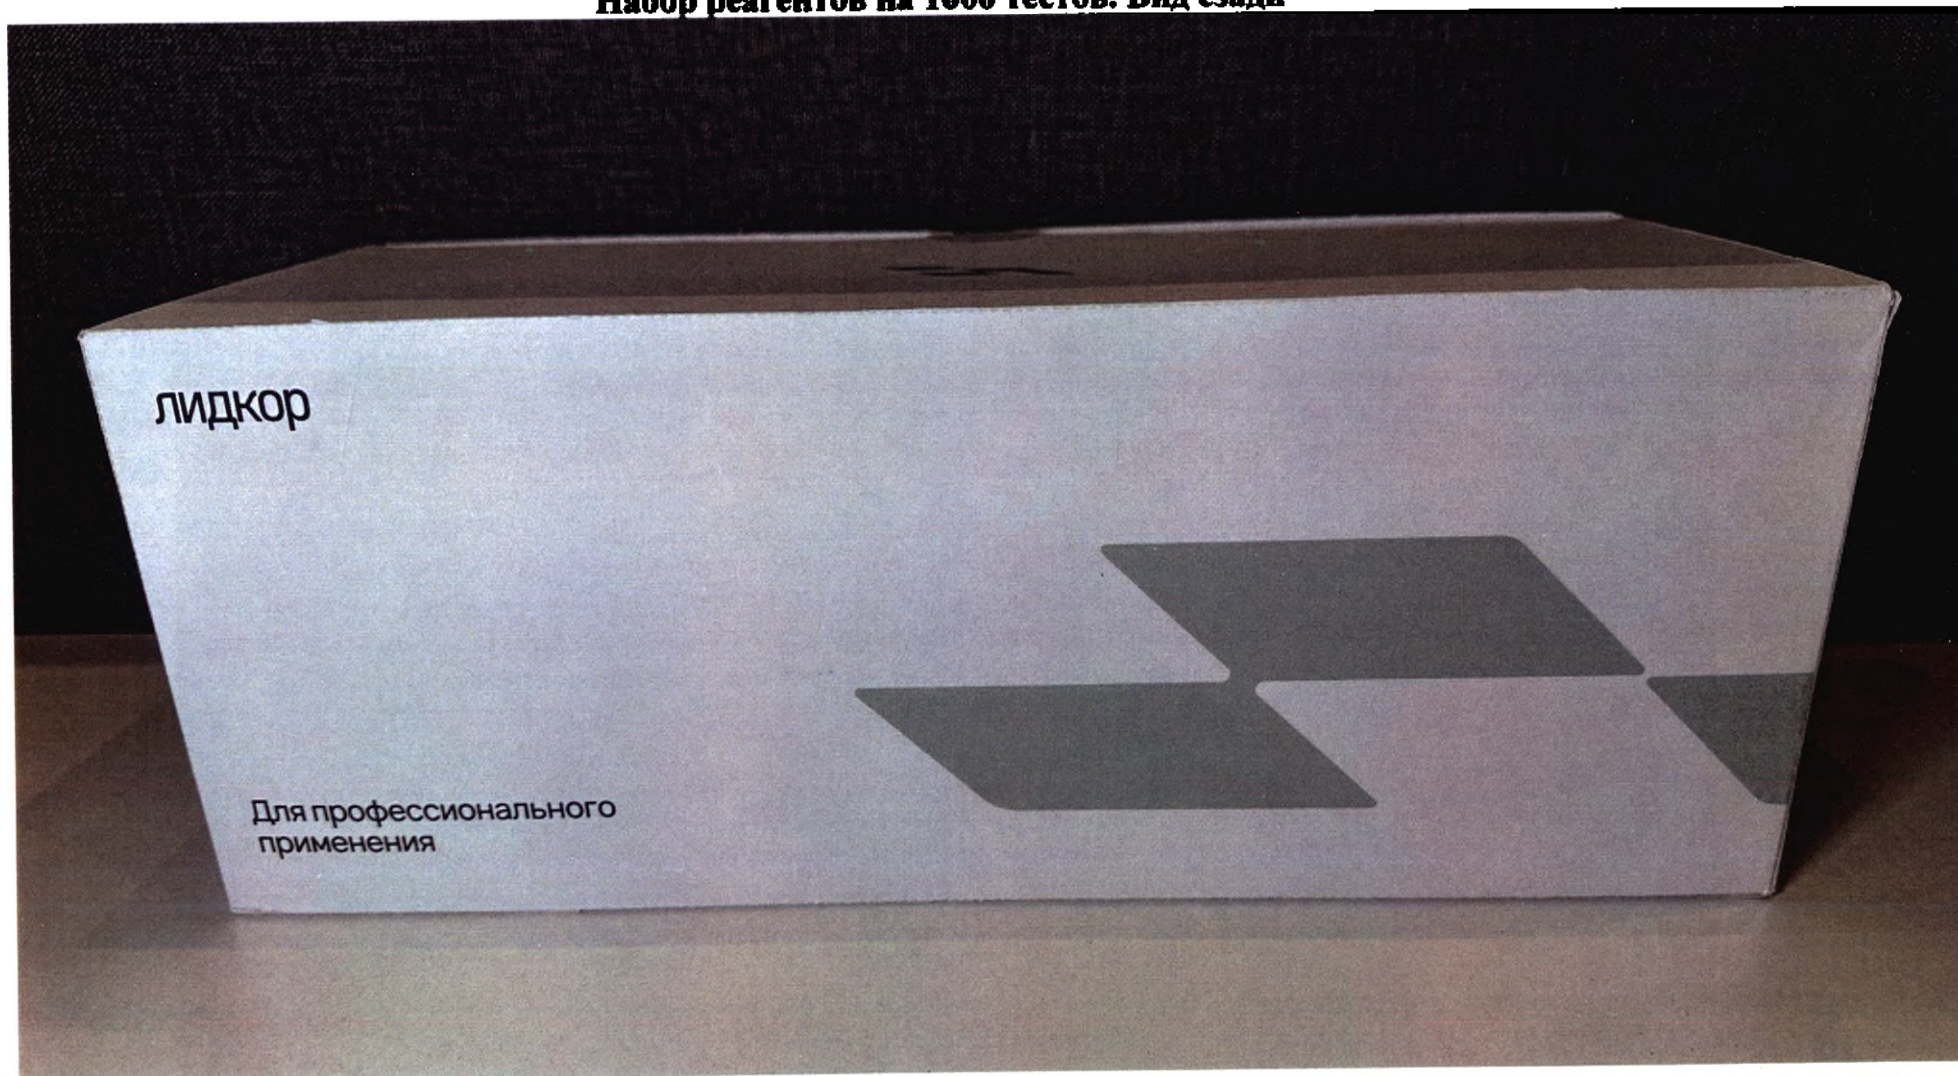


Общий вид медицинского изделия




Транспортная упаковка Набора реагентов на 100 тестов



Транспортная упаковка Набора реагентов на 200 тестов

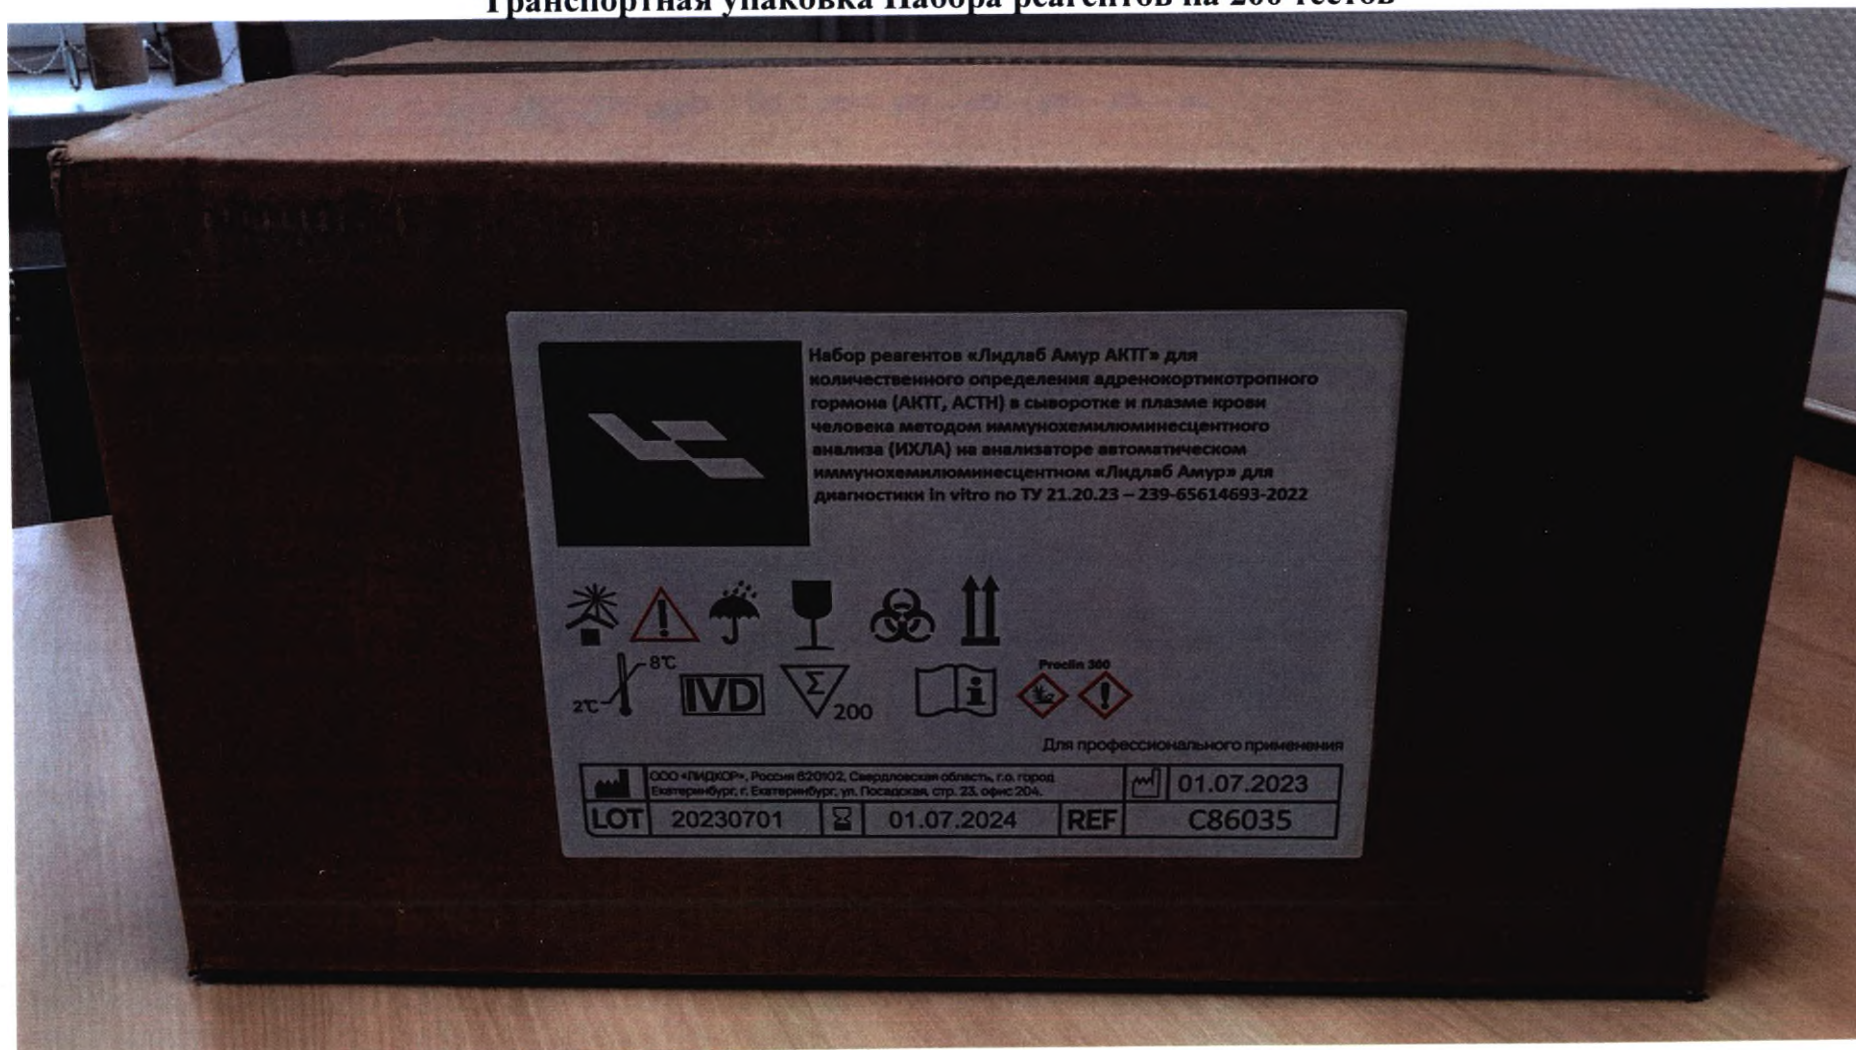

Транспортная упаковка Набора реагентов на 500 тестов

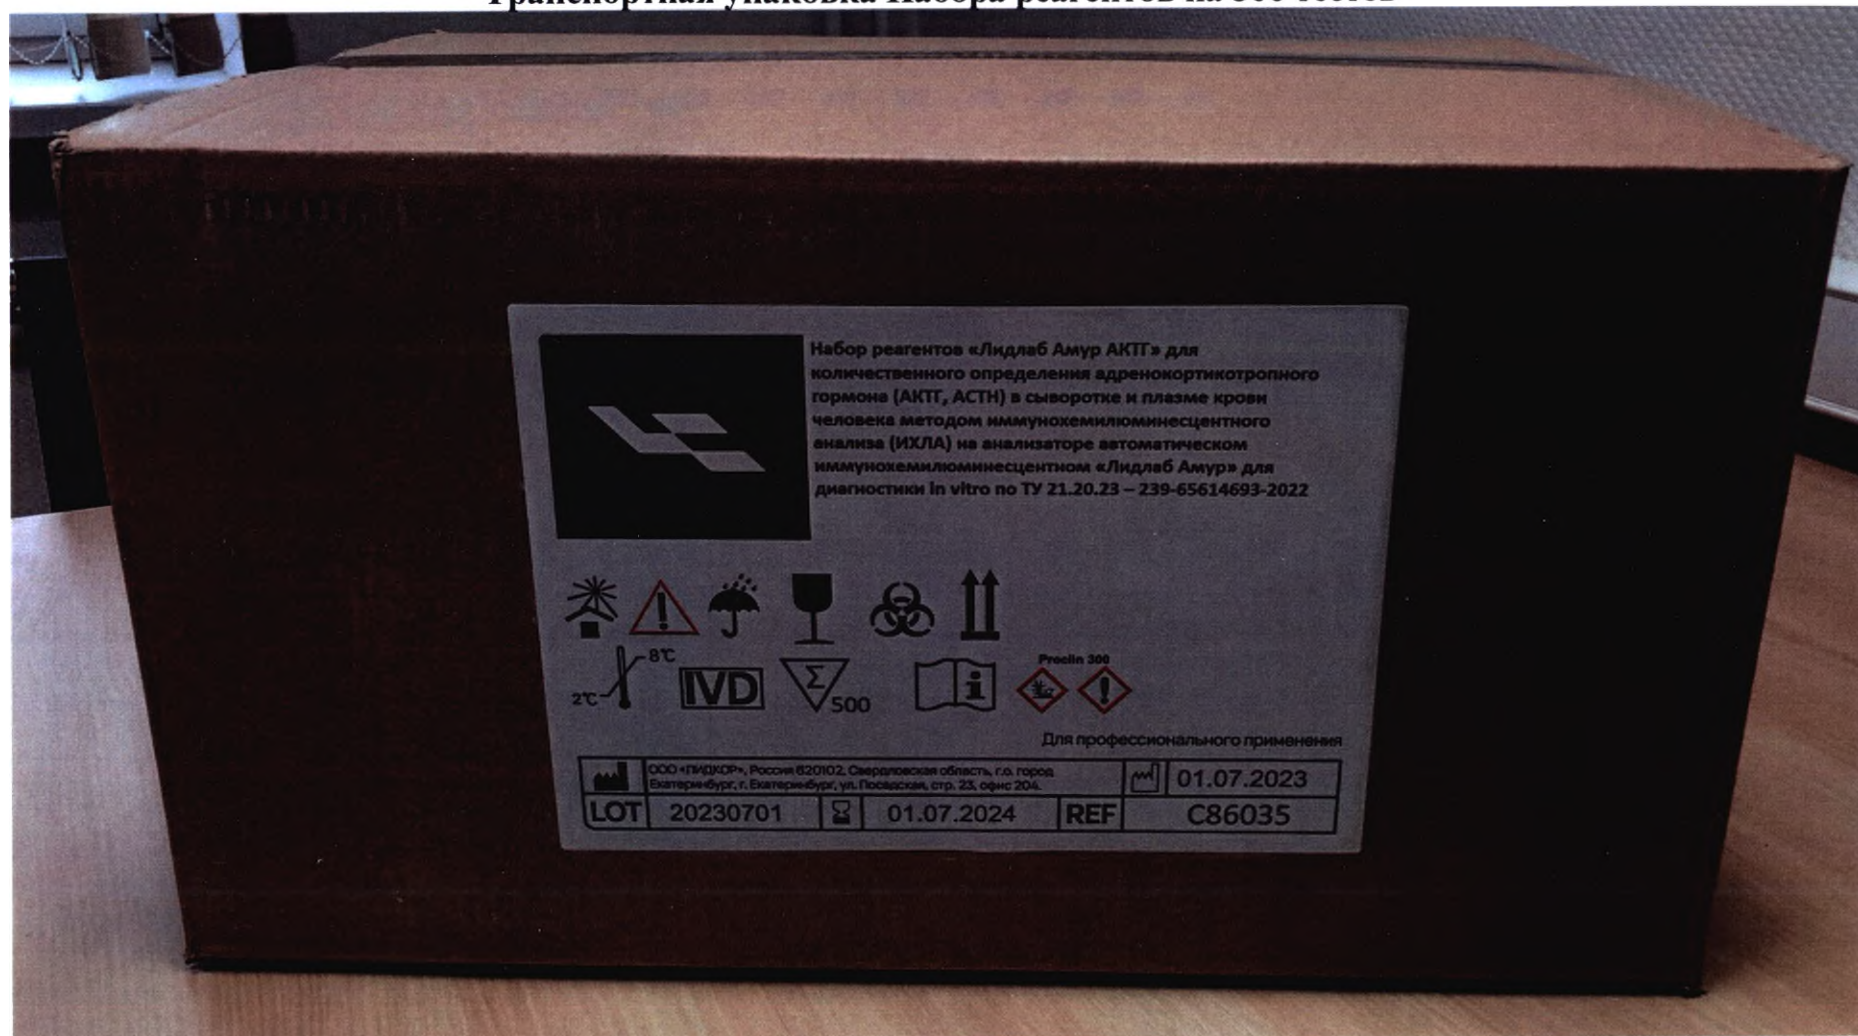

Транспортная упаковка Набора реагентов на 1000 тестов



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
23 (двадцать три) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»



/Е. Ю. Гохгут