

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «АРМАЛАЙН»

Воевода В.В.

20 20 г.



Примеры этикеток индивидуальных

• 2F-60

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 2F (0.75 мм). Длина: 60 см
Диаметр наполненного баллона: 4.0 ± 1.0 мм

STERILEO

нетоксично

REF 2F-60 **LOT** 010011220
 12-2020 12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 2F-80

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 2F (0.75 мм). Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: 4.0 ± 1.0 мм

STERILEO

нетоксично

REF 2F-80 **LOT** 020011220
 12-2020 12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 3F-40

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 3F (1.00 мм). Длина: 40 см
Диаметр наполненного баллона: 6.0 ± 1.0 мм

STERILEO

нетоксично

REF 3F-40 **LOT** 030011220
 12-2020 12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 3F-80

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 3F (1.00 мм). Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: 6.0 ± 1.0 мм

STERILEO

нетоксично

REF 3F-80 **LOT** 040011220
 12-2020 12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 4F-40

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 4F (1.30 мм). Длина: 40 см
Диаметр наполненного баллона: 9.0 ± 1.0 мм

STERILEO


нетоксично

REF 4F-40 **LOT** 050011220
 12-2020 12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 4F-80

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично


Размер: 4F (1,30 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $9,0 \pm 1,0$ мм

REF	4F-80	LOT	060011220
	12-2020		12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 4F-100

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично

Размер: 4F (1,30 мм), Длина: 100 см
Диаметр наполненного баллона: $9,0 \pm 1,0$ мм

REF	4F-100	LOT	070011220
	12-2020		12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 5F-40

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично

Размер: 5F (1,50 мм), Длина: 40 см
Диаметр наполненного баллона: $11,0 \pm 1,0$ мм

REF	5F-40	LOT	080011220
	12-2020		12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 5F-80

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично

Размер: 5F (1,50 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $11,0 \pm 1,0$ мм

REF	5F-80	LOT	090011220
	12-2020		12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 6F-40

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично

Размер: 6F (1,80 мм), Длина: 40 см
Диаметр наполненного баллона: $13,0 \pm 1,0$ мм

REF	6F-40	LOT	100011220
	12-2020		12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 6F-80

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично

Размер: 6F (1,80 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $13,0 \pm 1,0$ мм

REF	6F-80	LOT	110011220
	12-2020		12-2023

ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 7F-40

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 7F (2,20 мм), Длина: 40 см
Диаметр наполненного баллона: $14,0 \pm 1,0$ мм

STERILEEO    

нетоксично

REF 7F-40 **LOT** 120011220
12-2020 12-2023

 ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

• 7F-80

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 7F (2,20 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $14,0 \pm 1,0$ мм

STERILEEO    

нетоксично

REF 7F-80 **LOT** 130011220
12-2020 12-2023

 ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

3 (м/к)

ЛИСТ а

Директор ООО «АРМАЛАЙН»



В.В. Воевода



УТВЕРЖДАЮ

Директор


ООО «АРМАЛАЙН»

Воевода В.В.




2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
Катетер баллонный для эмболэктомии стерильный
однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020

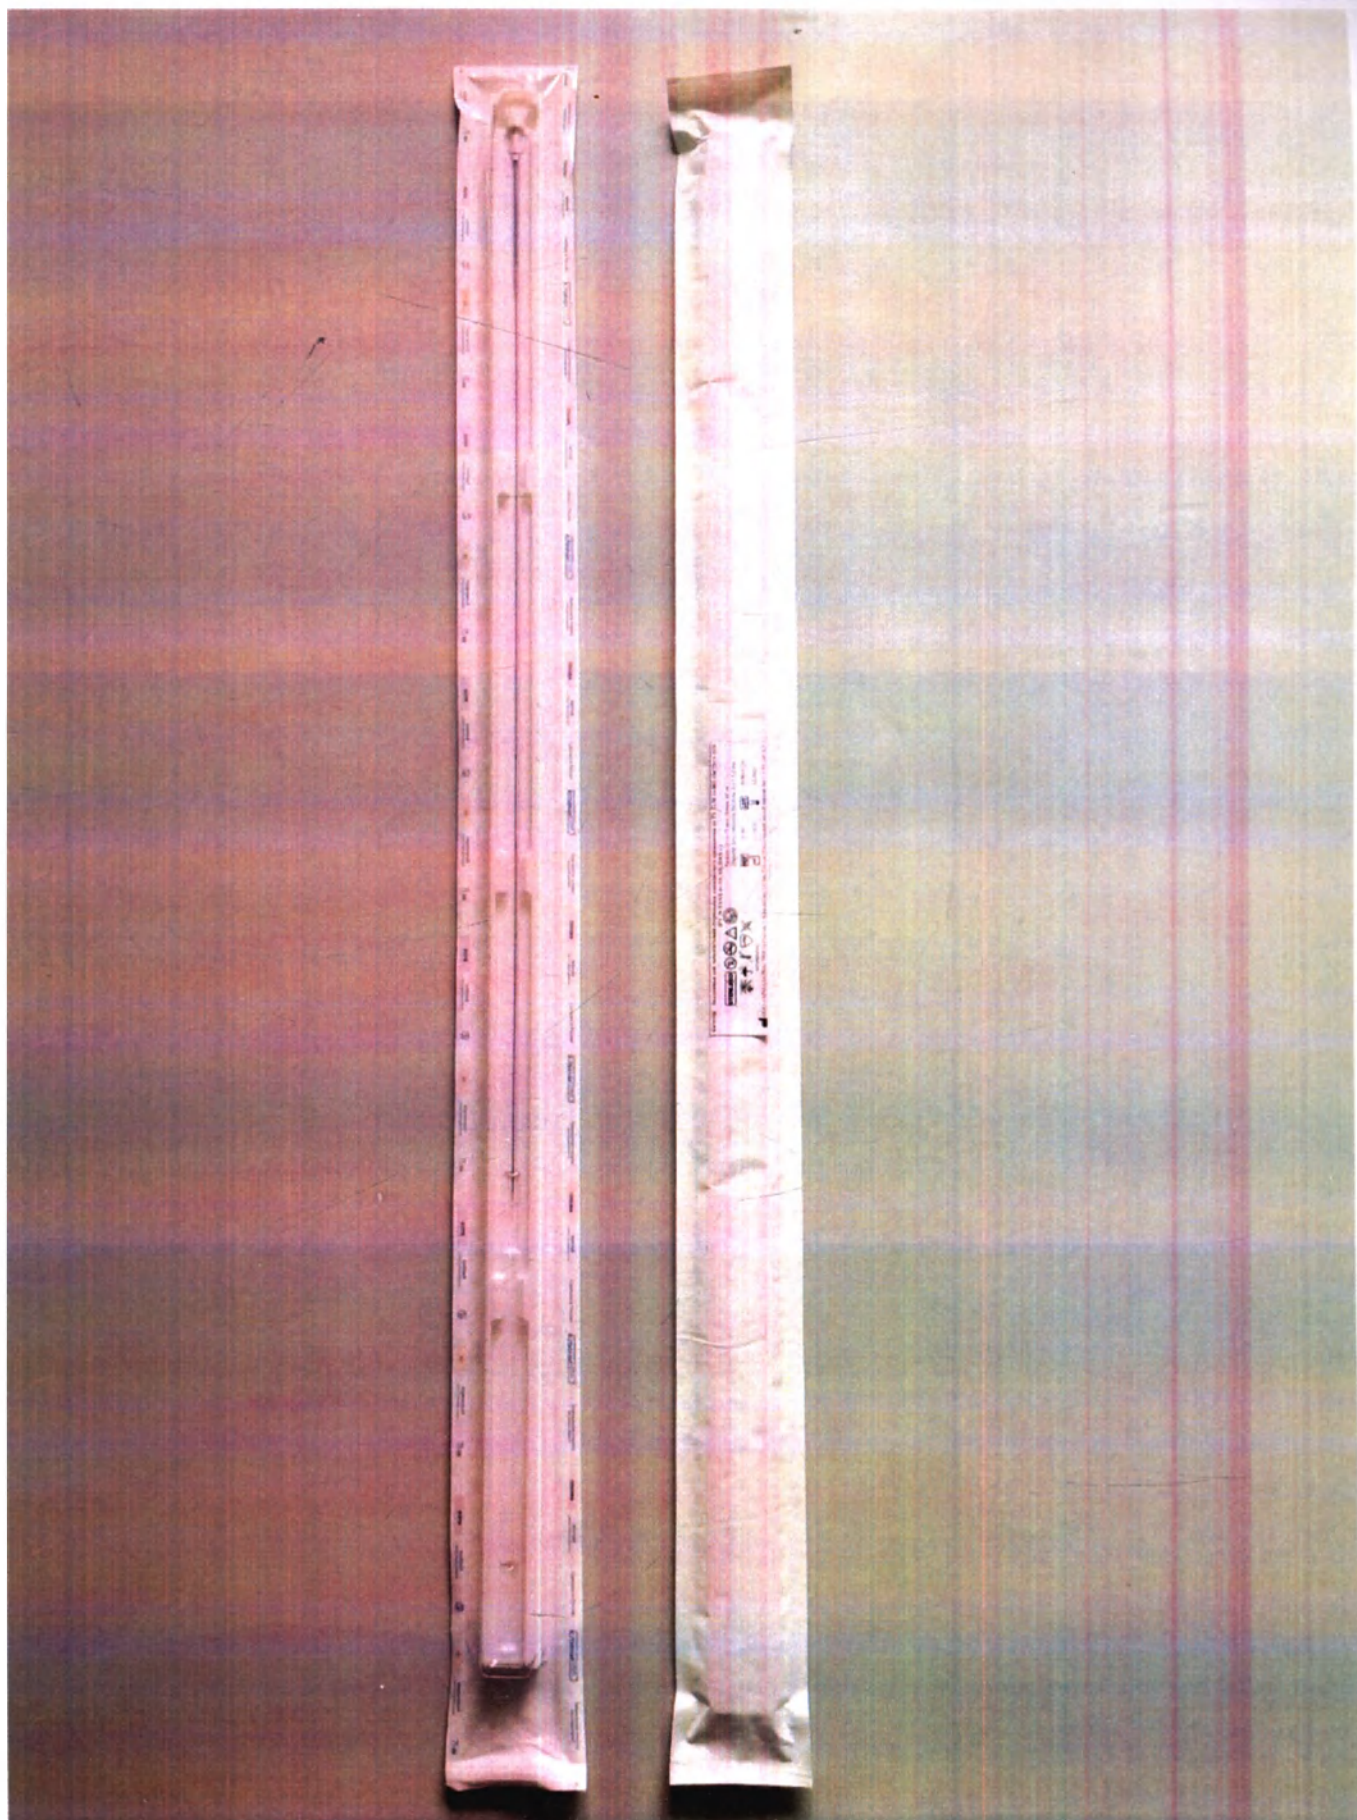

Катетер баллонный для эмболектomie стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 2F-60. Потребительская упаковка.

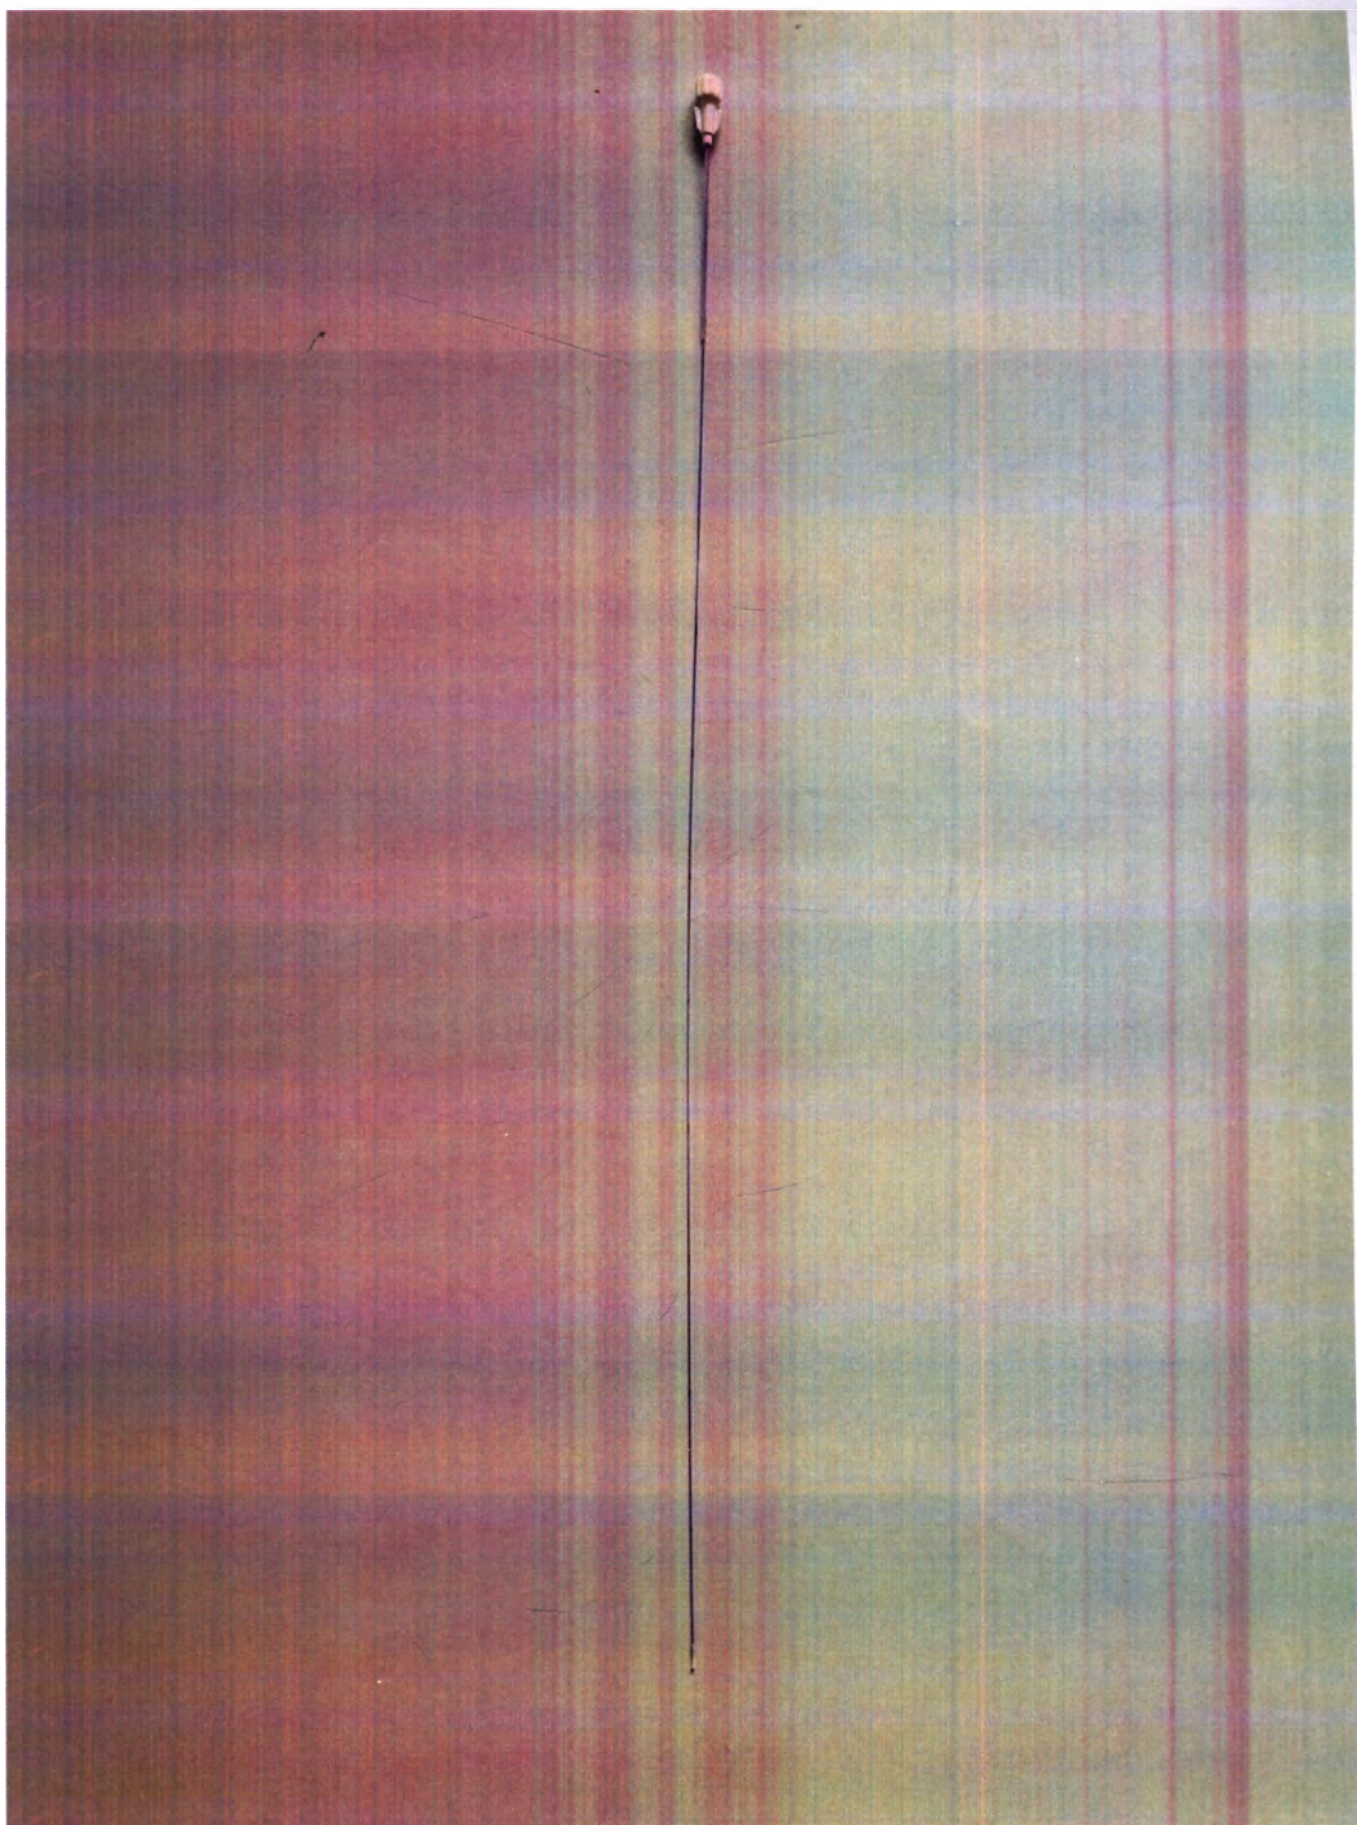

Катетер баллонный для эмболектмии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 2F-60.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

STERILE



нетоксично

Размер: 2F (0,75 мм), Длина: 60 см
Диаметр наполненного баллона: $4,0 \pm 1,0$ мм

REF

2F-60

LOT

010011220



12-2020




12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 2F-60. Маркировка.

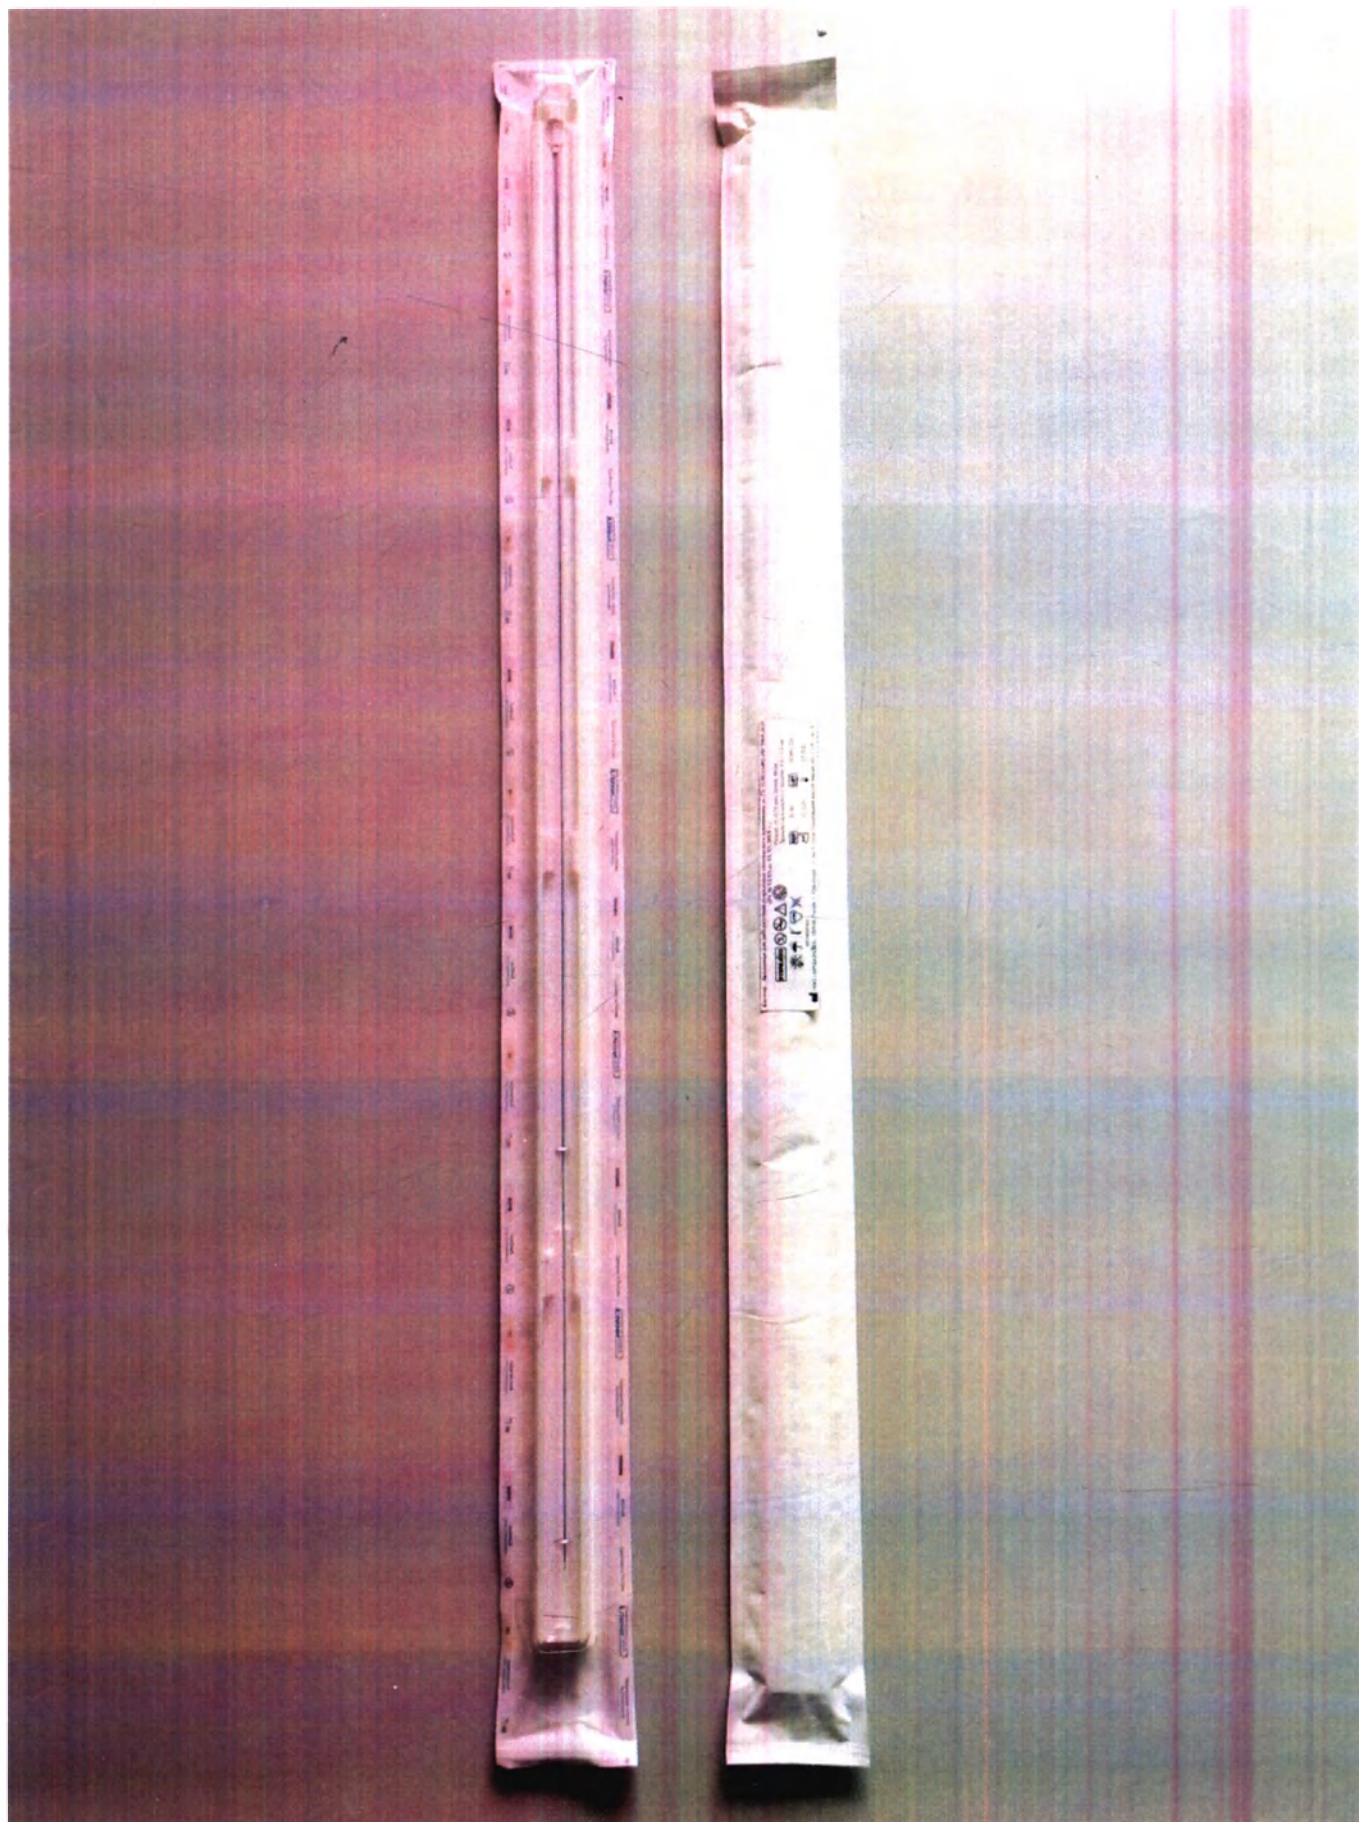

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 2F-80. Потребительская упаковка.

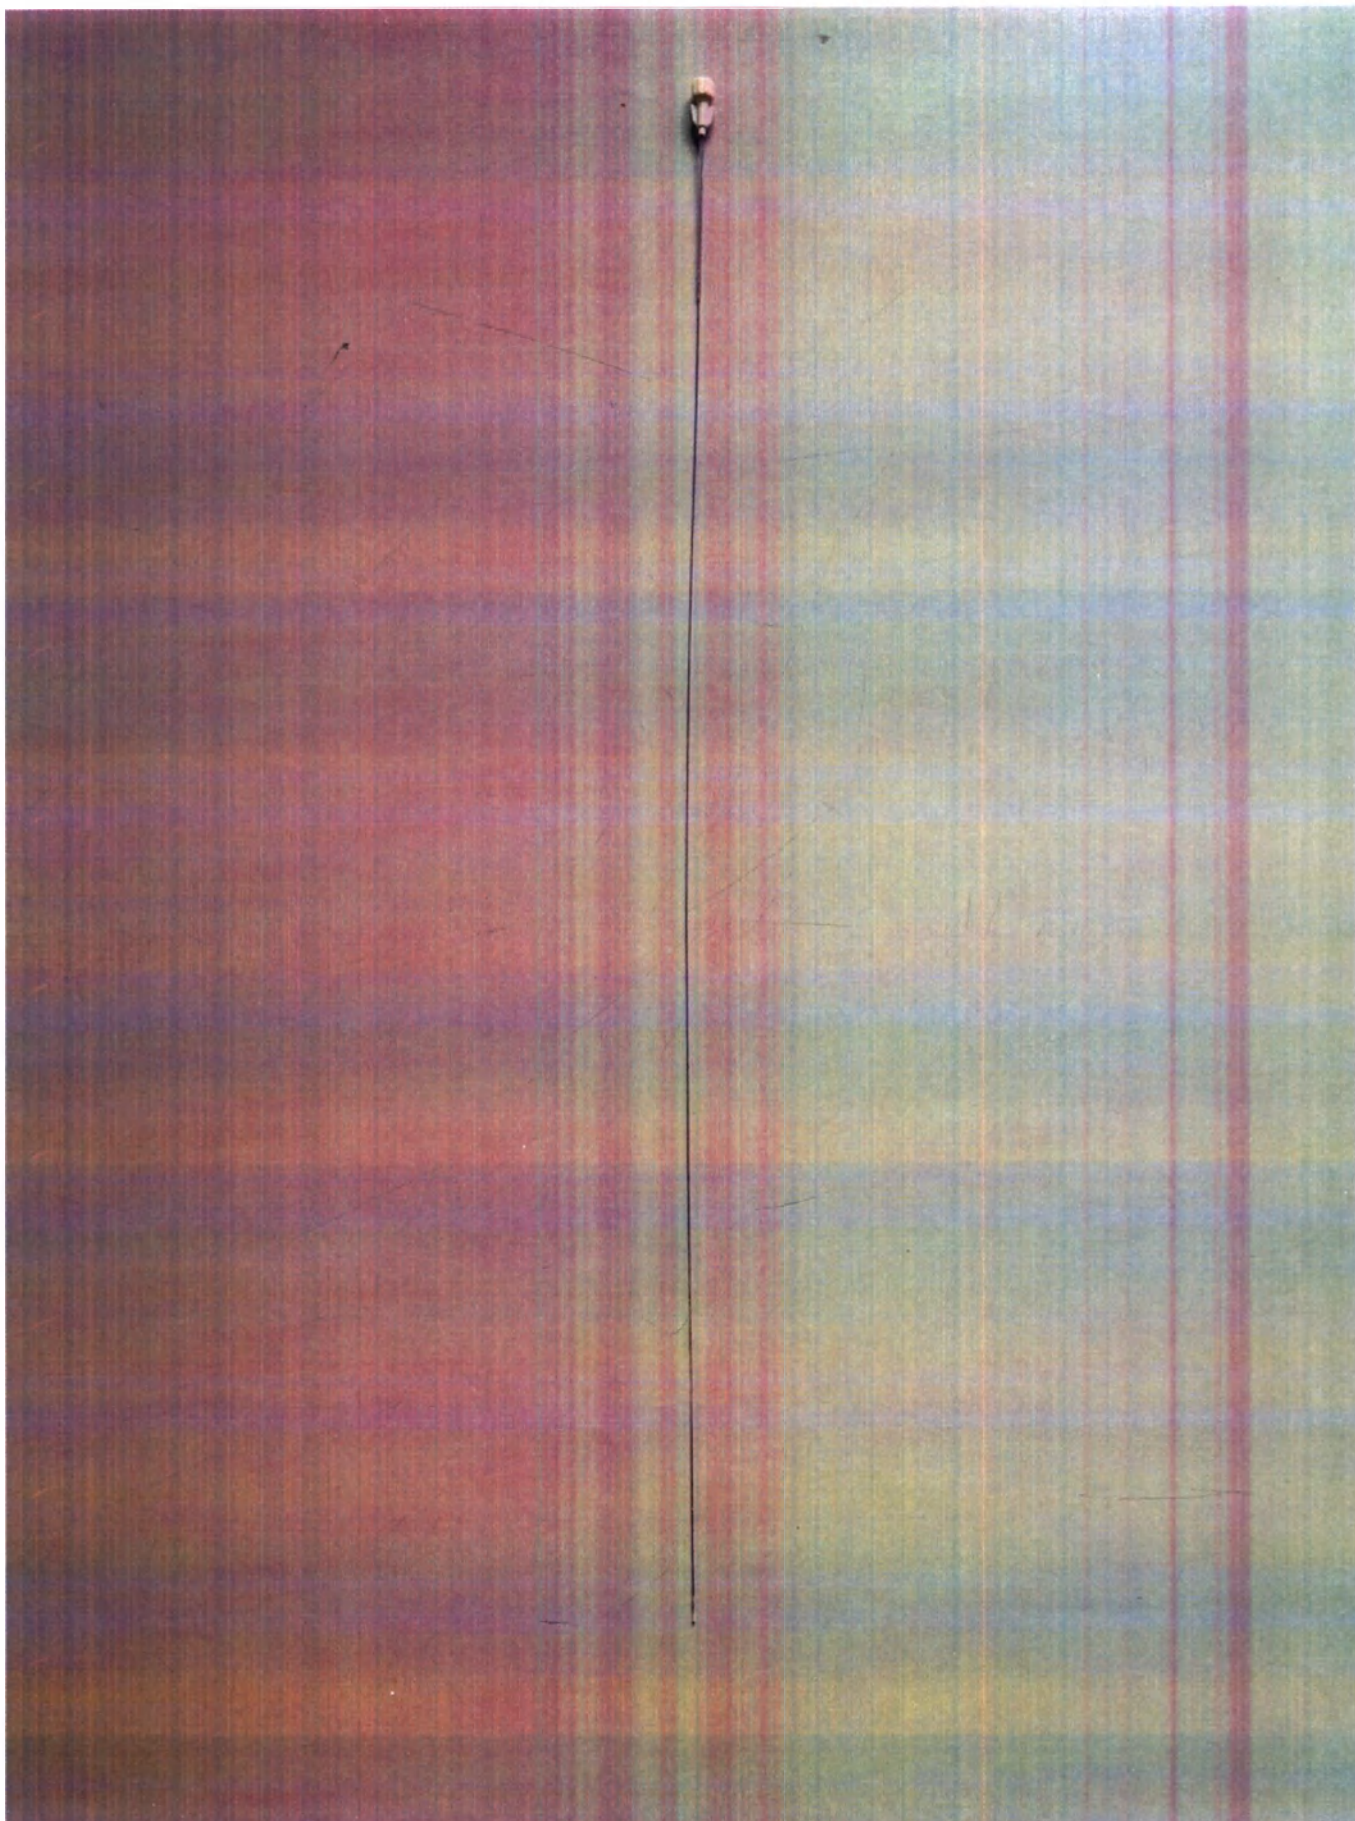


Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 2F-80

Катетер баллонный для эмболизкции стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



Размер: 2F (0,75 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $4,0 \pm 1,0$ мм



нетоксично



2F-80



020011220


12-2020

12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б


Катетер баллонный для эмболизкции стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 2F-80. Маркировка.

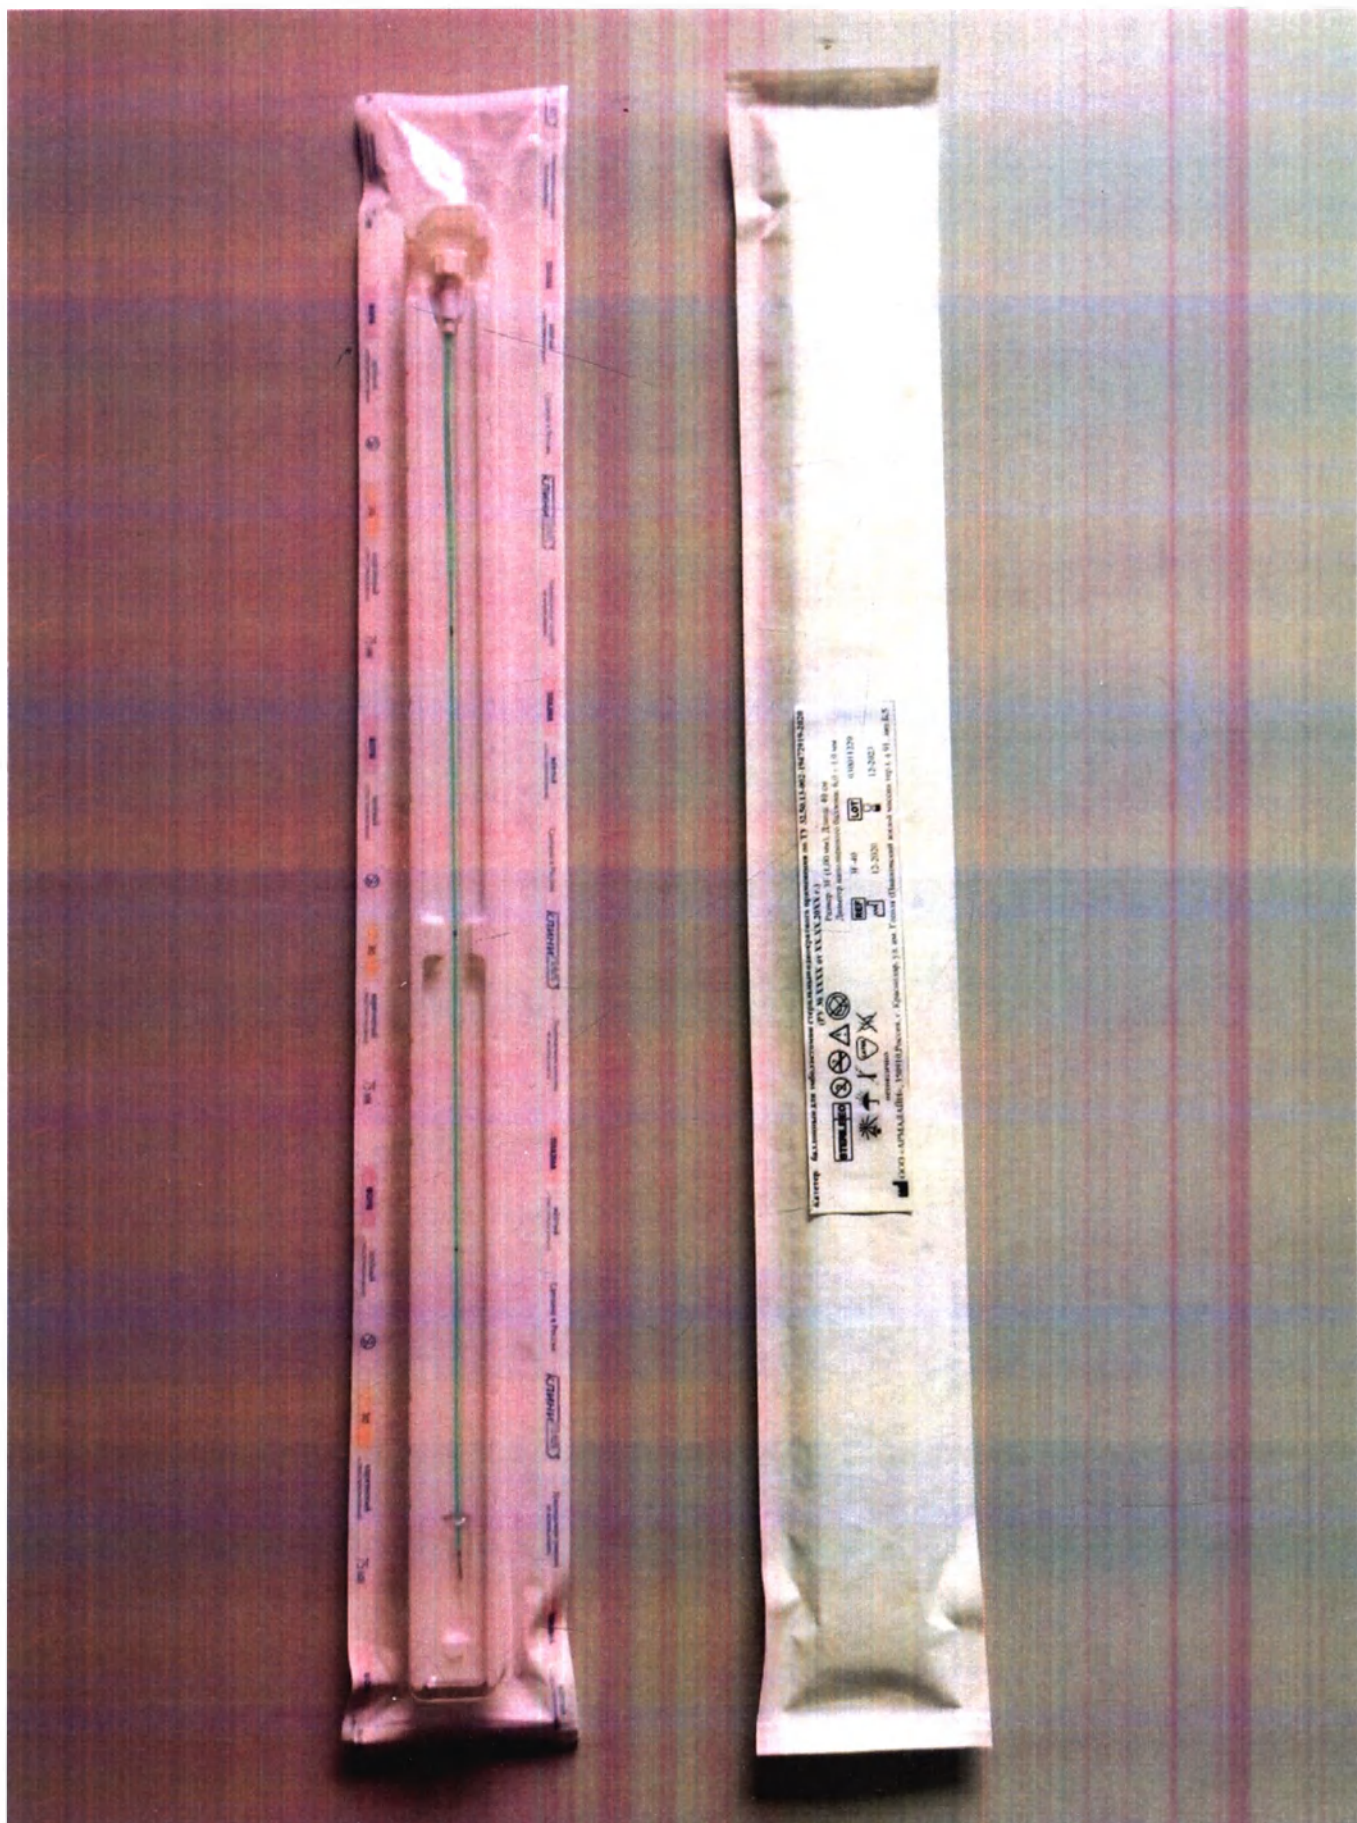

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 3F-40. Потребительская упаковка.

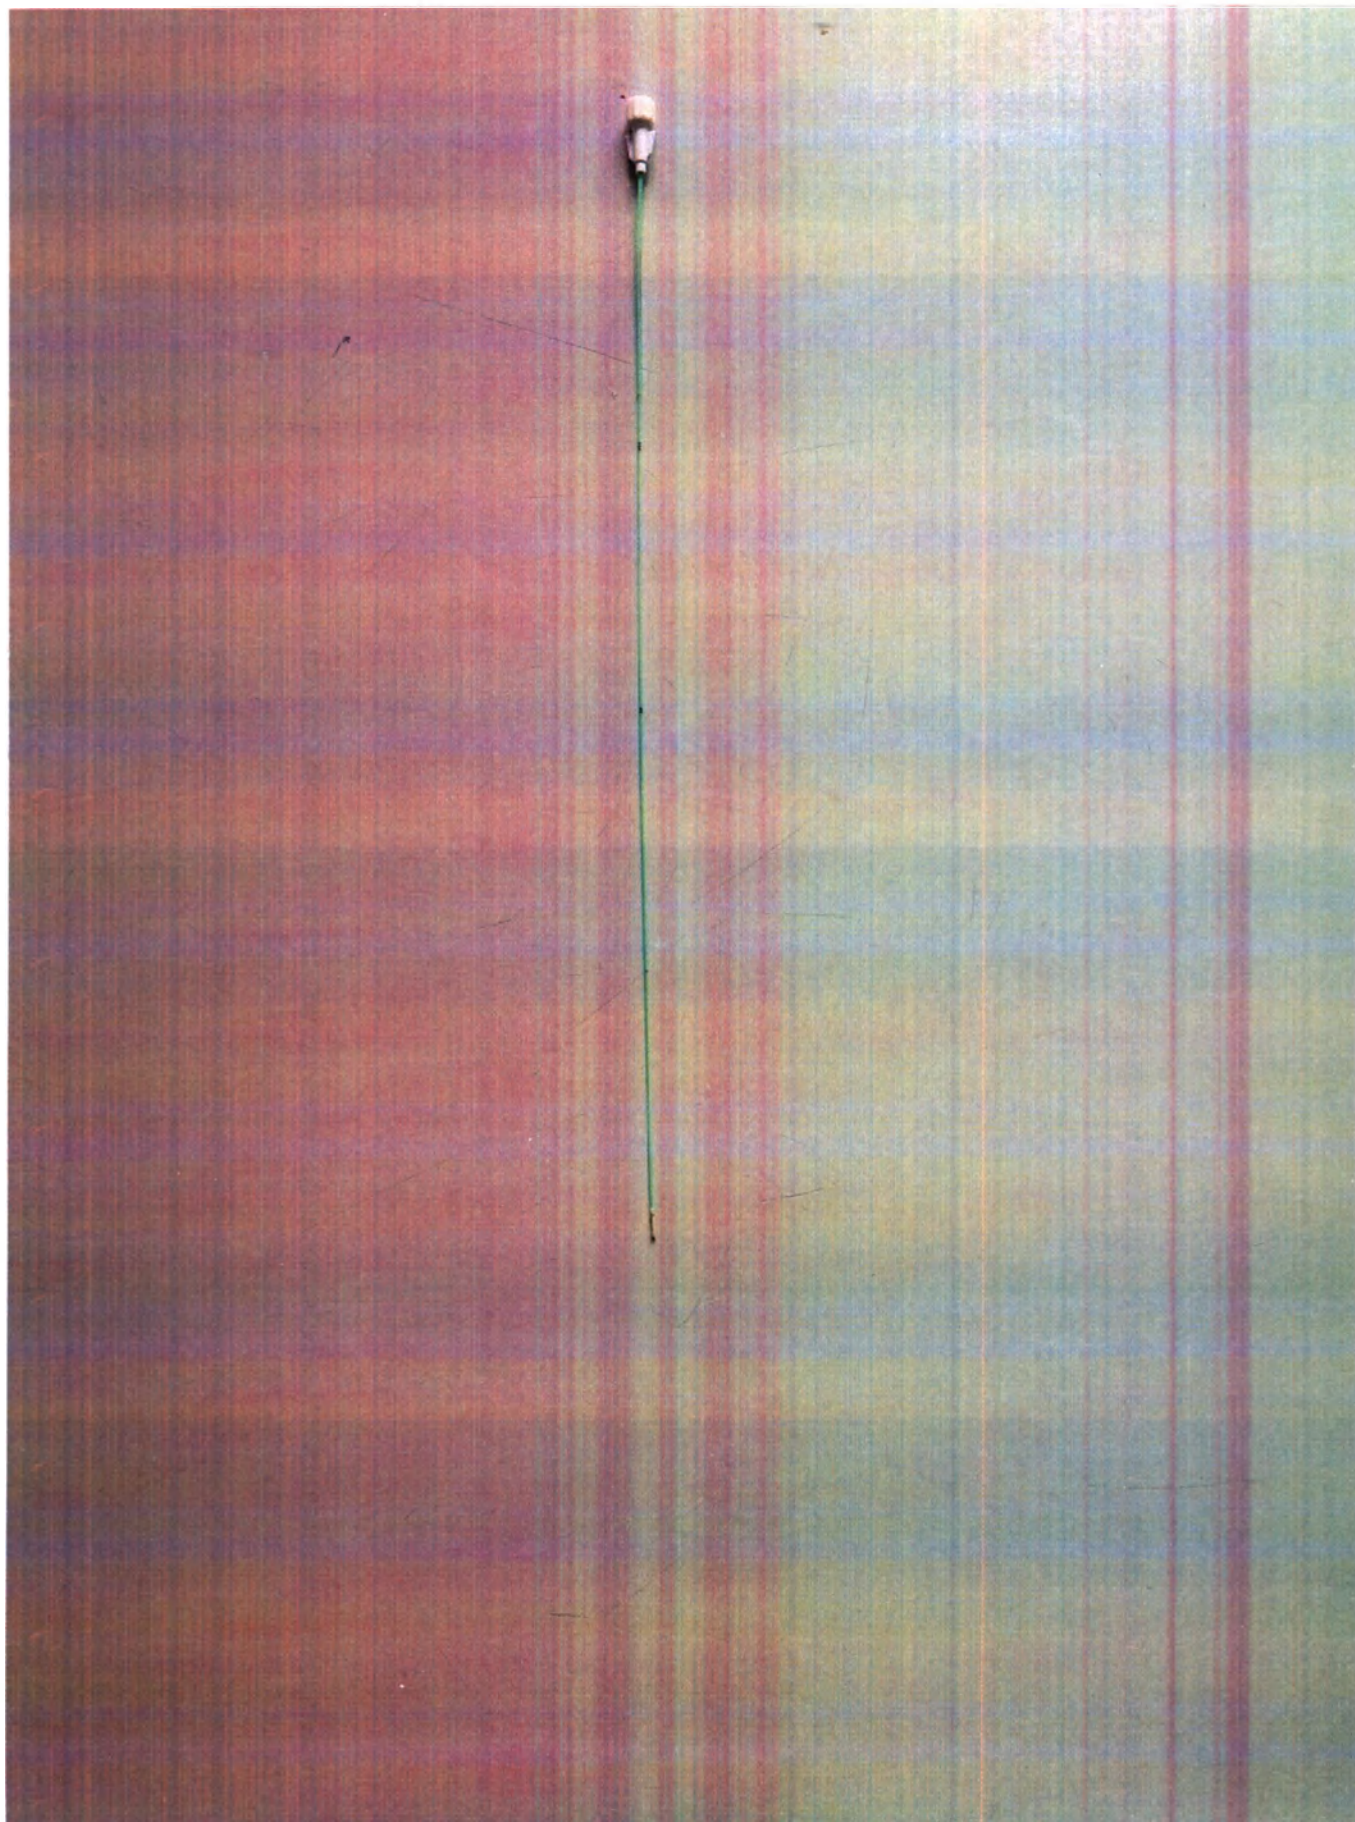

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 3F-40.

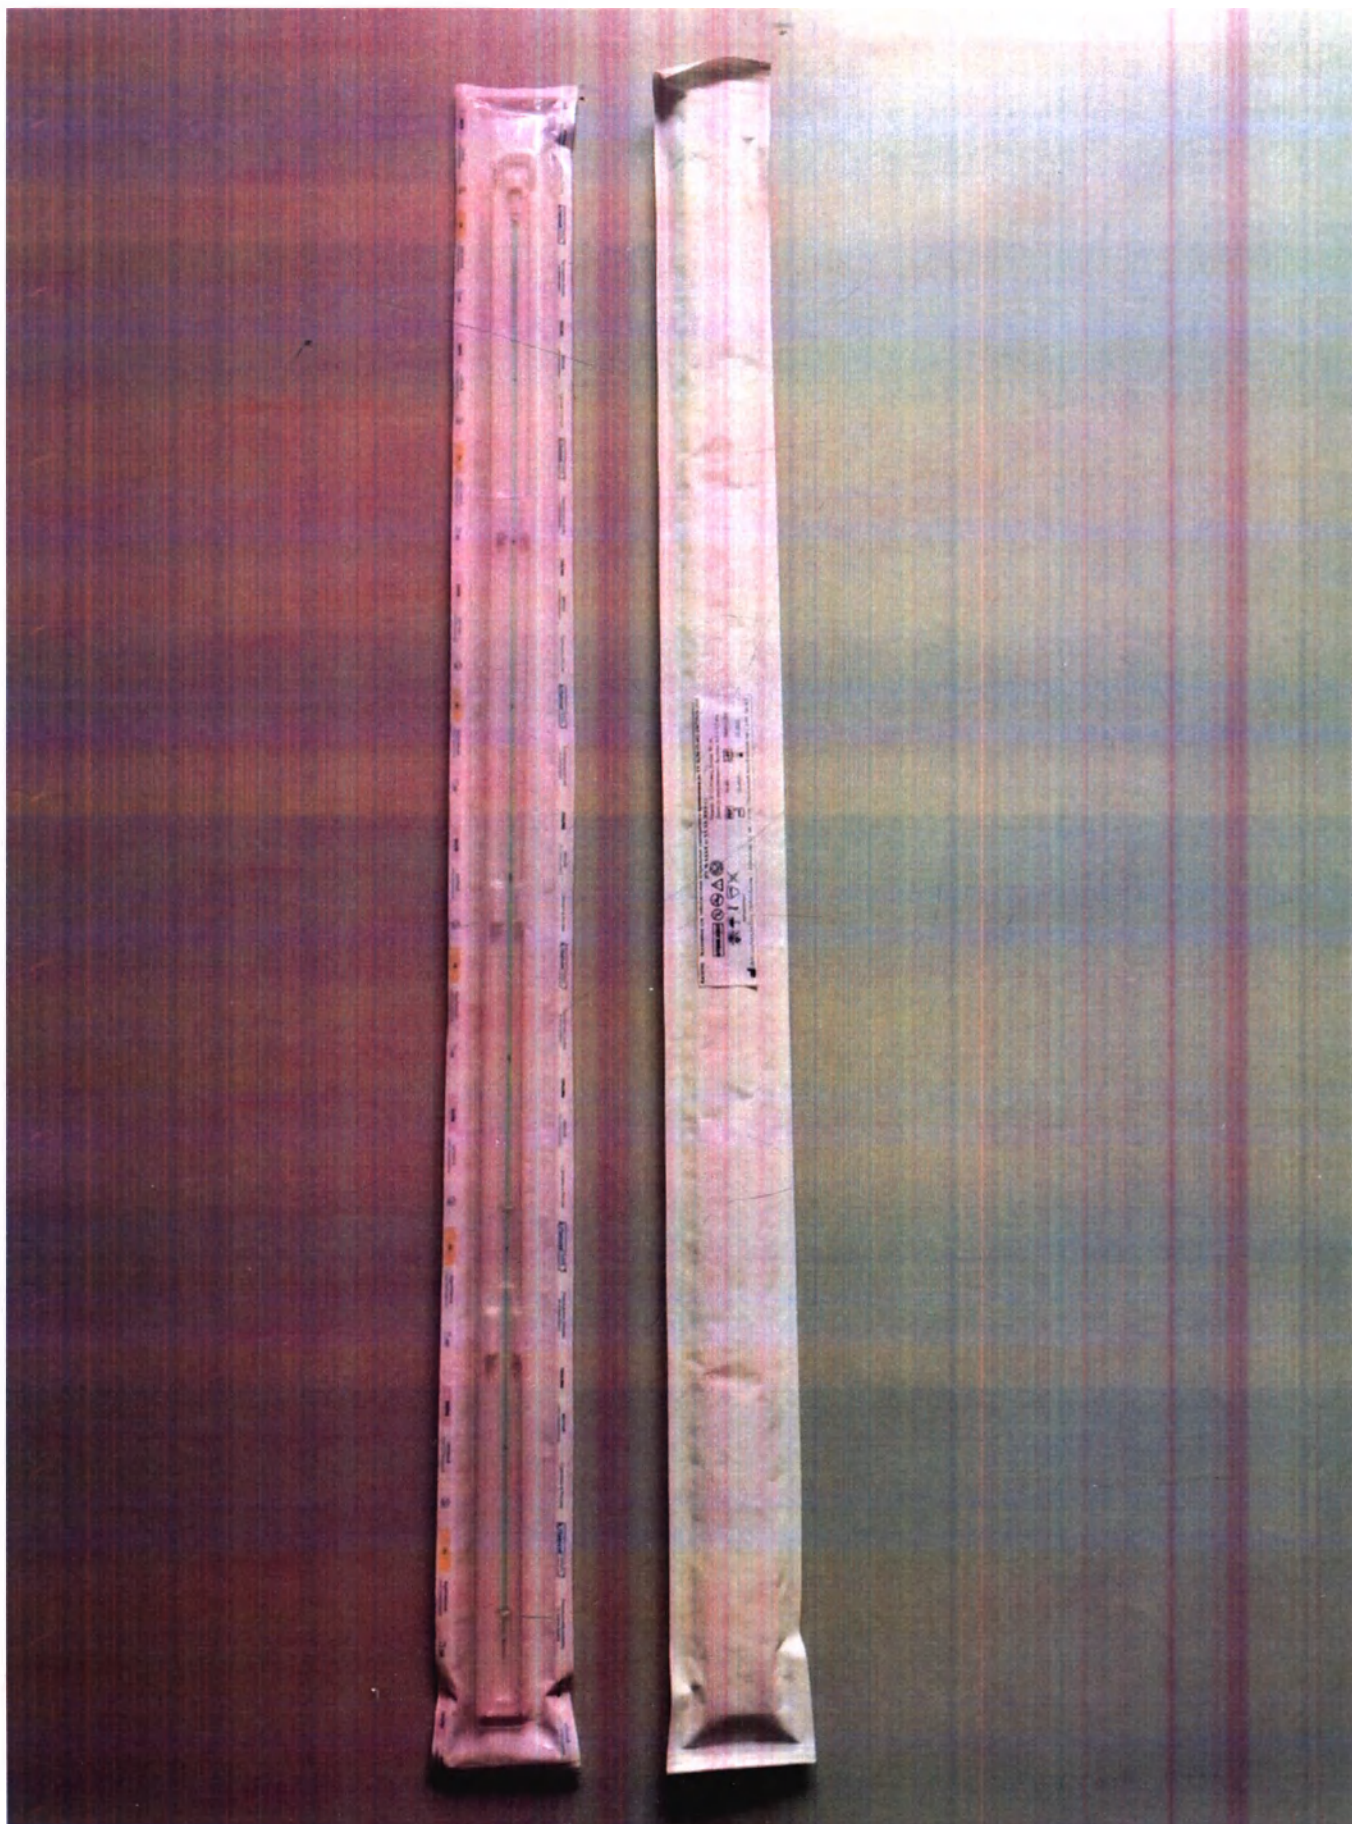

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 3F-80. Потребительская упаковка.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
 (ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

STERILEEO    


нестоксично

Размер: 3F (1,00 мм), Длина: 40 см
 Диаметр наполненного баллона: 6,0 ± 1,0 мм


REF	3F-40	LOT	030011220
	12-2020		12-2023

 ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 3F-40. Маркировка.

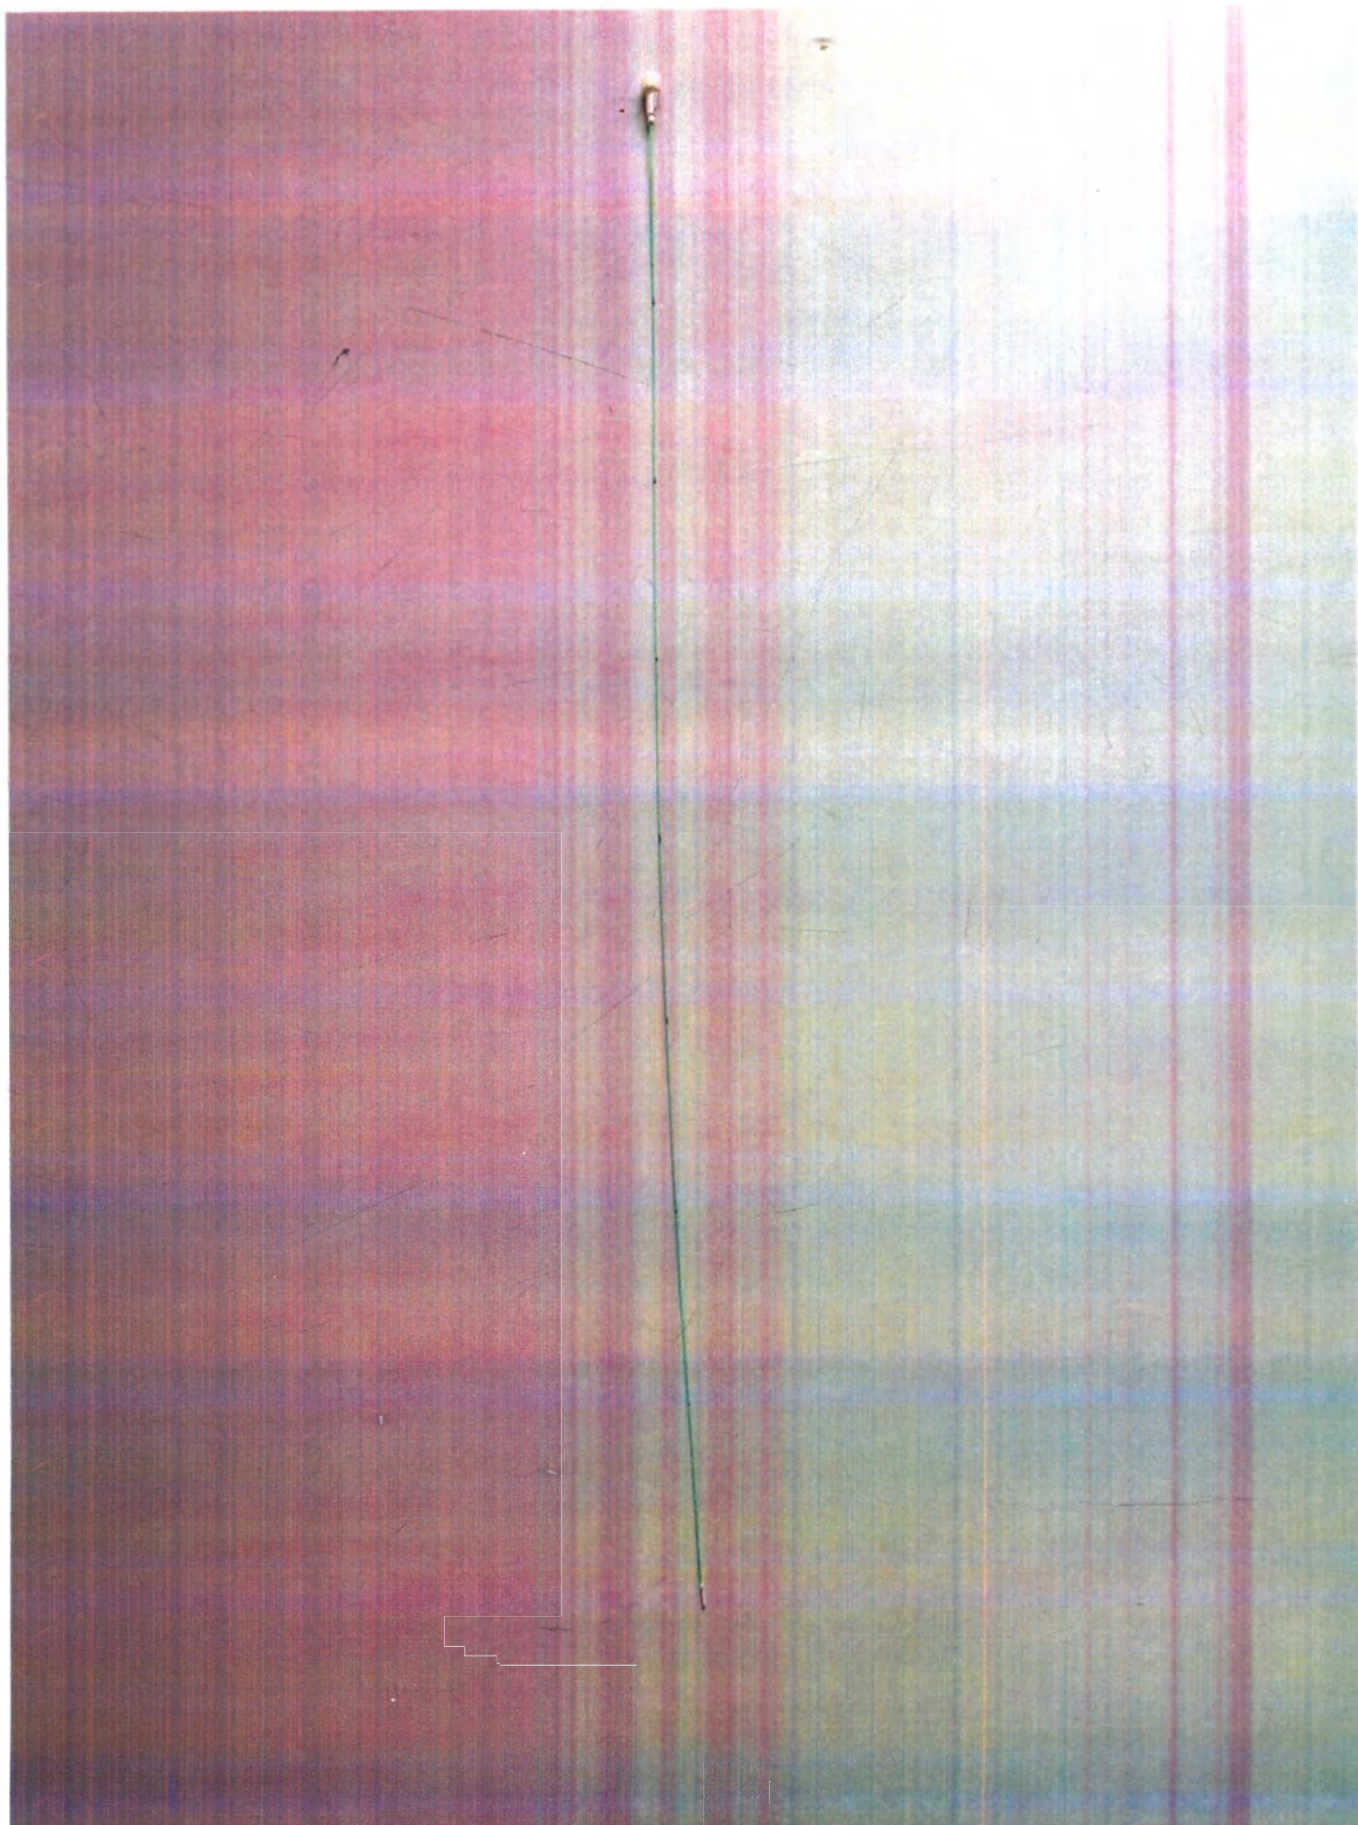

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 3F-80.

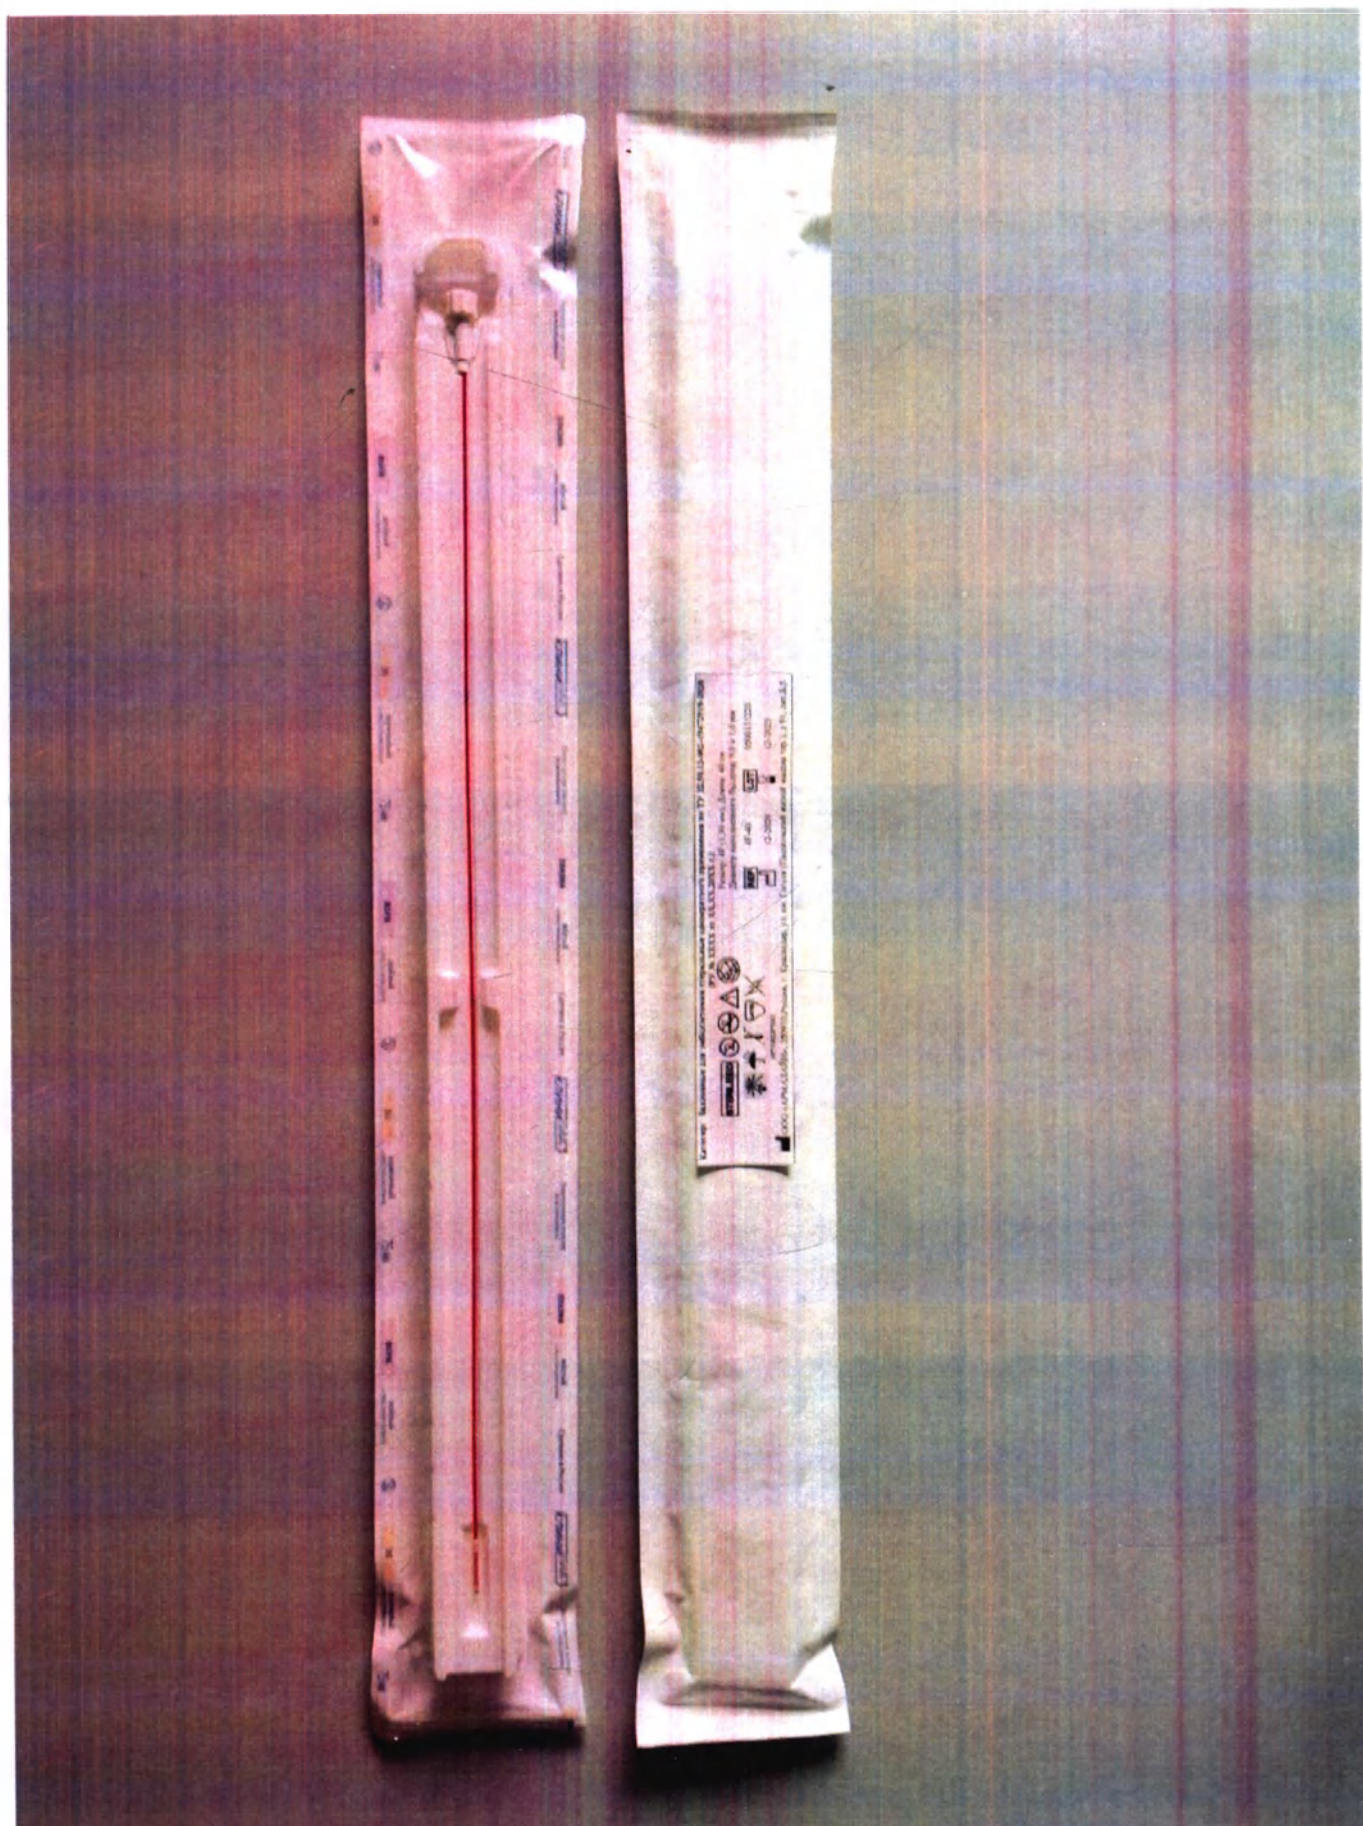

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-40. Потребительская упаковка.

Катетер баллонный для эмболизкции стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

STERILE



нетоксично

Размер: 3F (1,00 мм), Длина: 80 см

Диаметр наполненного баллона: $6,0 \pm 1,0$ мм

REF

3F-80

LOT

040011220



12-2020




12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Катетер баллонный для эмболизкции стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 3F-80. Маркировка

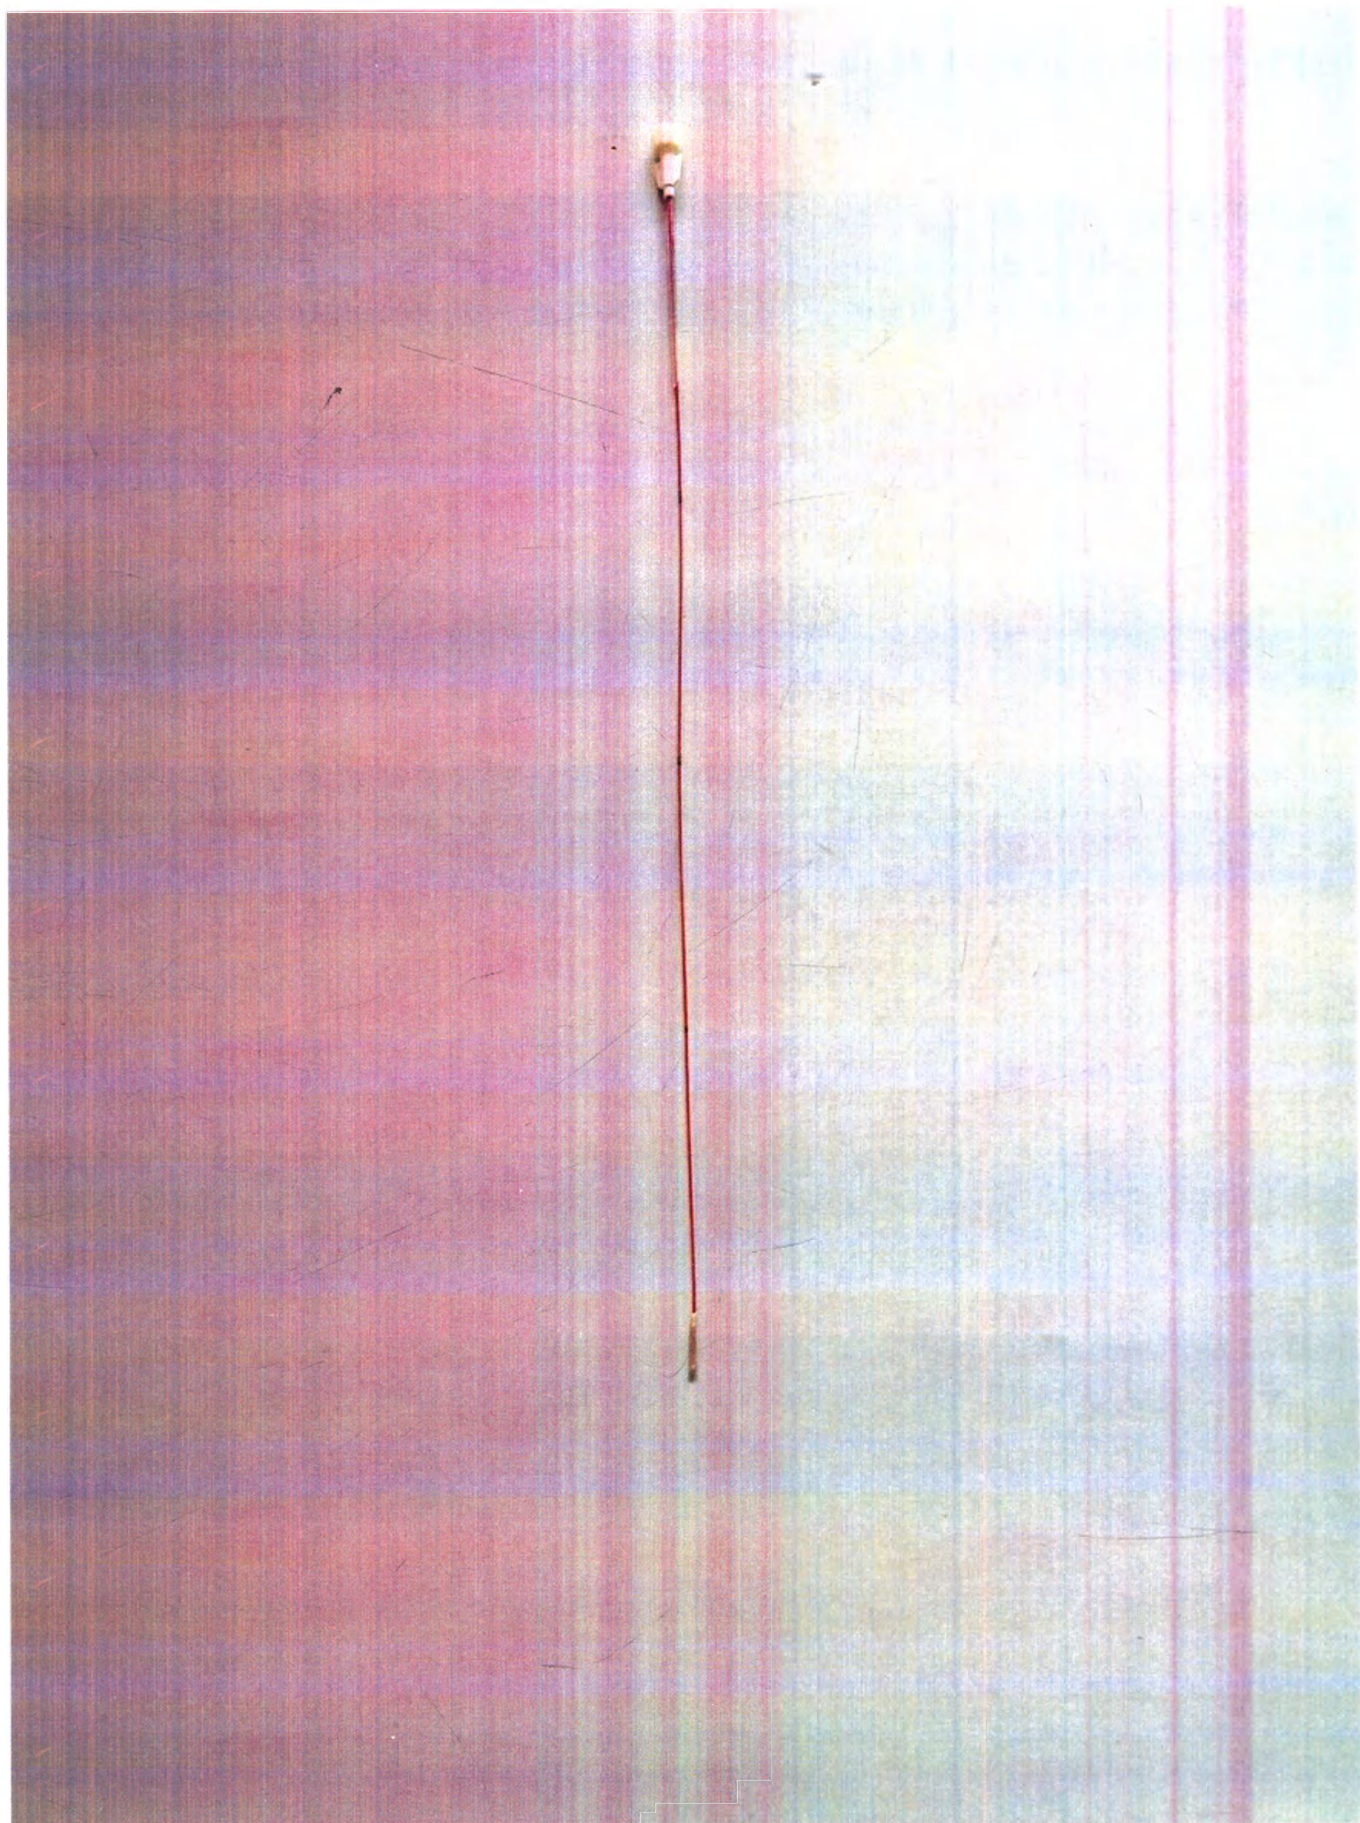

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-40.

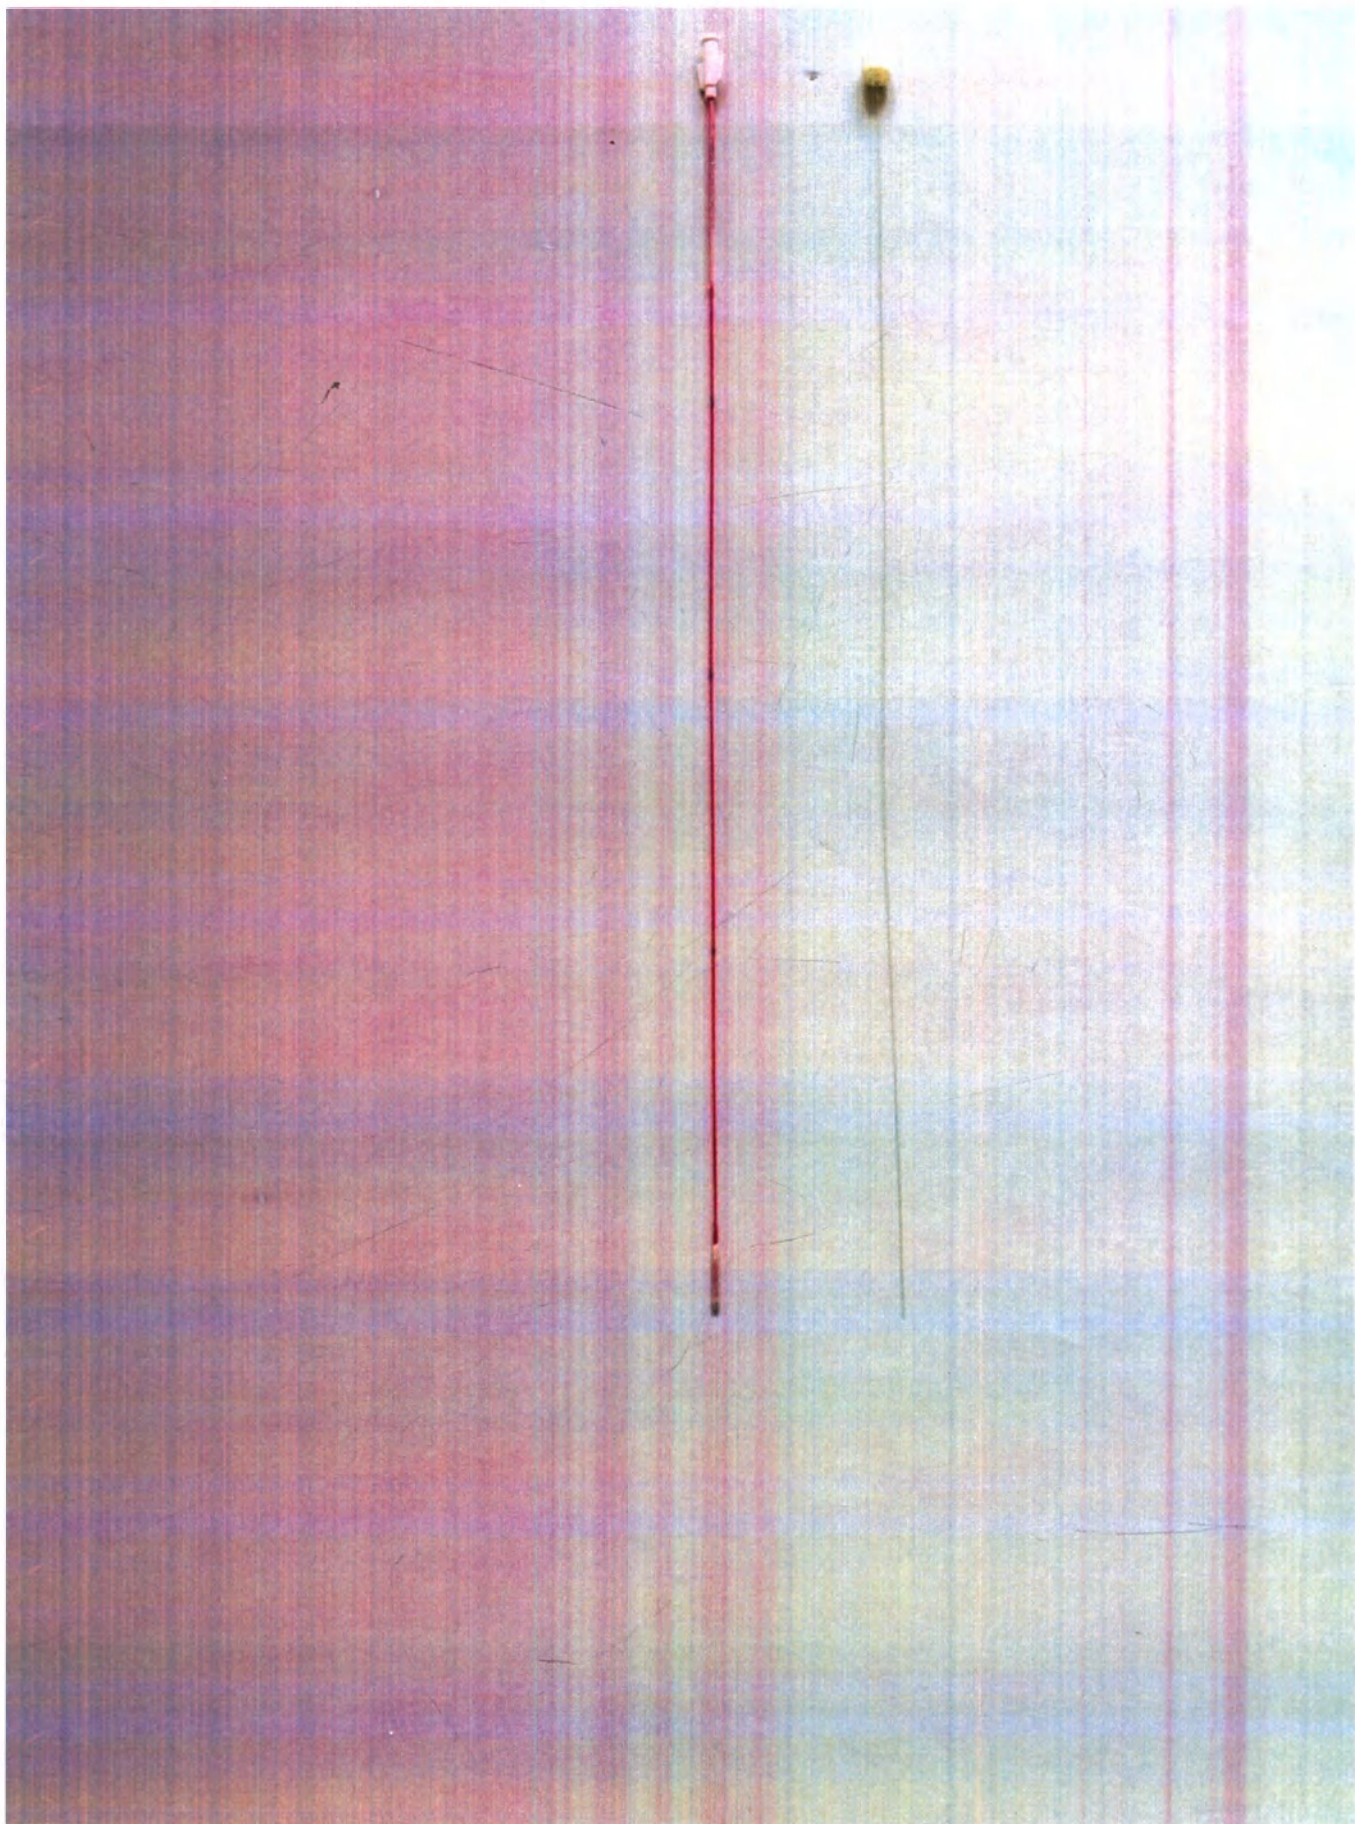

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-40.

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(РУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



Размер: 4F (1,30 мм), Длина: 40 см
Диаметр наполненного баллона: $9,0 \pm 1,0$ мм



нетоксично



4F-40



0500111220


12-2020

12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б


Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-40. Маркировка.

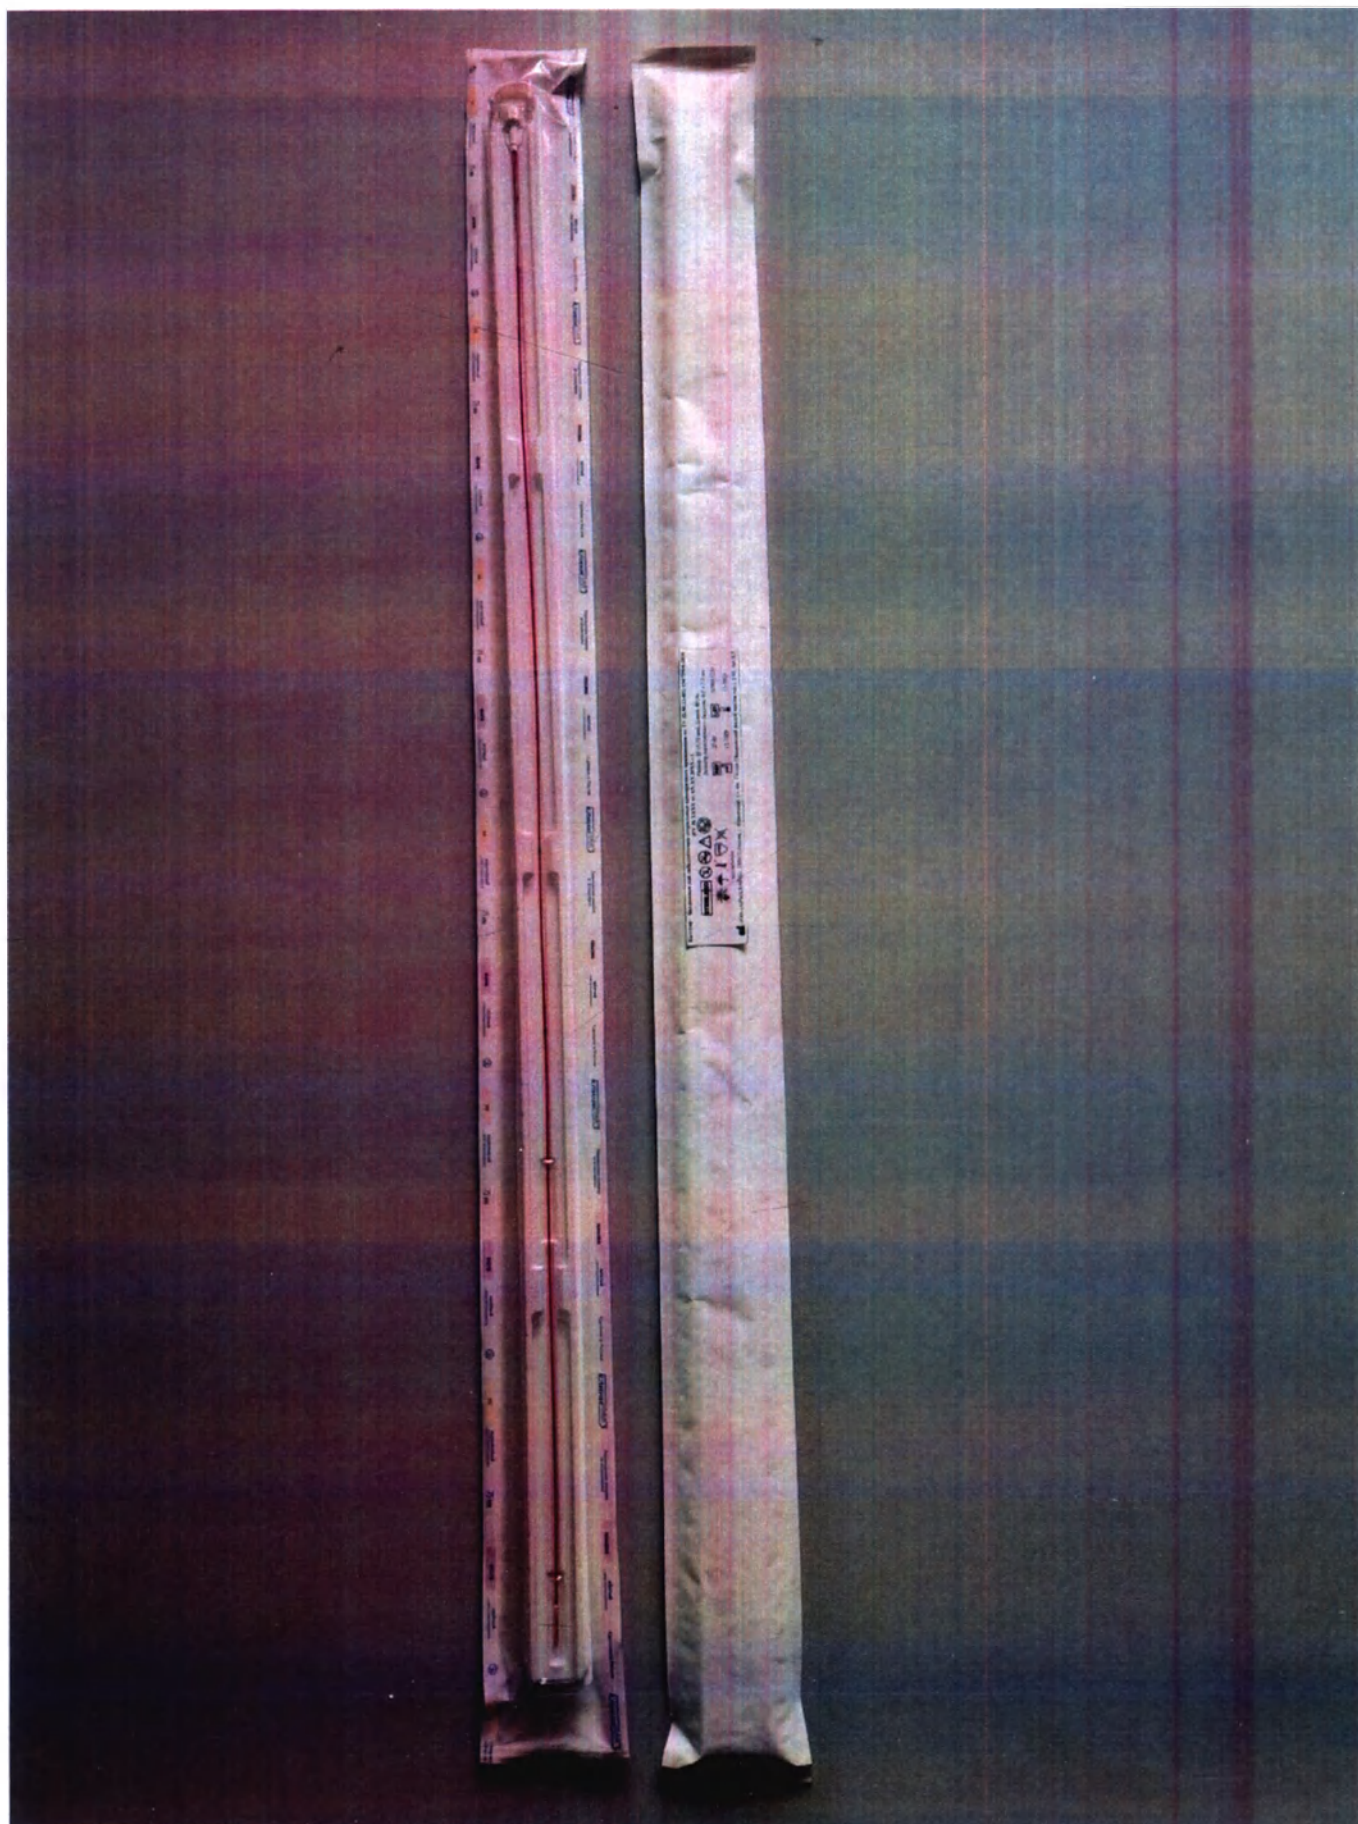

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-80. Потребительская упаковка.

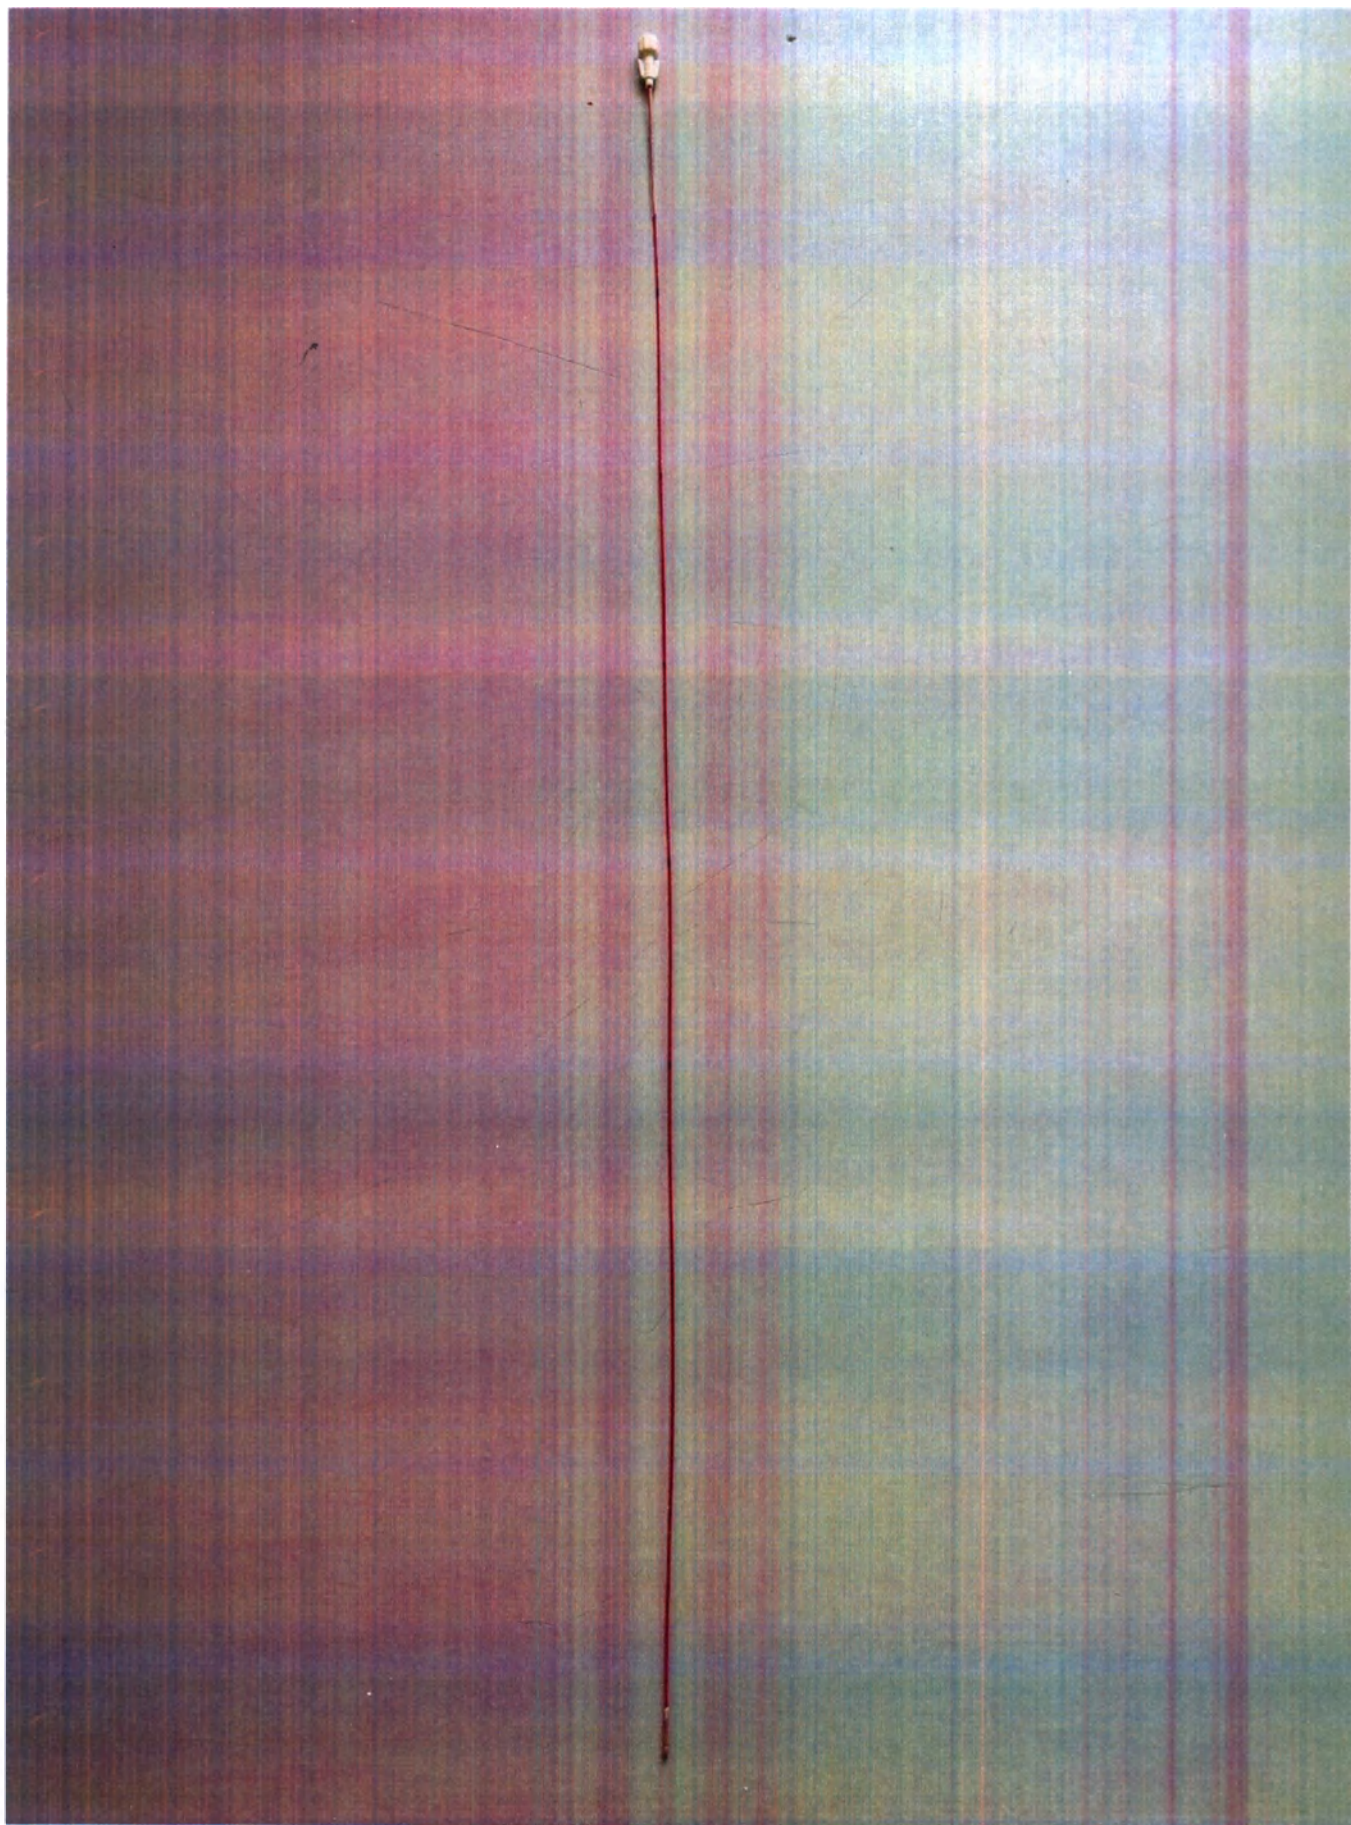

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-80.

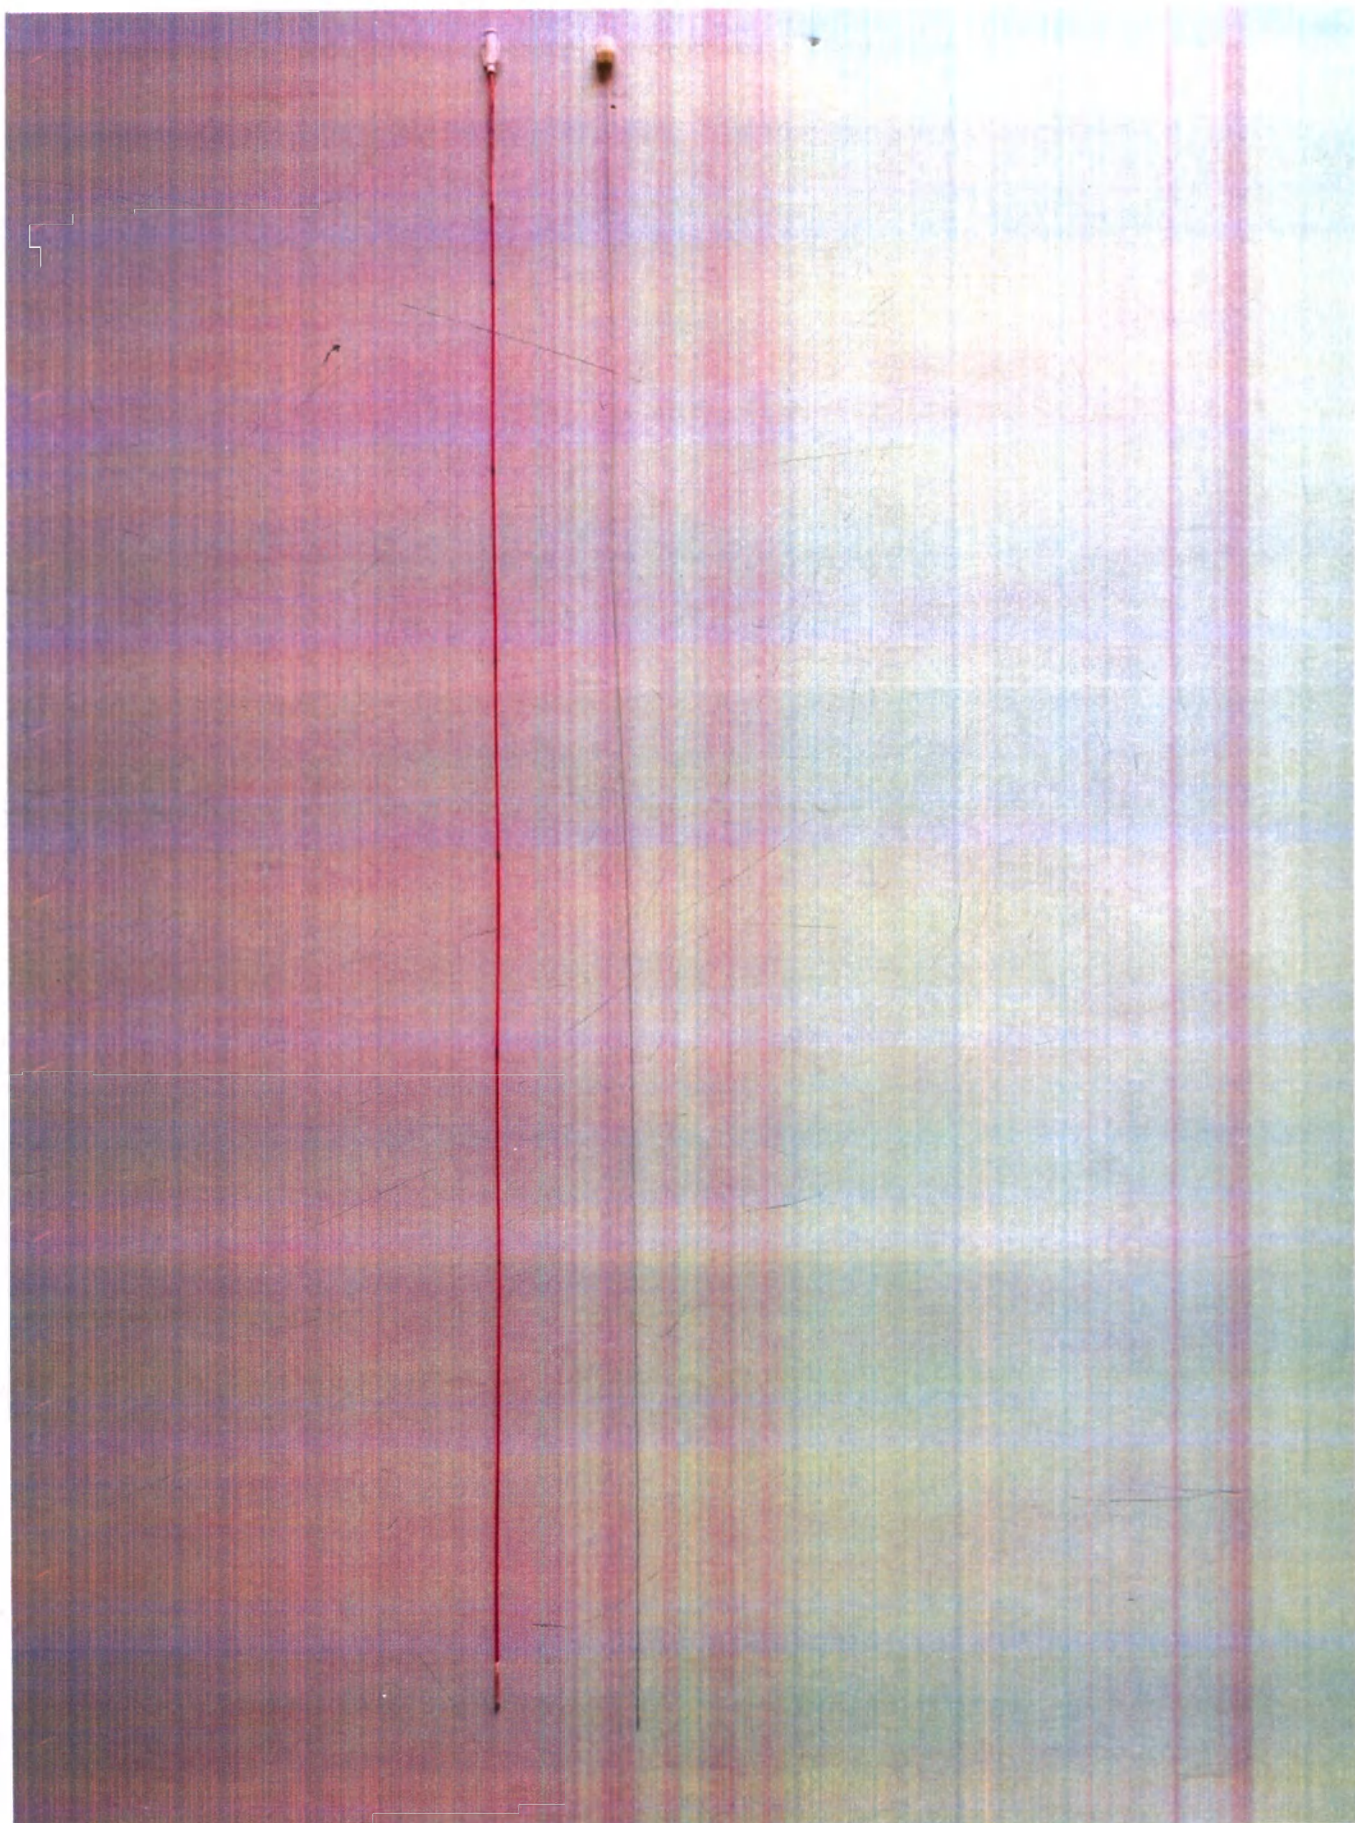

Катетер баллонный для эмболизектомии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-80 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично



ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Размер: 4F (1,30 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $9,0 \pm 1,0$ мм

REF

4F-80

LOT

060011220




12-2020




12-2023


Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-80. Маркировка.

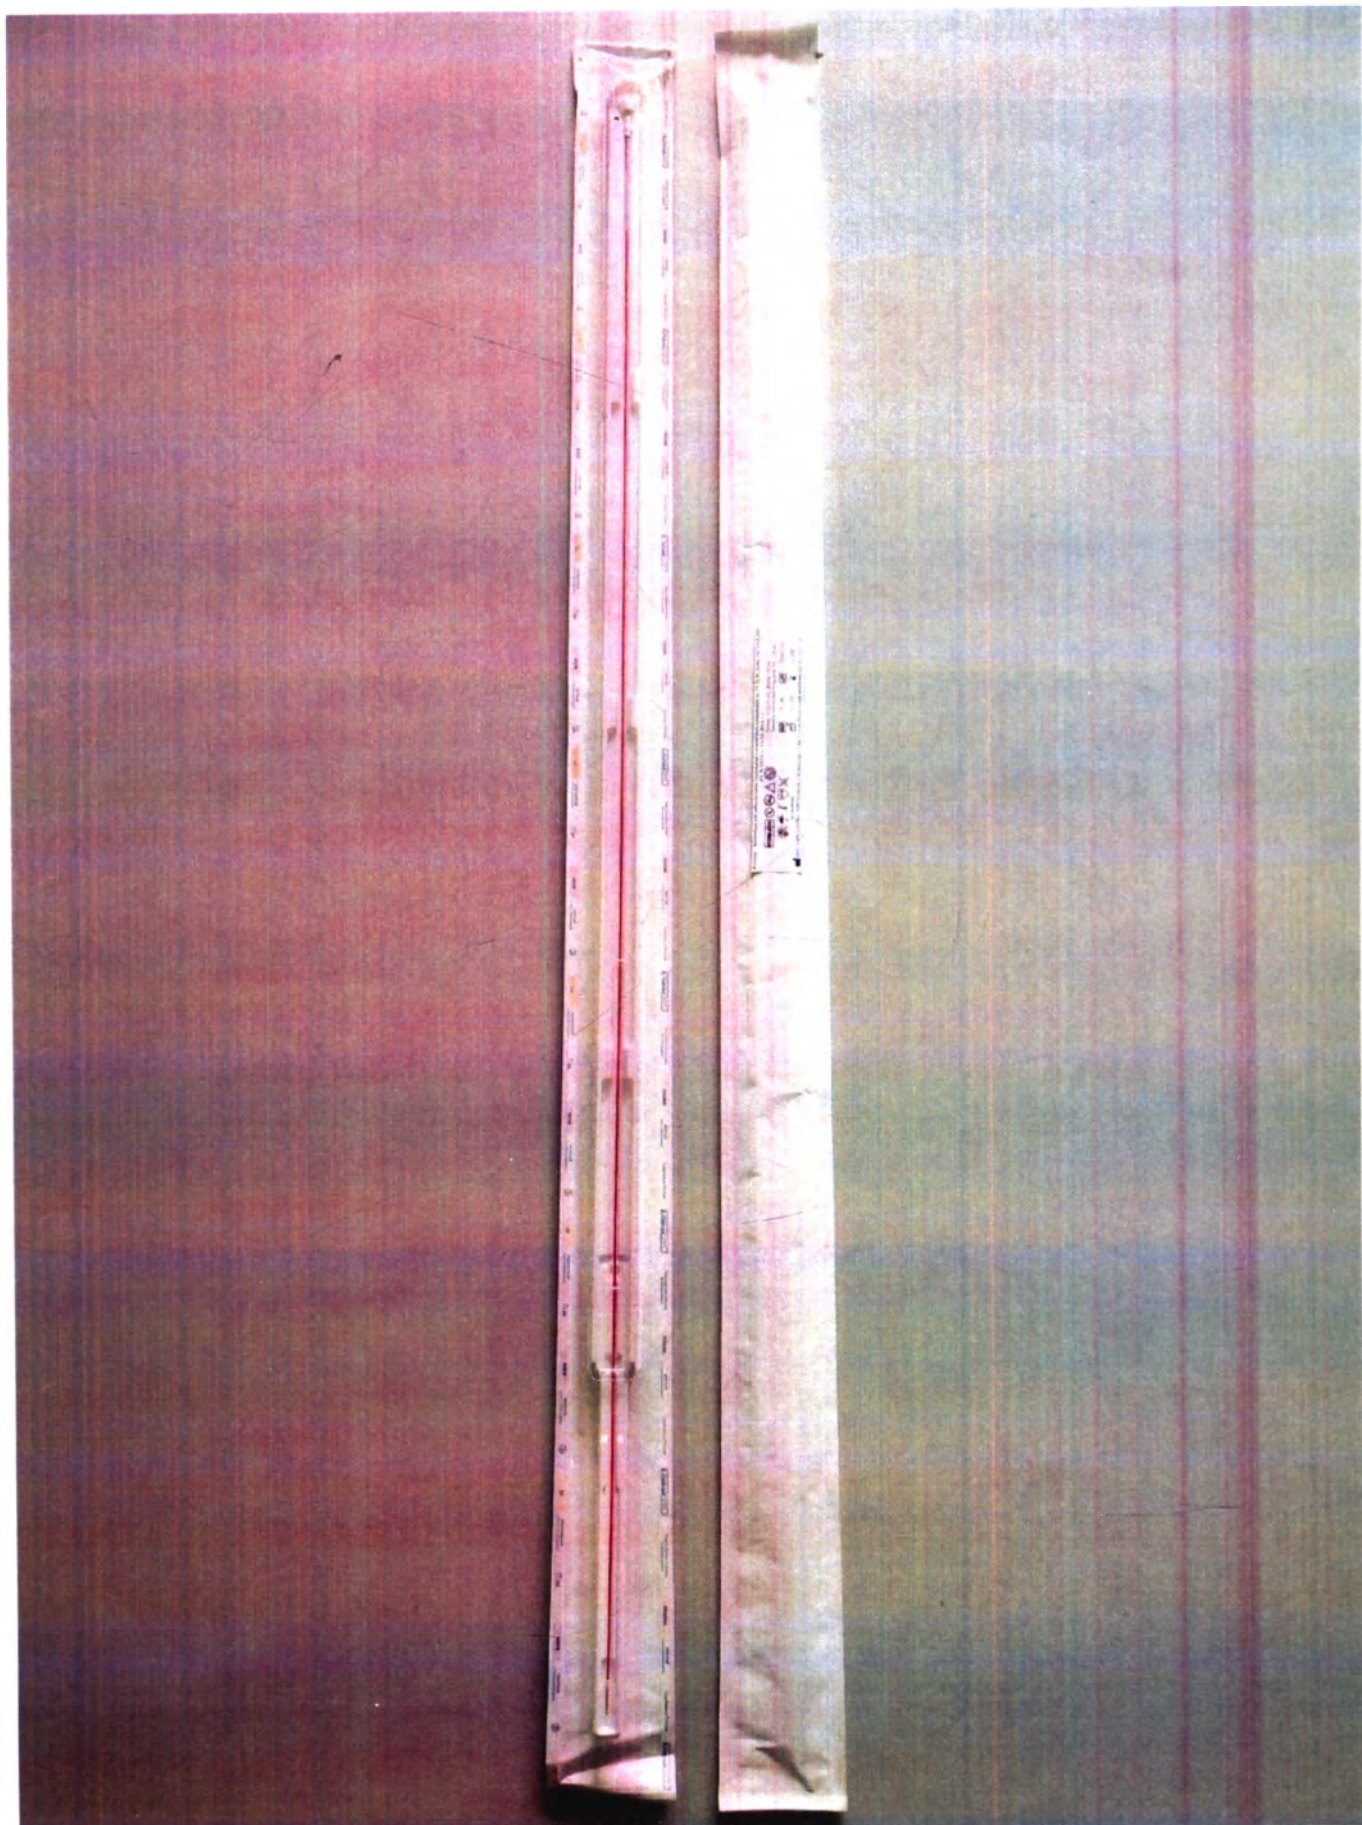

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-100. Потребительская упаковка.

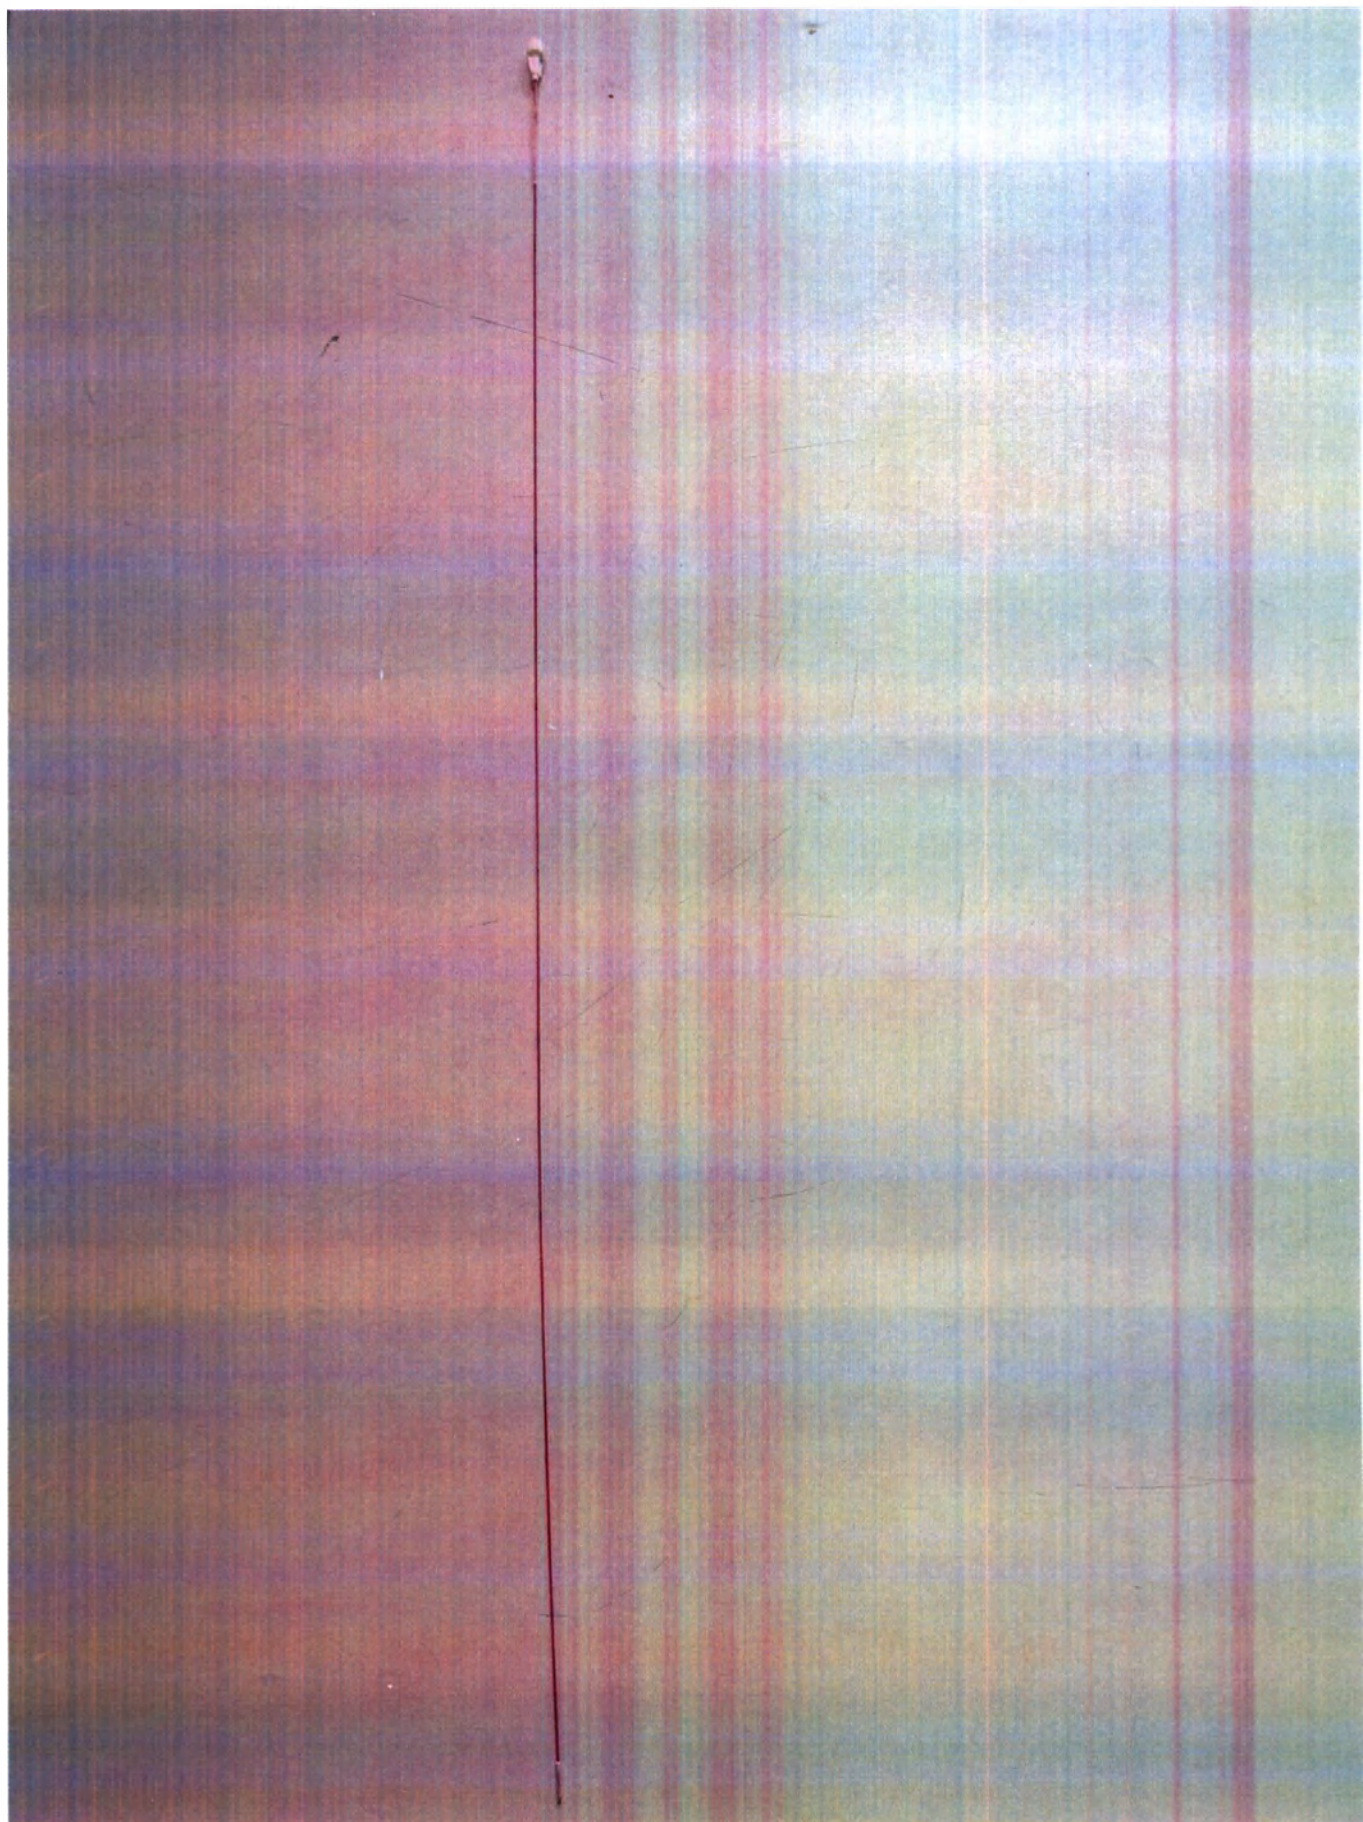

Катетер баллонный для эмболектмии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-100.

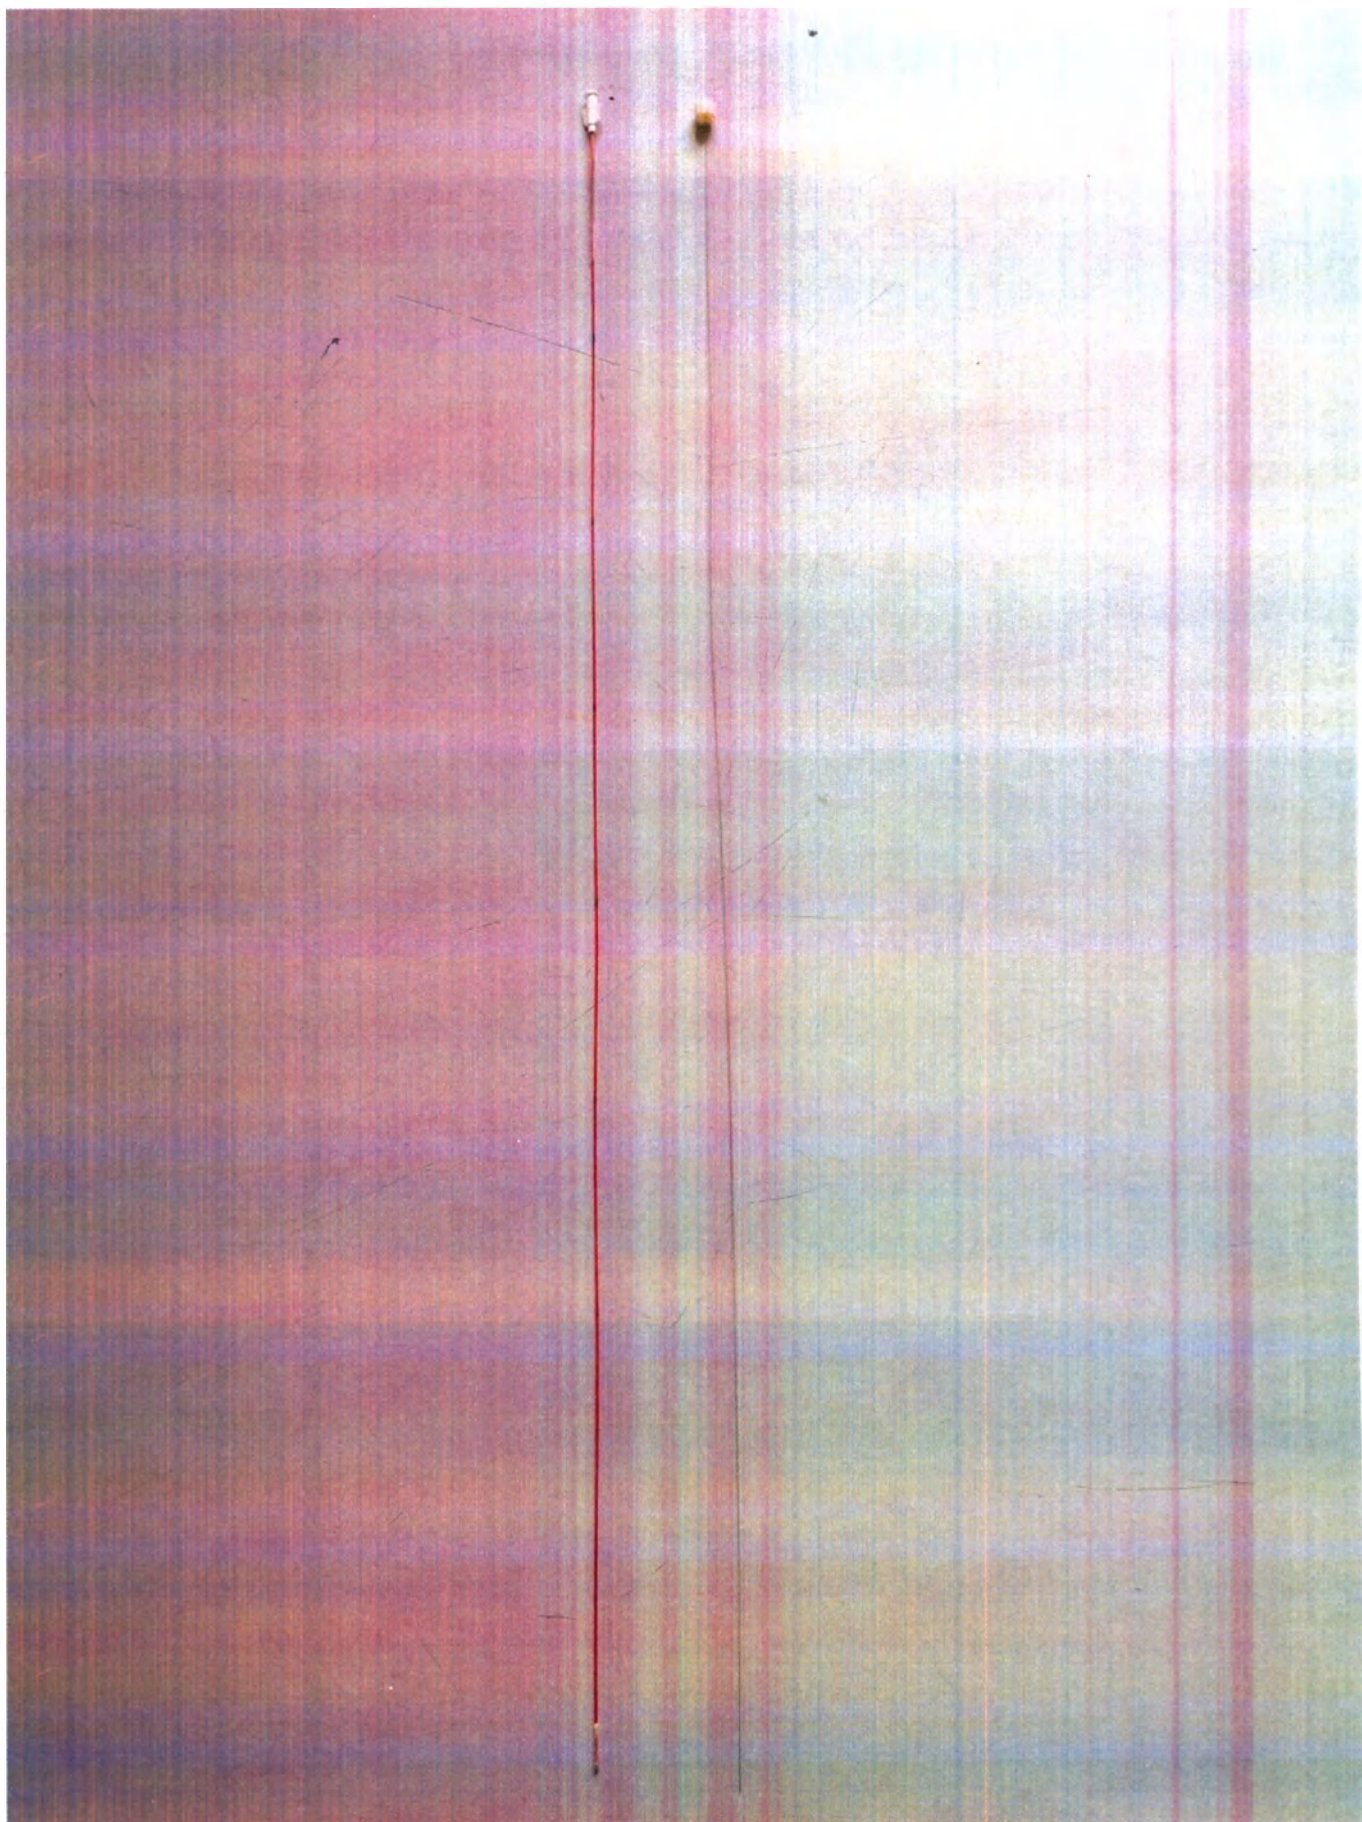

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-100 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



Размер: 4F (1,30 мм), Длина: 100 см
Диаметр наполненного баллона: $9,0 \pm 1,0$ мм



нетоксично



4F-100



070011220


12-2020

12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 4F-100. Маркировка.

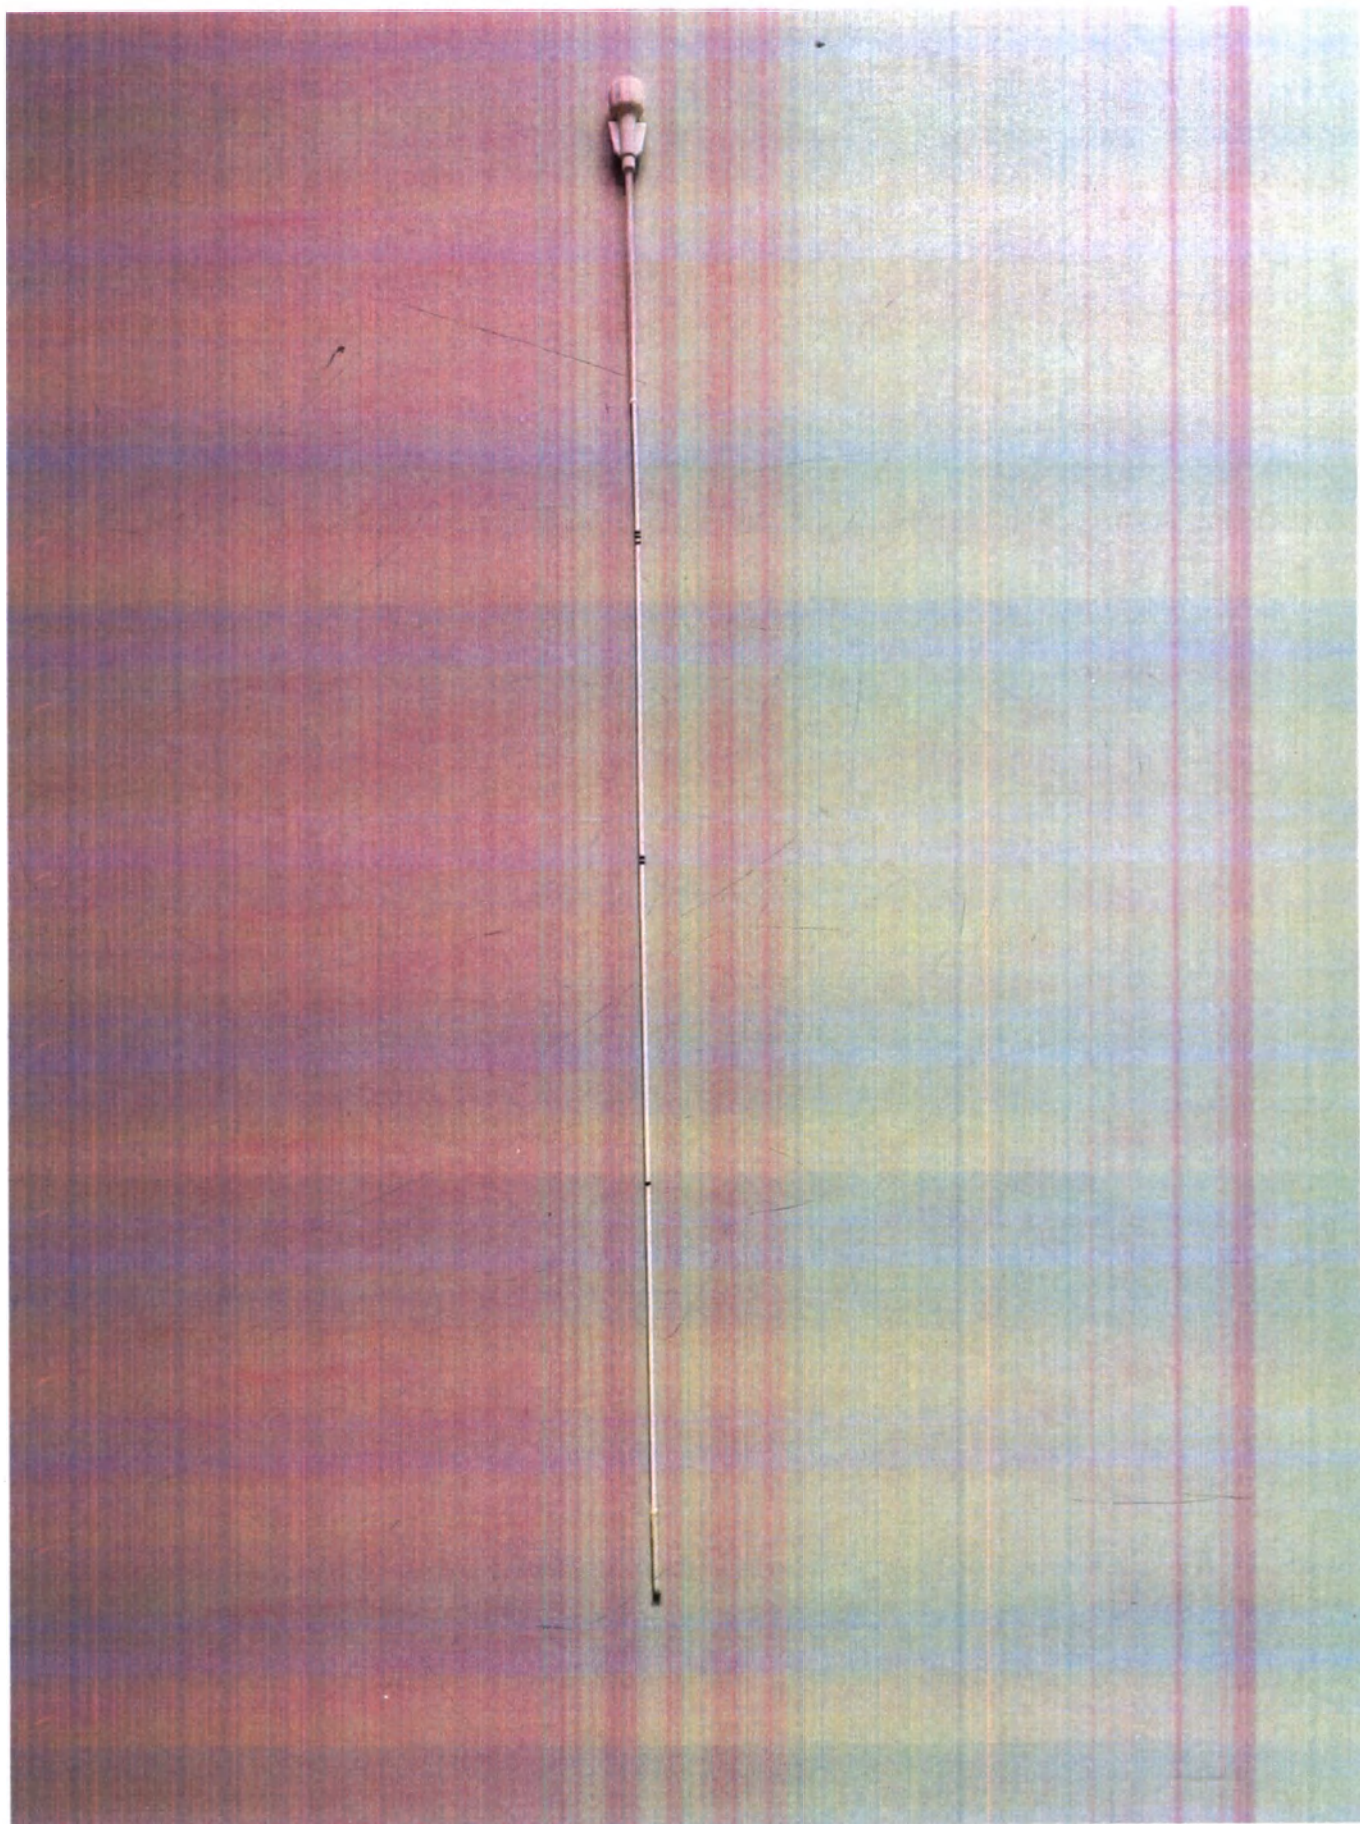

Катетер баллонный для эмболизектомии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 5F-40.

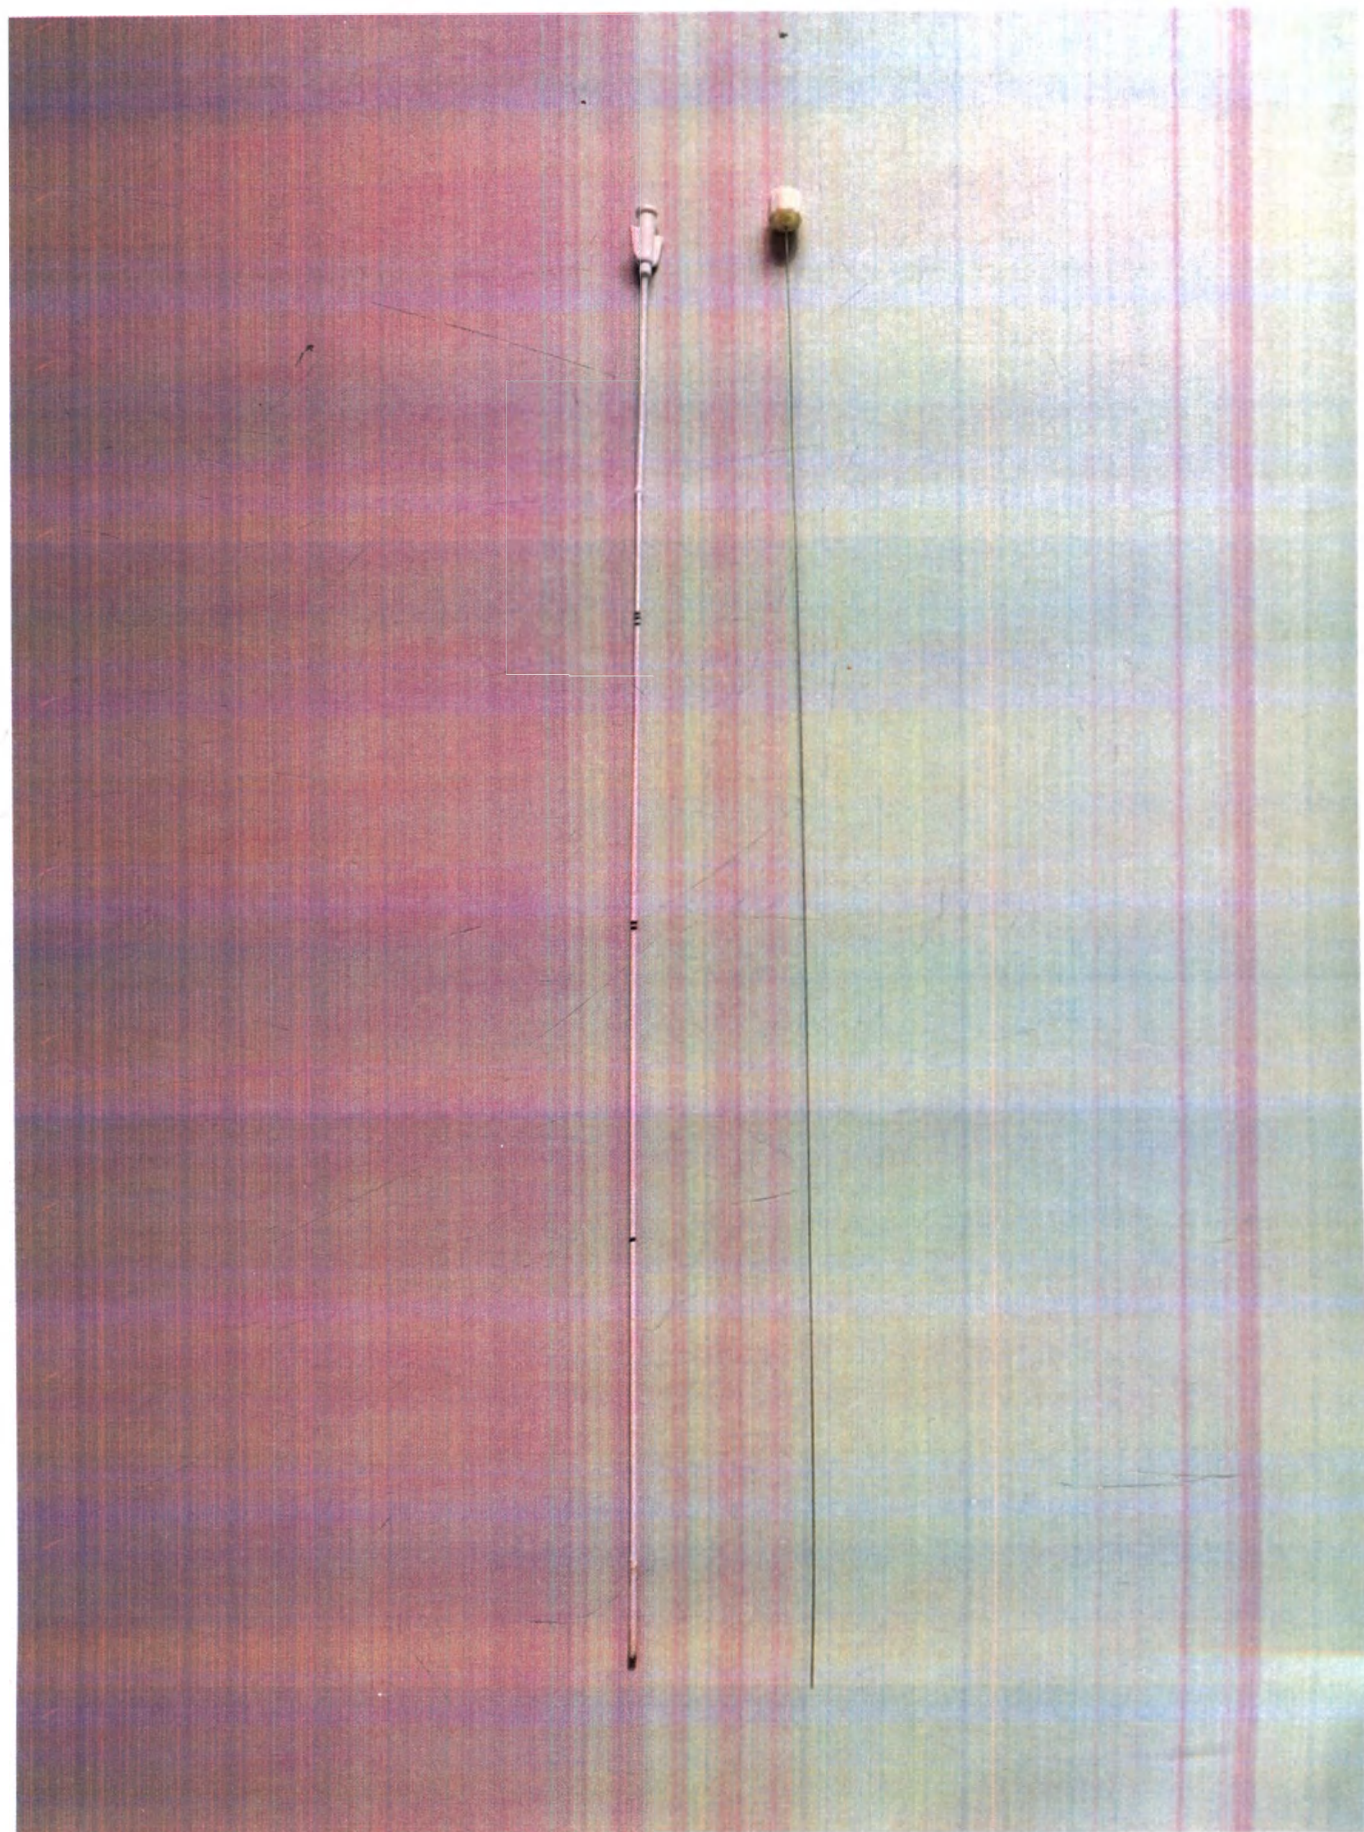

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 5F-40 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично

Размер: 5F (1,50 мм), Длина: 40 см

Диаметр наполненного баллона: $11,0 \pm 1,0$ мм



5F-40



080011220


12-2020

12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б


Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 5F-40. Маркировка.

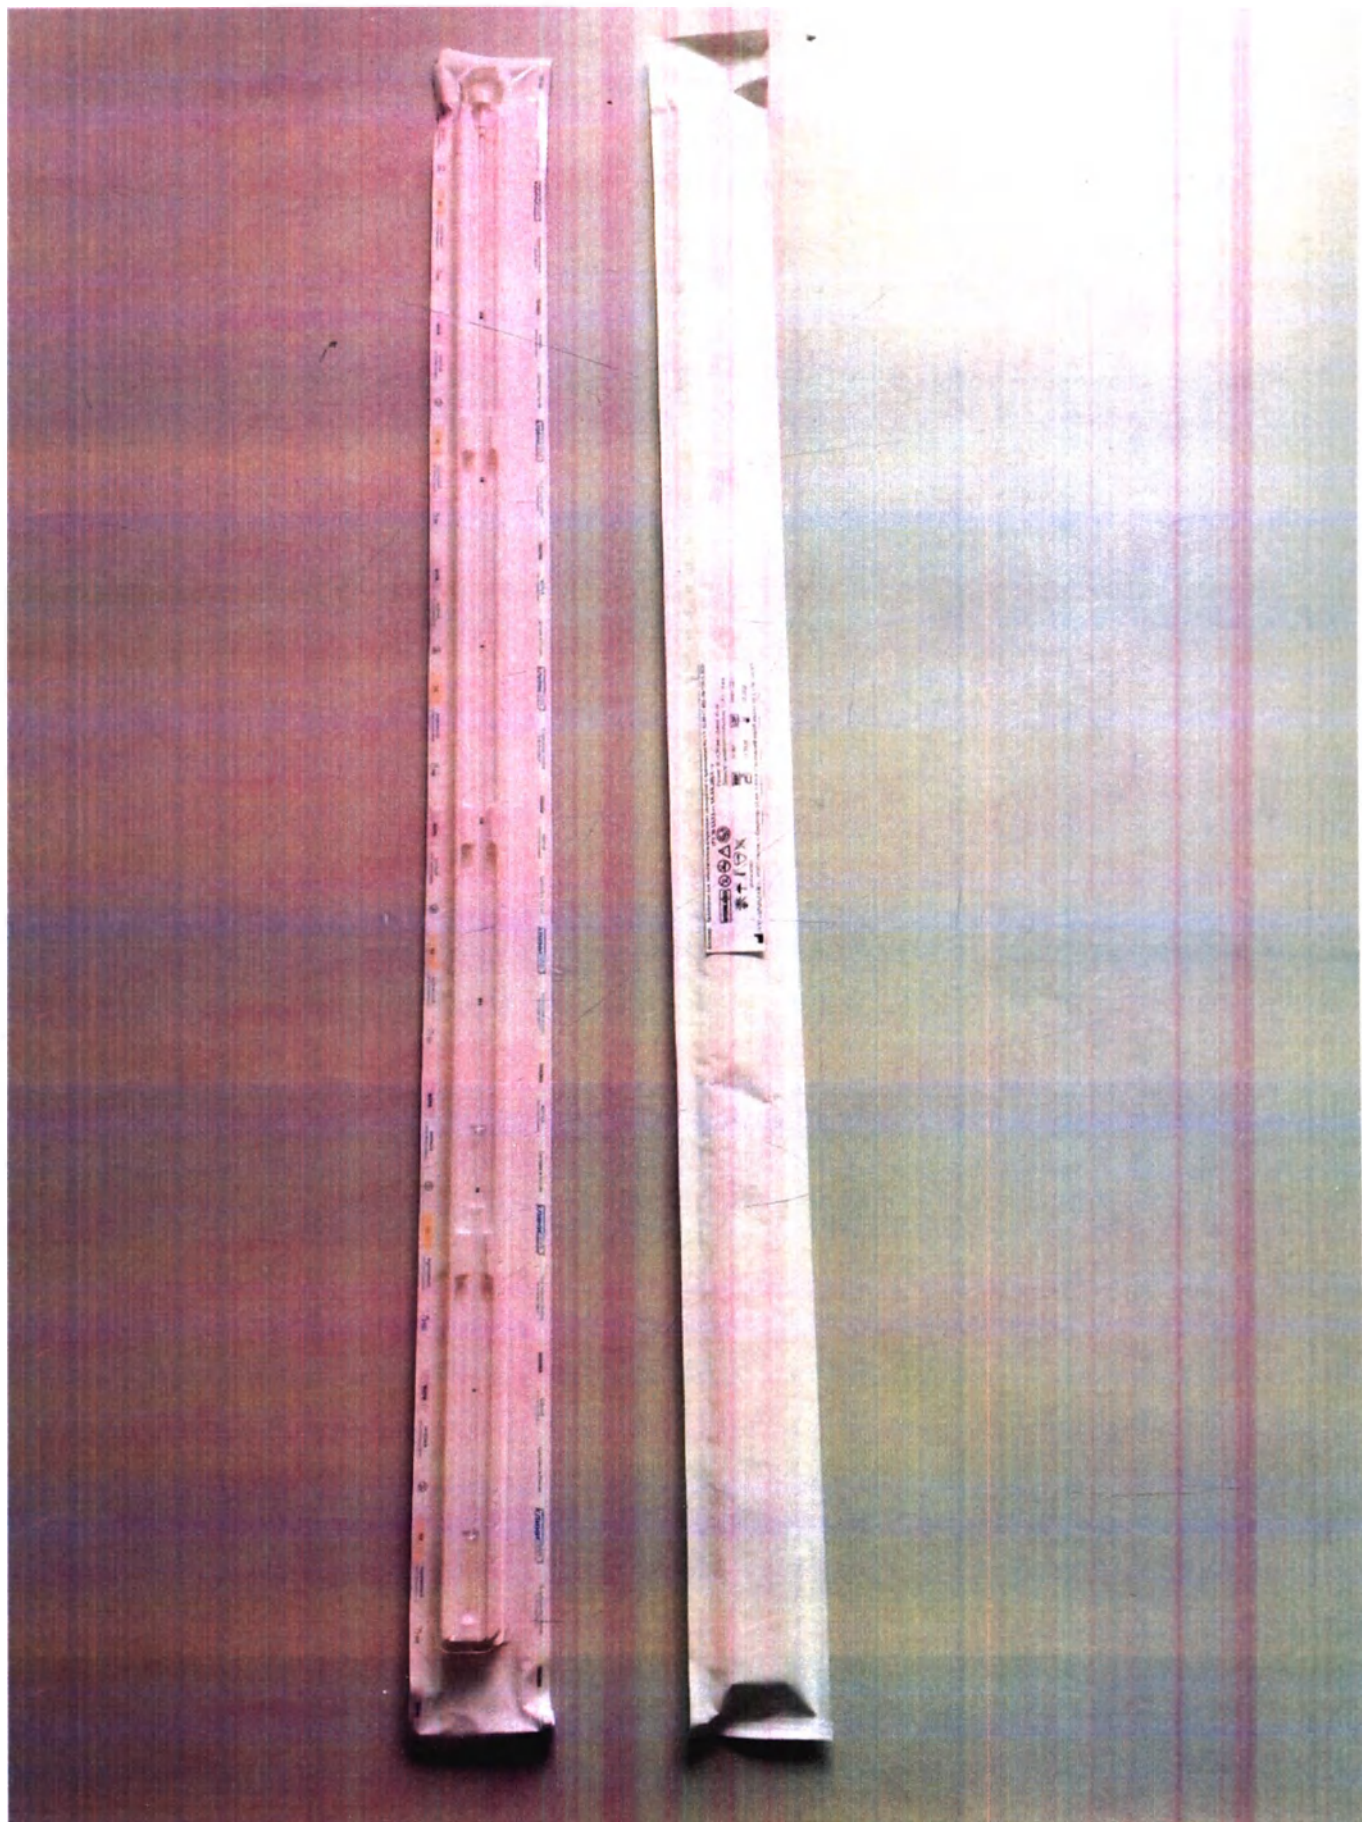

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 5F-80. Потребительская упаковка.

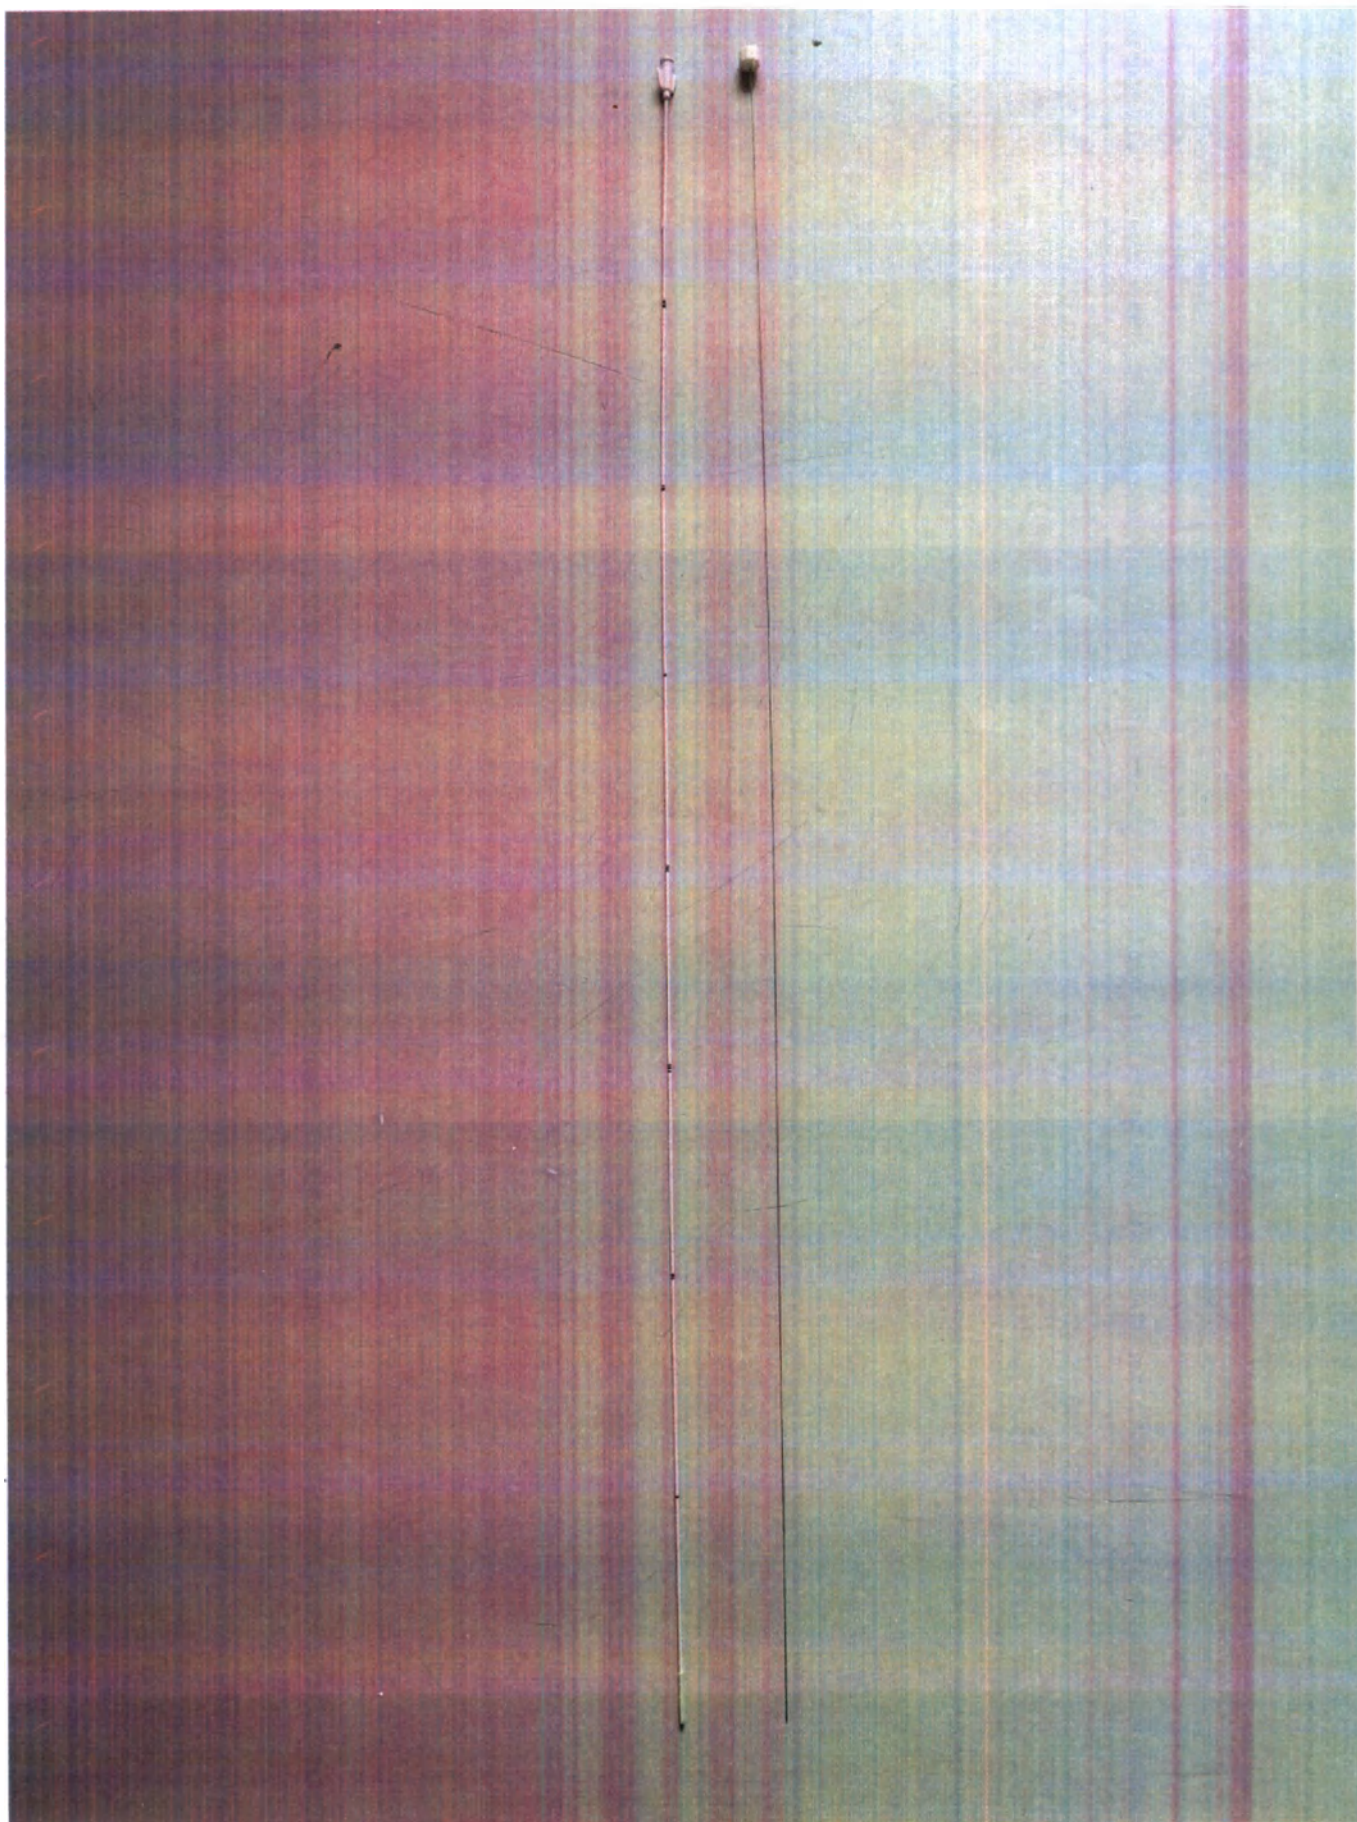

Катетер баллонный для эмболизэктомии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 5F-80.

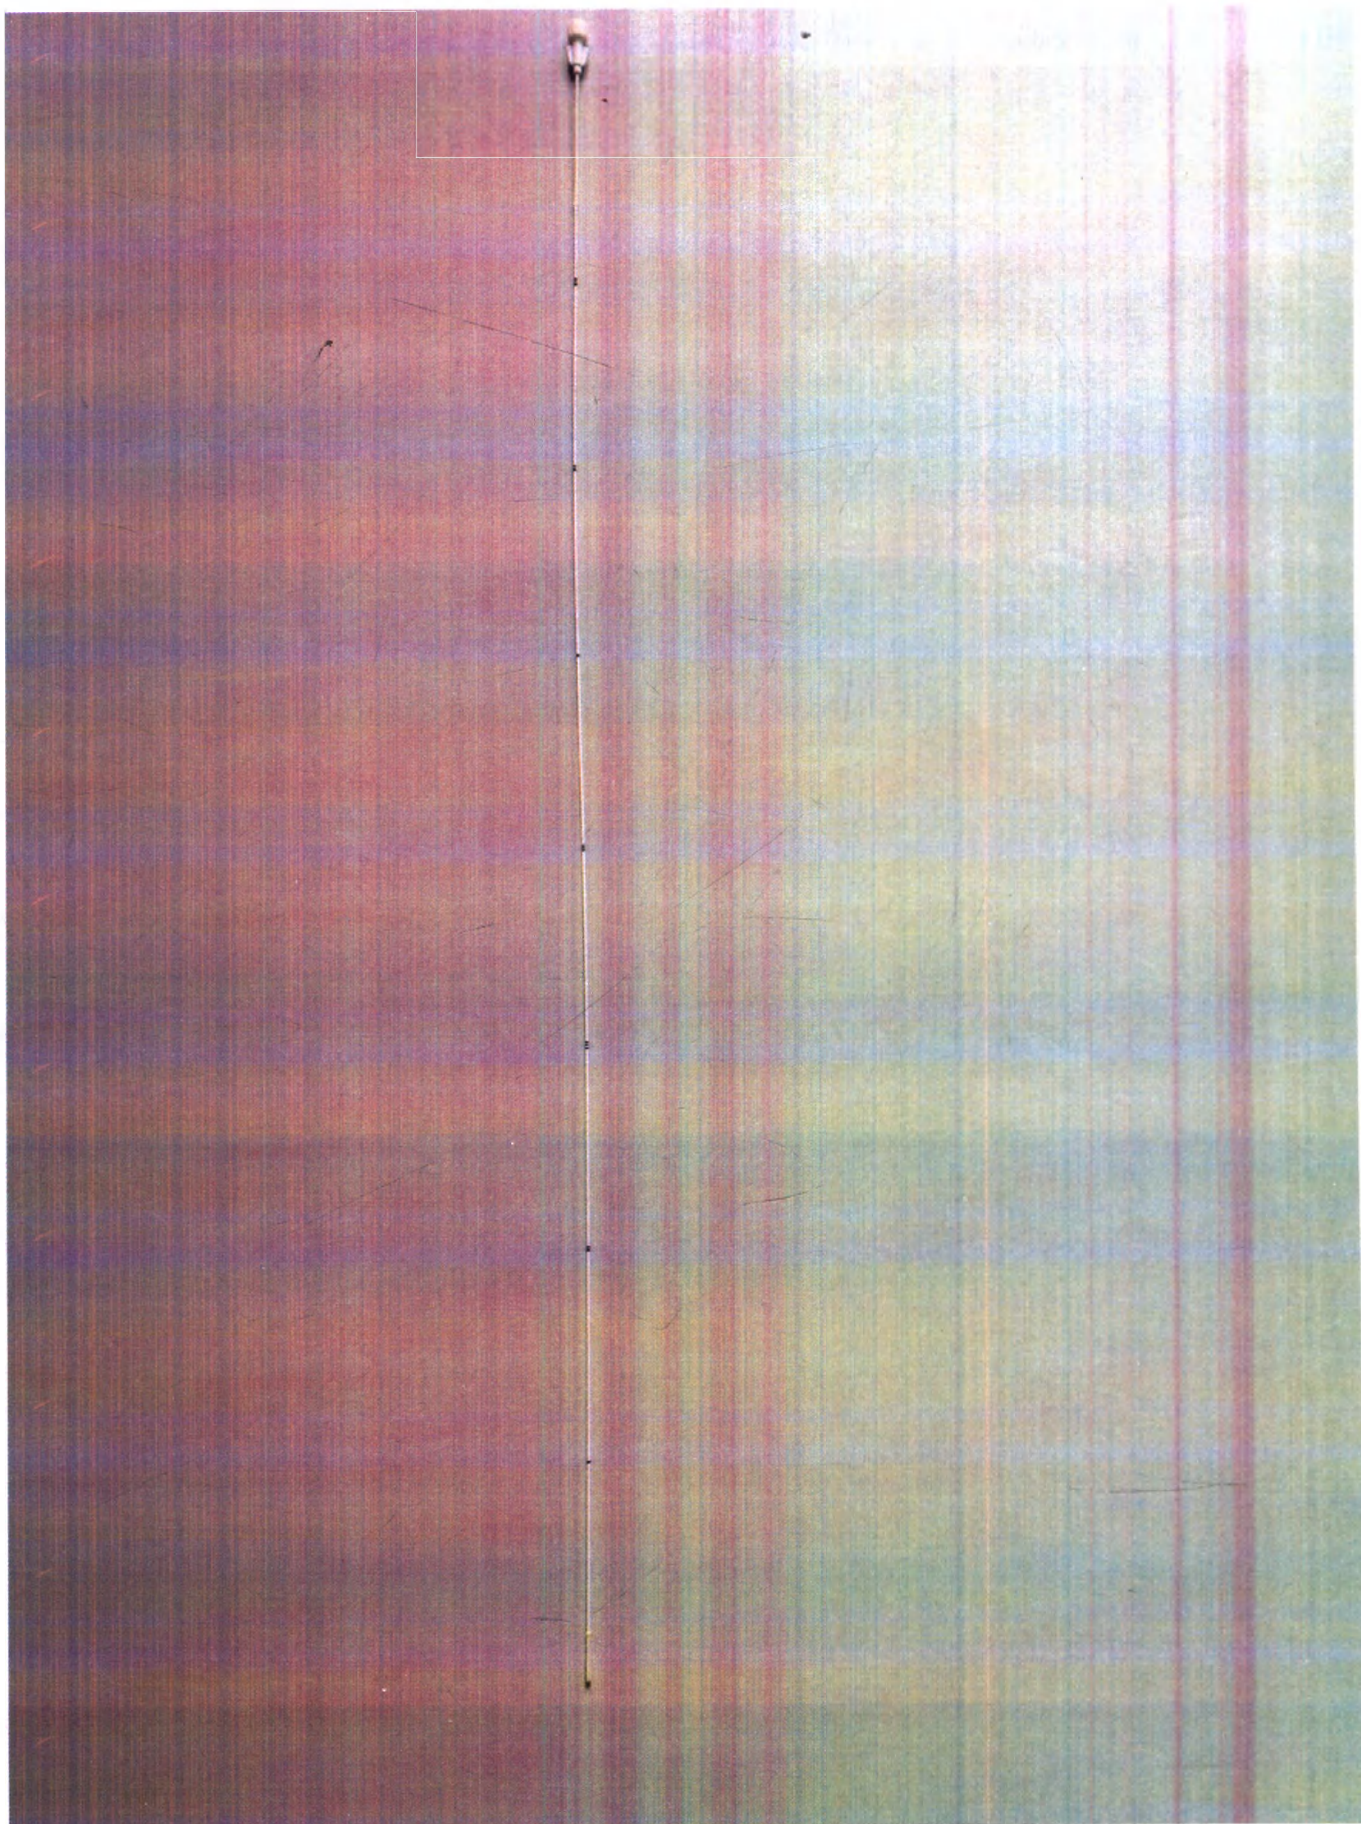

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 5F-80 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



нетоксично



ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Размер: 5F (1,50 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $11,0 \pm 1,0$ мм

REF

5F-80

LOT

090011220




12-2020




12-2023


Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 5F-80. Маркировка.

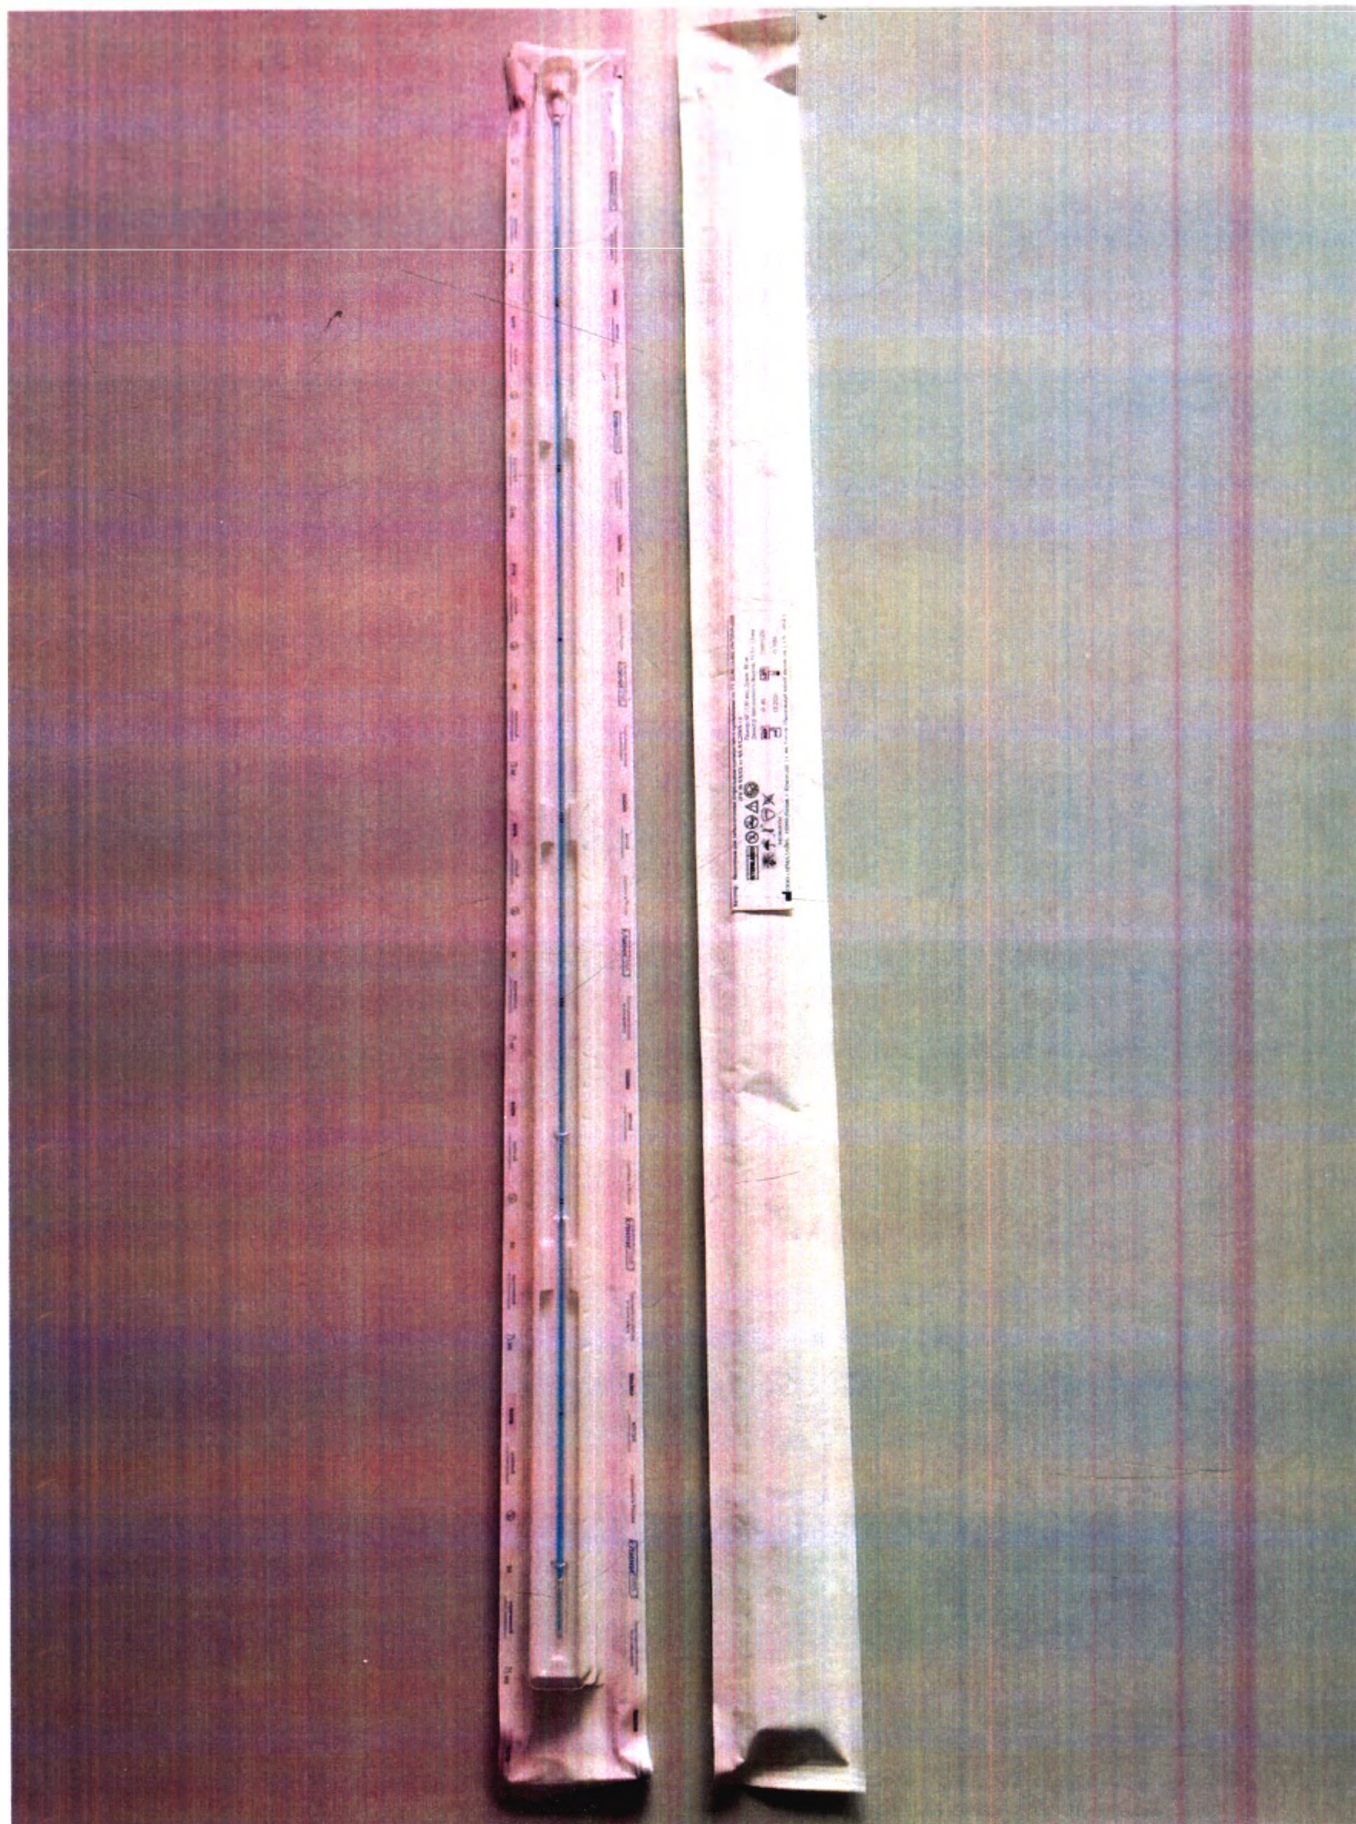

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-80. Потребительская упаковка.

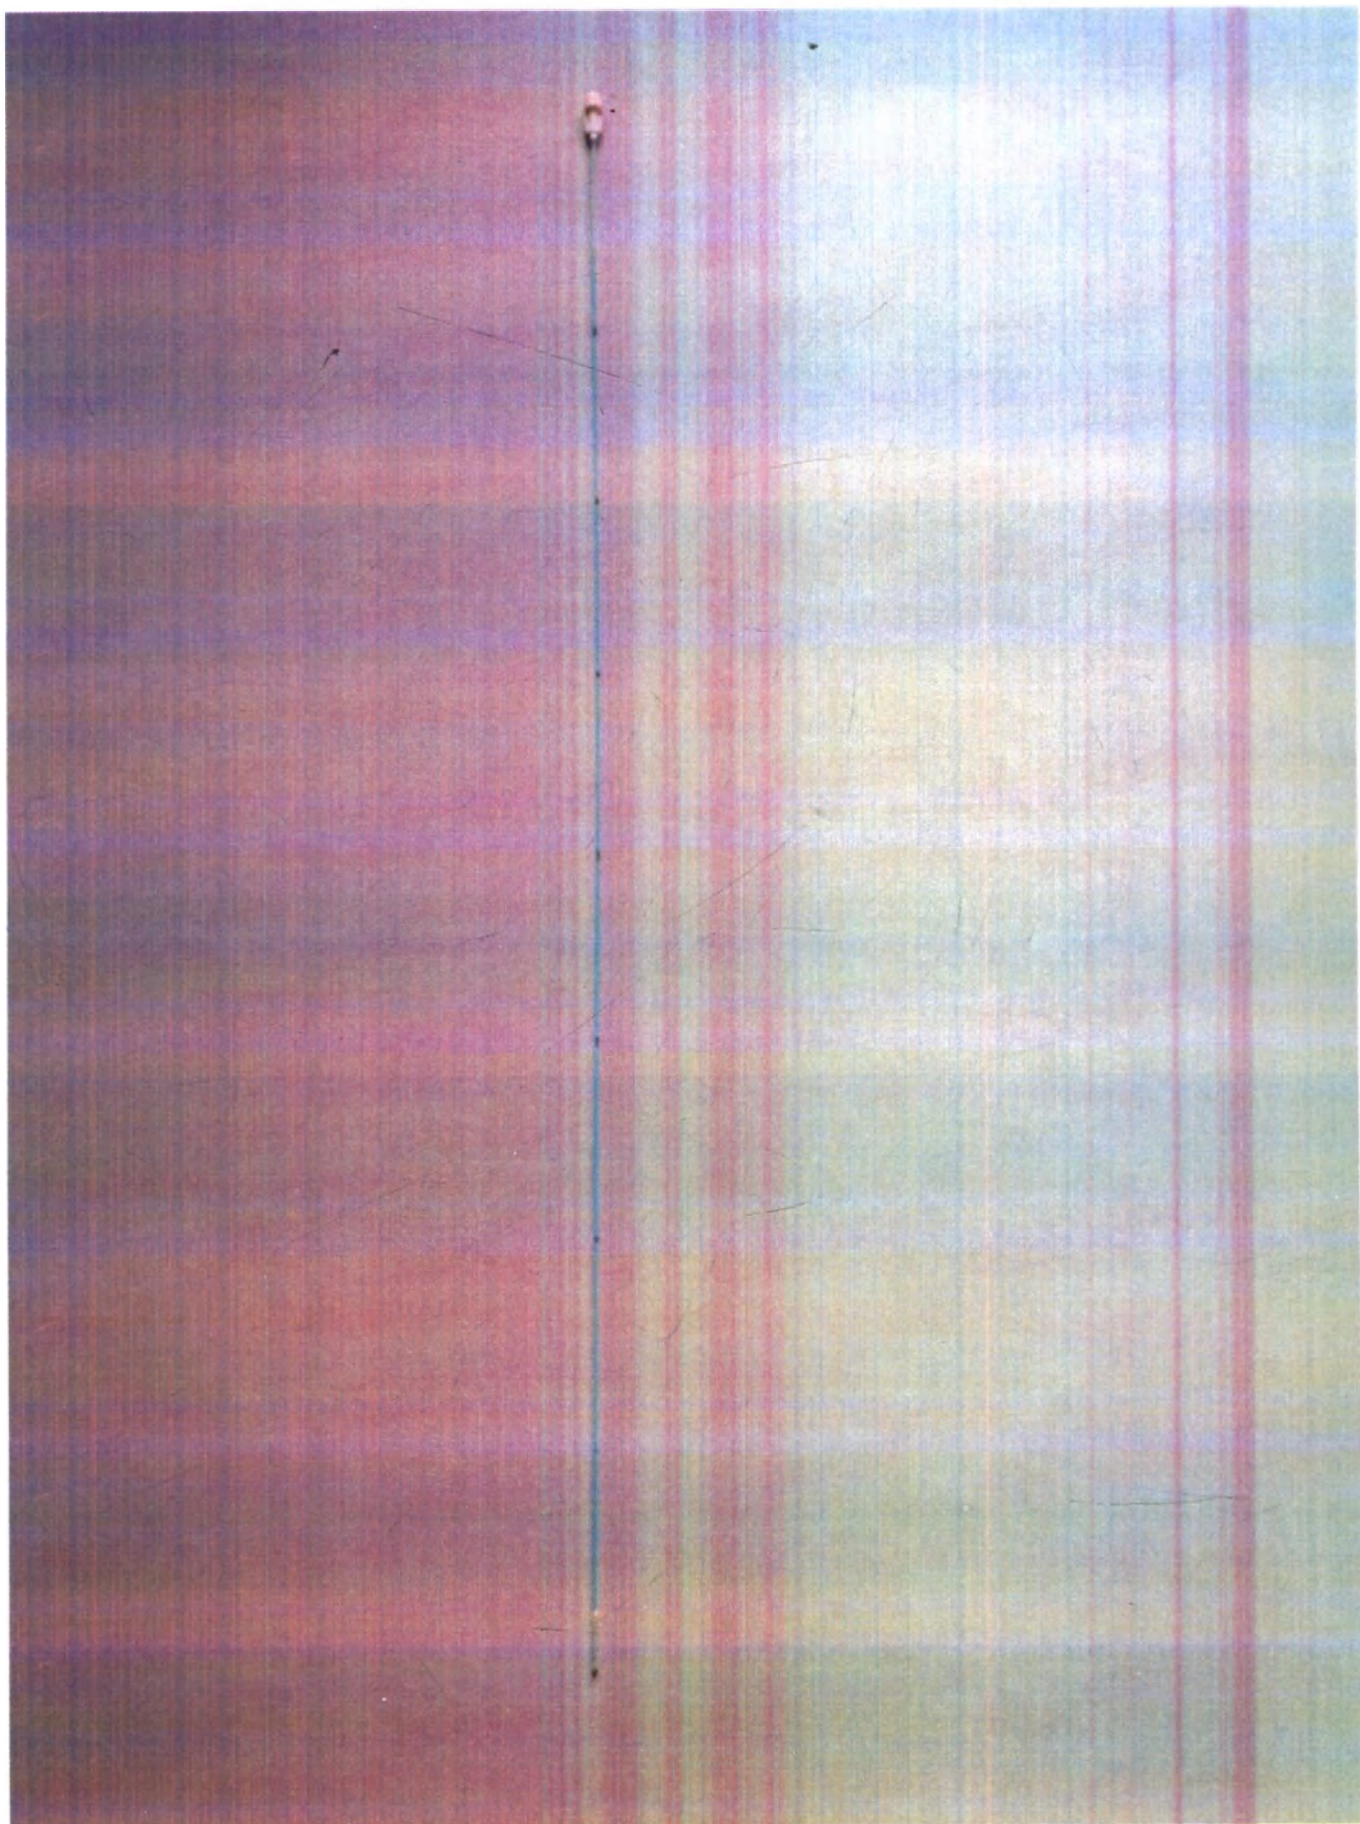

Катетер баллонный для эмболизомии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-80.

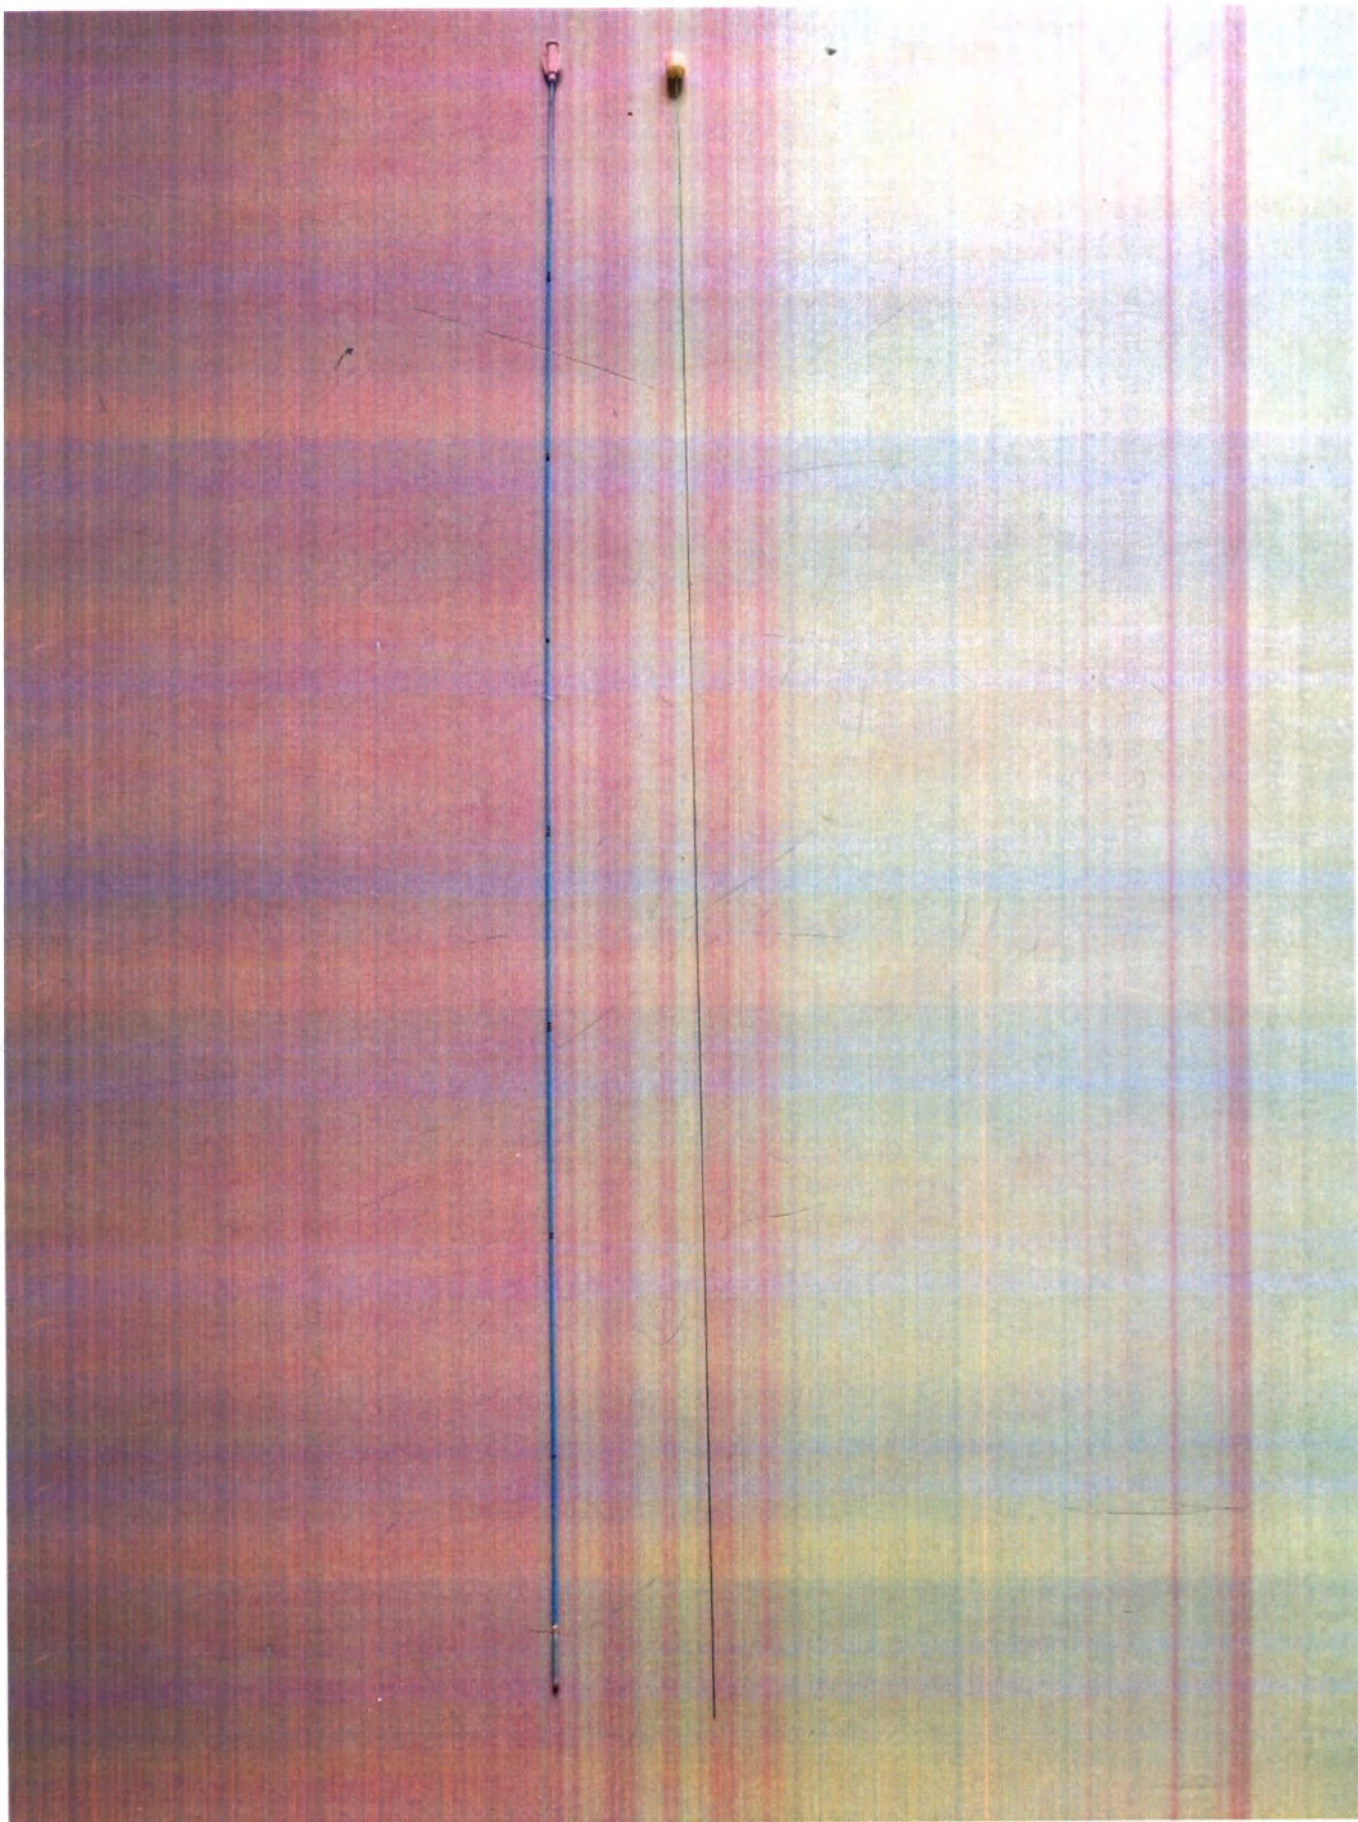

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-80 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

STERILE



нетоксично

Размер: 6F (1,80 мм), Длина: 80 см

Диаметр наполненного баллона: $13,0 \pm 1,0$ мм

REF

6F-80

LOT

110011220



12-2020




12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б


Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-80. Маркировка.

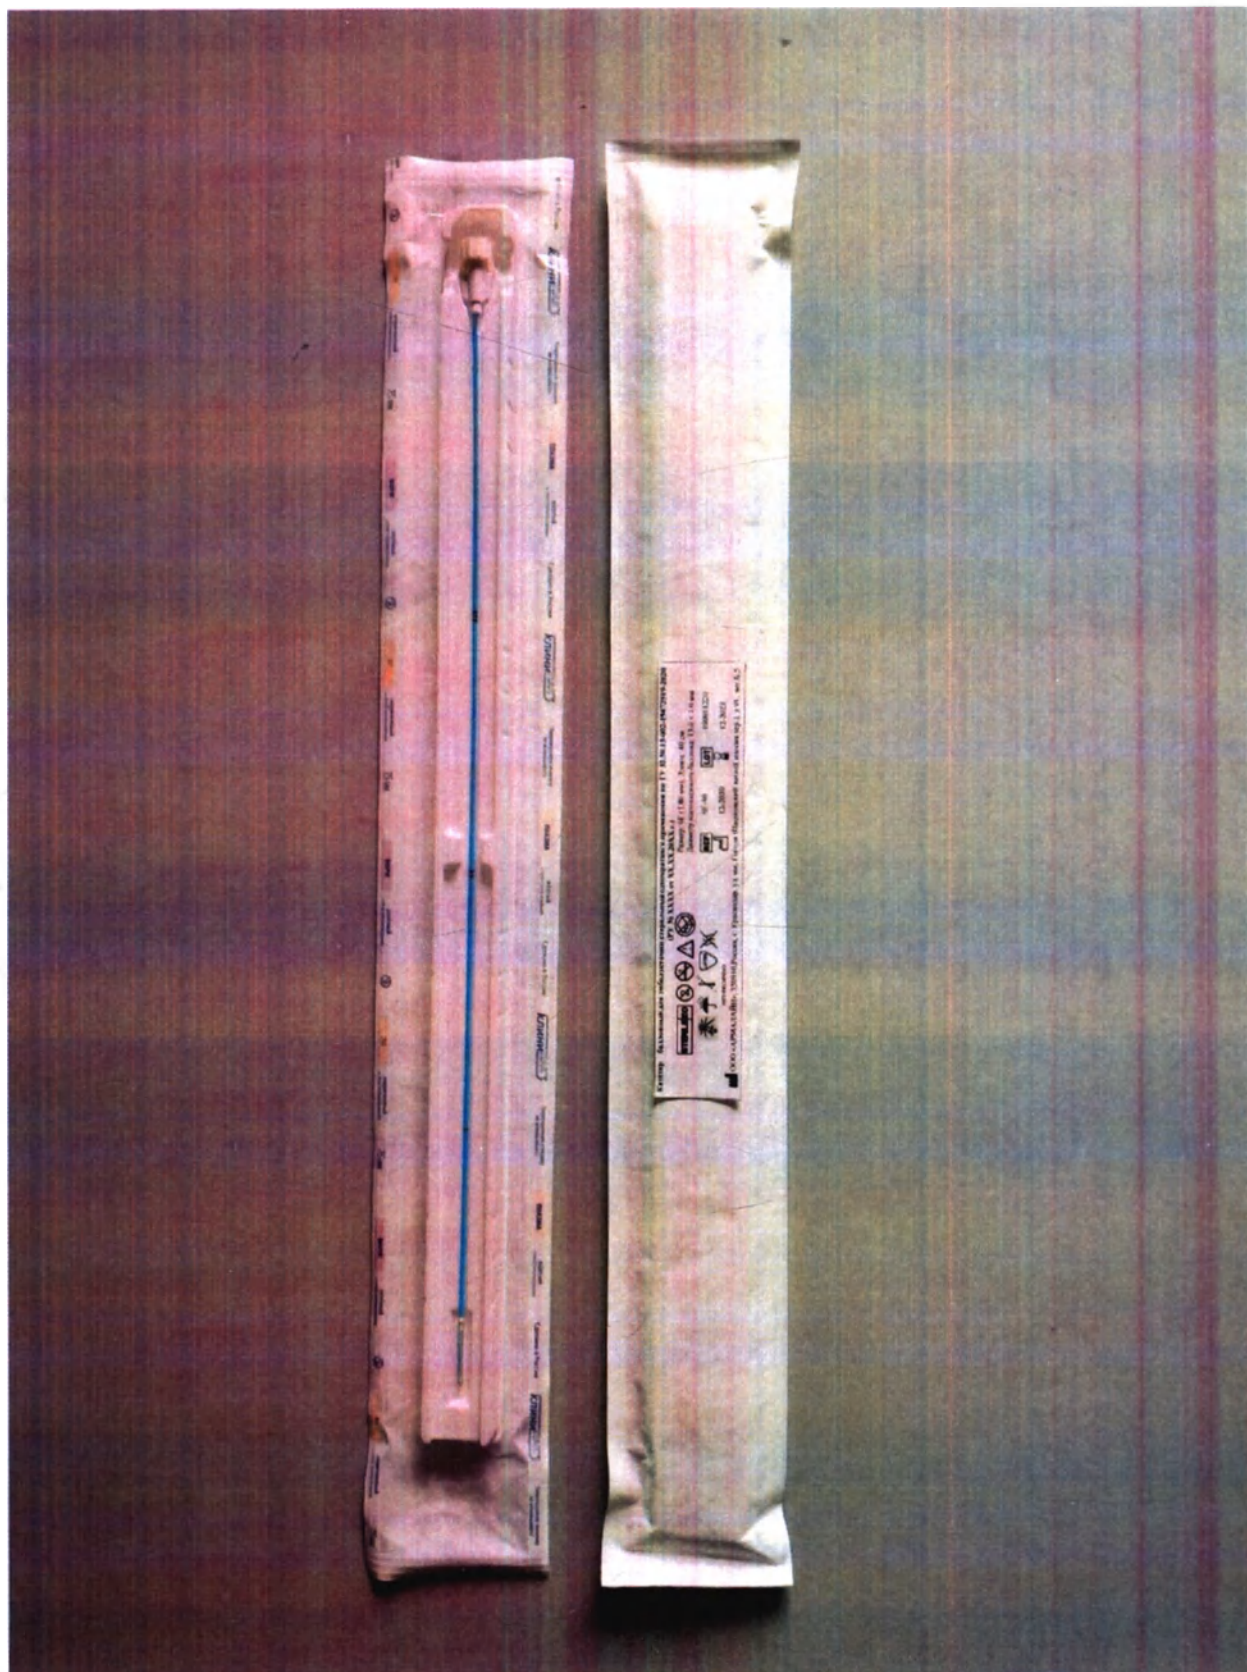

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-40. Потребительская упаковка.

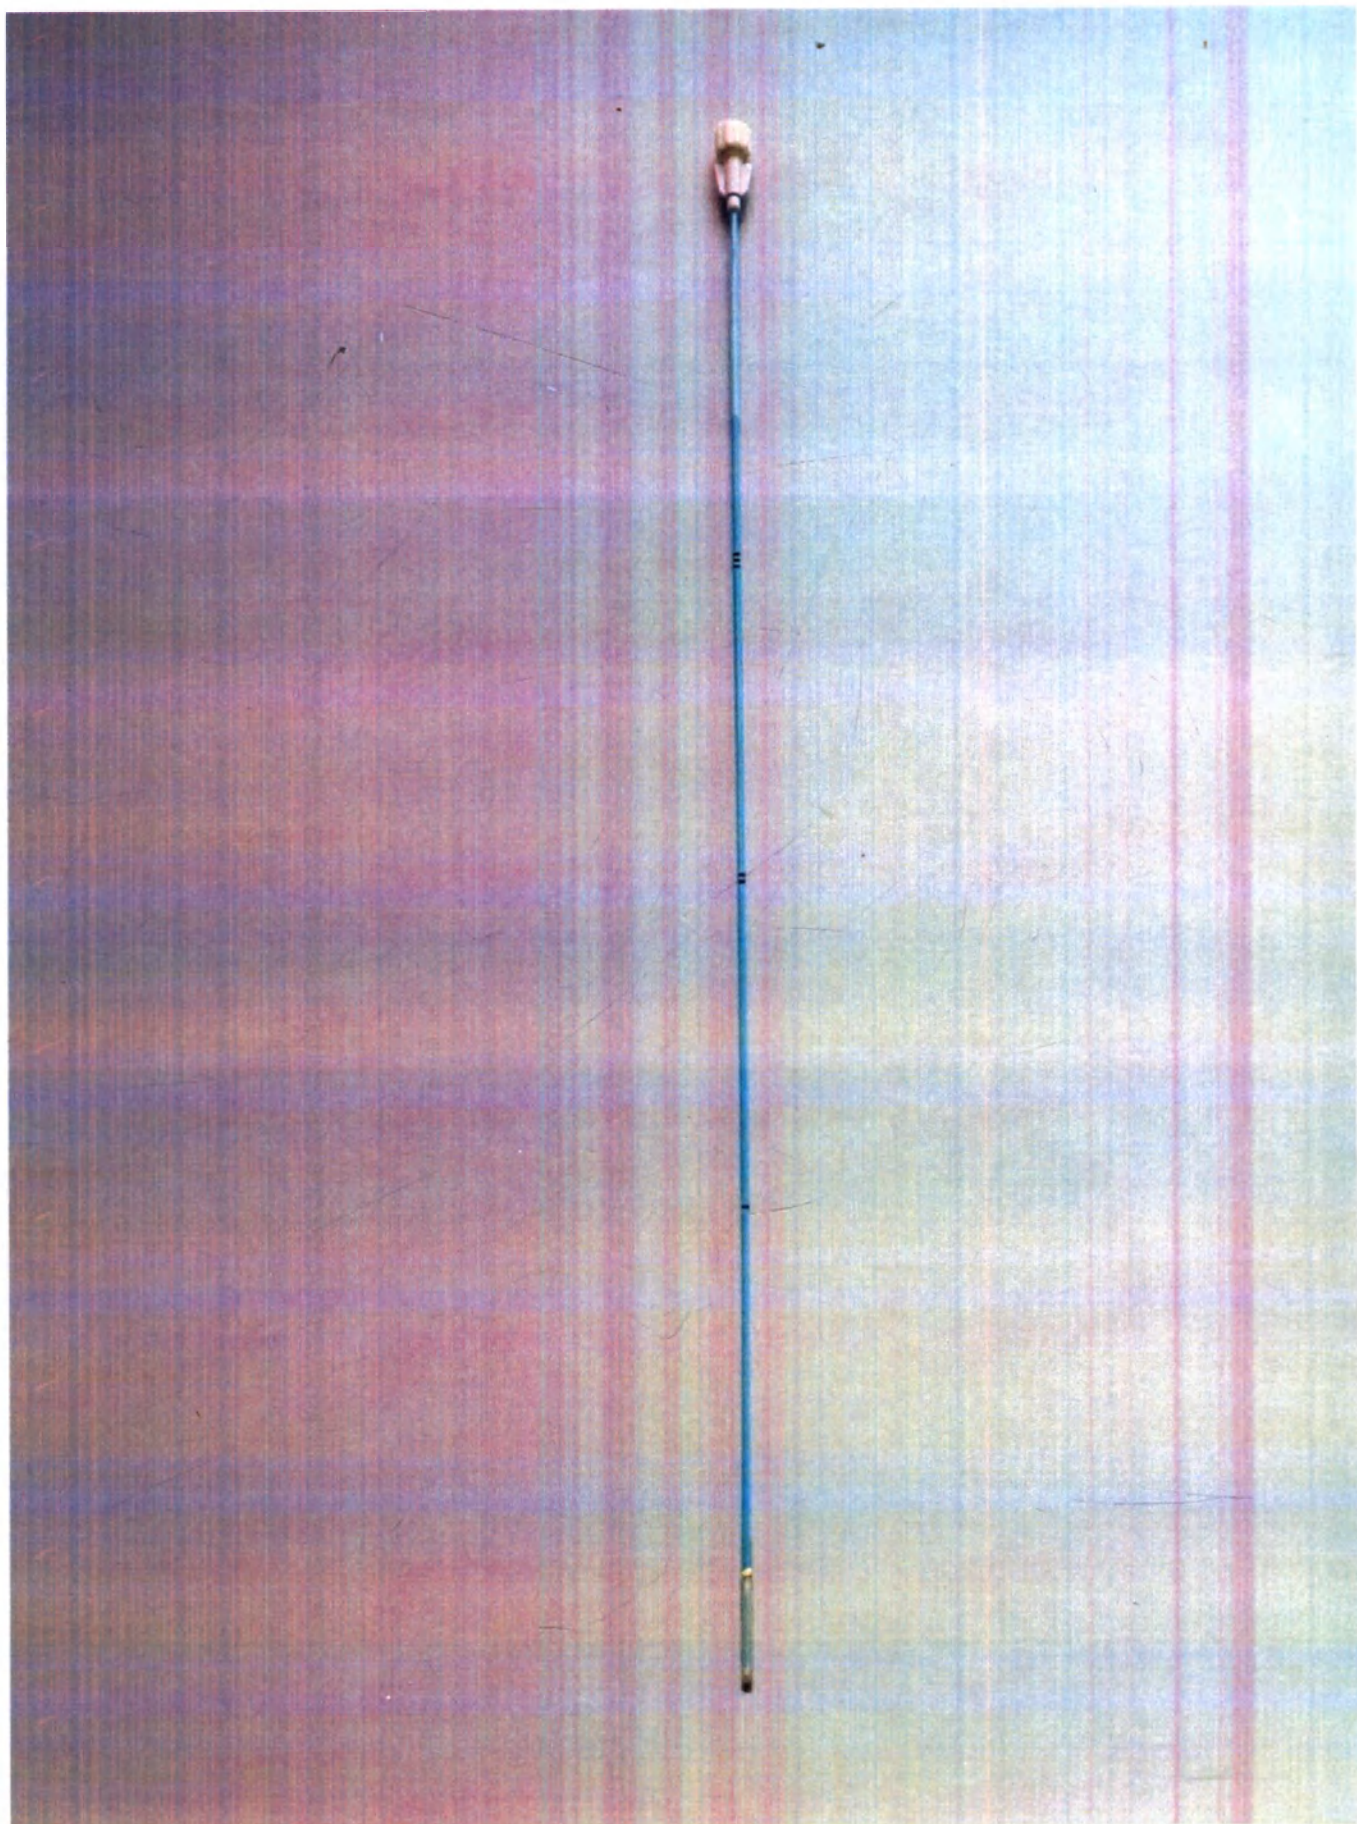

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-40.

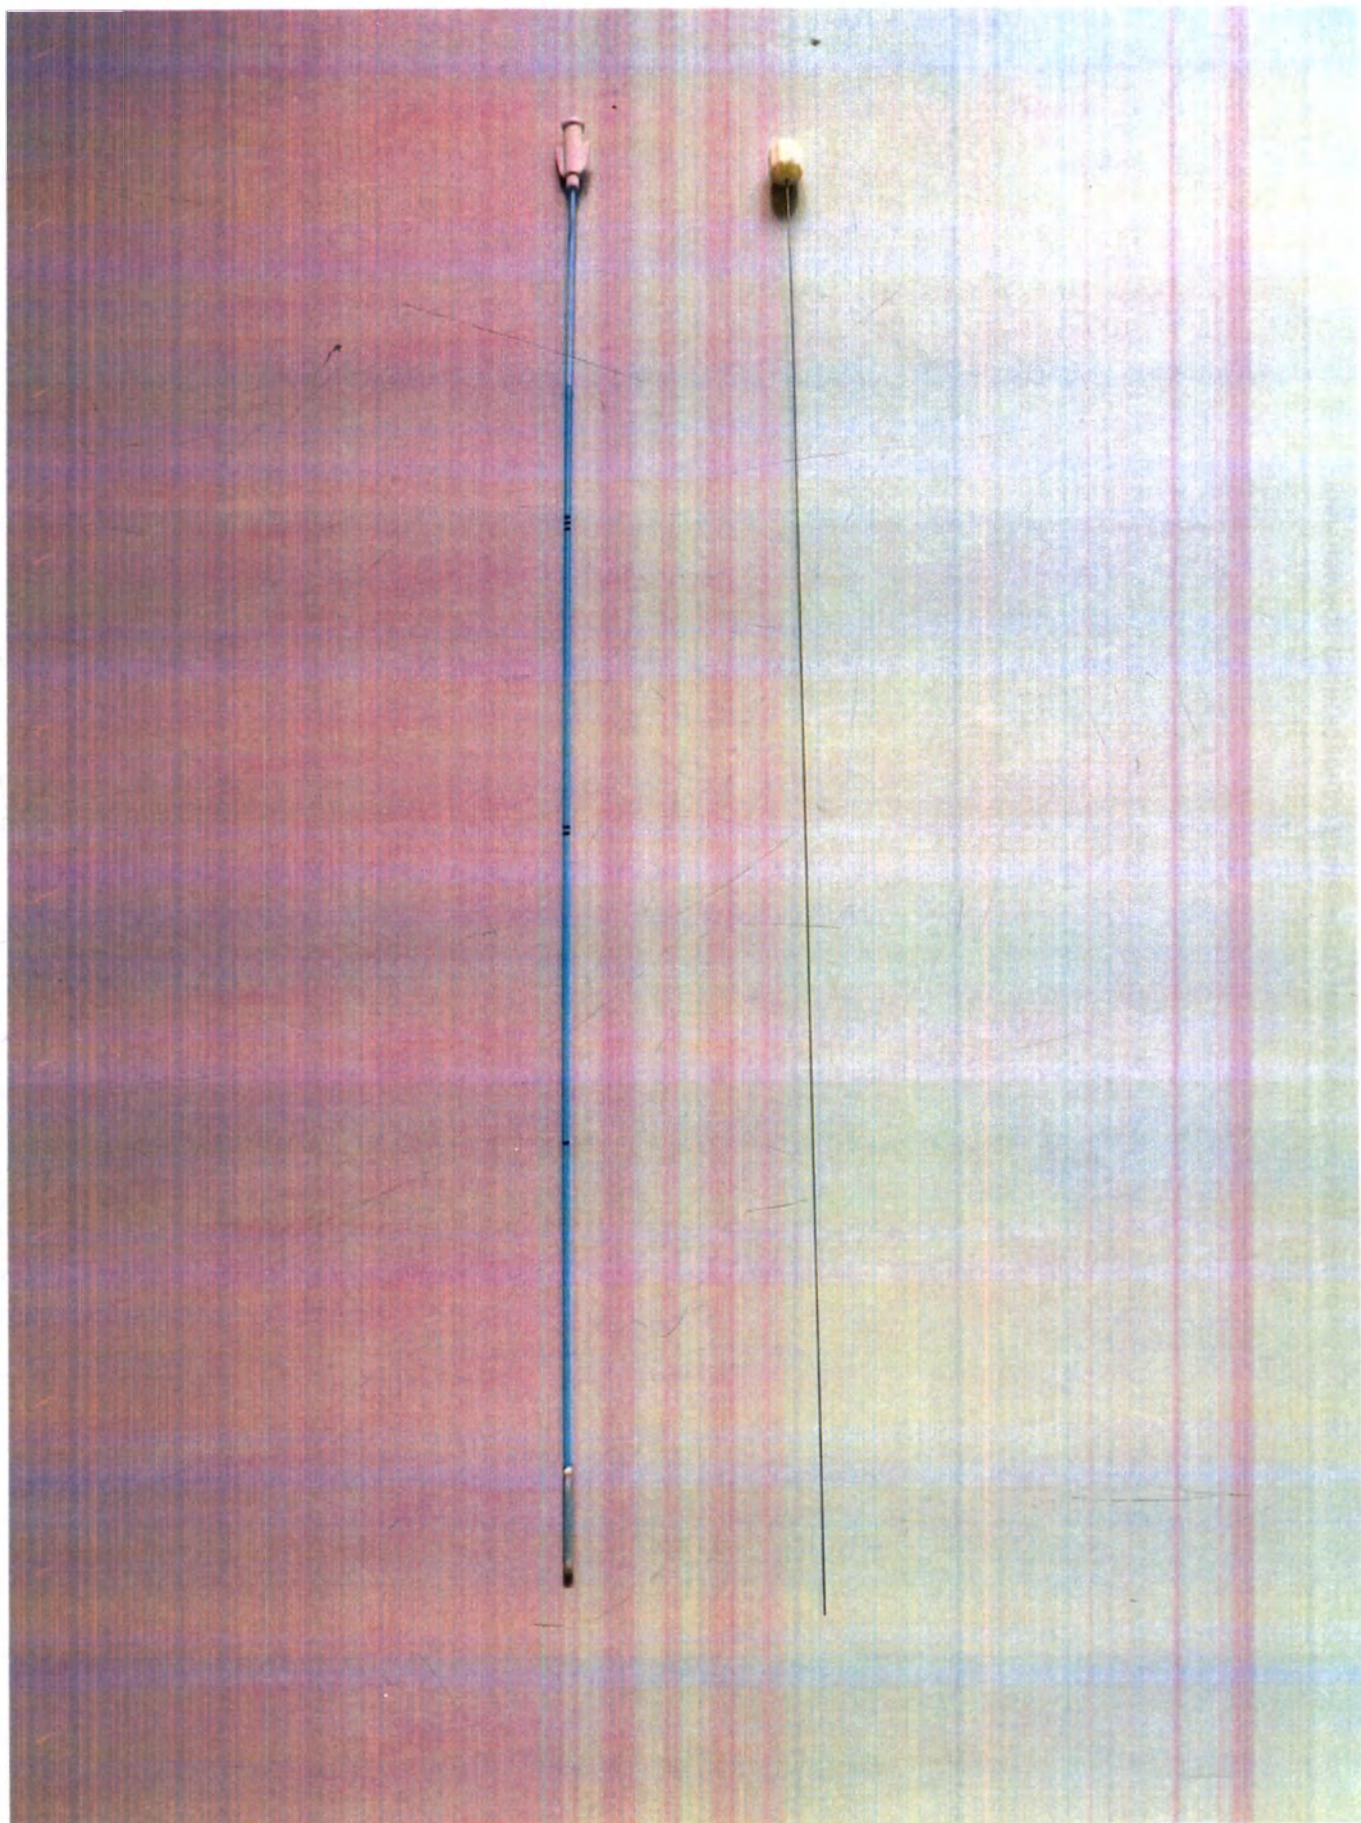


Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-40 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



Размер: 6F (1,80 мм), Длина: 40 см
Диаметр наполненного баллона: $13,0 \pm 1,0$ мм



нетоксично



6F-40



100011220


12-2020

12-2023




ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 6F-40. Маркировка.

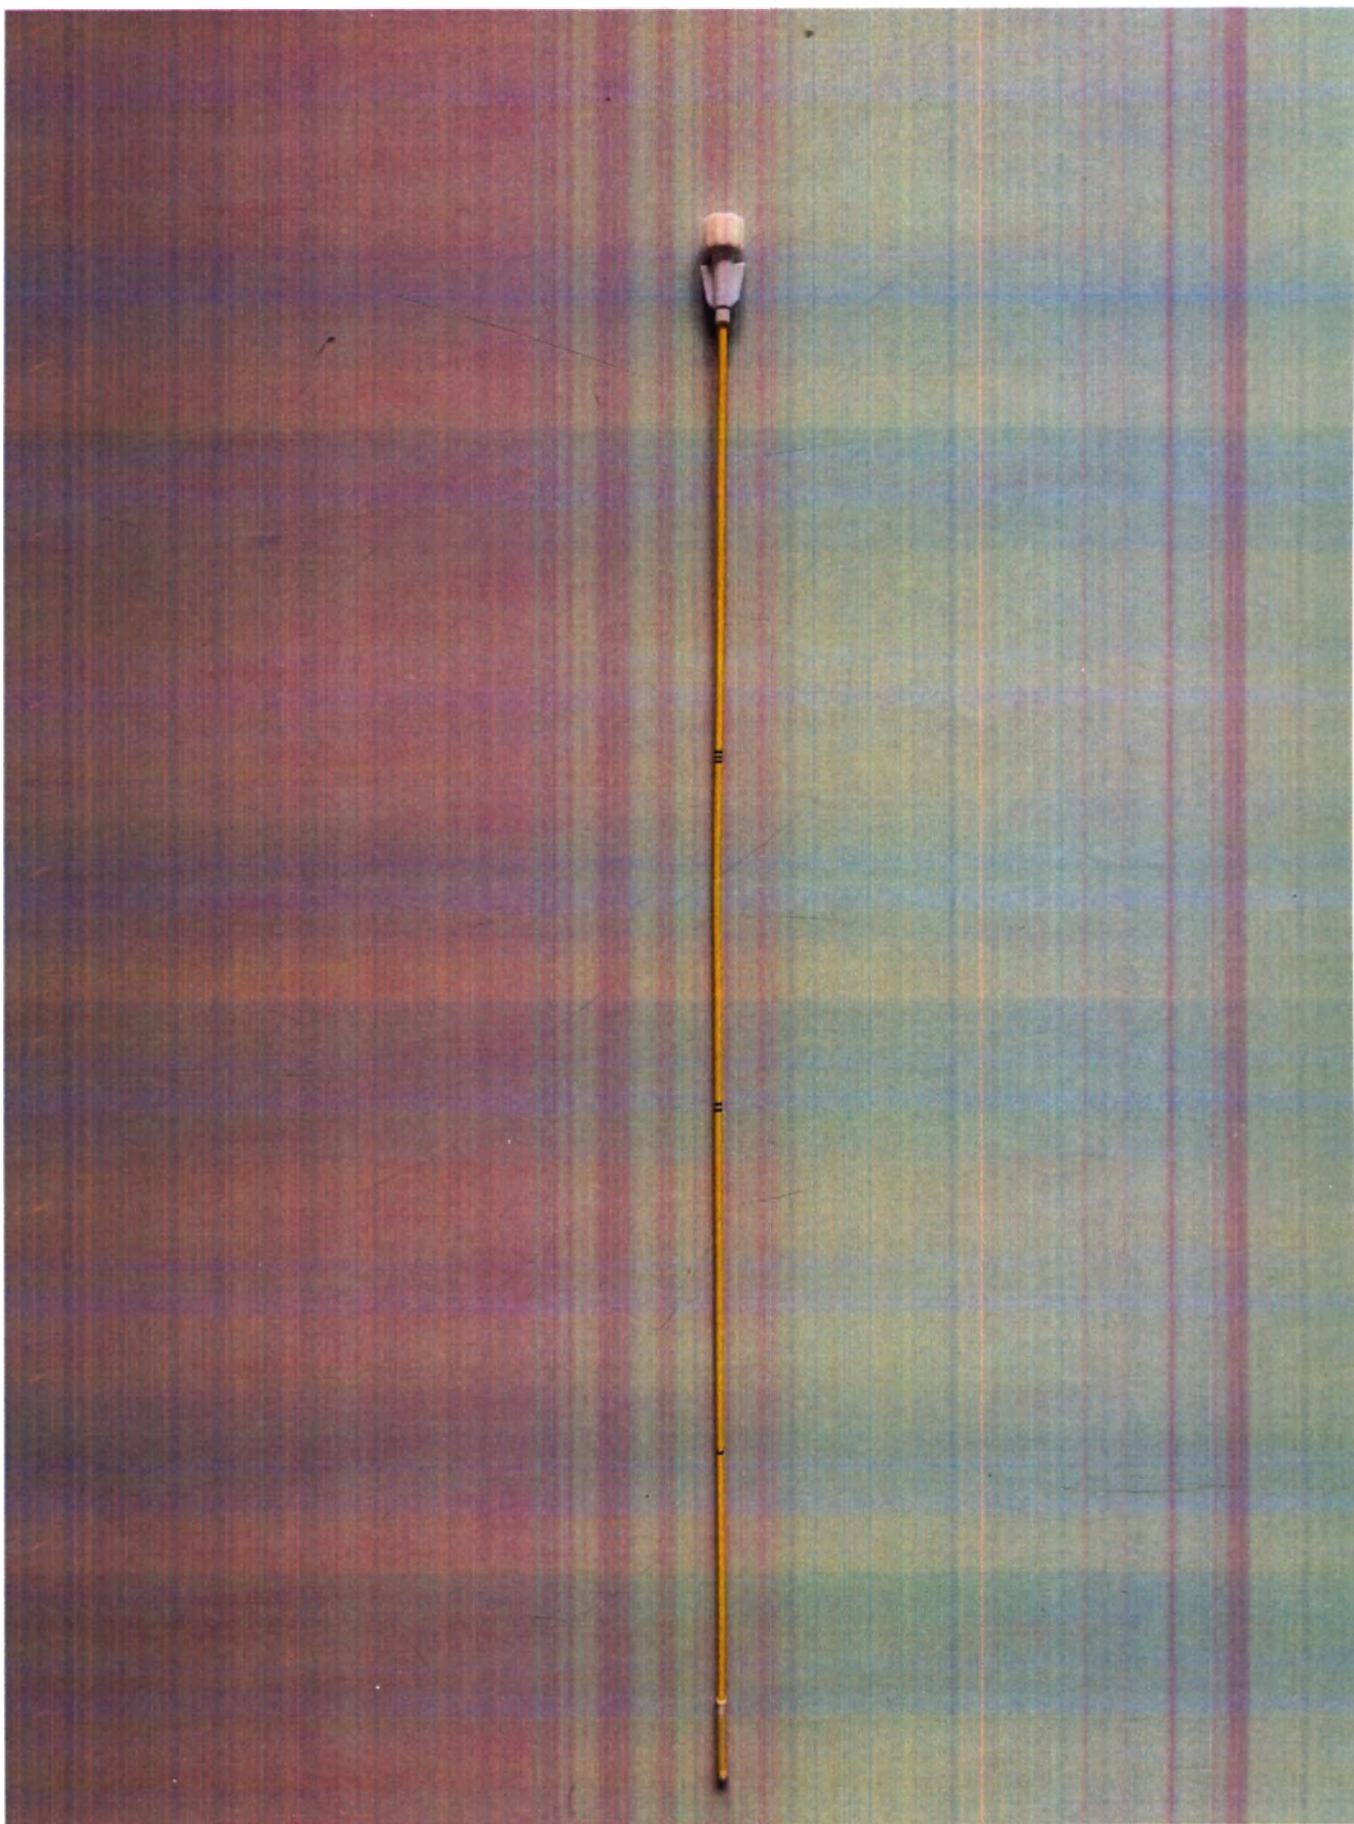

Катетер баллонный для эмболизектомии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 7F-40.

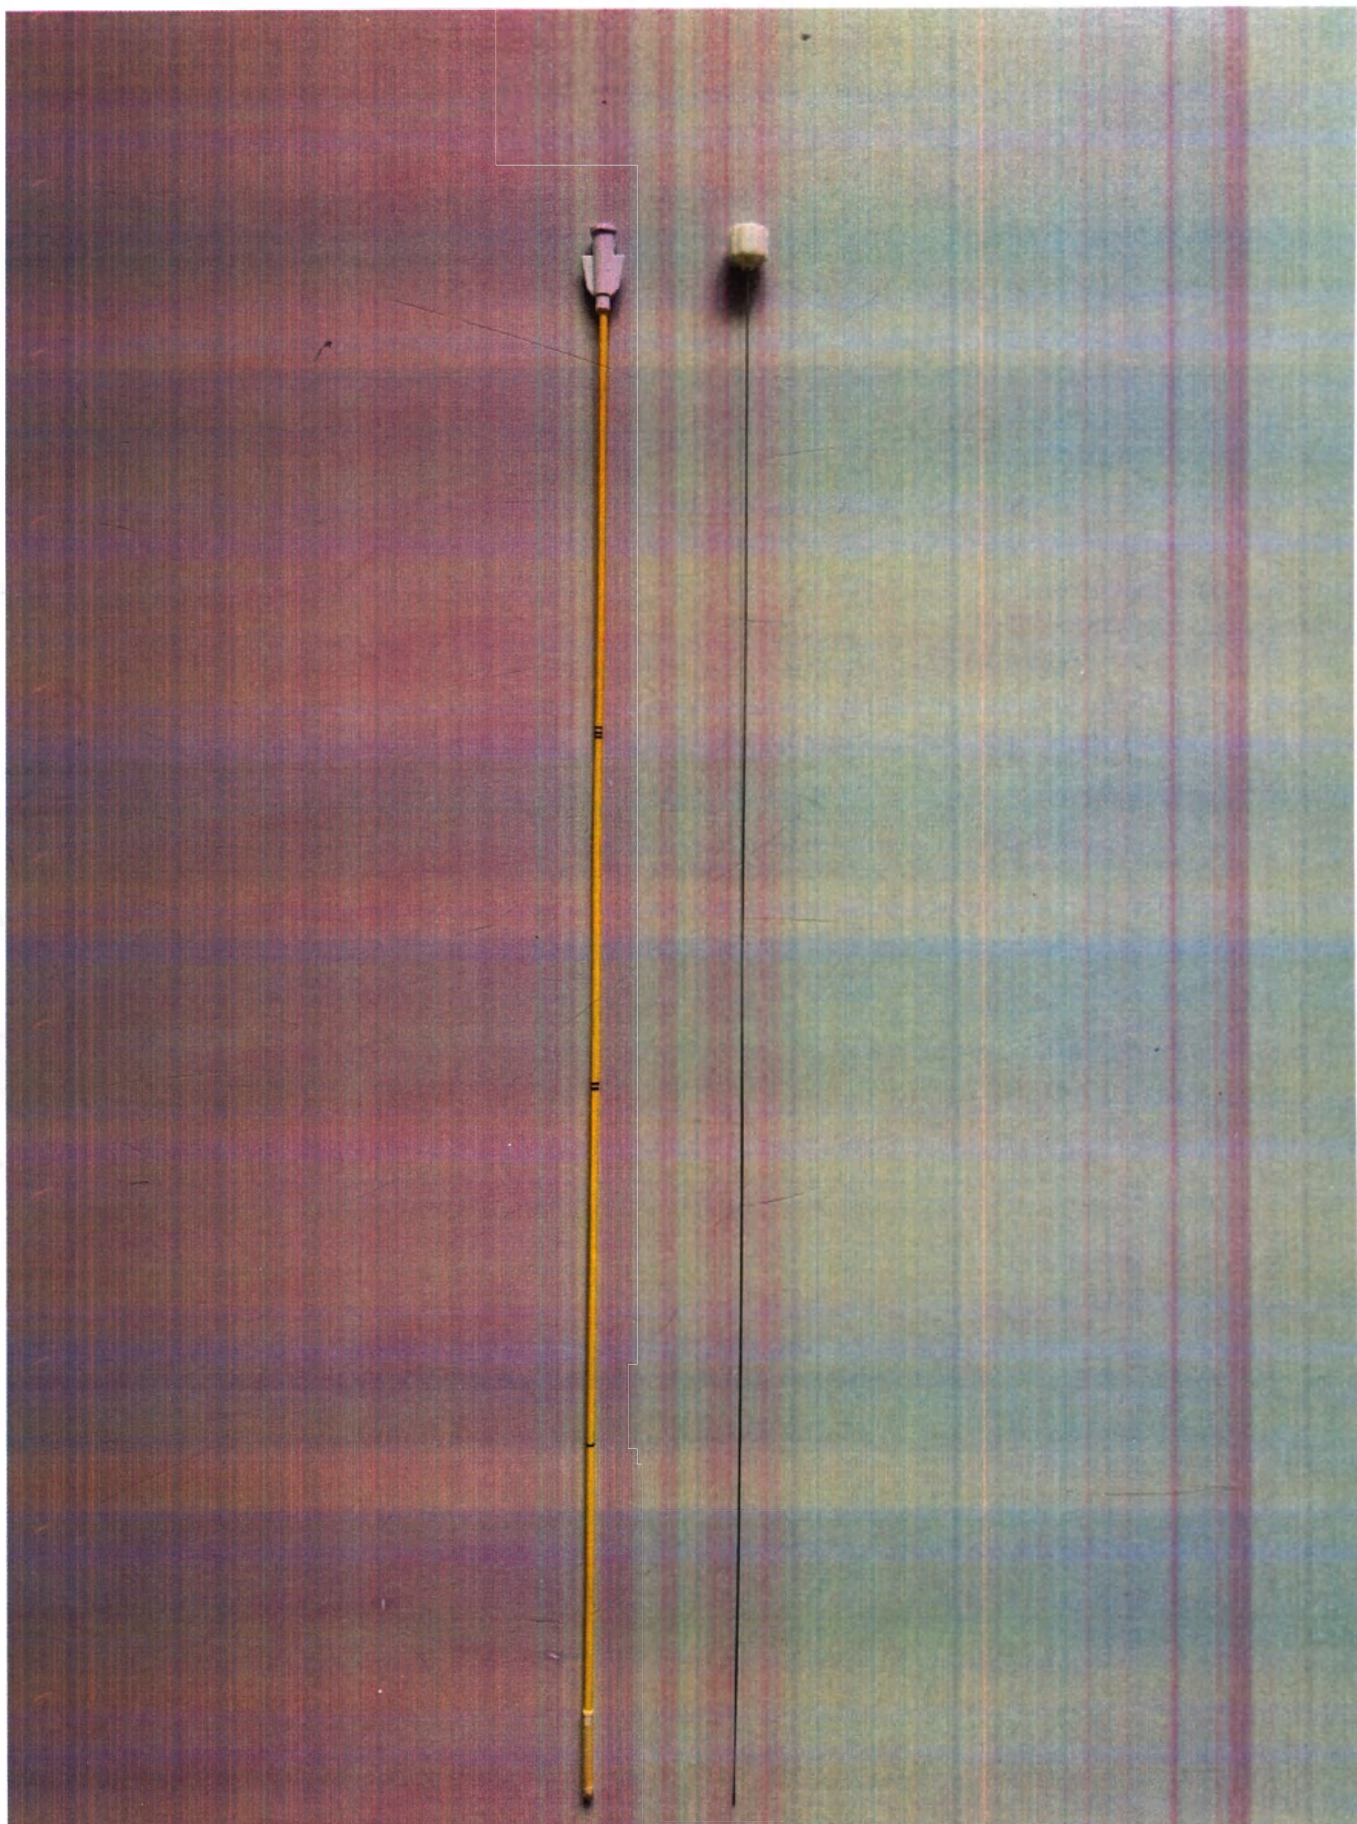

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 7F-40 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
 (ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

STERILE EO    


нетоксично

REF 7F-40 **LOT** 120011220


 12-2020  12-2023

 ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б


Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
 по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 7F-40. Маркировка.

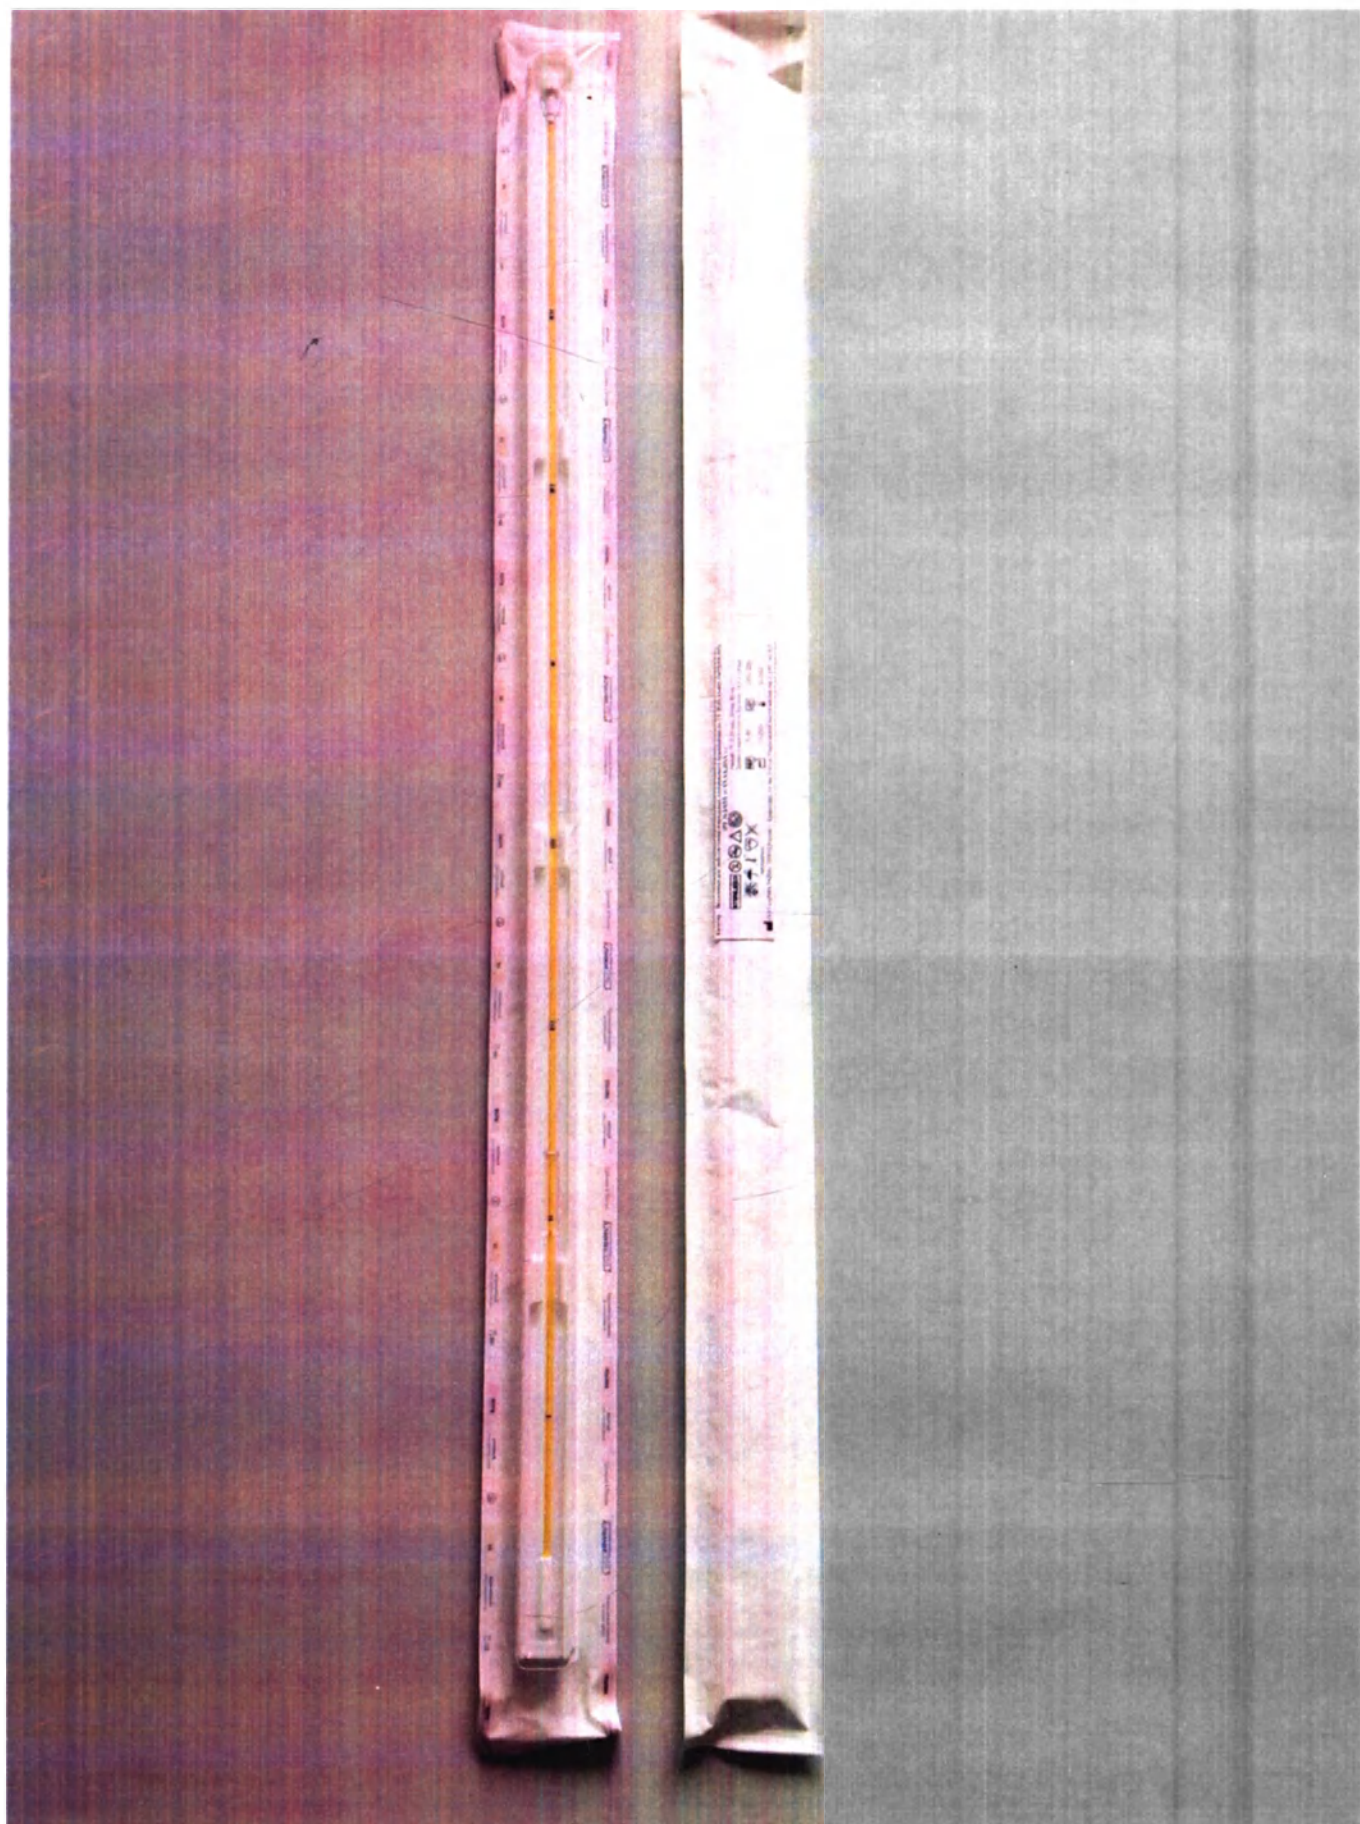

Катетер баллонный для эмболектмии стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 7F-80. Потребительская упаковка.

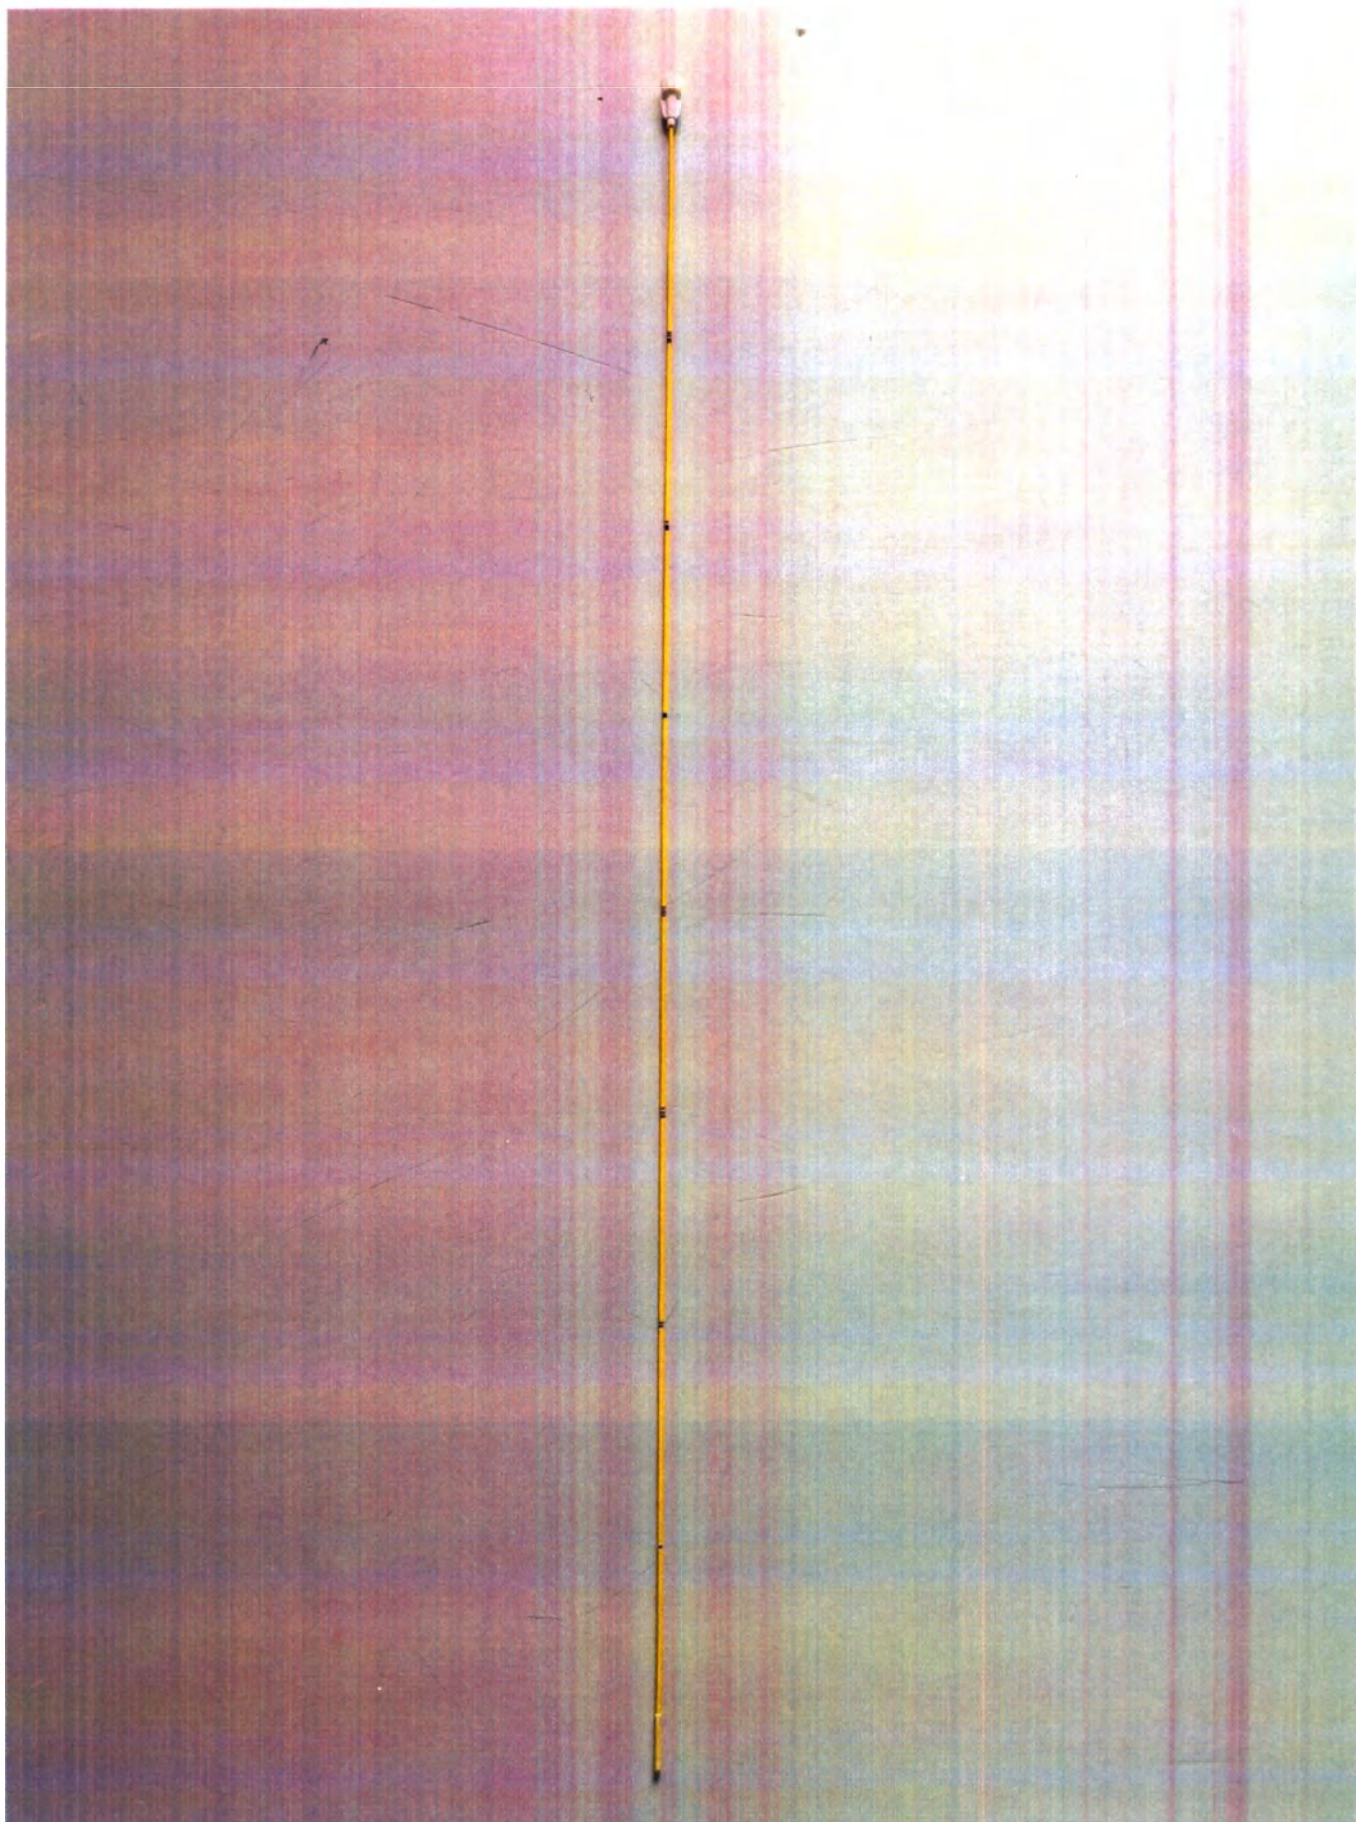

Катетер баллонный для эмболектонии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 7F-80.

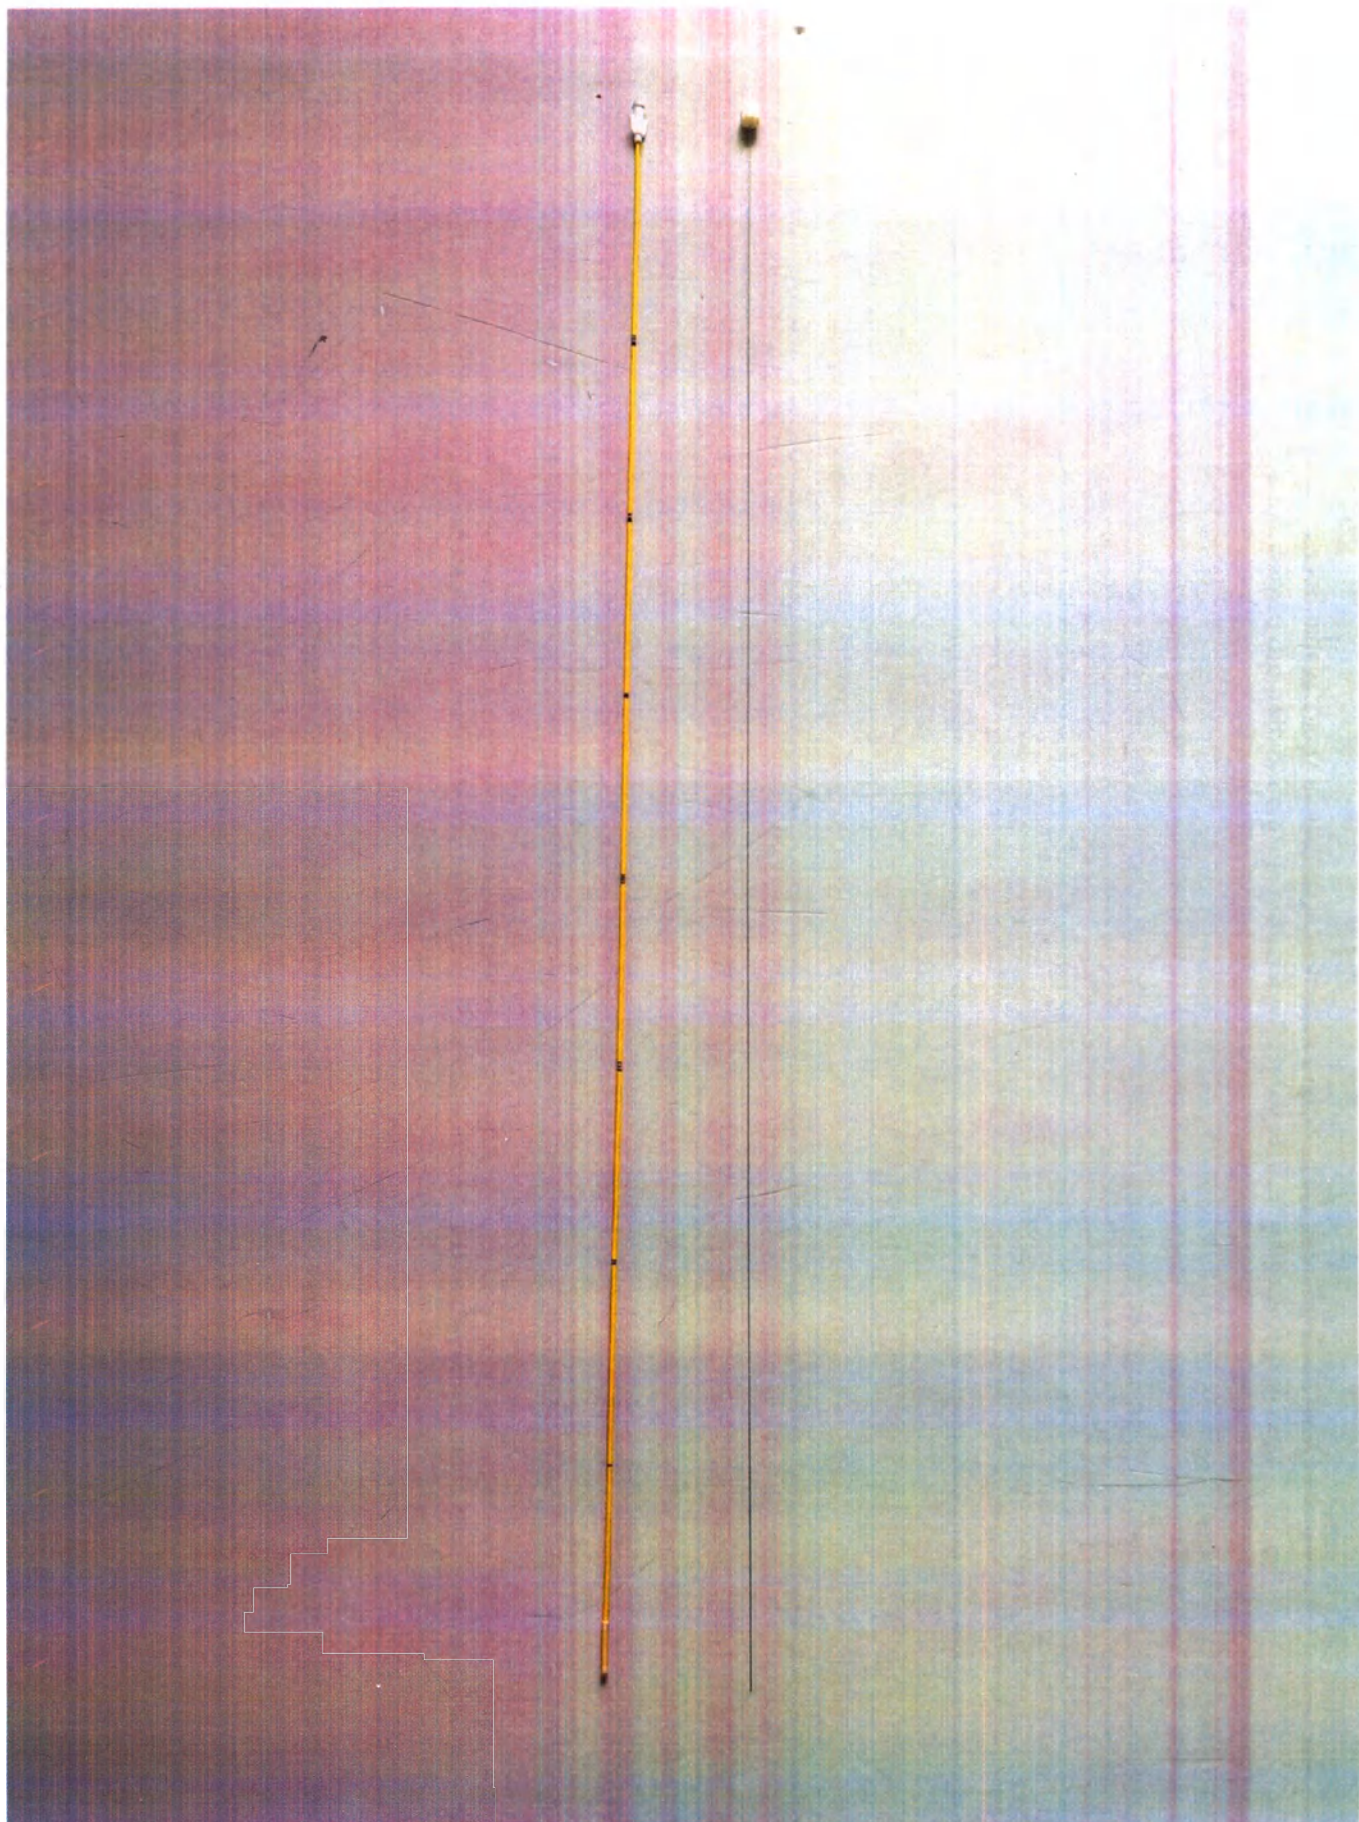

Катетер баллонный для эмболектмии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 7F-80 с извлеченным стержнем.

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020
(ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)



Размер: 7F (2,20 мм), Длина: 80 см
Диаметр наполненного баллона: $14,0 \pm 1,0$ мм



нетоксично

REF

7F-80

LOT

130011220



12-2020




12-2023



ООО «АРМАЛАЙН», 350910, Россия, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пашковский жилой массив тер.), д 91, лит. Б

Катетер баллонный для эмболизации стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 в варианте исполнения 7F-80. Маркировка.

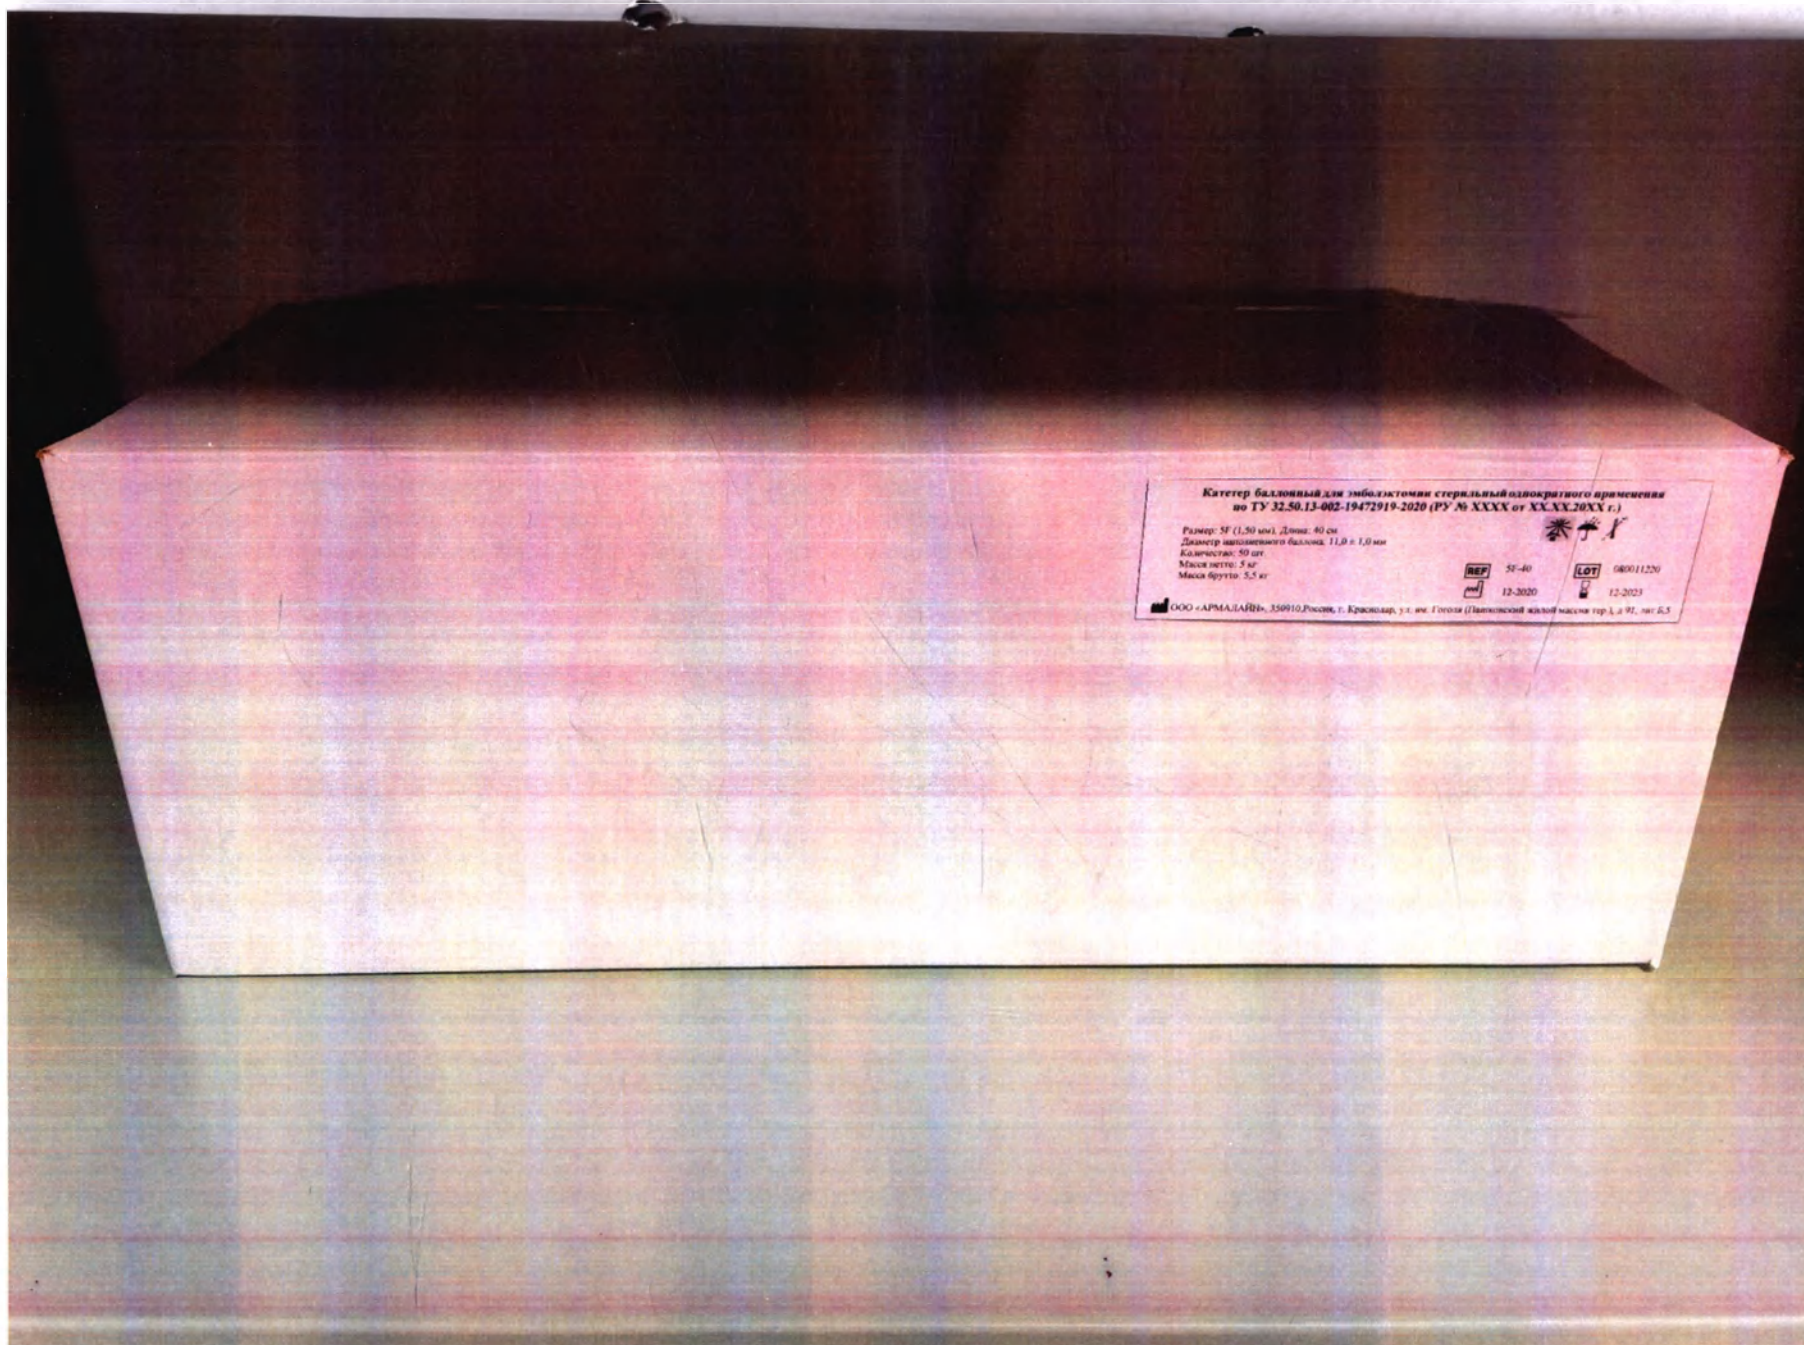

Катетер баллонный для эмболизомии стерильный однократного применения
по ТУ 32.50.13-002-19472919-2020 (ПУ № XXXX от XX.XX.20XX г.)

Размер: 5F (1,50 мм), Длина: 80 см
Диаметр надуваемого баллона: 11,0 ± 1,0 мм
Количество: 50 шт.
Масса нетто: 3 кг
Масса брутто: 5,5 кг

REP 5F-40 LOT 080011220
12-2020 12-2023

ООО «АРМАЛАРЪ», 350910, Ростов, г. Краснодар, ул. им. Гоголя (Пятиковский жилой массив тер. 4, д. 91, лит. Б.5)

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

50 (пятьдесят)

ЛИСТ

56

Директор ООО «АРМАЛАЙН»

В.В. Воевода

