



ТЕРМОМЕТР

медицинский
в защитной
оболочке

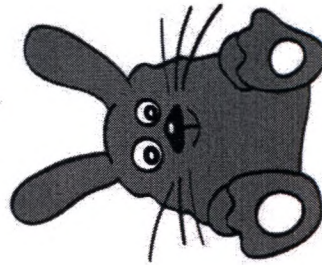

Разбившийся
термометр
остается
внутри
оболочки



ТЕРМОМЕТР медицинский
Clinical thermometer mercury in-glass with maximum device


максимальный стеклянный (ртутный)

Защитная полимерная оболочка на стекле
Protective polymer coating on thermometer glass surface
ГОСТ 31516-2012 / ТУ 9441-033-31881402-2008

Запатентовано

Преимущества защитного термометра

- Термометр по всей наружной поверхности покрыт полимерной оболочкой.
- Осколки стекла и ртути разбившегося термометра остаются внутри прочной герметичной оболочки.
- Классический стеклянный термометр – это точность и безотказность.
- Герметичная оболочка добавляет безопасности при использовании изделия.
- Руководство по эксплуатации в упаковке.



ОАО «ТЕРМОПРИБОР»

Россия, 141600, Московская обл.,
г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
Тел.: (495) 663-87-03
Эл. почта: sales@thermopribor.com
<http://supergradusnik.ru/>



Joint Stock Company
THERMOPRIBOR
44 Volokolamskoye shosse,
town of Klin, Moscow Region,
141600, Russia
Phone: +7 495 663-87-03
E-mail: sales@thermopribor.com

Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора
№ ФСР 2009/04500 от 19.03.2009 г.


LOT



42°C max.
-35°C min.



4 603788 100004

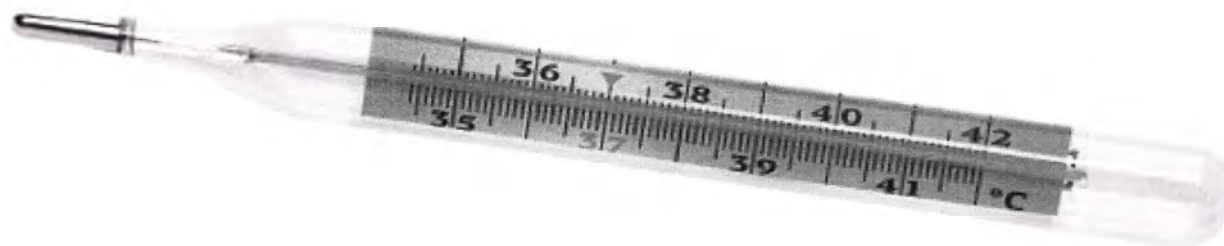


 THERMOPRIBOR JSC



Made in
Russia

CLINICAL
THERMOMETER
MERCURY-IN-GLASS

with maximum device

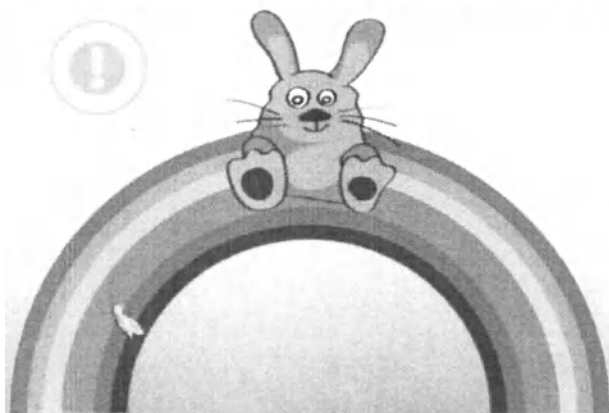

model «Gradient»
12 pieces

ТЕРМОМЕТР
МЕДИЦИНСКИЙ
максимальный стеклянный
ртутный




LOT

 ОАО «ТЕРМОПРИБОР»

Россия, 141600, Московская область,
г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
+7 (495) 663-87-03,
sales@thermopribor.com

Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора № ФСР 2009/04500
от 19.03.2009 г.



4 603788 000079


 ОАО «ТЕРМОПРИБОР»



Сделано
в России

ТЕРМОМЕТР
МЕДИЦИНСКИЙ
максимальный стеклянный

ртутный

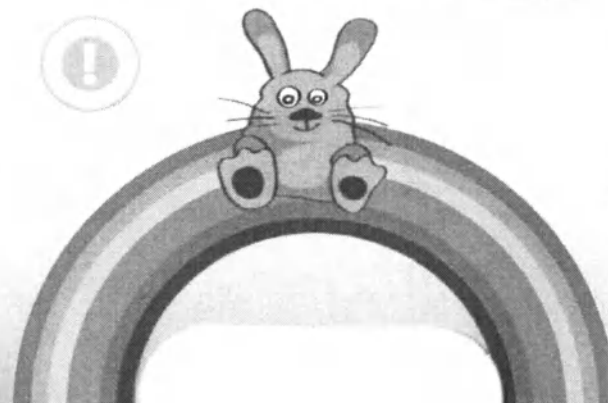

модель «Градиент»
12 штук



LOT

CLINICAL
THERMOMETER
MERCURY-IN-GLASS

with maximum device



 Joint Stock Company
THERMOPRIBOR

Joint Stock Company THERMOPRIBOR
44, Volokolamskoje Shosse, town of Klin,
Moscow Region, 141600, Russia
+7 (495) 663-87-03,
sales@thermopribor.com



ГОСТ 31516-2012 / ТУ 9441-033-31881402-2008



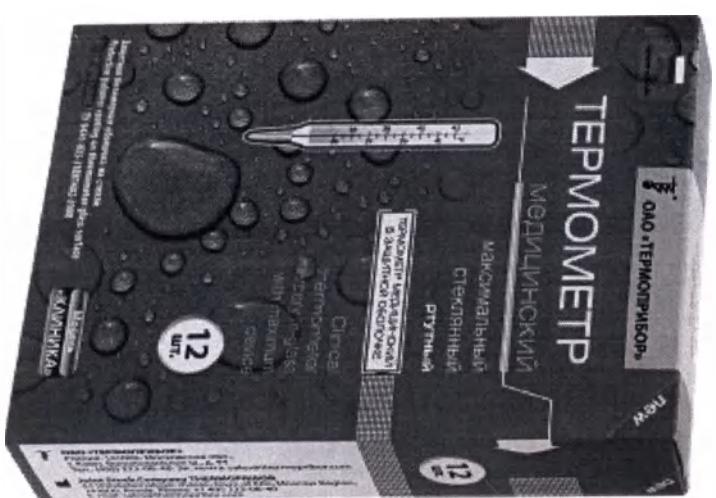

ТЕРМОМЕТР

медицинский
ртутный



ОАО «ТЕРМОПРИБОР»

ТЕРМОМЕТР

медицинский

максимальный
стеклянный
ртутный



ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ
В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Clinical
thermometer
mercury in-glass
with maximum
device

12
шт.

Защитная полимерная оболочка на стекле
Protective polymer coating on thermometer glass surface
ГОСТ 31516-2012/ТУ 9441-033-31881402-2008

Модель
«КЛИНИКА»



ОАО «ТЕРМОПРИБОР»
Россия, 141600, Московская обл.,
г. Клин, Волоколамское ш., д. 44
Тел.: (49624) 2-60-87, Эл. почта: sales@thermopribor.com
Joint Stock Company THERMOPRIBOR
44 Volokolamskoye shosse, town of Klin, Moscow Region,
141600, Russia. Phone: (49624) 2-60-87
E-mail: sales@thermopribor.com



ОАО «ТЕРМОПРИБОР»

ТЕРМОМЕТР

медицинский

Преимущества модели
«КЛИНИКА»

- 1 Термометр по всей наружной поверхности покрыт полимерной оболочкой. Осколки стекла и ртути разбившегося термометра остаются внутри прочной герметичной оболочки.
- 2 Классический стеклянный термометр — это точность и безотказность.
- 3 Герметичная оболочка добавляет безопасности при использовании изделия.
- 4 Данная модель термометра с защитным покрытием разработана специально для медицинских учреждений и отвечает всем требованиям, предъявляемым по дезинфекции и санитарной обработке медицинских изделий.
- 5 Не требуется больших усилий при стряхивании.

Инструкция в упаковке.

12
шт.



4 603788 1000062

LOT



Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора
№ ФСР 2009/04500 от 19.03.2009 г.





и пронумеровано
(6) листов
С.Г.Иткин