

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (АМН (CLIA)), набор на 200 тестов

производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллера гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (AMH (CLIA)); набор на 200 тестов»

 Specification: 2 × 100 Tests

Storage: 2°C ~ 8°C Keep away from sunlight

 Cat No.: **IM4407208**

 Production date: **20230702**

 Lot No.: **0124041**

 Expiry date: **20240702**

**Anti-Müllerian Hormone (AMH)
Chemiluminescent Immunoassay Kit**

 UDI




(01) 06950617423997

(10) 1022071

(11) 221006

(17) 231006

(21) SW2208310174000227



AMH (CLIA)



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массуга i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов»



maccura



IVD

6 9506 17 423997

生产许可证编号：川食药监械生产许20150064号

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：

川械注准20212400027

注意事项：其他内容详见说明书

EC REP

Shanghai International Holding Corp.GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80,20537
Hamburg,Germany

AMH



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: + 86 28 8782 6777

传真: + 86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.

Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731

Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel : +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов»

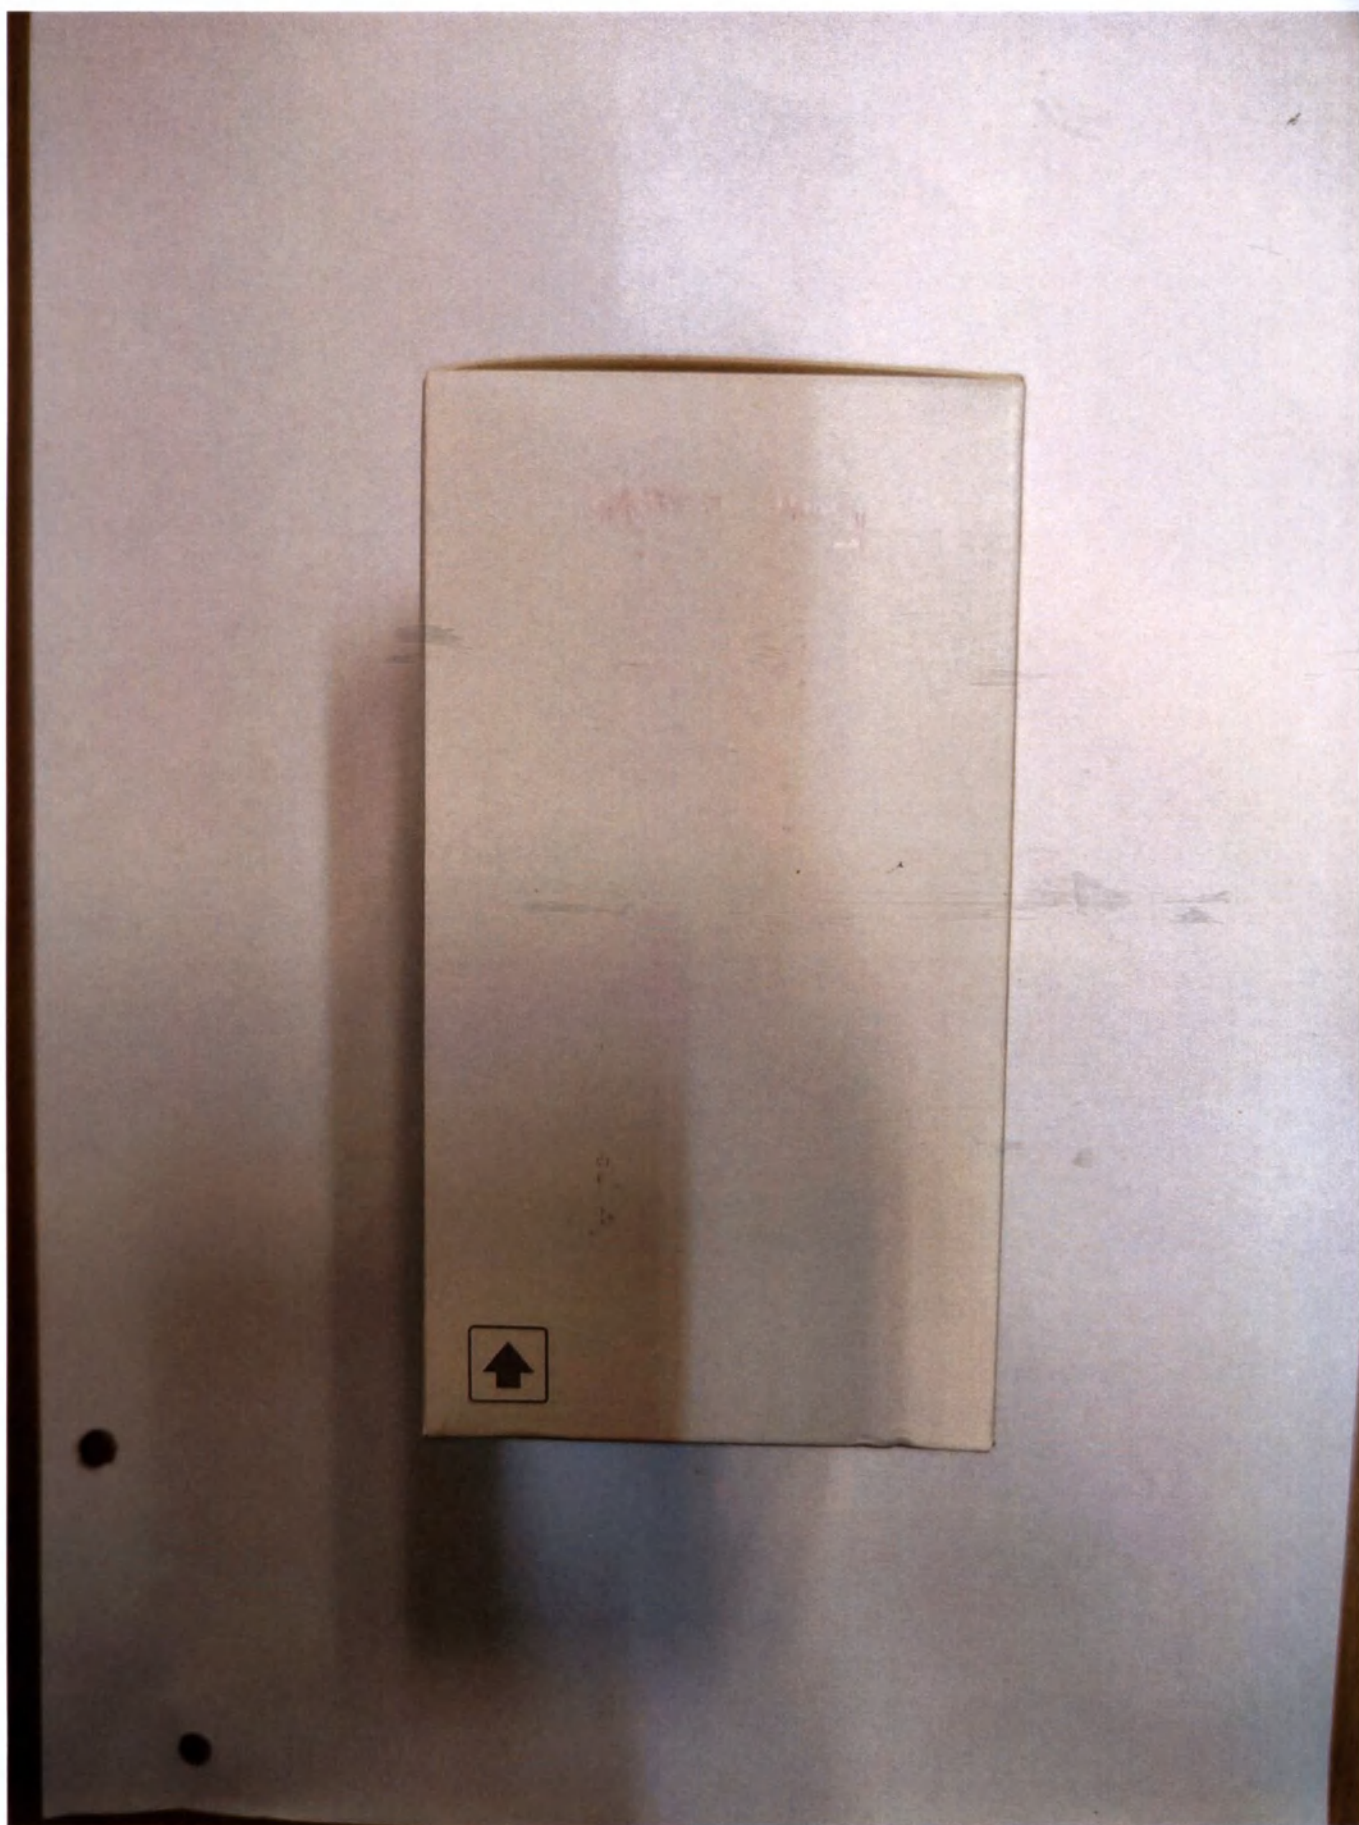


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (АМН (CLIA)), набор на 200 тестов»

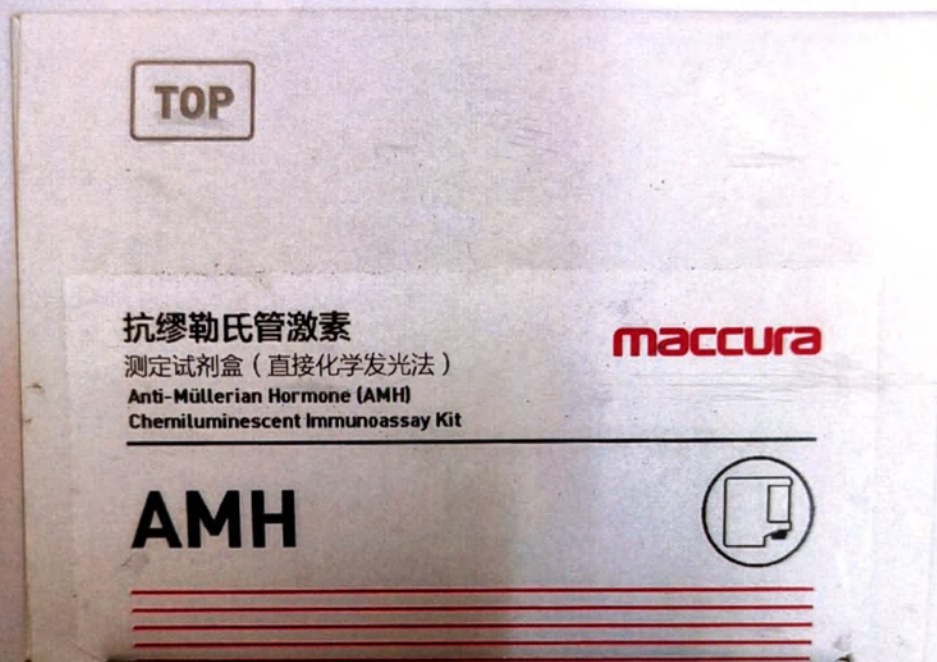


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов»




Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллера гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов»

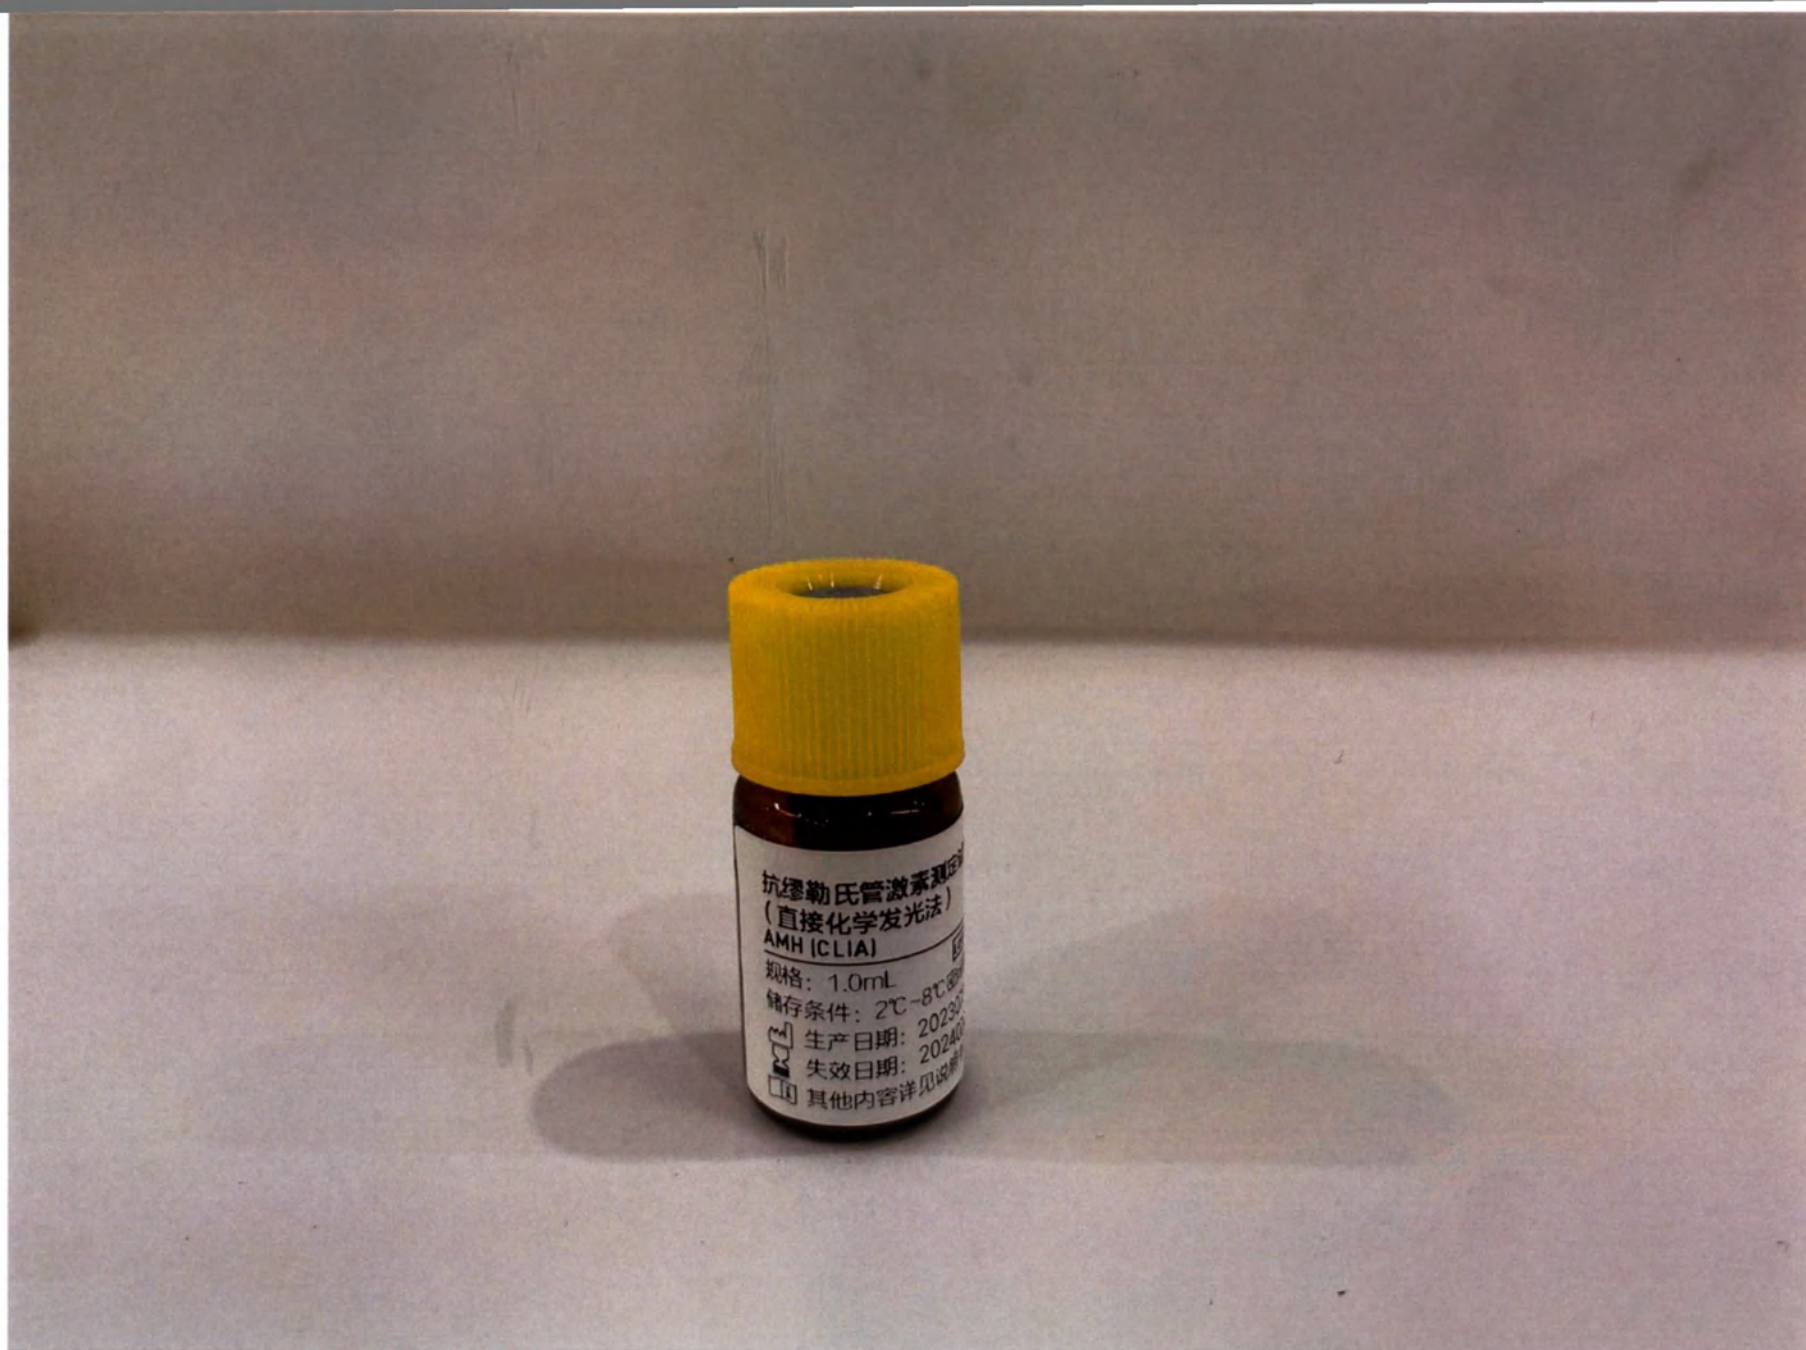


Внешний вид флакона Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллера гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массира i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

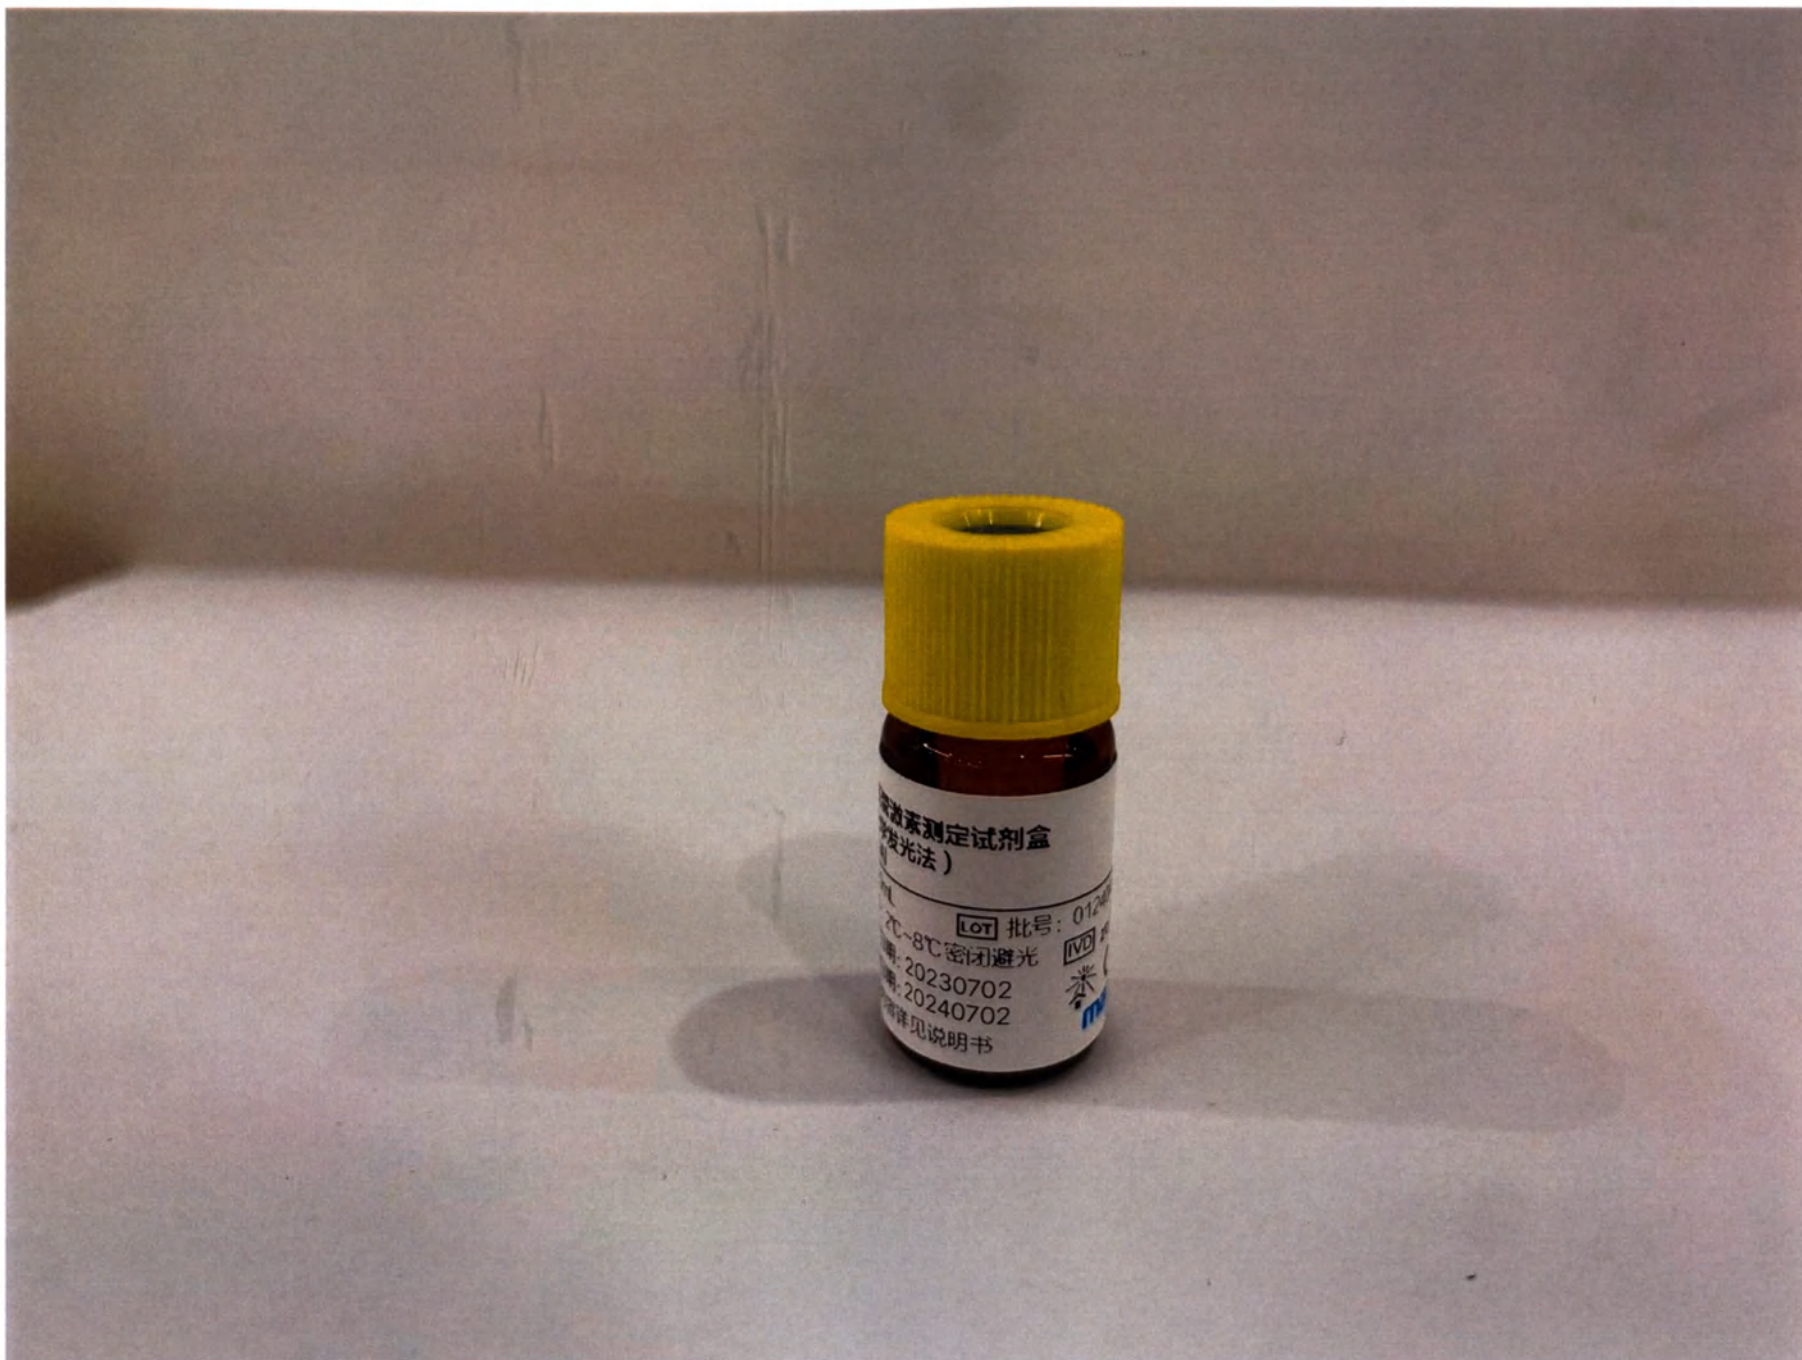


Внешний вид флакона Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллера гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов»,

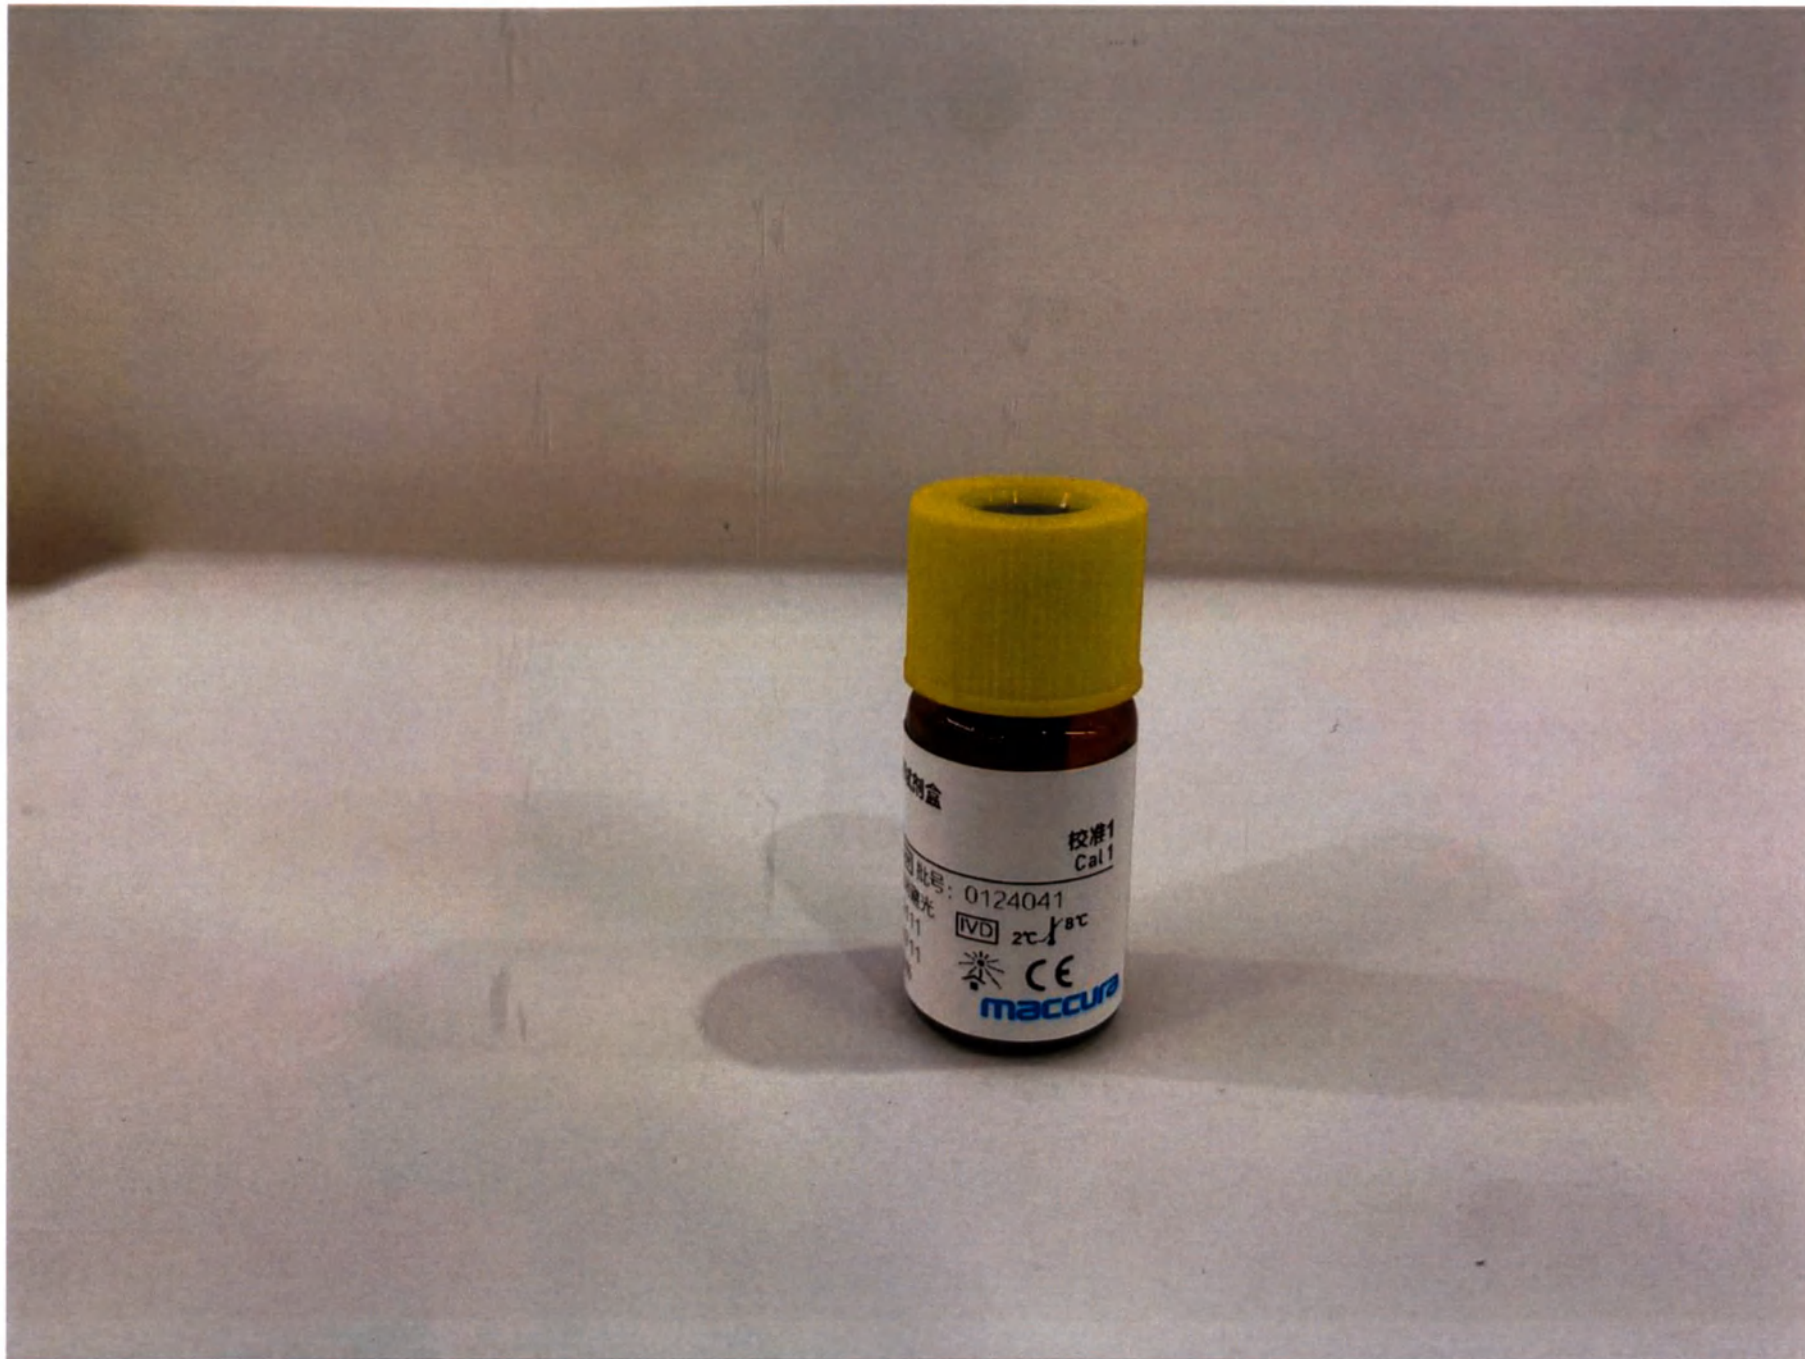


Внешний вид флакона Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

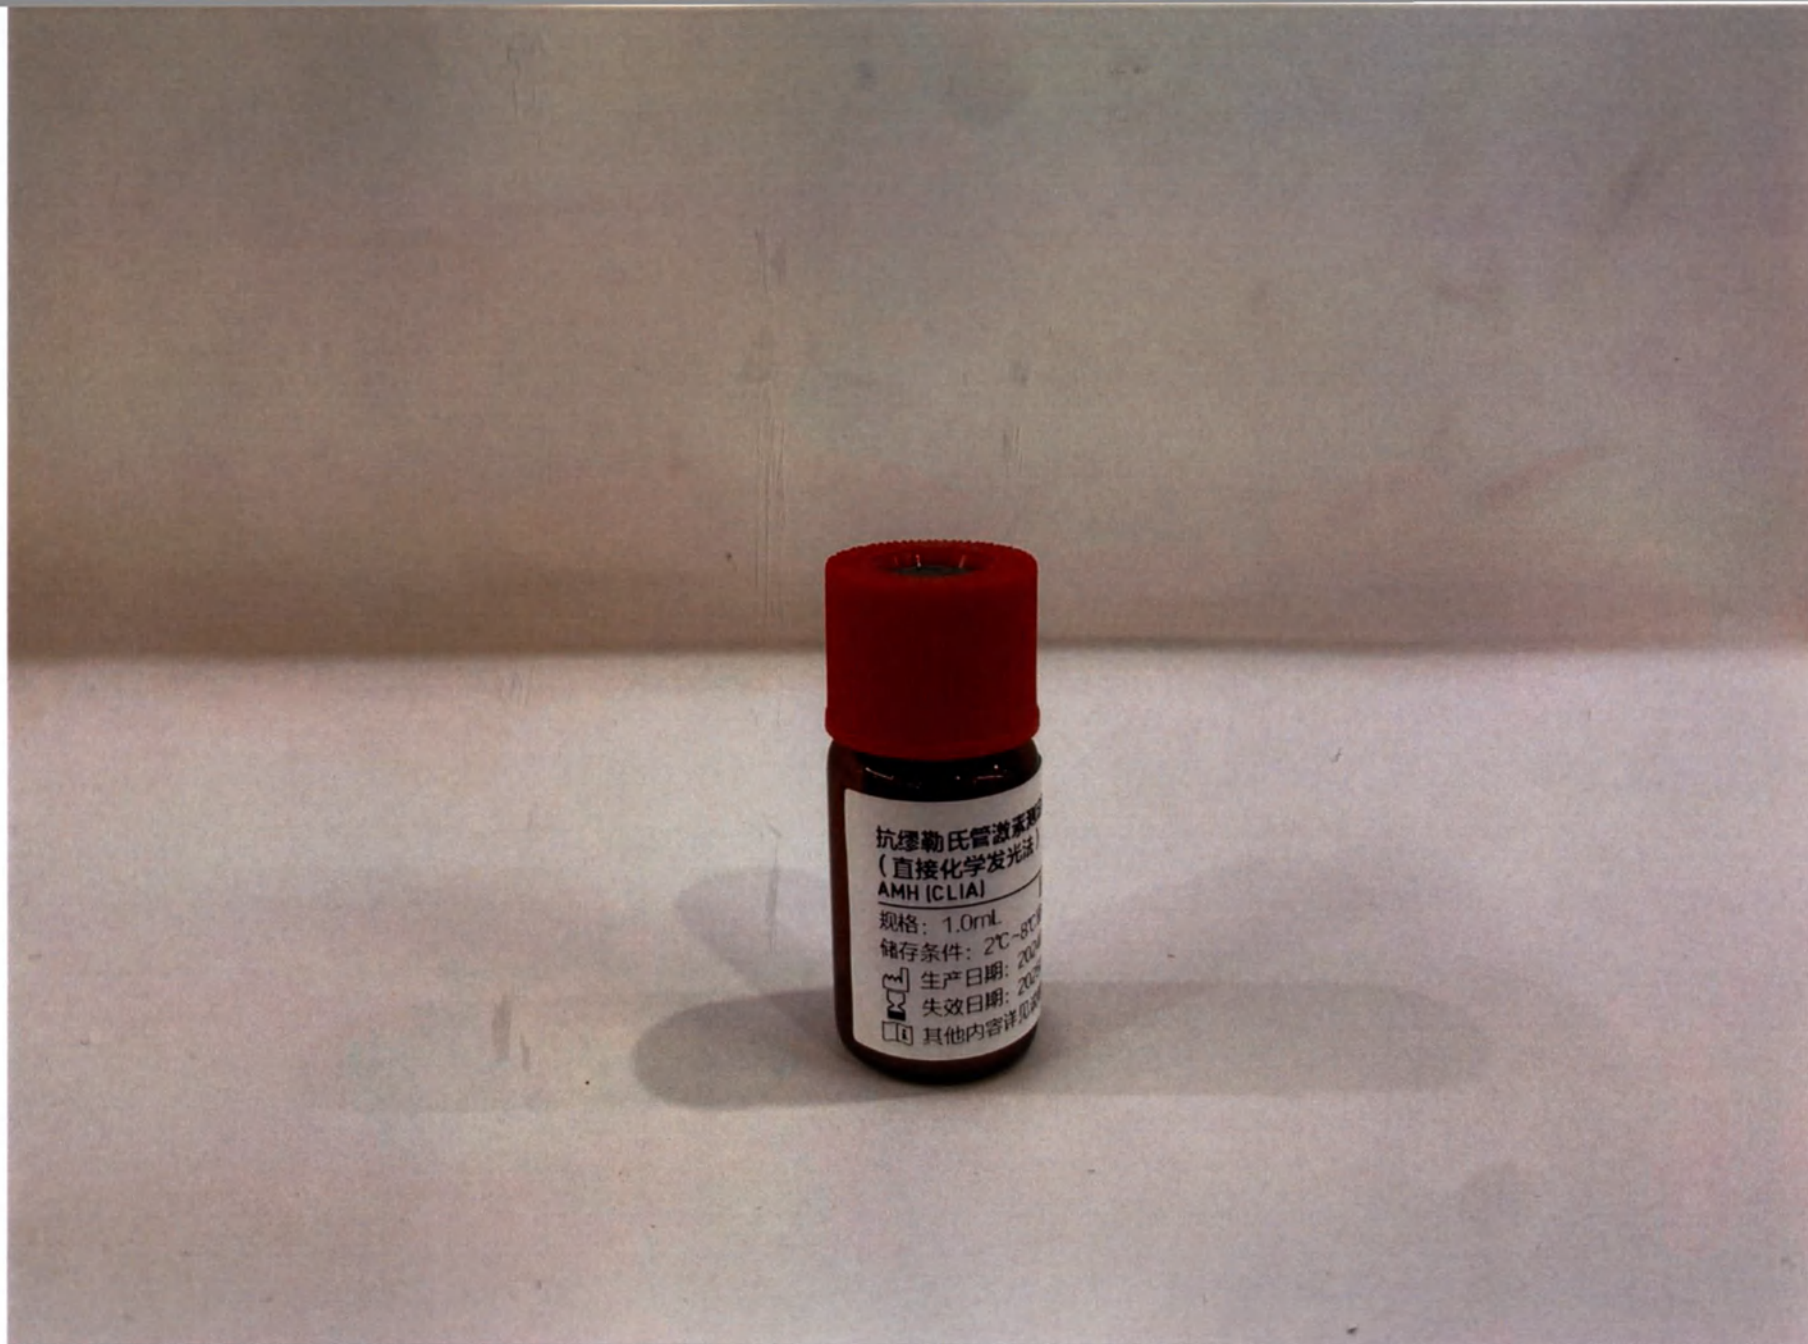

Внешний вид флакона Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллера гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

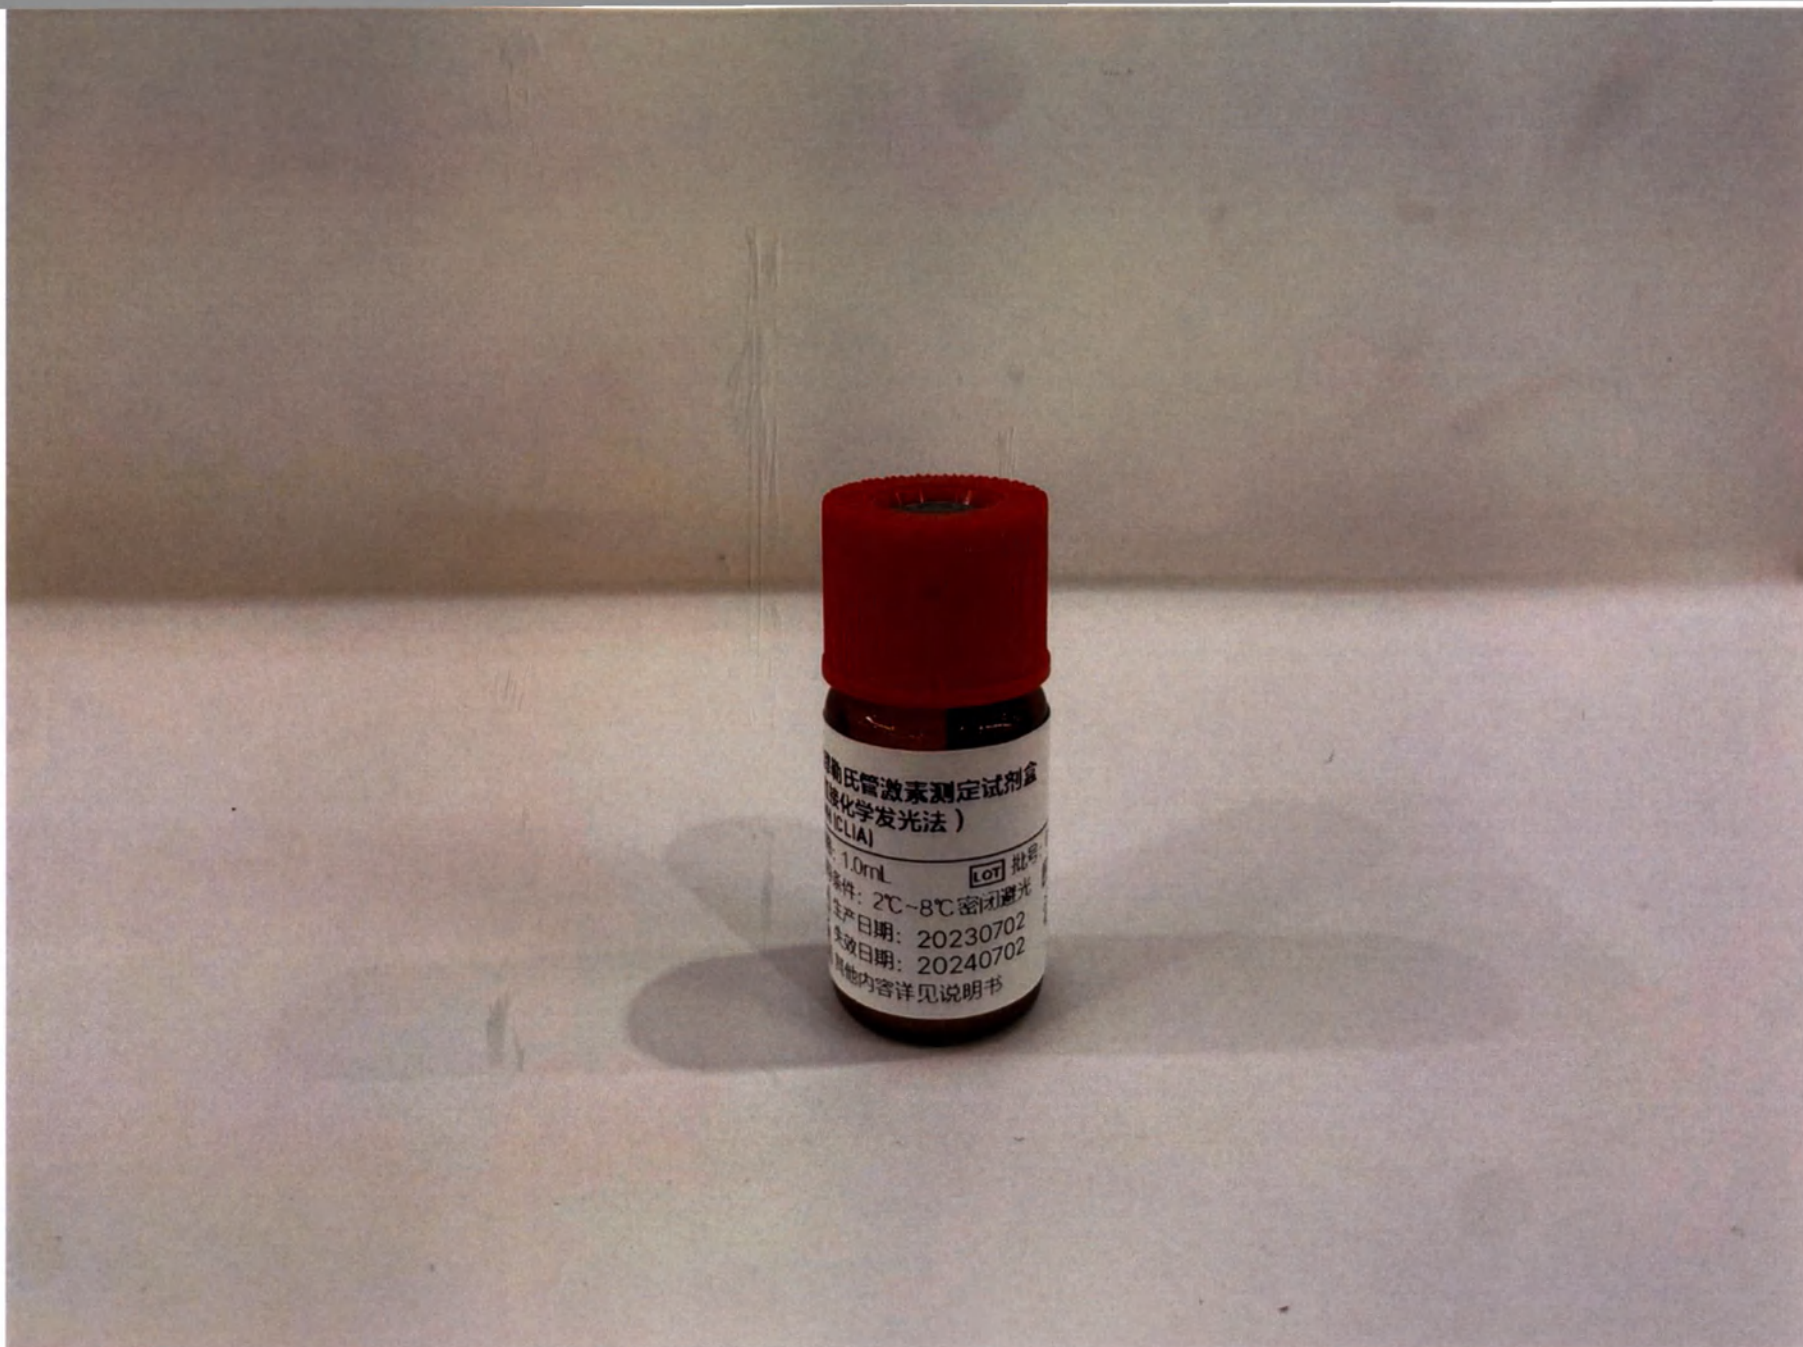


Внешний вид флакона Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

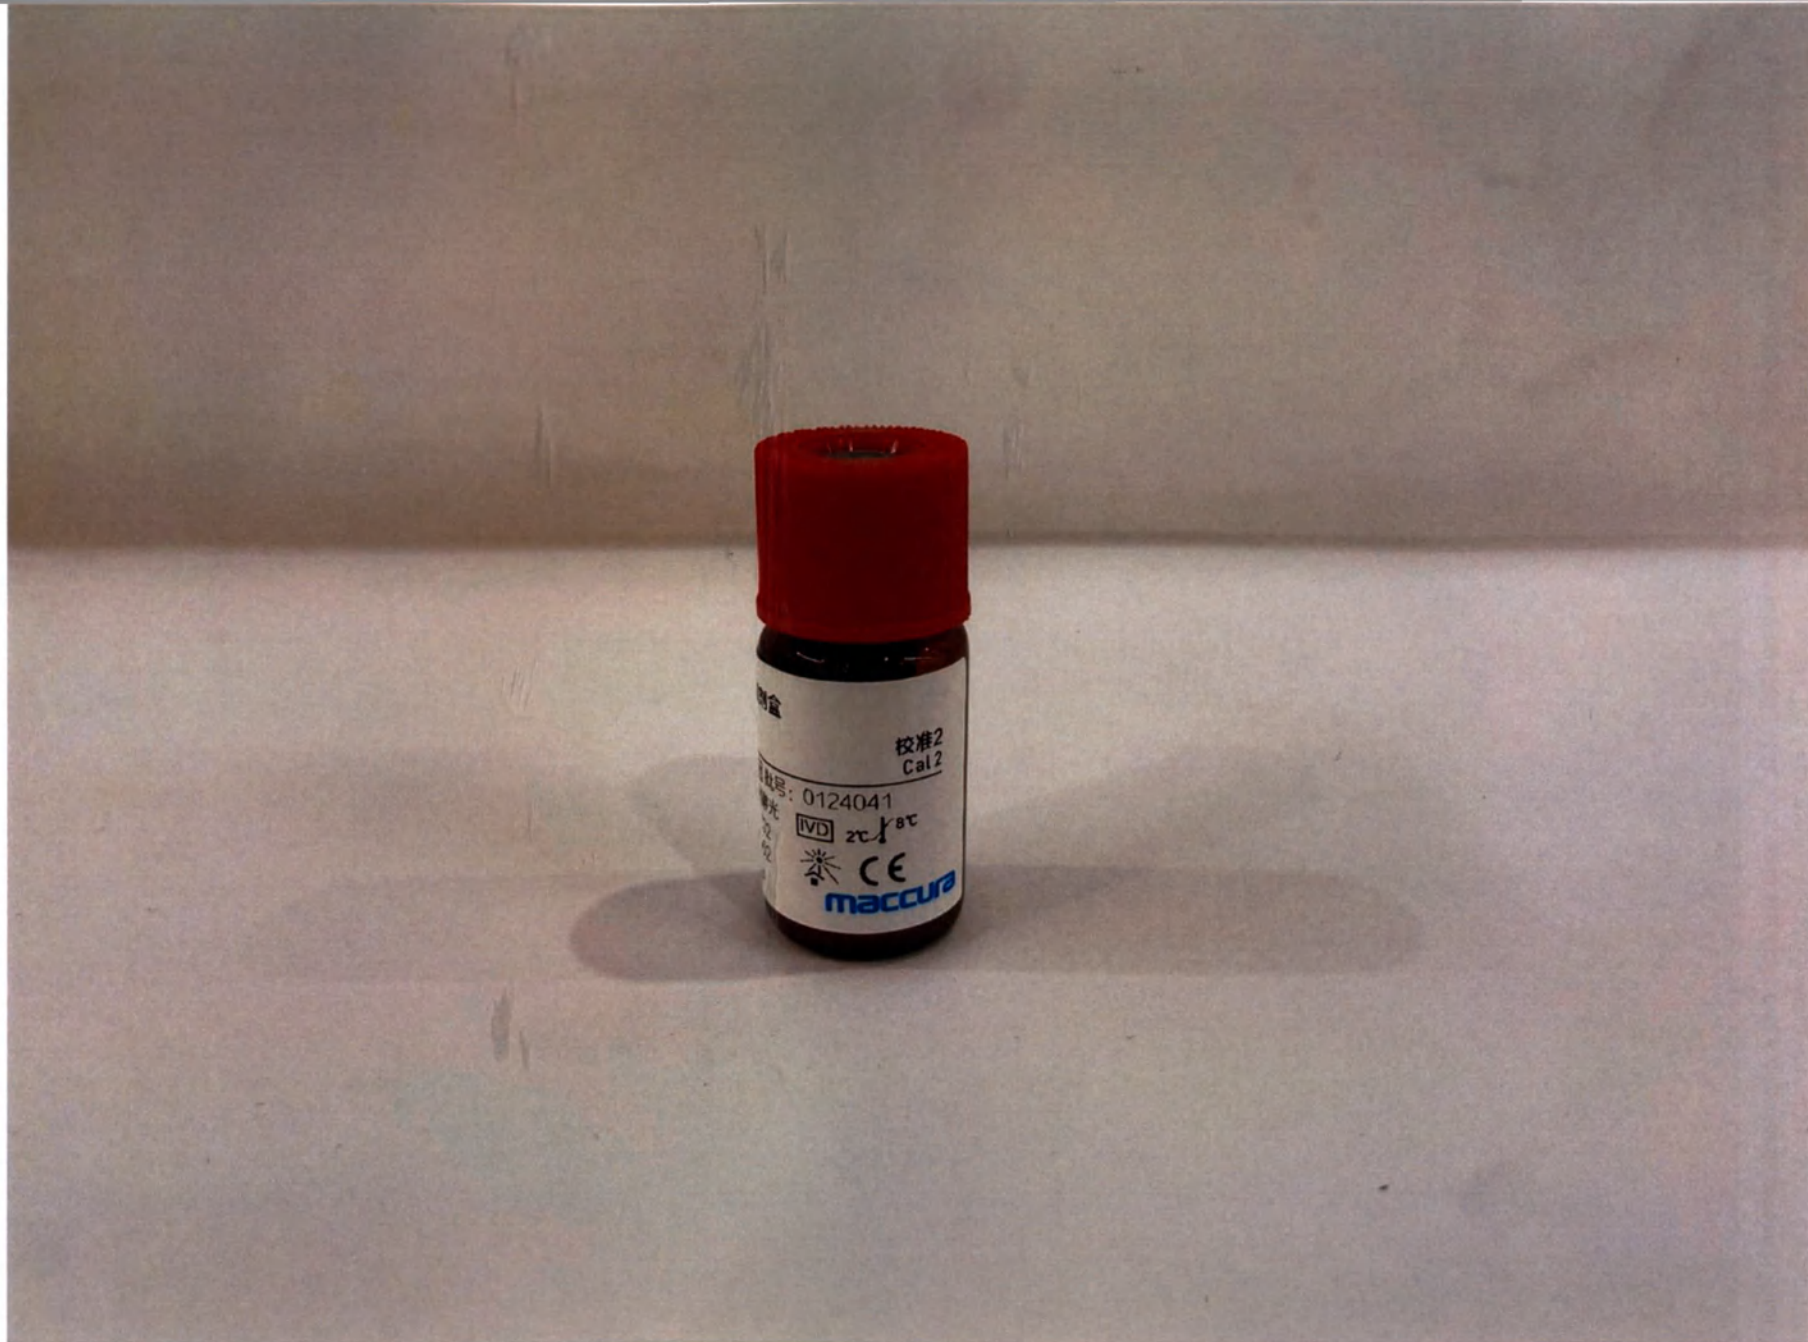

Внешний вид флакона Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массуга i (АМН (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3



Внешний вид Этикеток флаконов для восстановленного Cal 1/ Cal 2 на клеящей основе «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллера гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов»

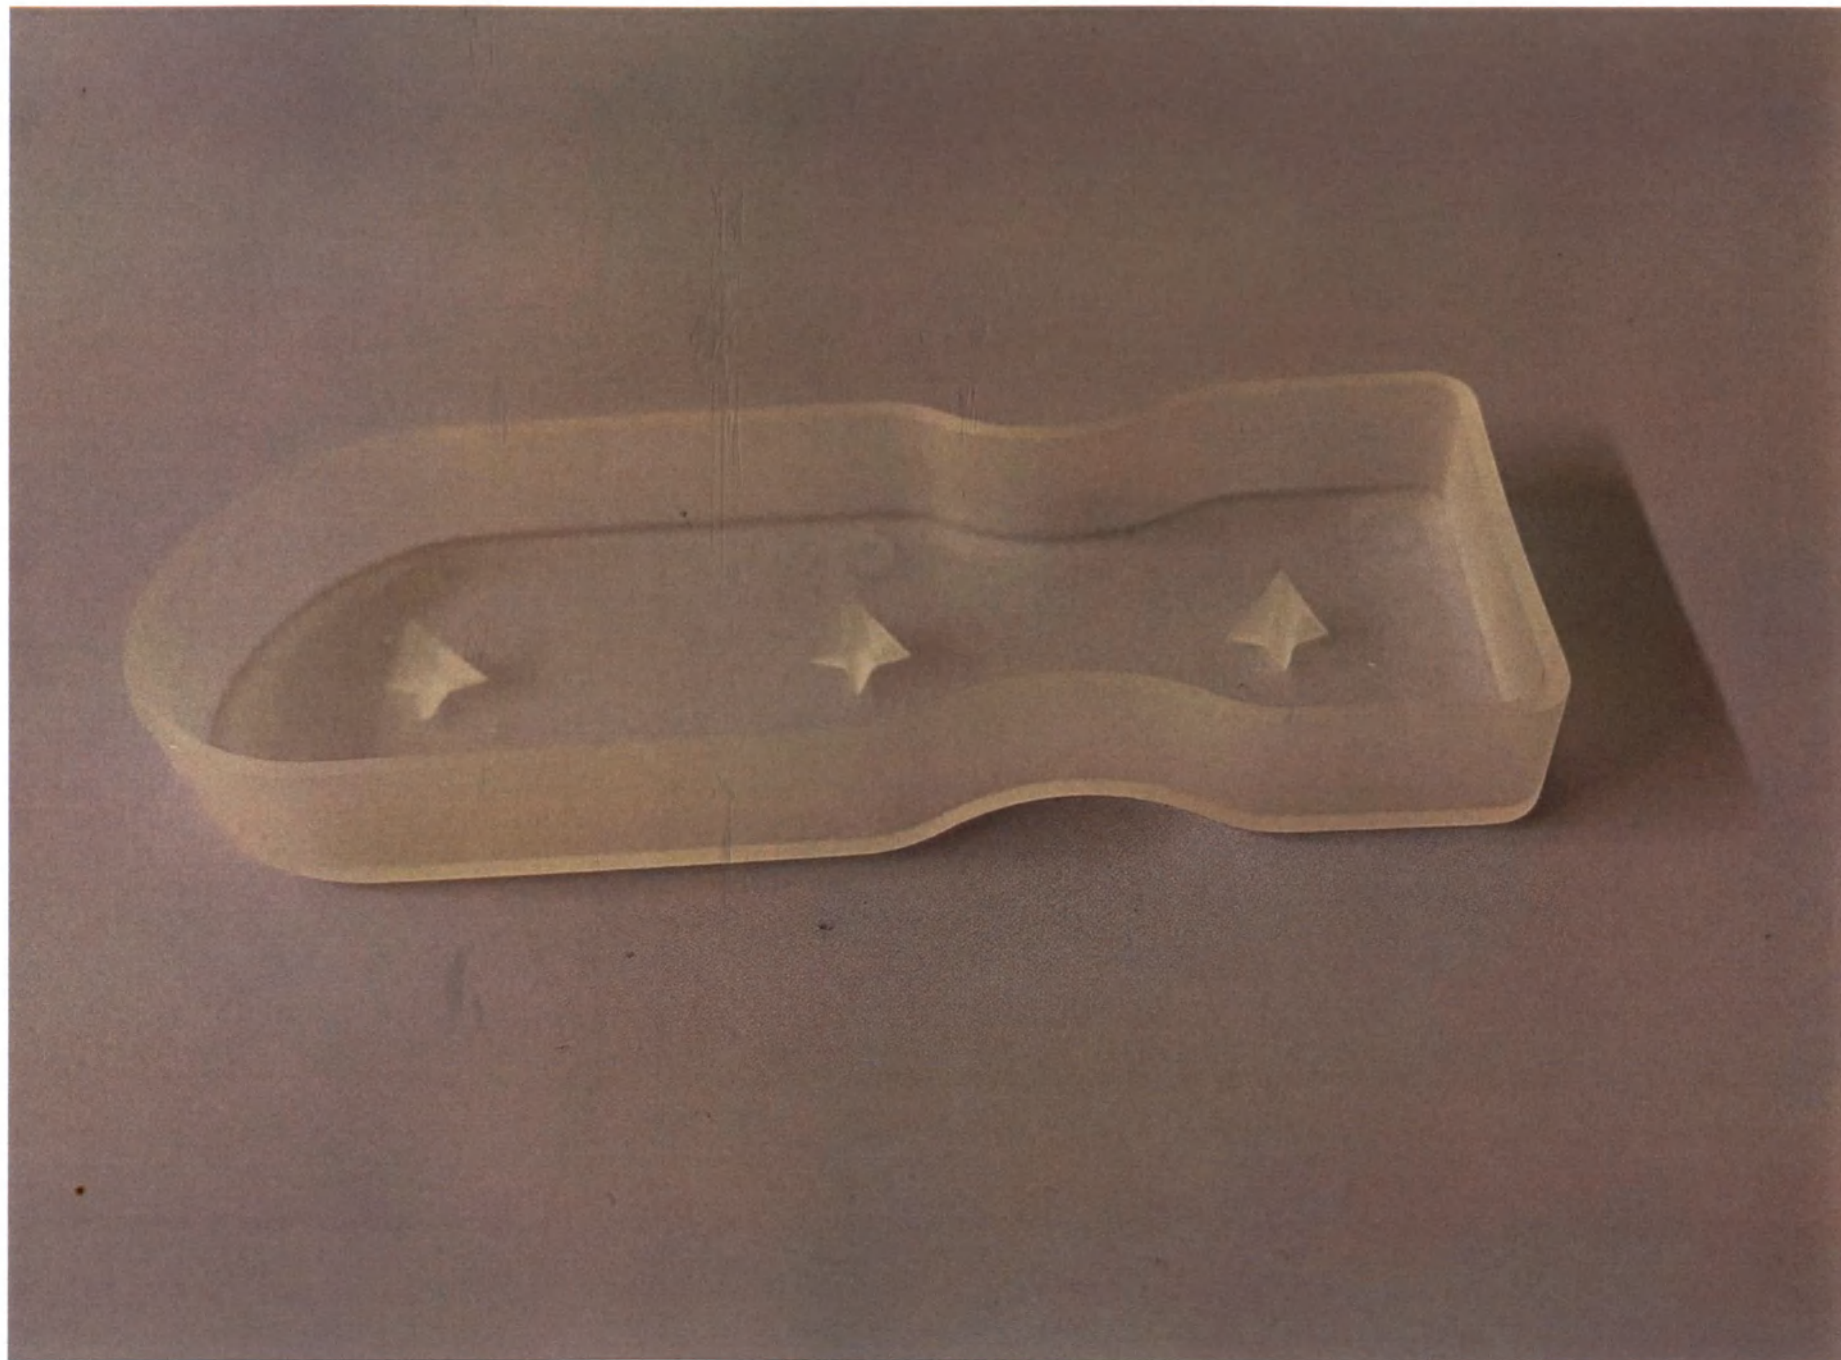

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ)



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 17 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»

