


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов и калибраторов для количественного
определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura
i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов**

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan
Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**

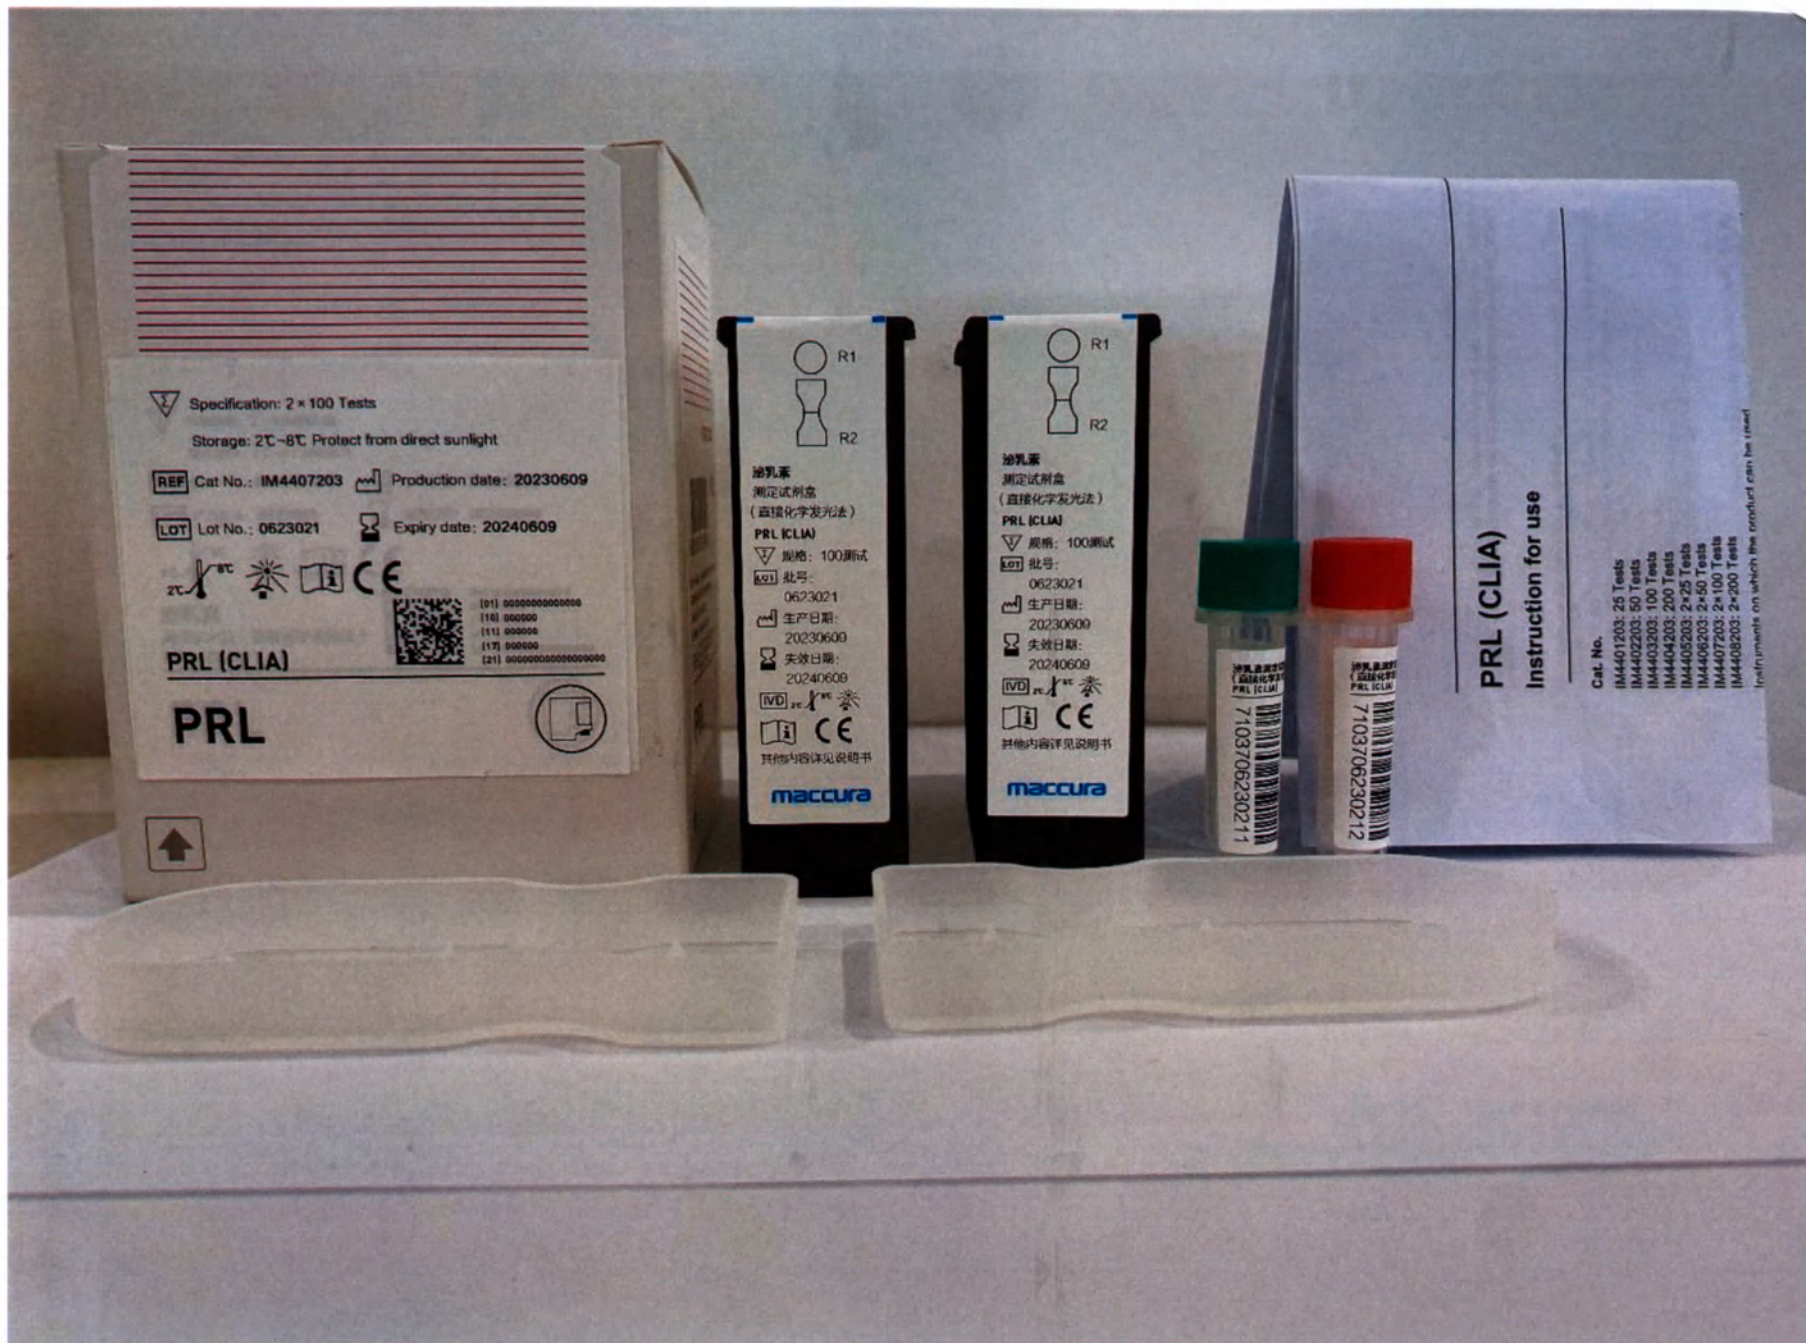

Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»



Specification: 2 × 100 Tests

Storage: 2°C–8°C Protect from direct sunlight



Cat No.: IM4407203




Production date: 20230609



Lot No.: 0623021



Expiry date: 20240609



(01) 0000000000000000
(10) 000000
(11) 000000
(17) 000000
(21) 0000000000000000

PRL (CLIA)

PRL



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»



maccura



IVD

6 9506 17 424024

生产许可证编号：川食药监械生产许20150064号

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：

川械注准20202400086

注意事项：其他内容详见说明书

EC REP

Shanghai International Holding Corp.GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80,20537
Hamburg, Germany

PRL



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: + 86 28 8782 6777

传真: + 86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.

Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731

Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel : +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com

www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»

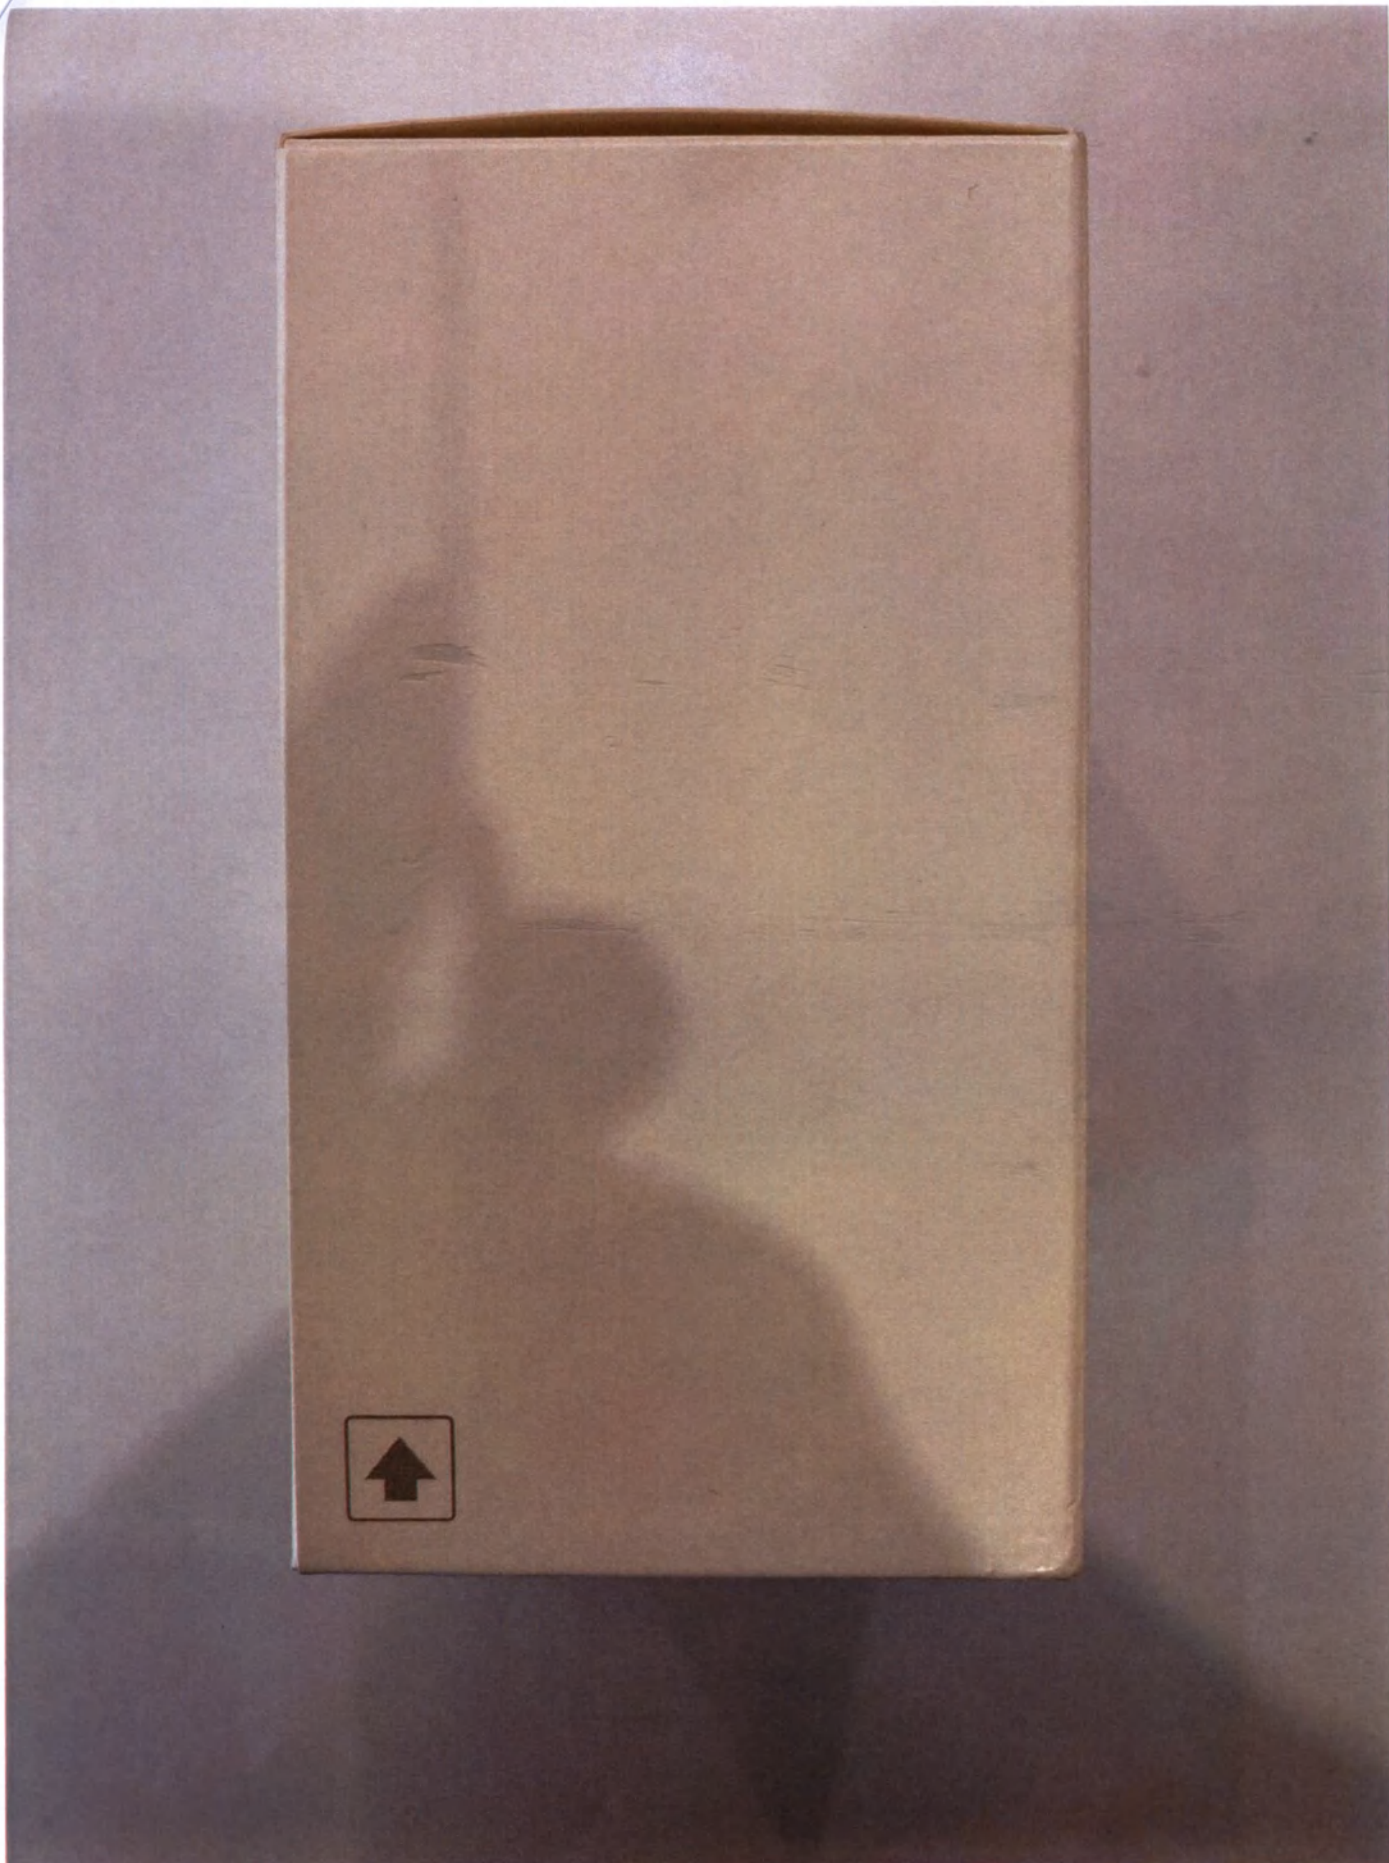

Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»

TOP

泌乳素

测定试剂盒（直接化学发光法）

PRL (CLIA)

maccura


PRL




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»




Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»

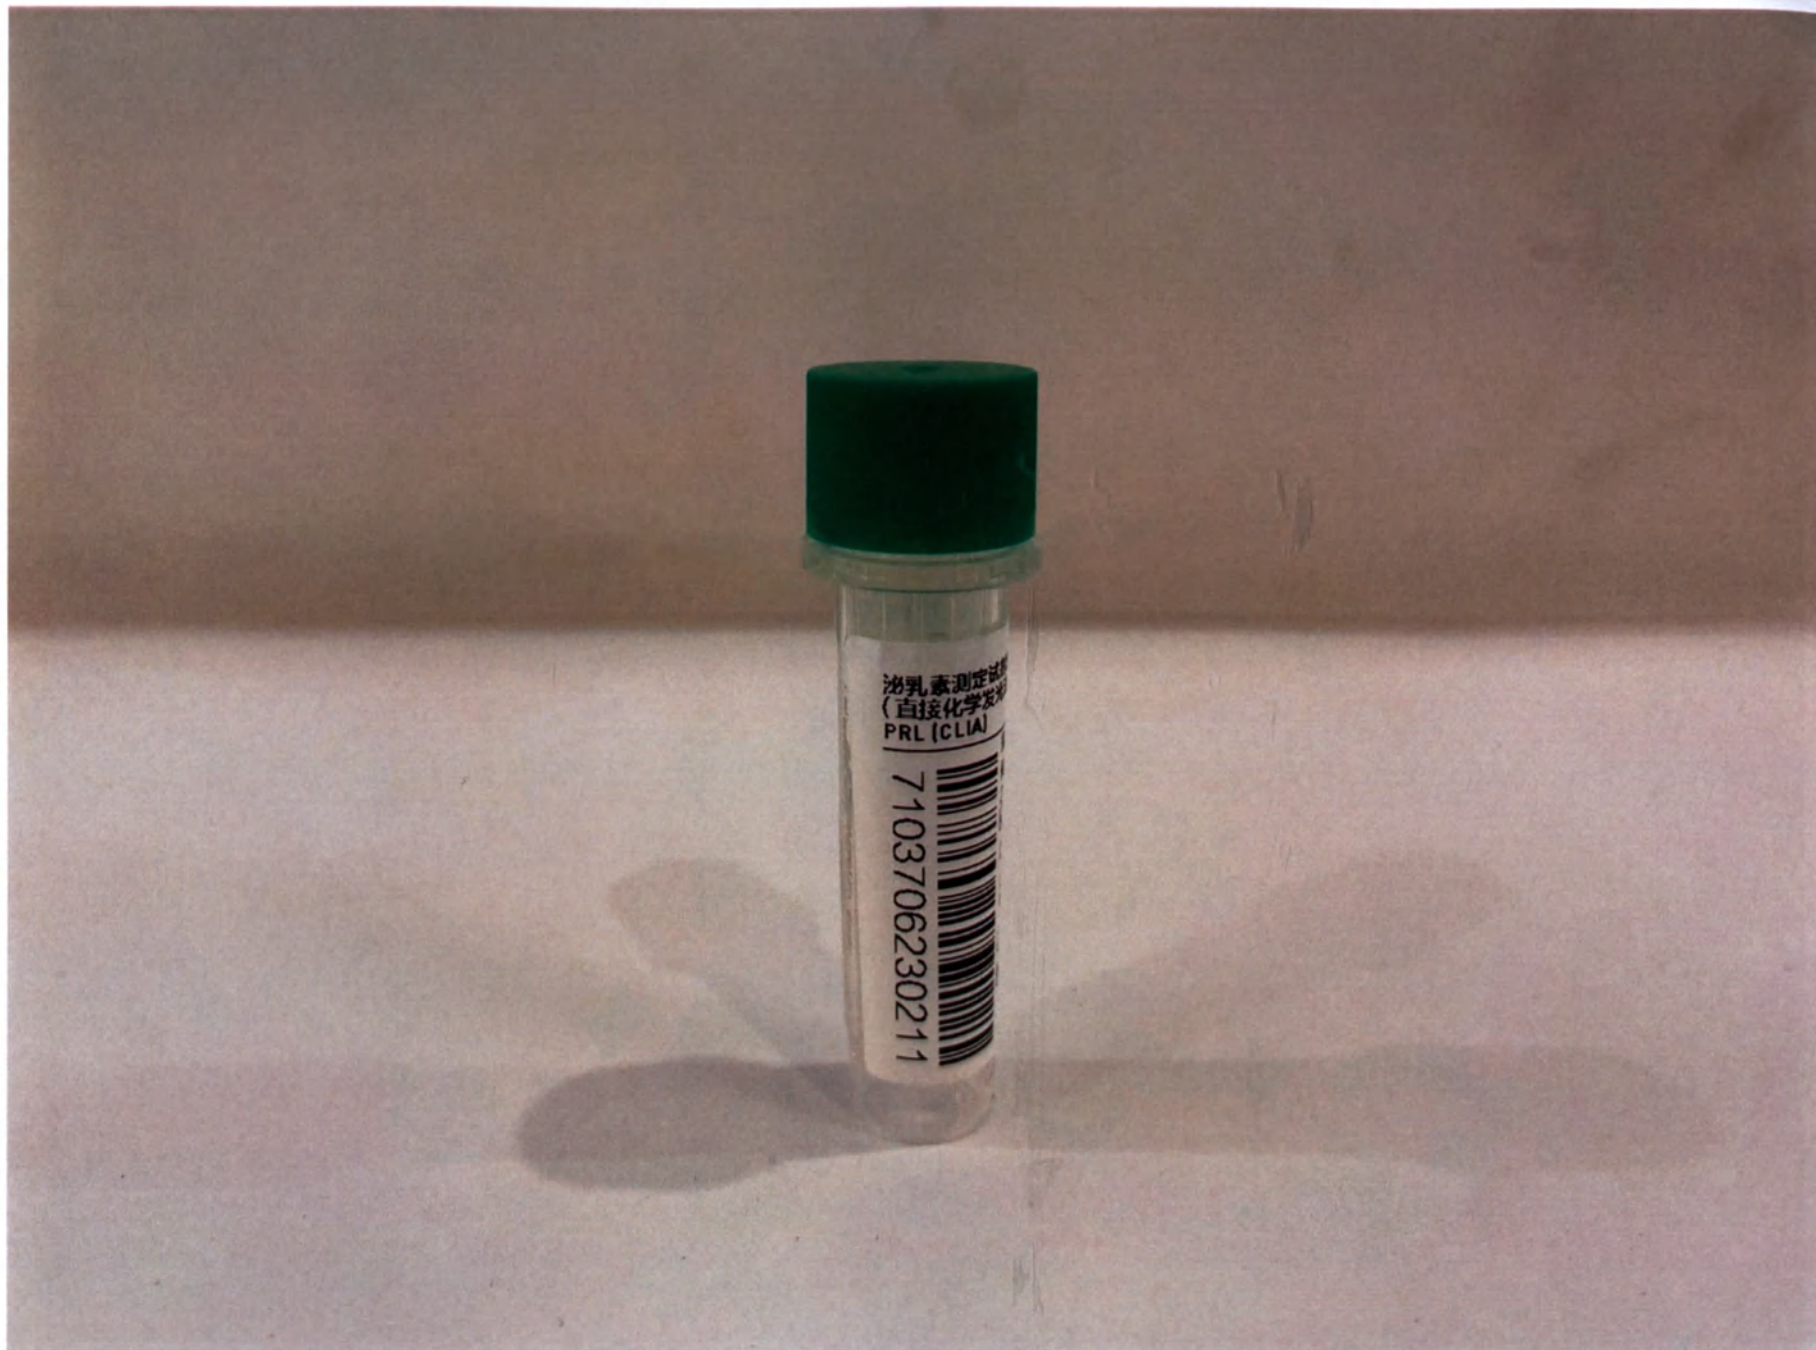

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

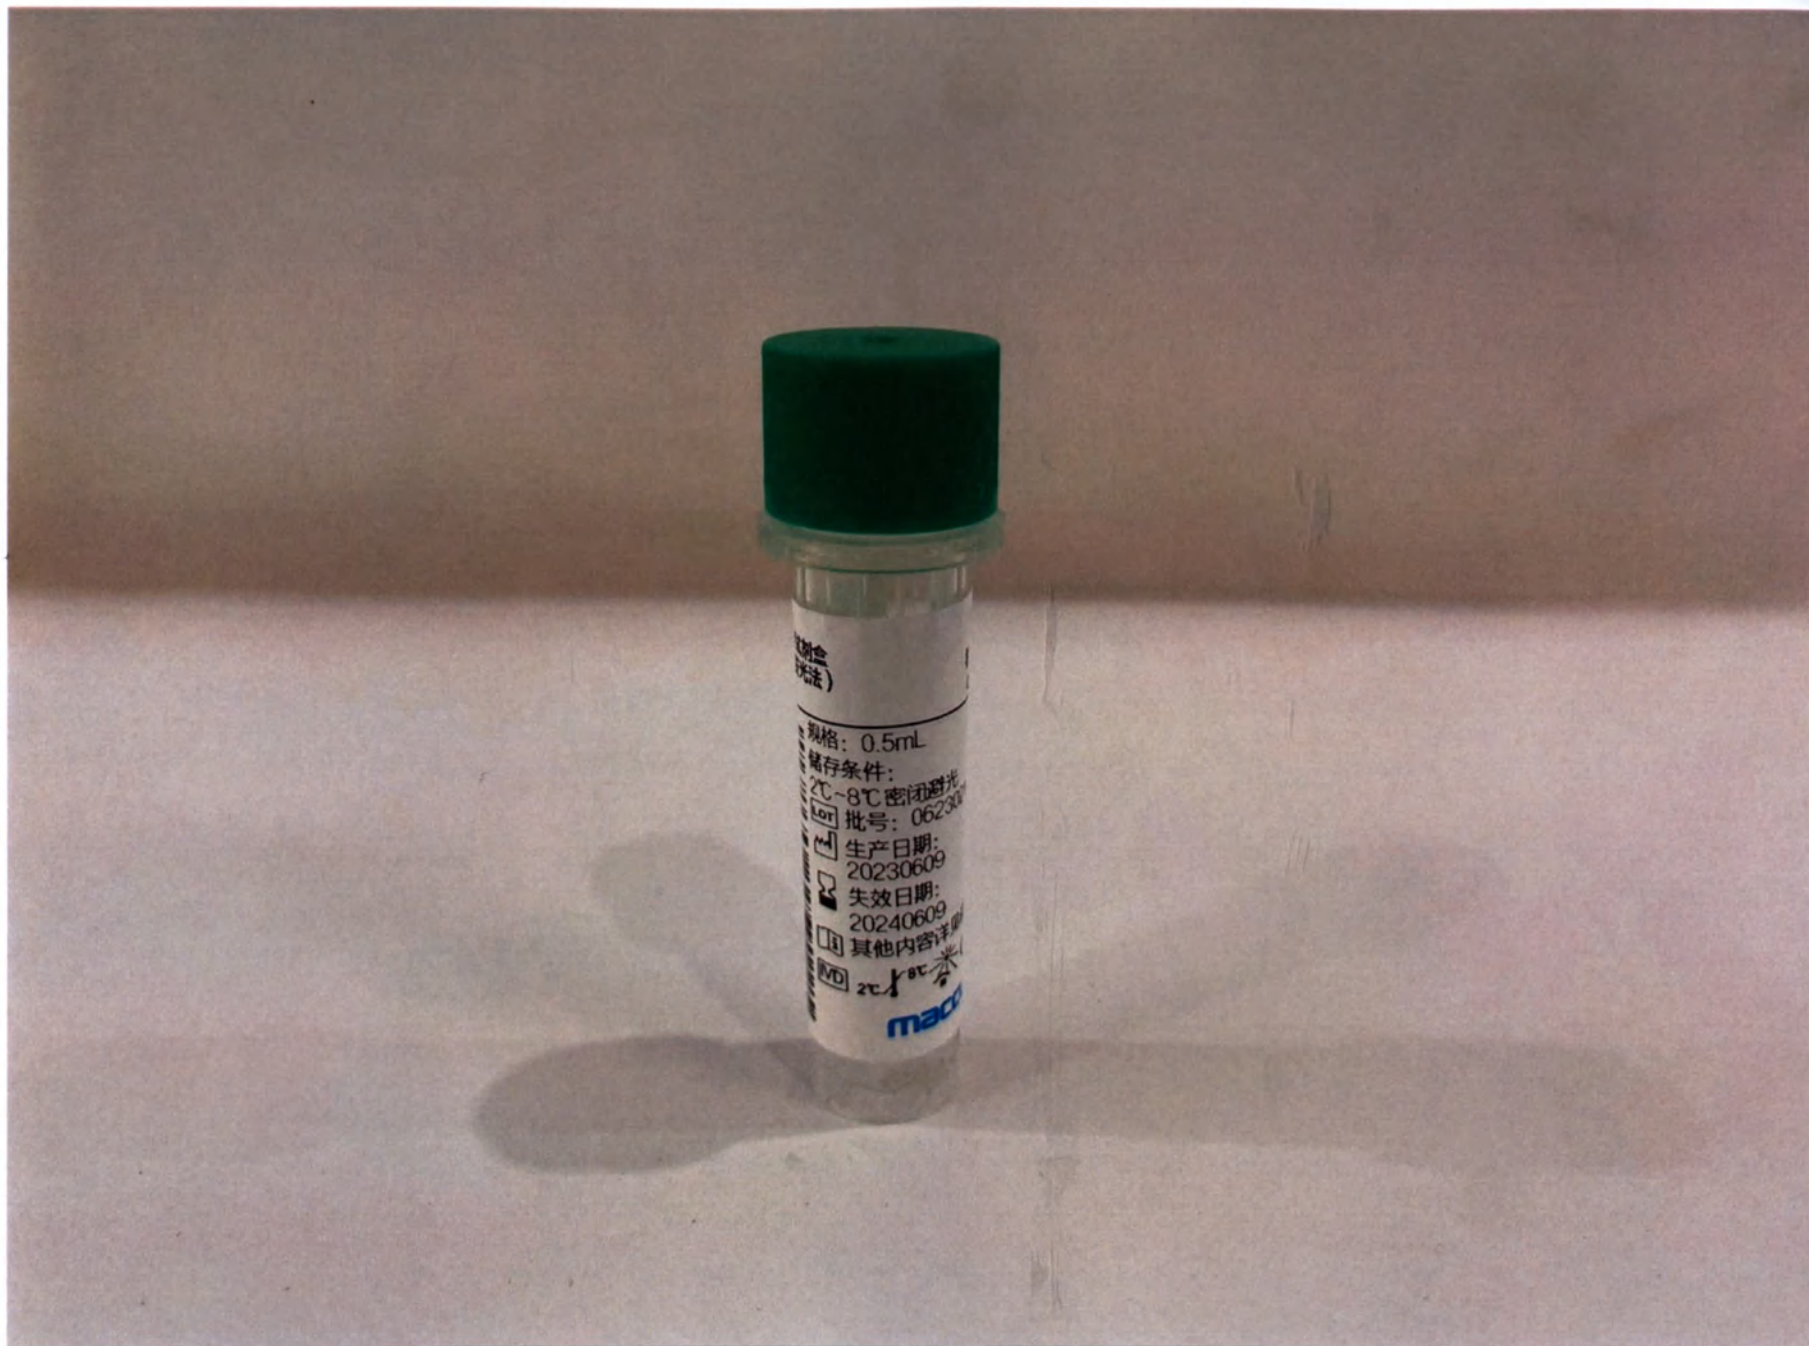


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Massura i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

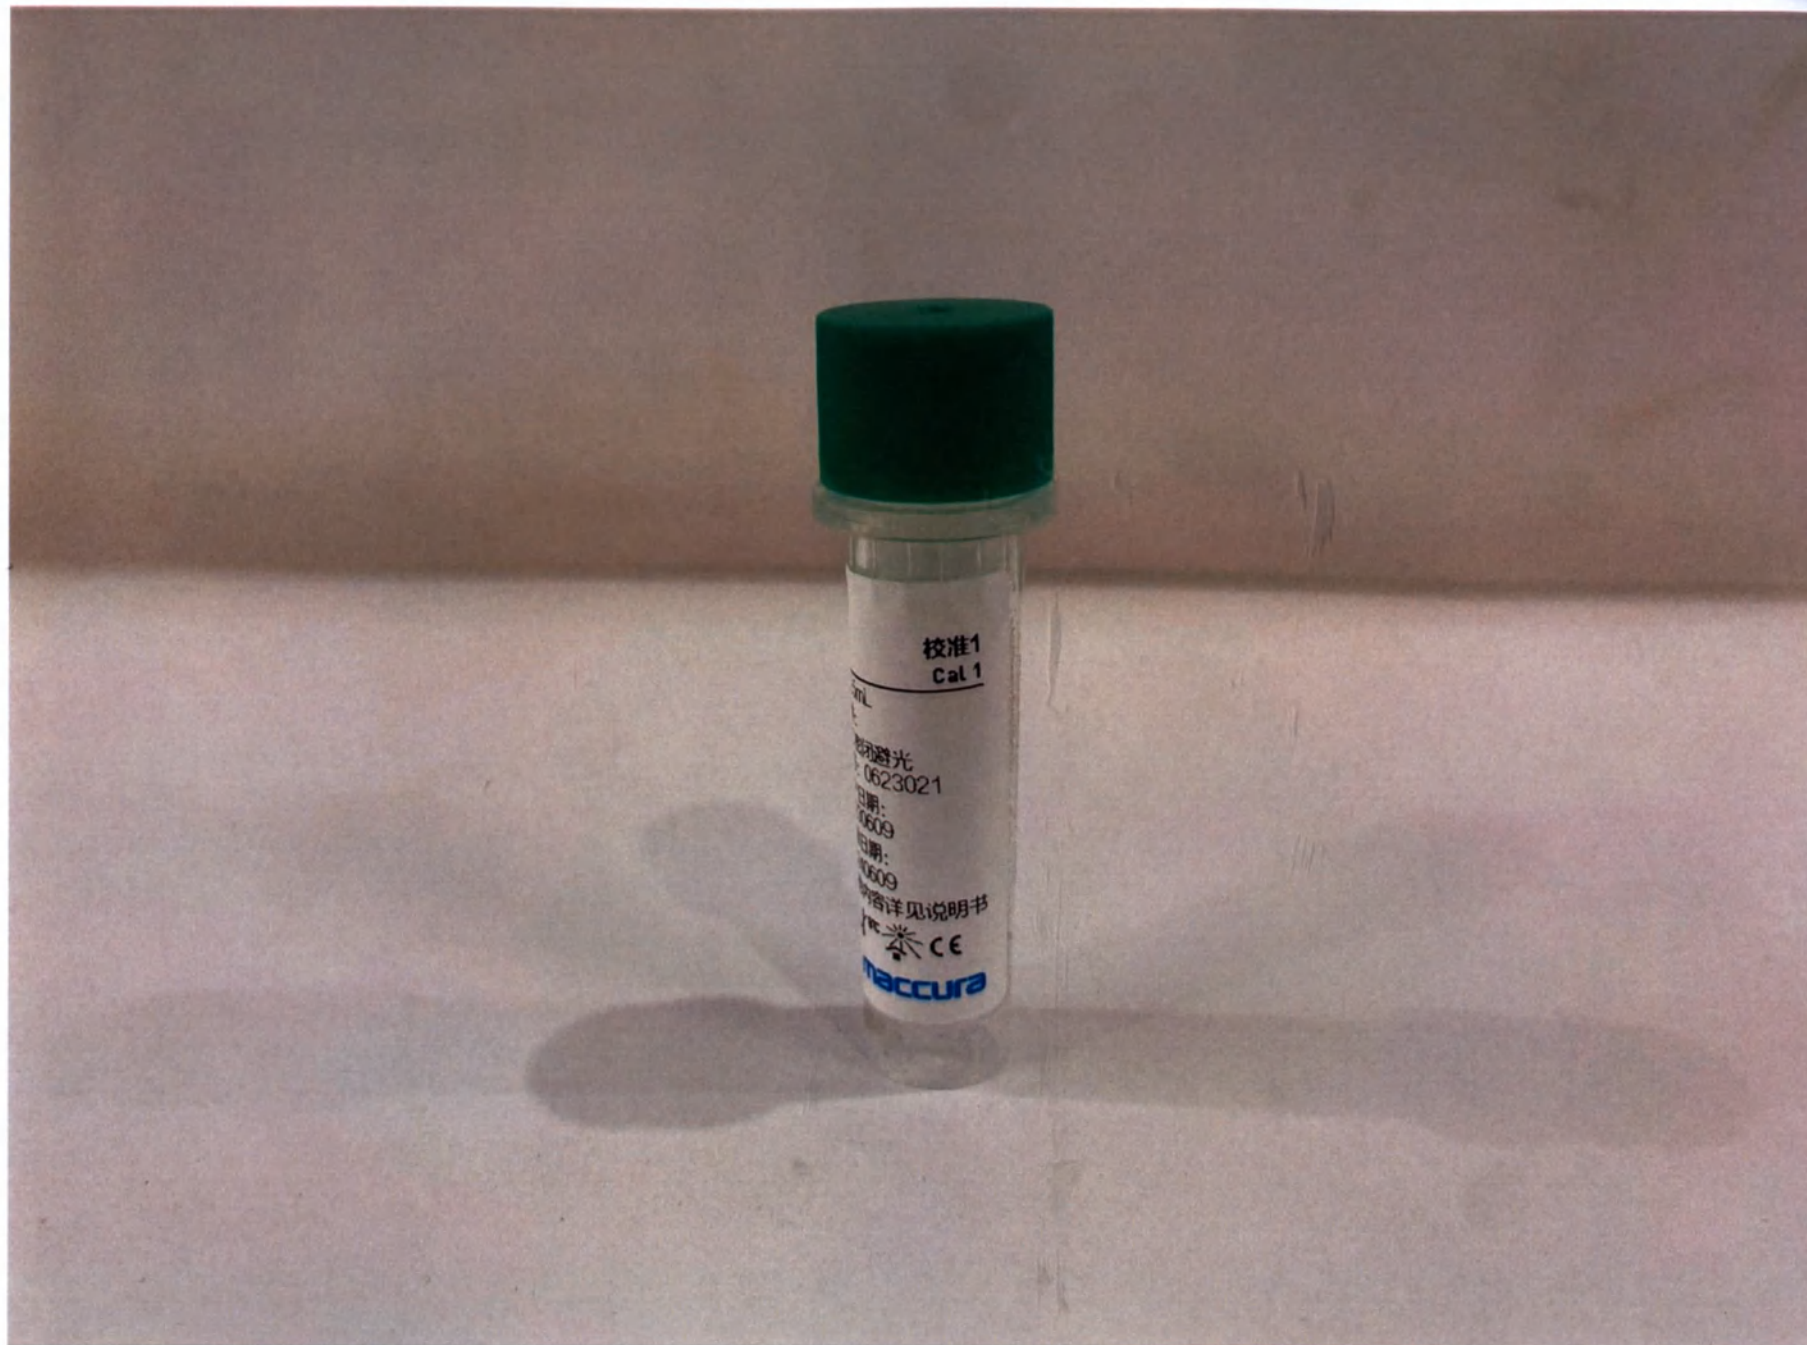

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массуга i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3




Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массуга i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

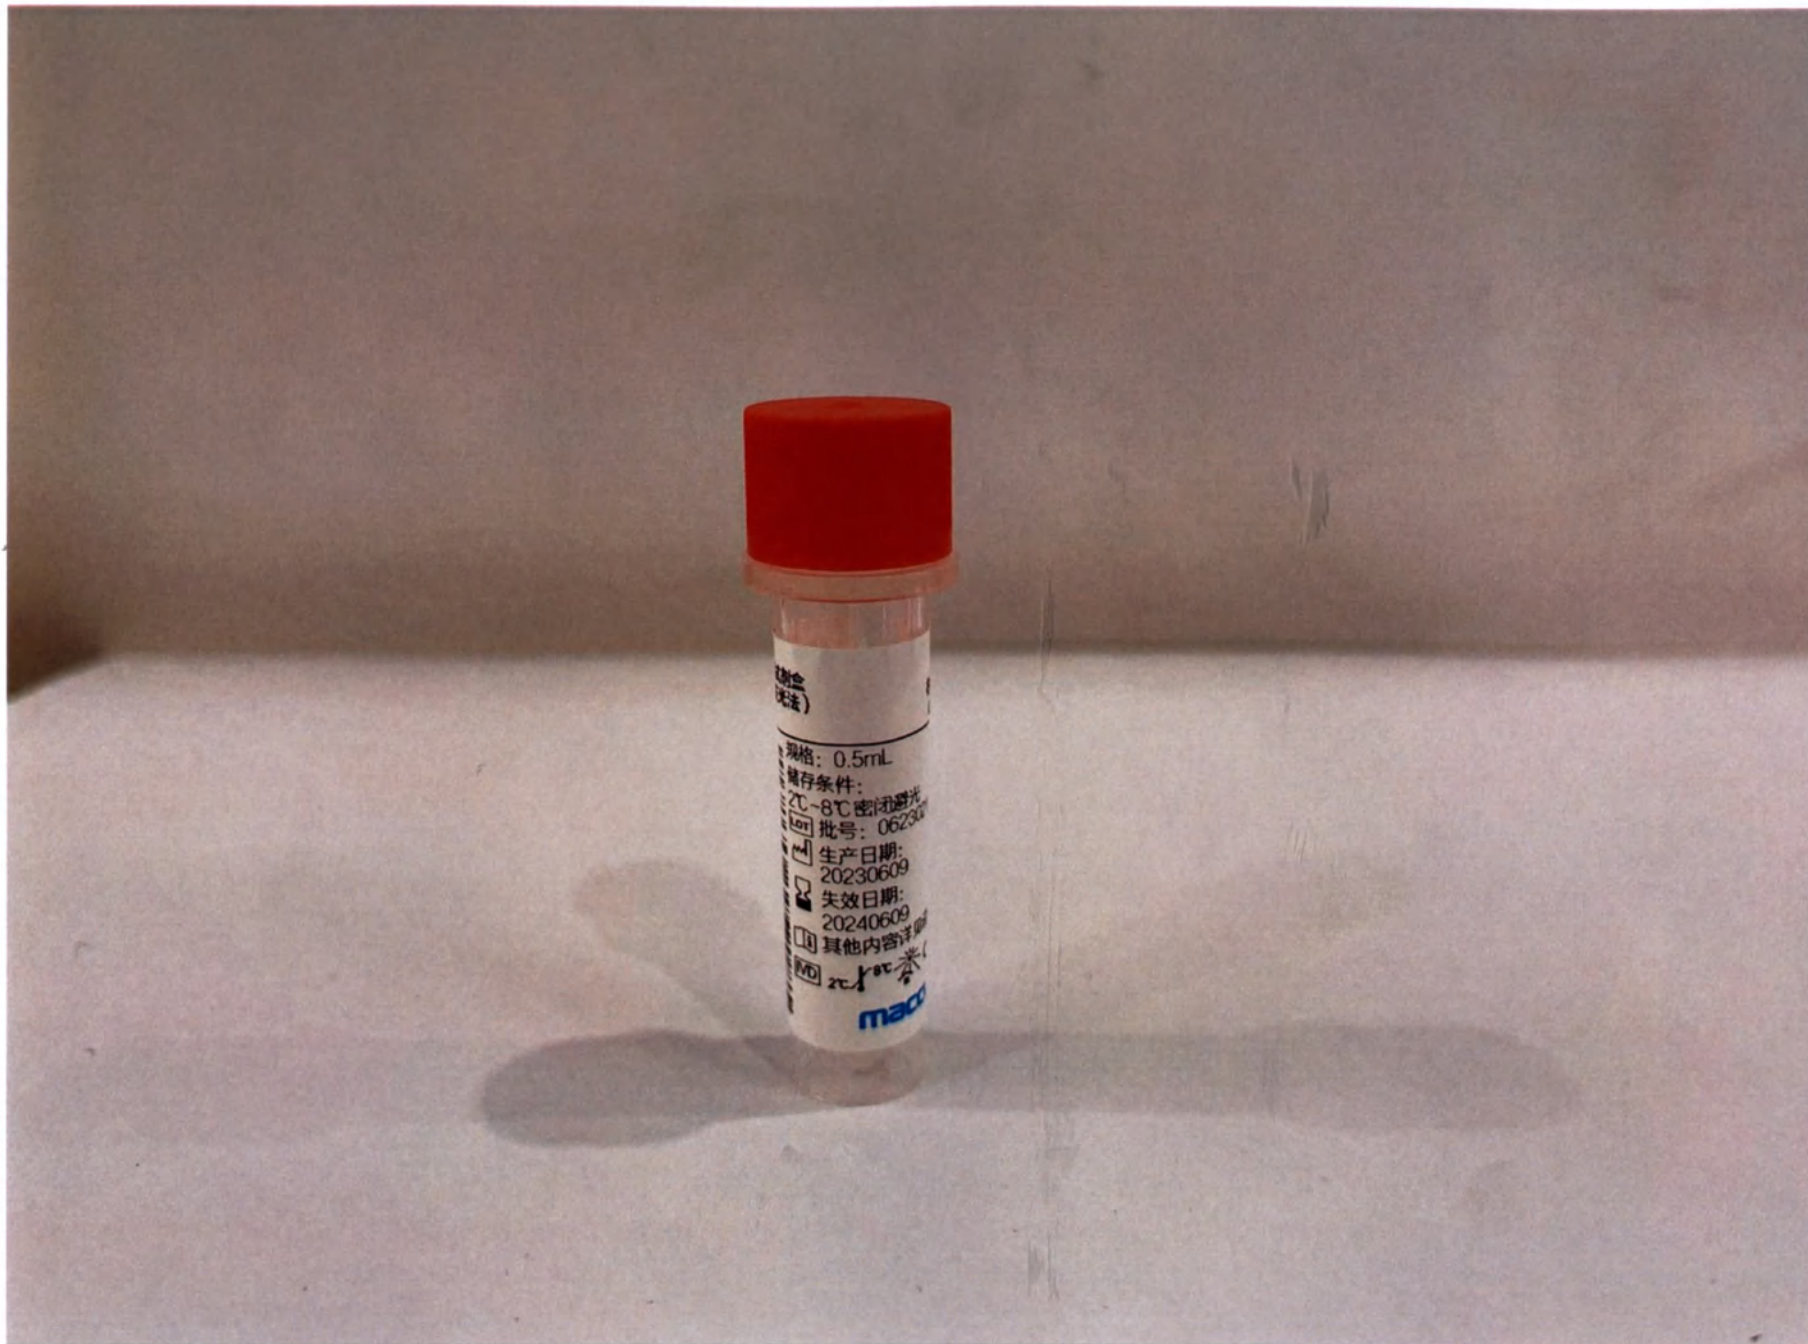

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

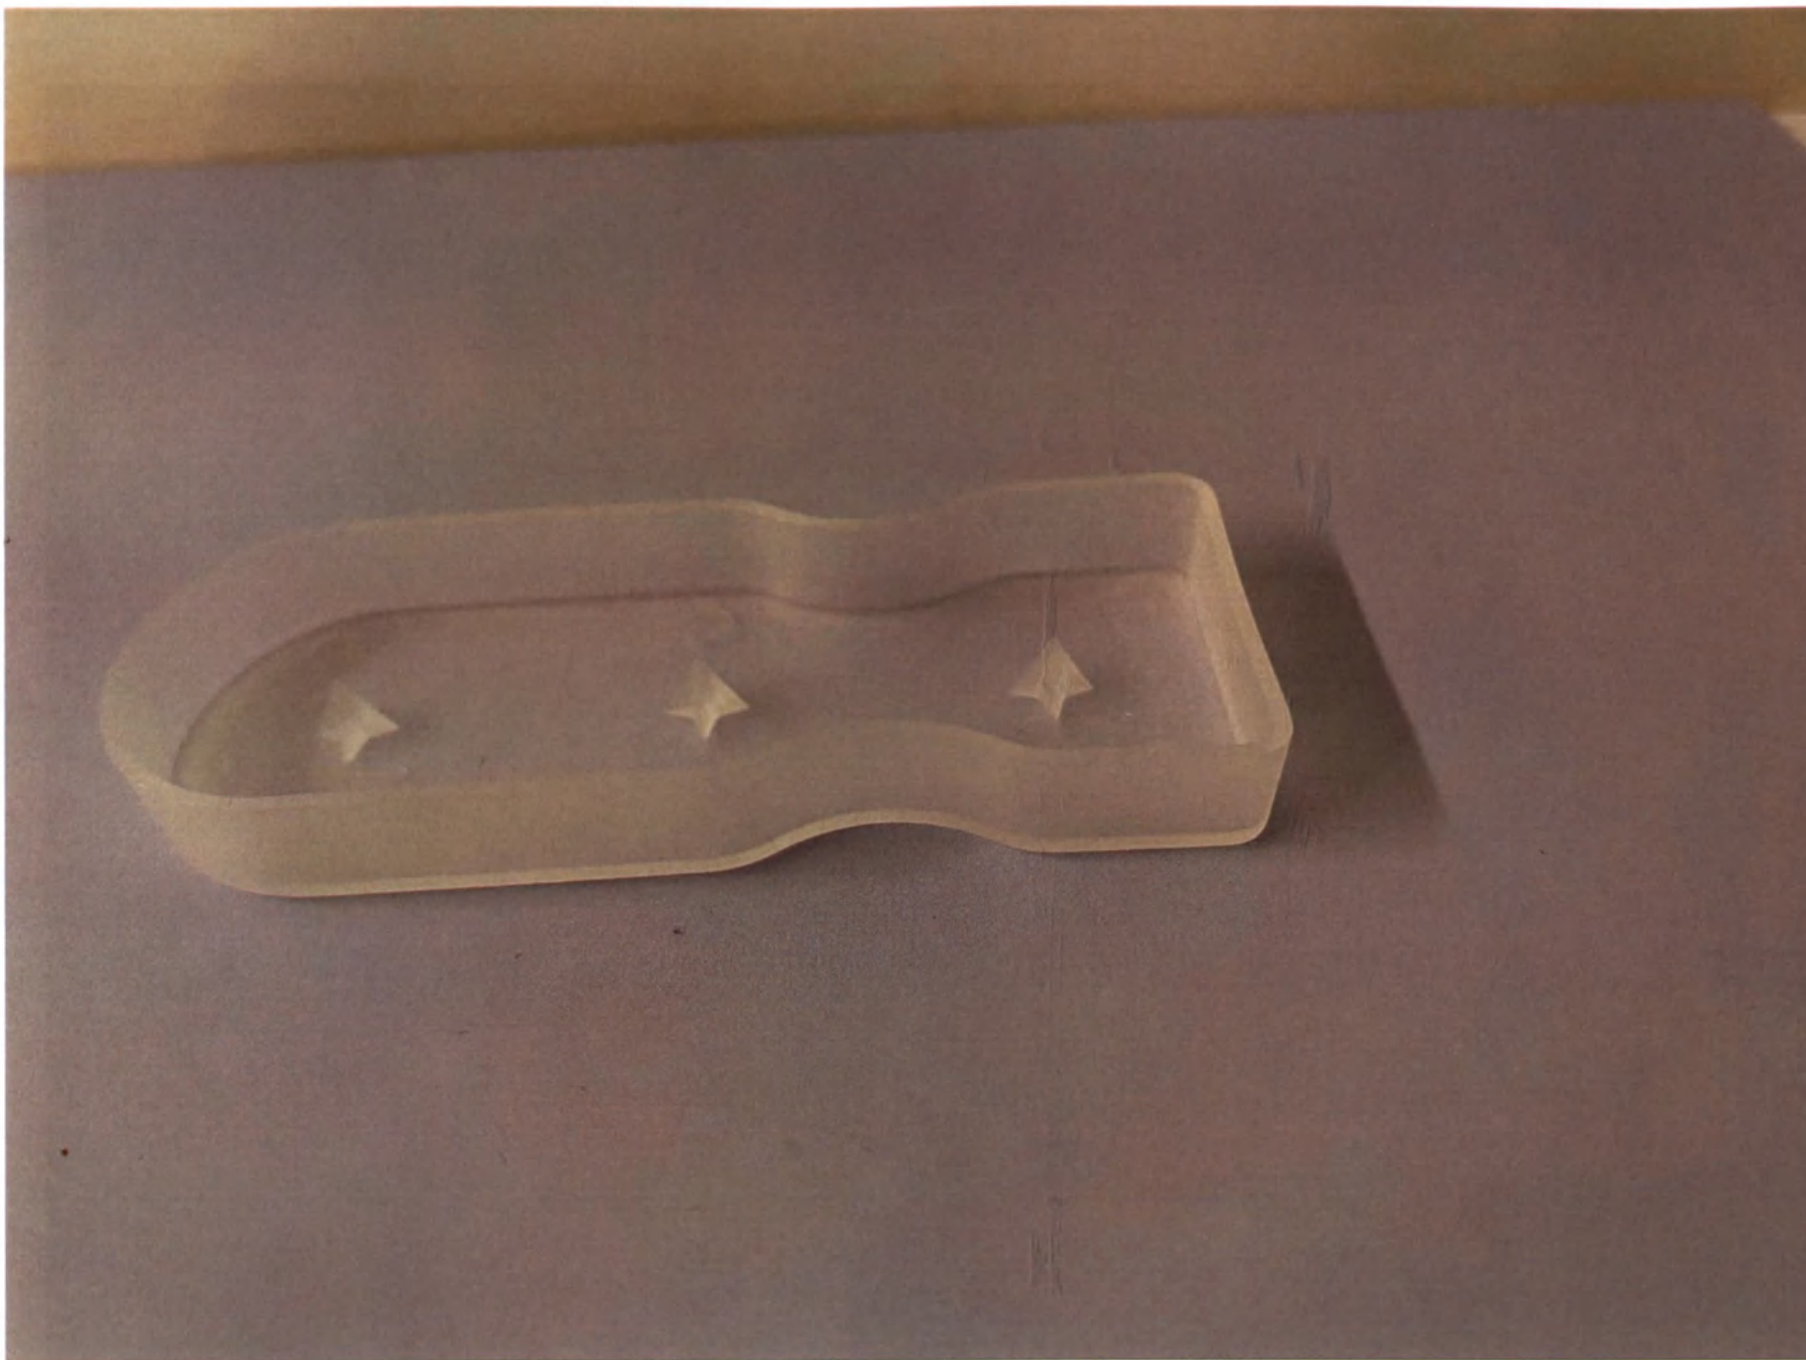

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (PRL (CLIA)), набор на 200 тестов»



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»