


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор контрольных материалов для контроля качества
определения антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке и
плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на
анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах
исполнения**

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan
Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**

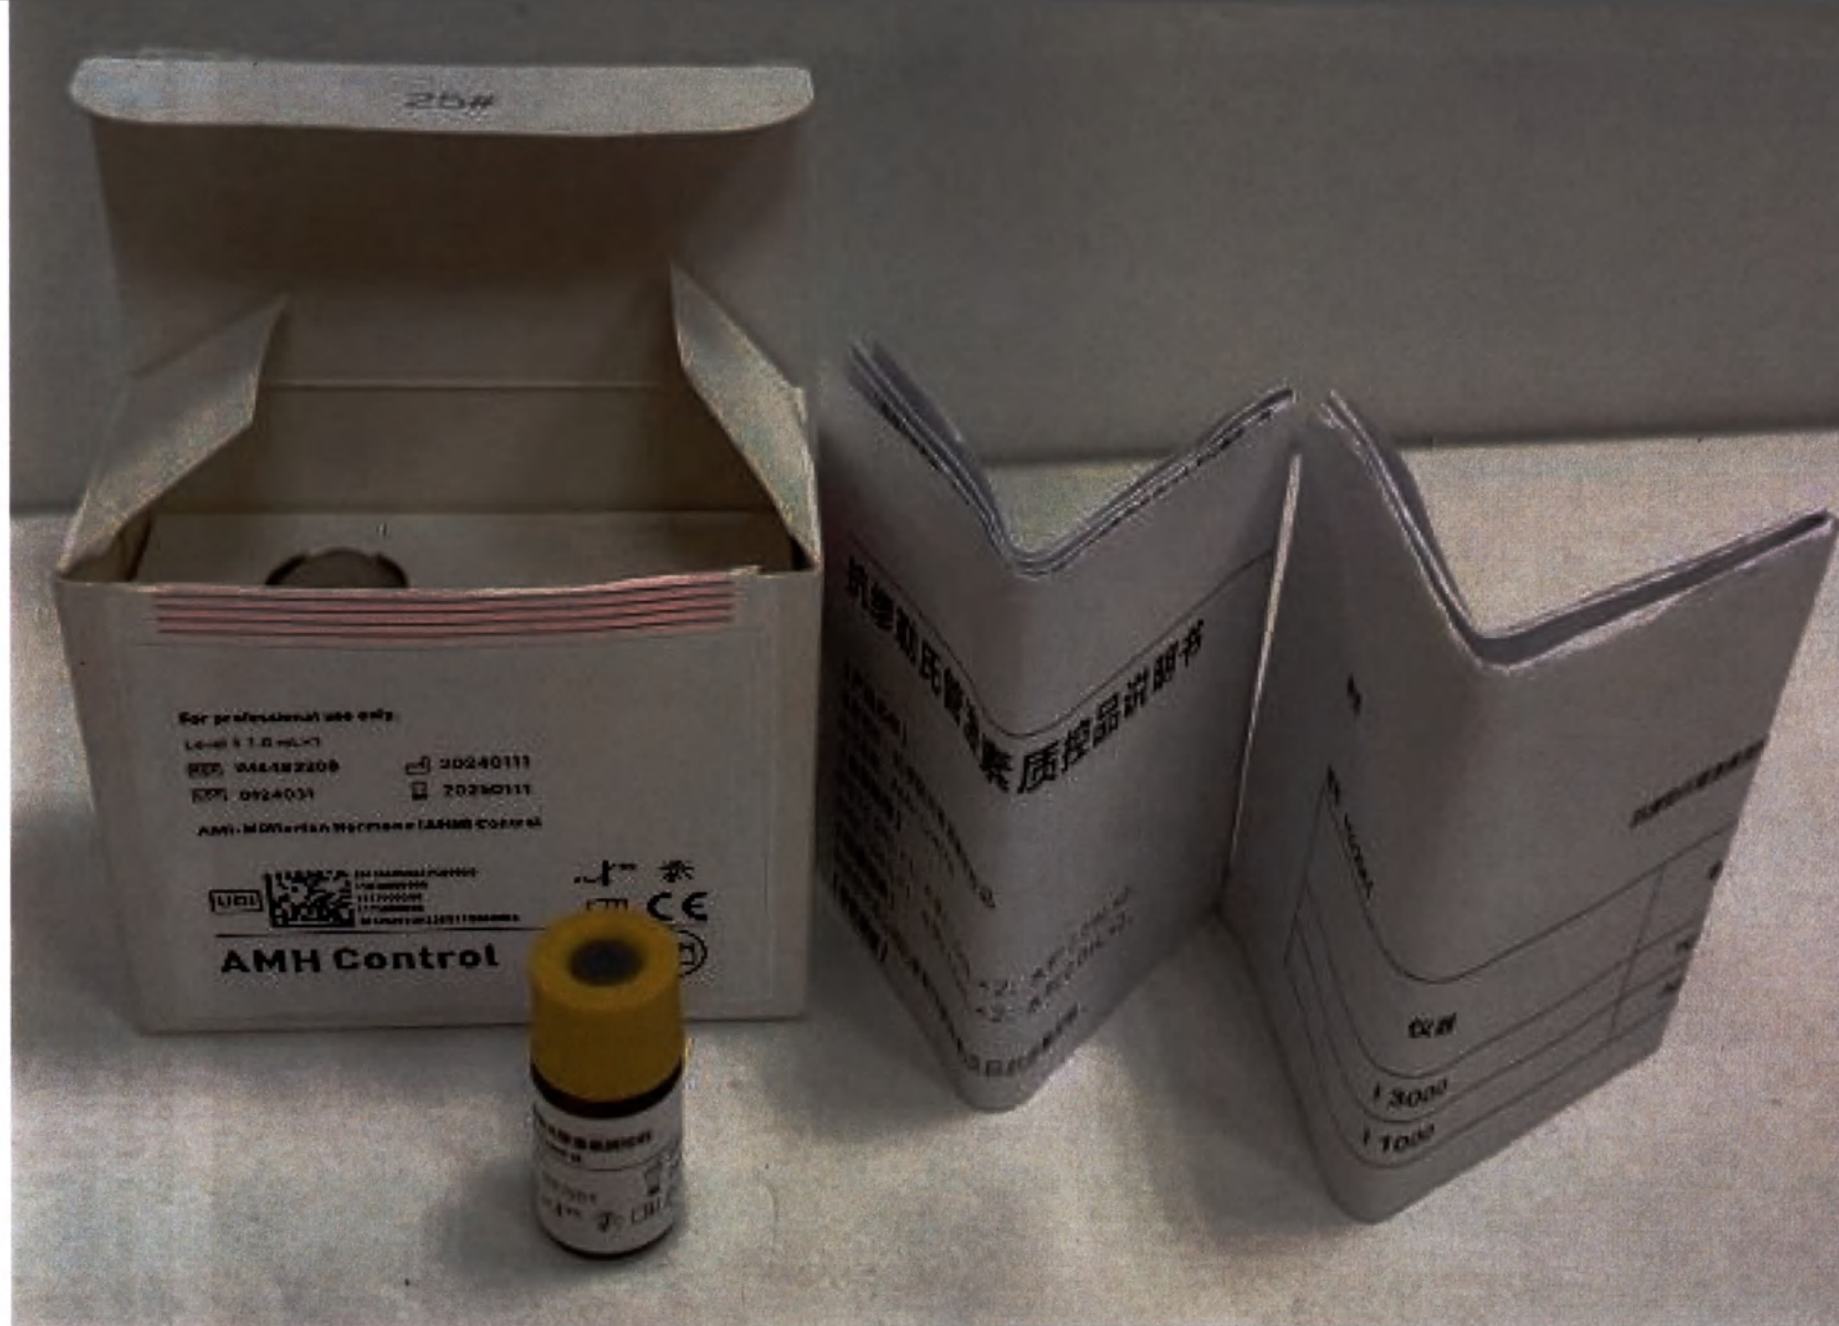

Общий вид медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллера гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (АМН Control), в вариантах исполнения:

Вариант 1»



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллера гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид спереди.



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллера гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (AMH Control), в вариантах исполнения» - вид сбоку.

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: +86 28 8782 6777

传真: +86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.

Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731

Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллера гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах исполнения» - вид сзади

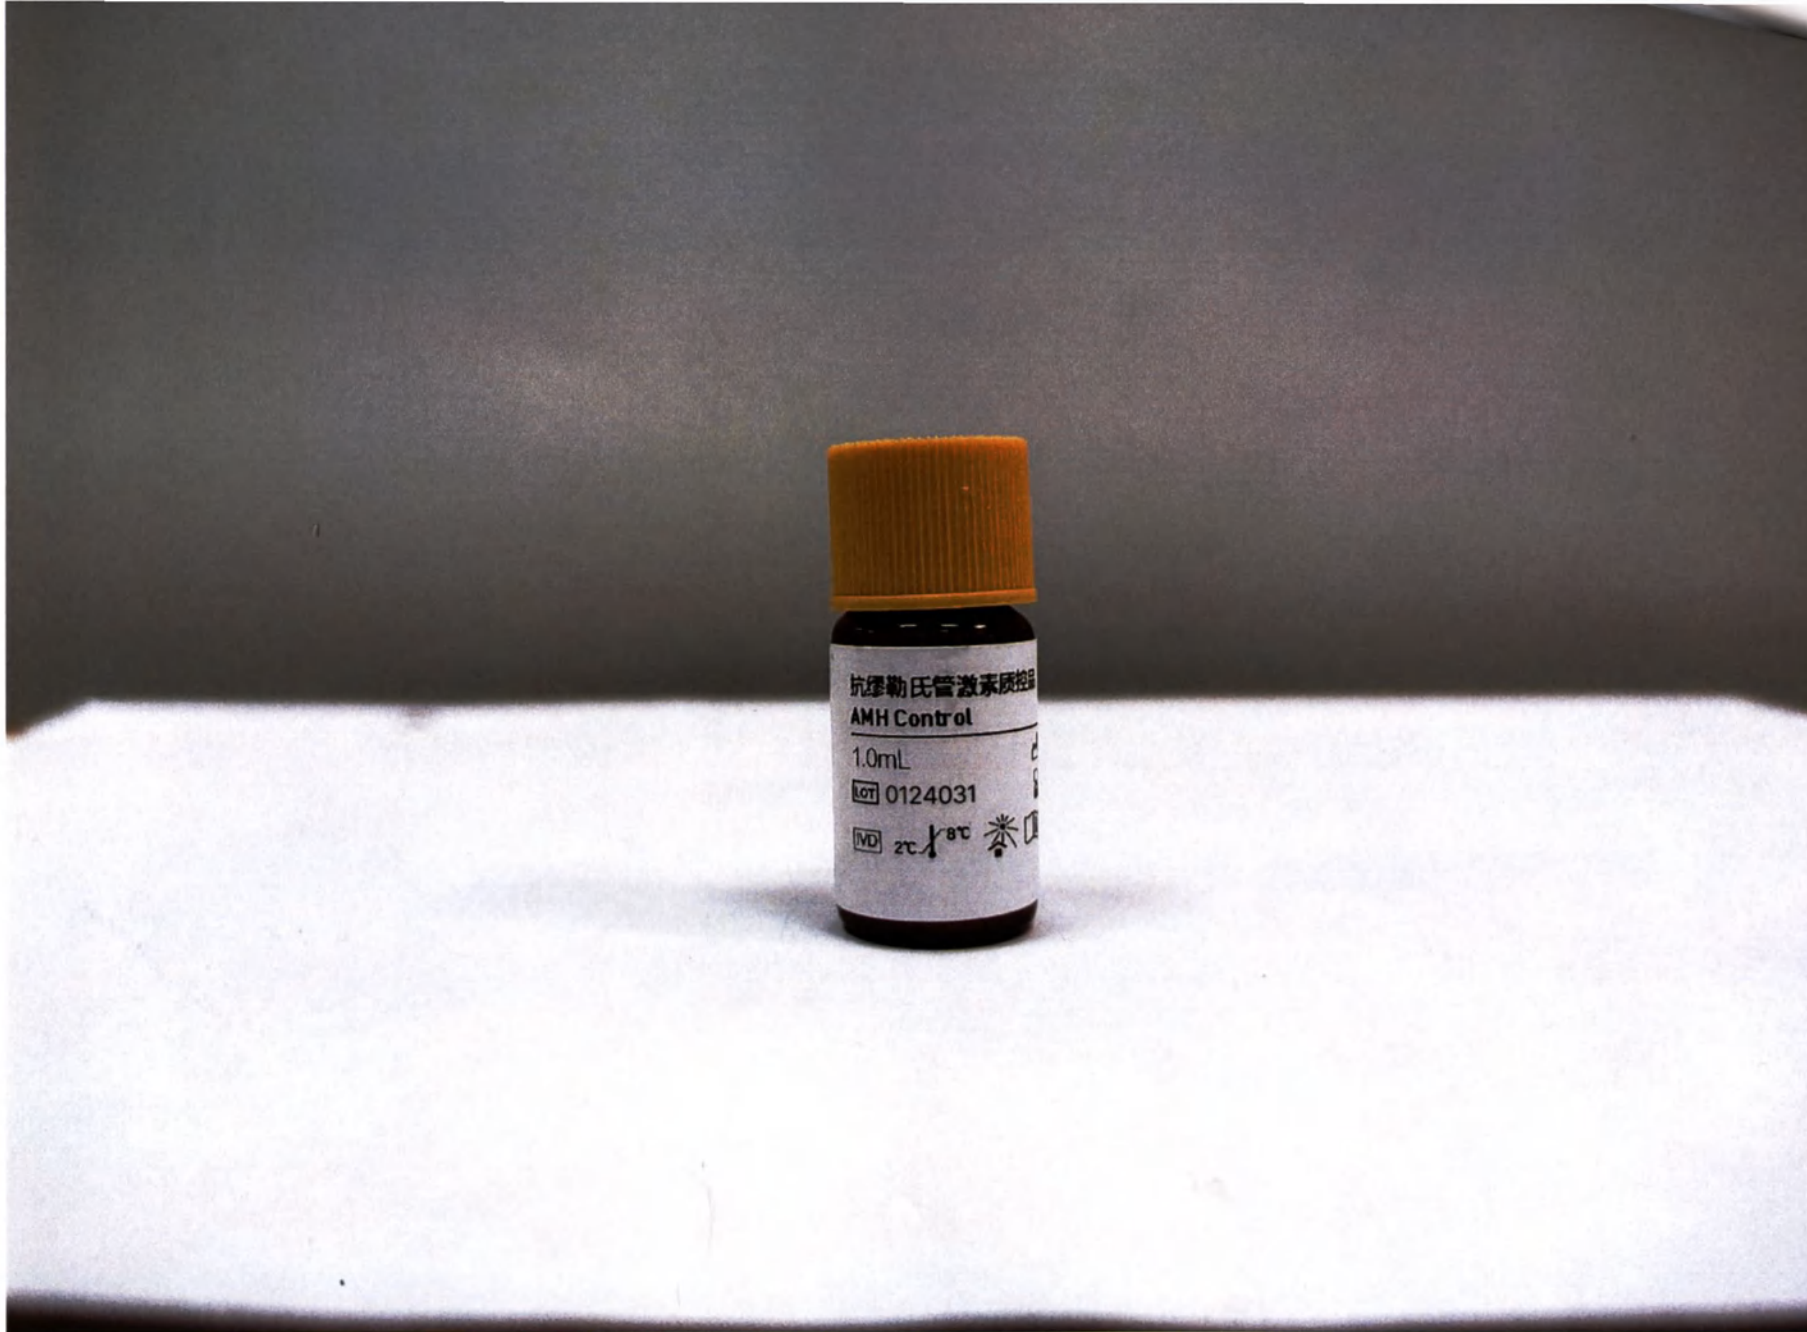


Флакон содержащий «Материал контрольный 1 (AMH Control - Level 1)» - сторона 1.

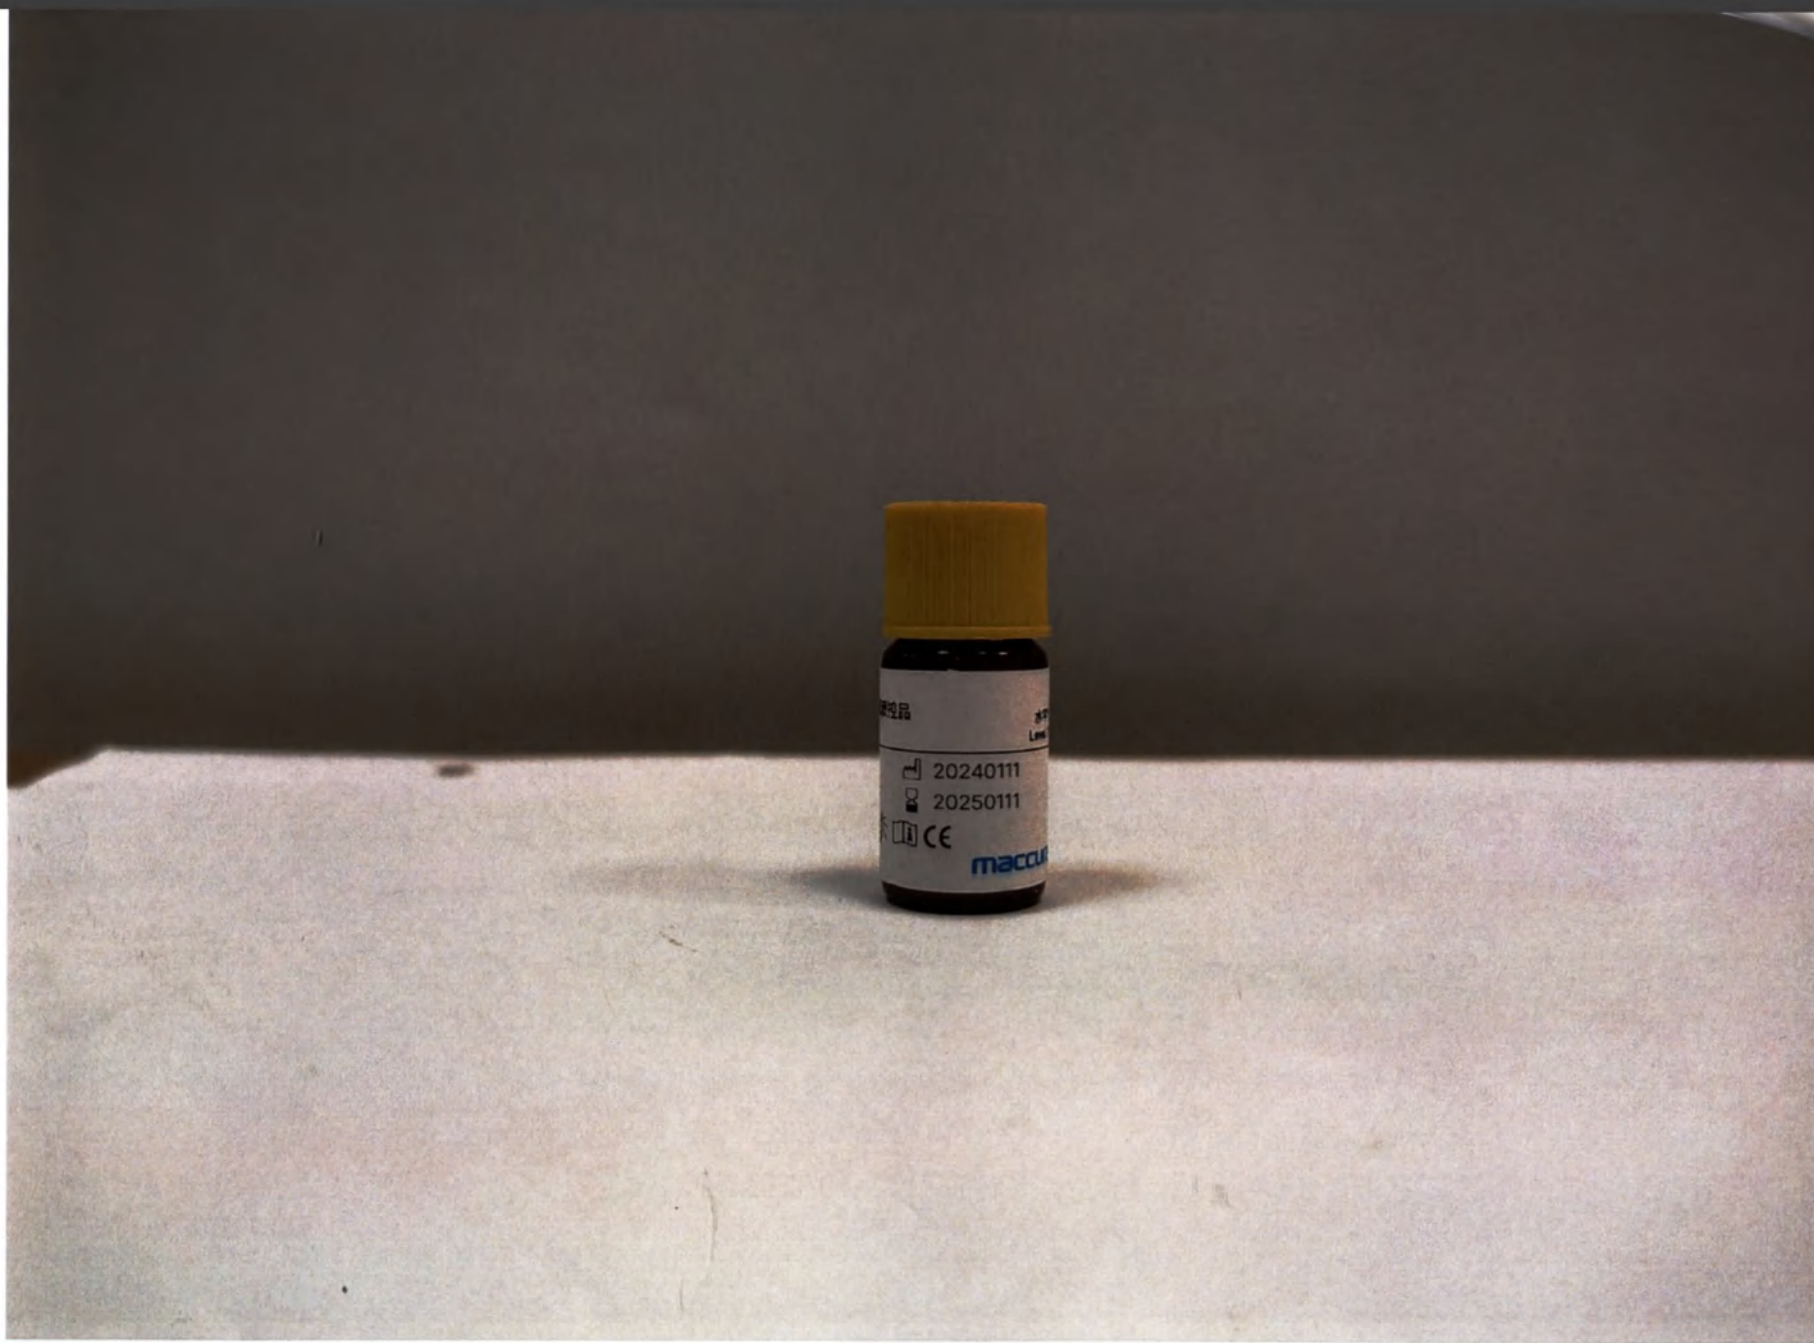

Флакон содержащий «Материал контрольный 1 (AMH Control - Level 1)» - сторона 2.

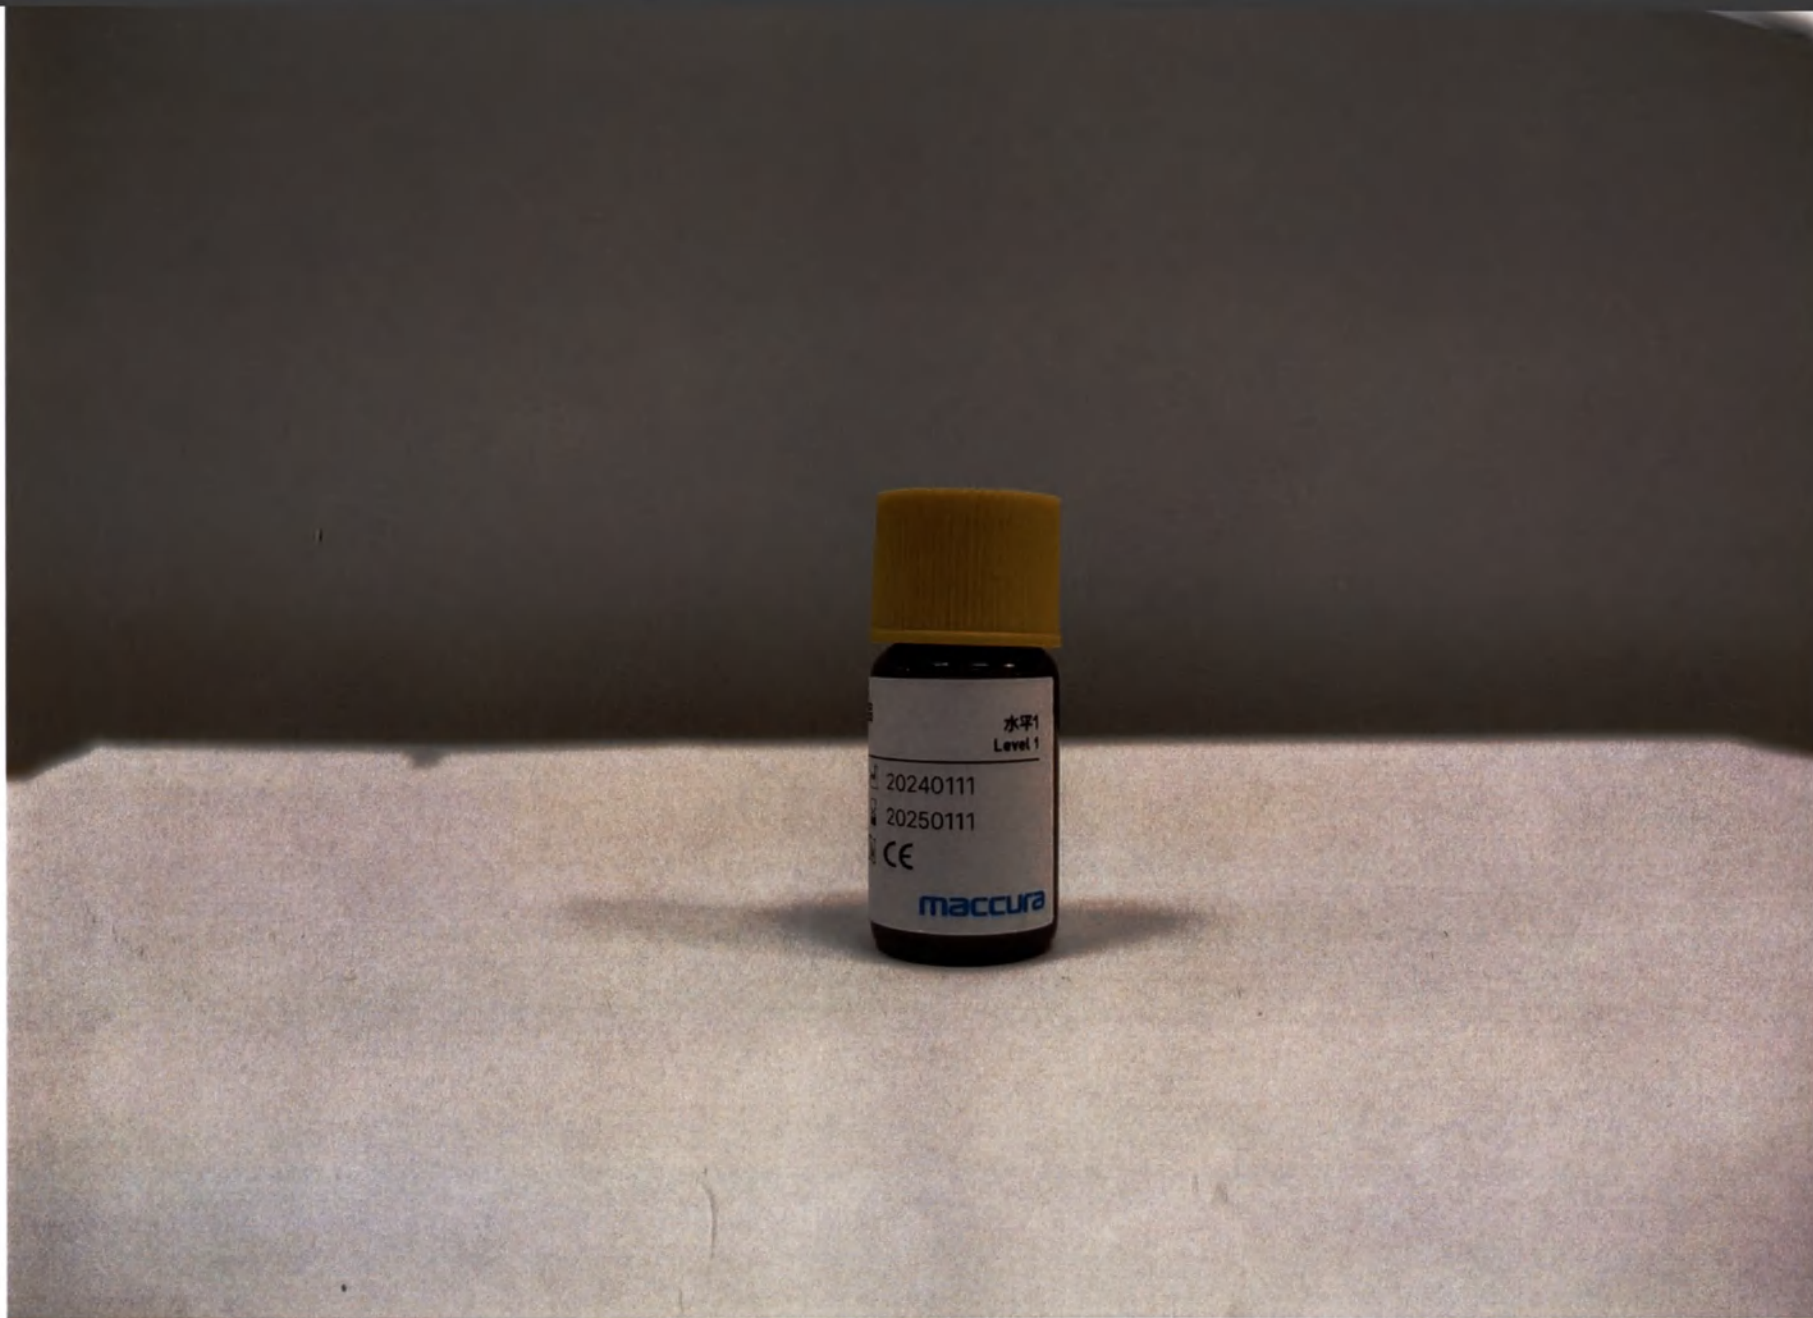

Флакон содержащий «Материал контрольный 1 (AMH Control - Level 1)» - сторона 3.

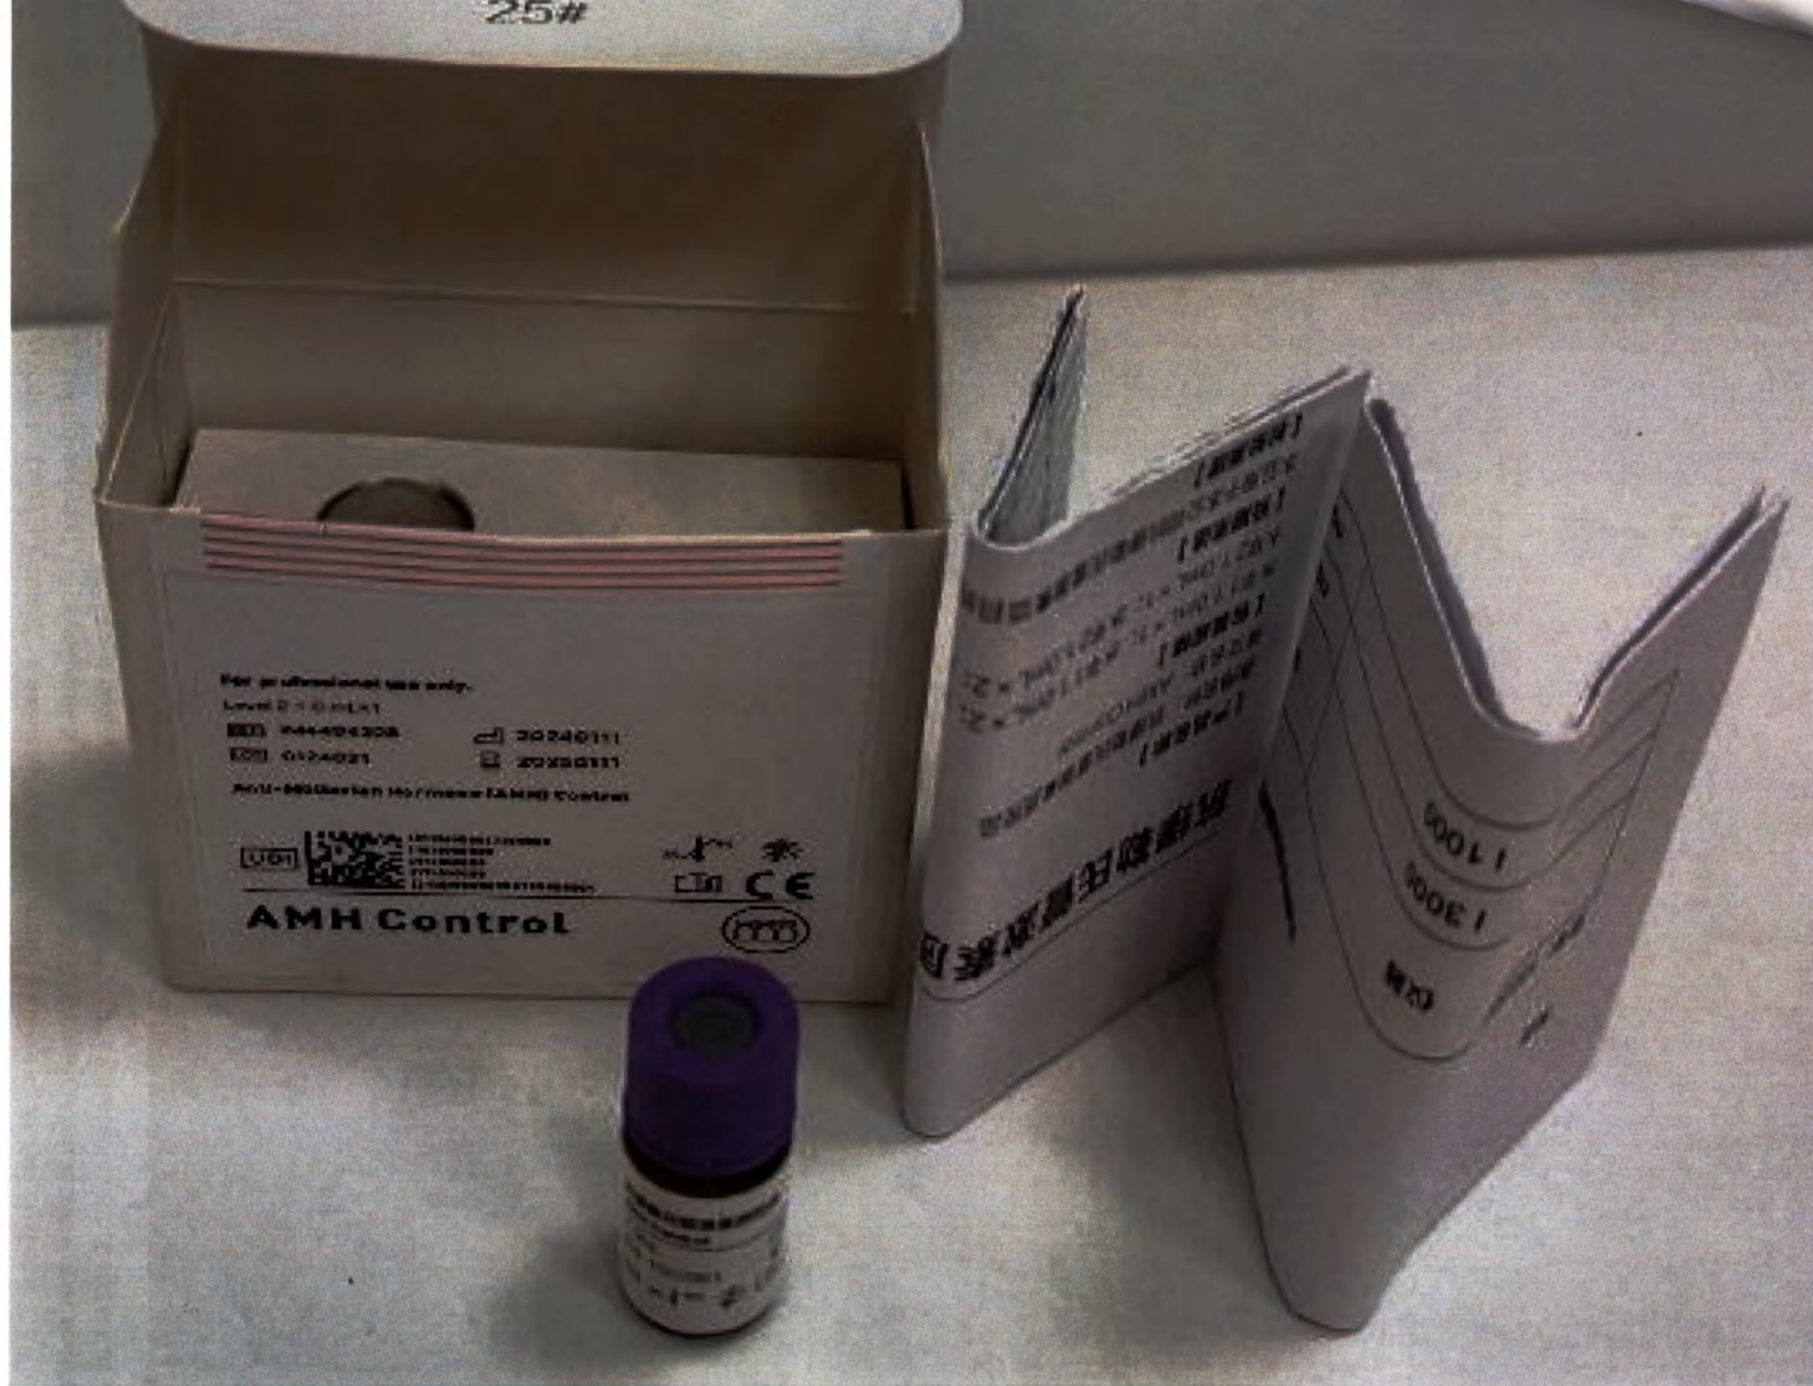

Level 2 1.0 mL × 1

REF IM4494208

 20240111

LOT 0124031

 20250111

**Anti-Müllerian Hormone
(AMH) Control**

UDI




(01) 0000000000000000
(10) 000000
(11) 000000
(17) 000000
(21) 000000000000000000




AMH Control



оричная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллера гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид спереди.

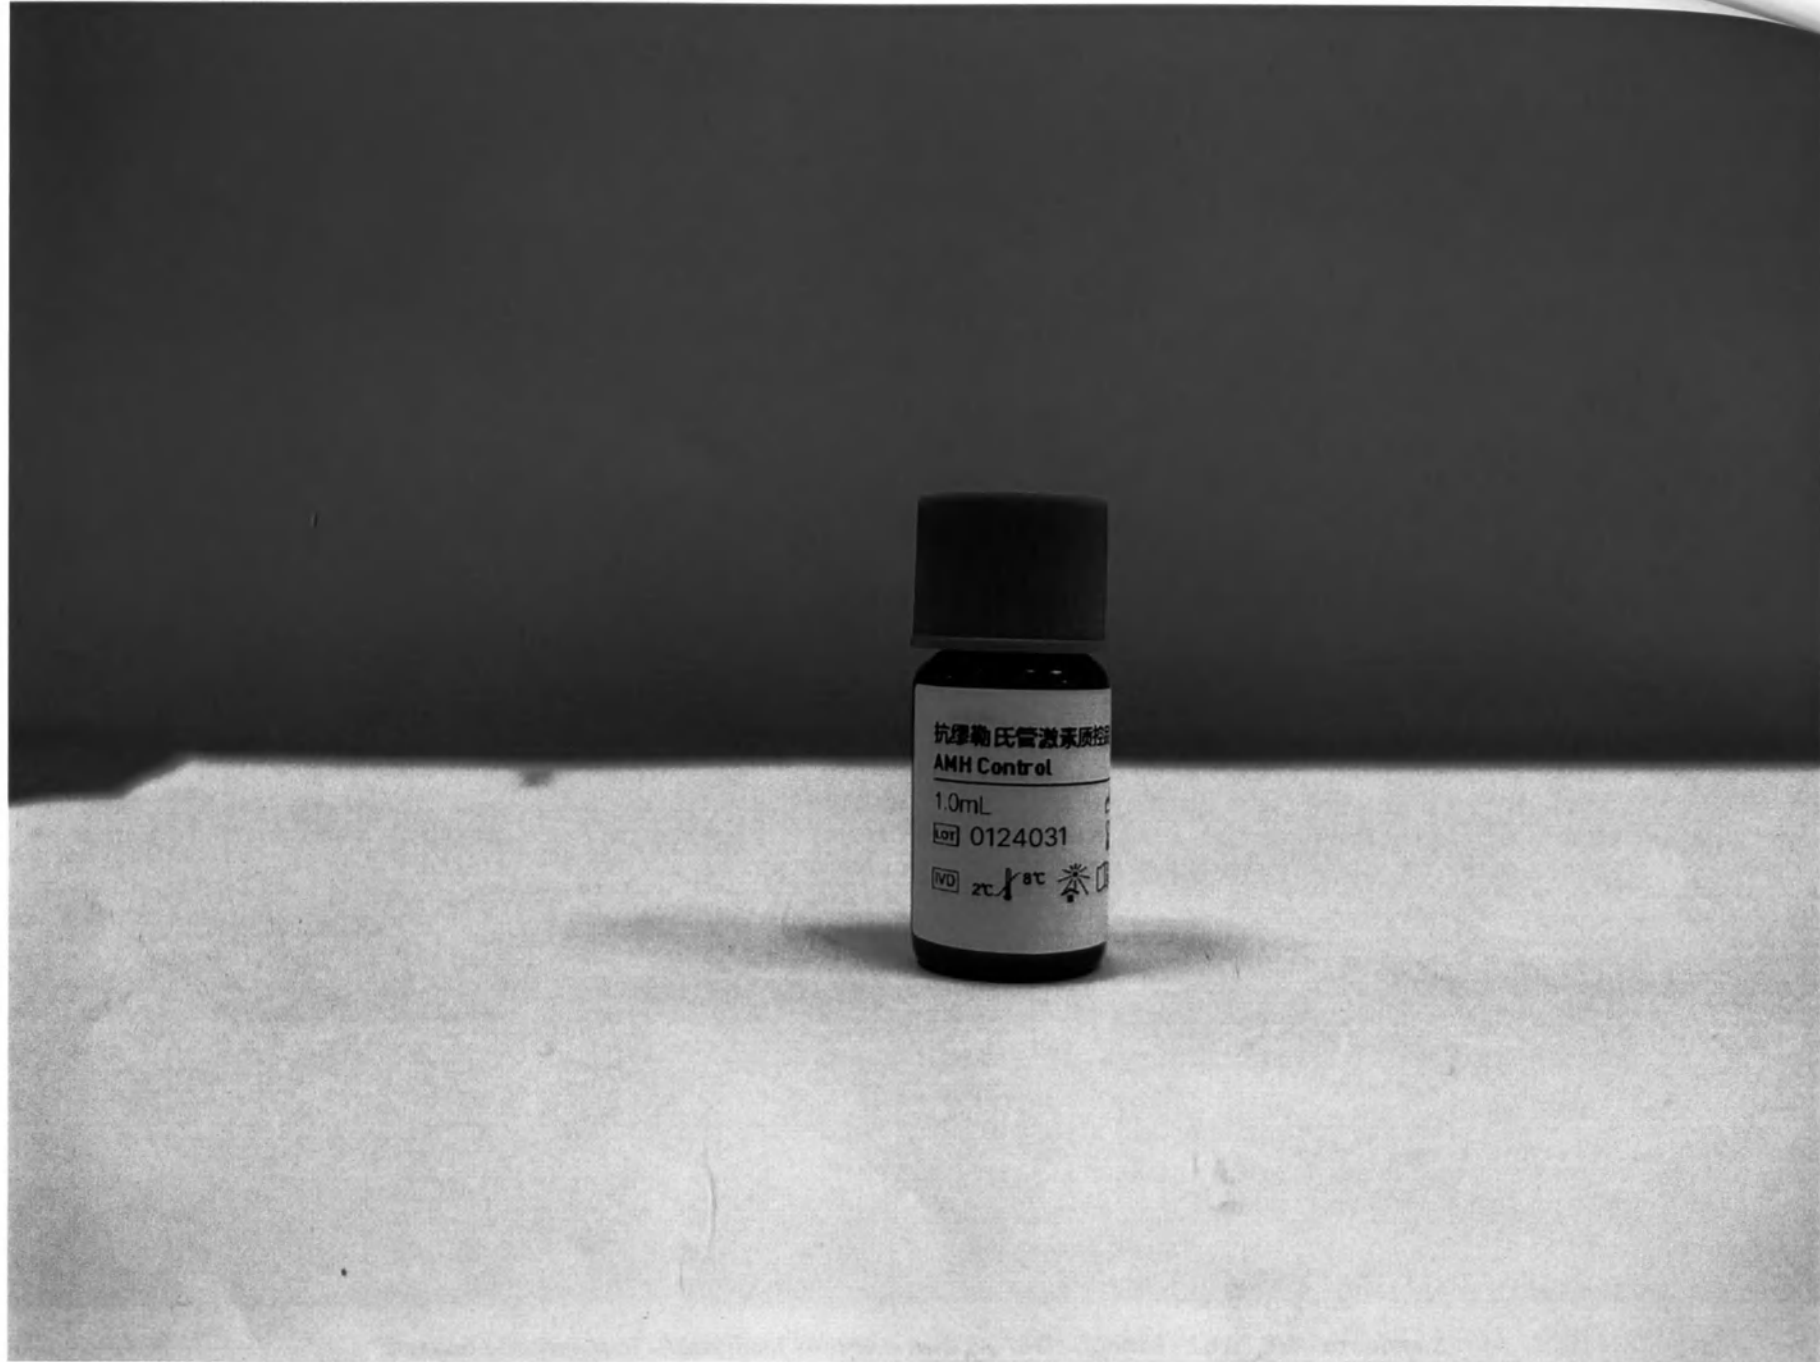

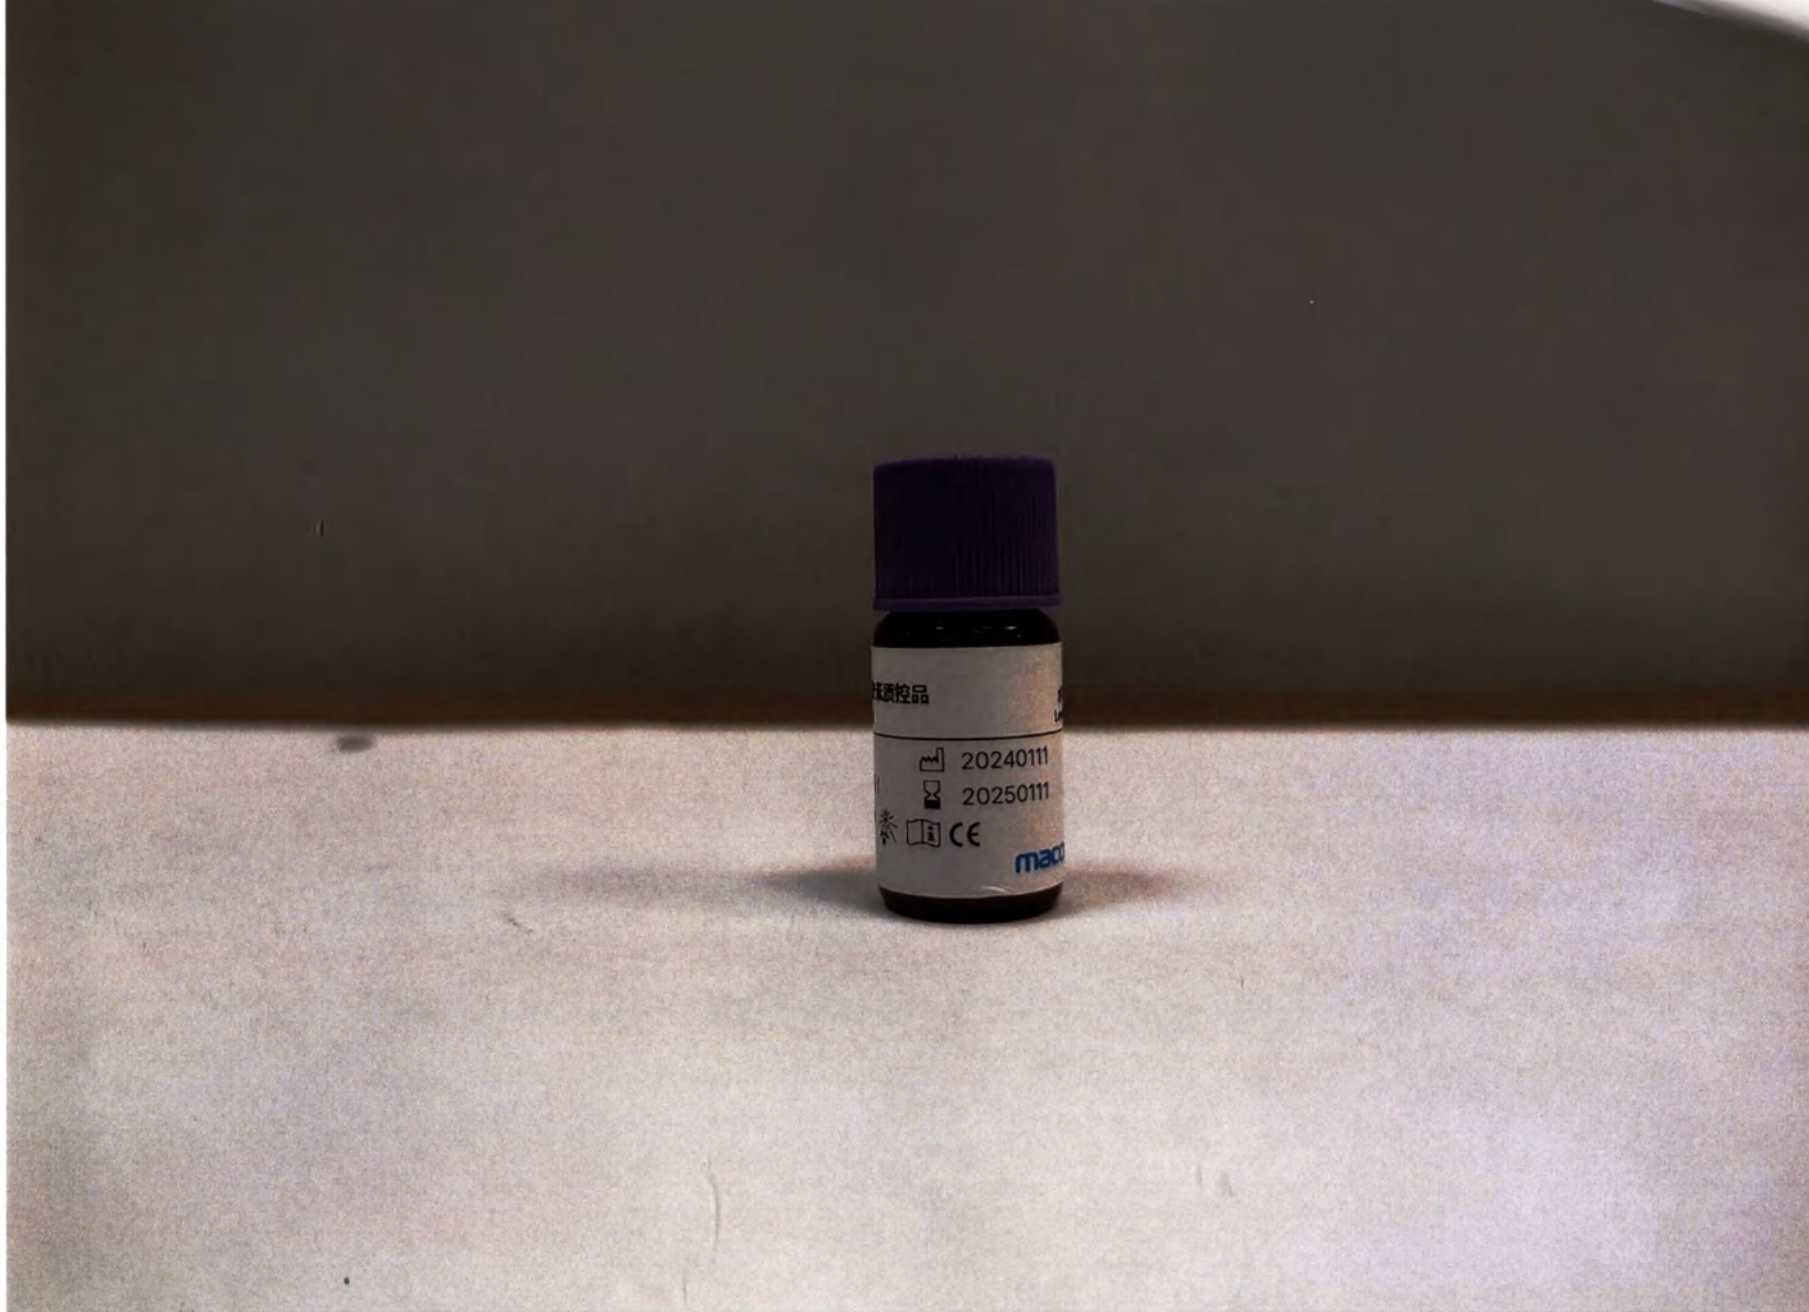

Флакон содержащий «Материал контрольный 1 (AMH Control - Level 2)» - сторона 2.



Флакон содержащий «Материал контрольный 1 (AMH Control - Level 2)» - сторона 3.



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 14 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эволам»

