

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на
анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов**

производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road, Hi-tech
Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: +86 28 8782 6777

传真: +86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.


Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»

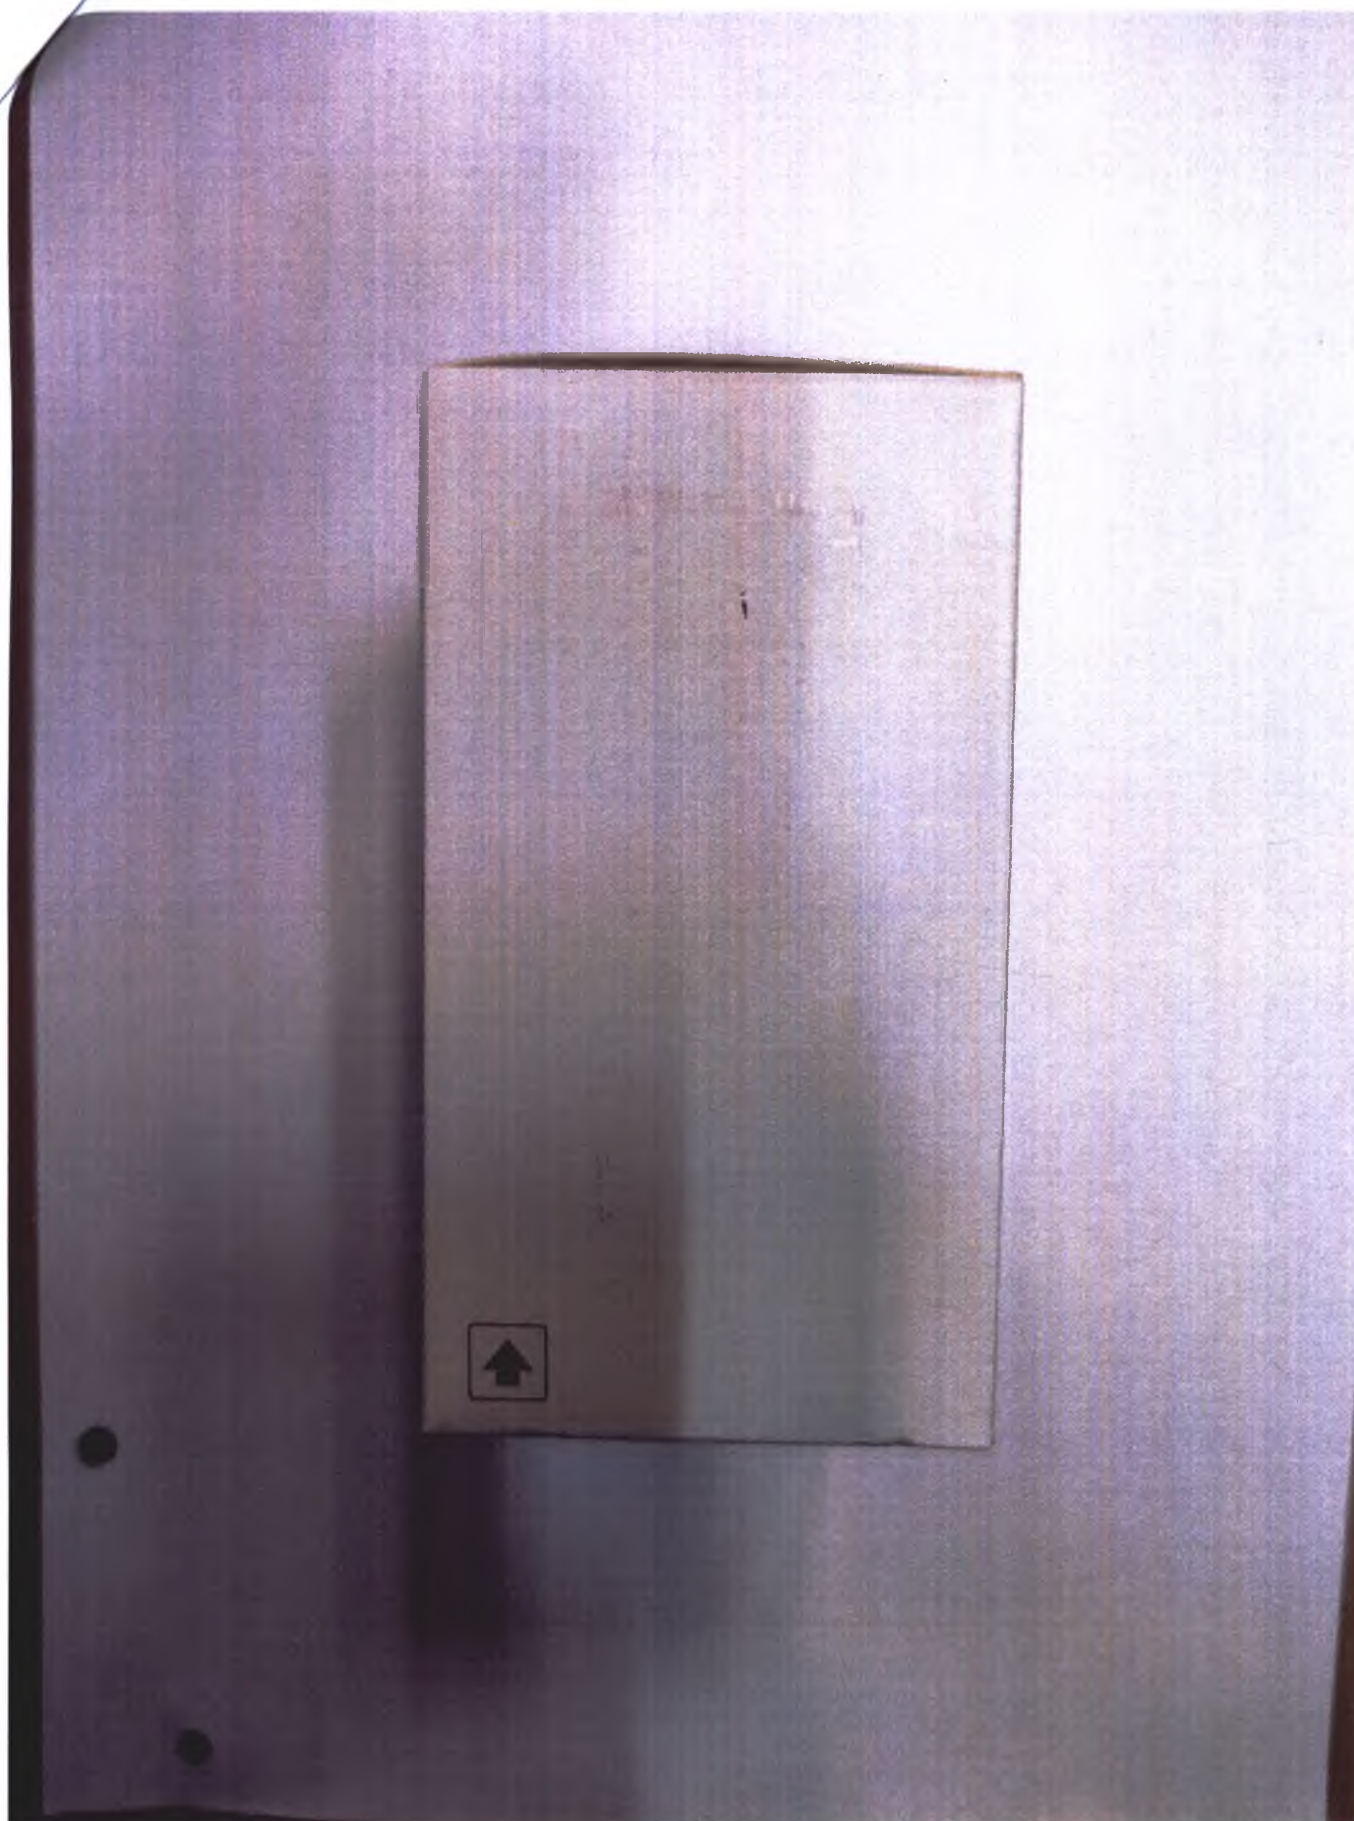


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»

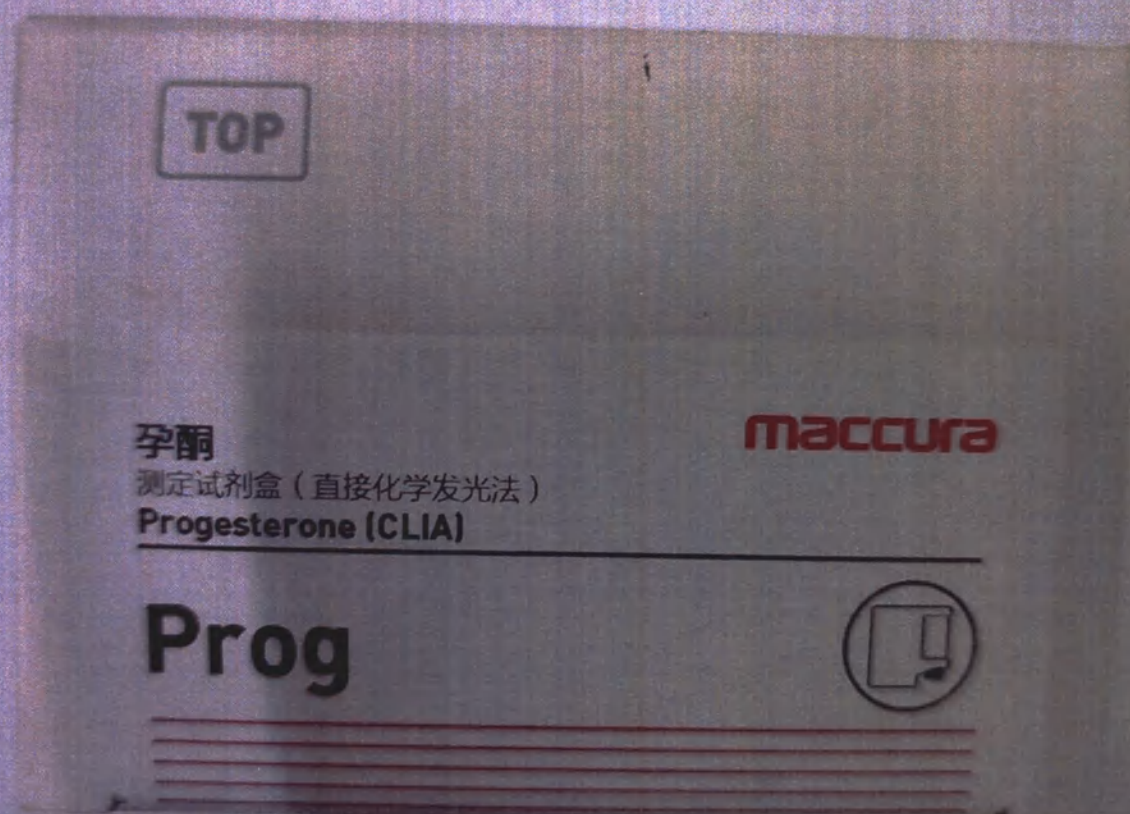


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»

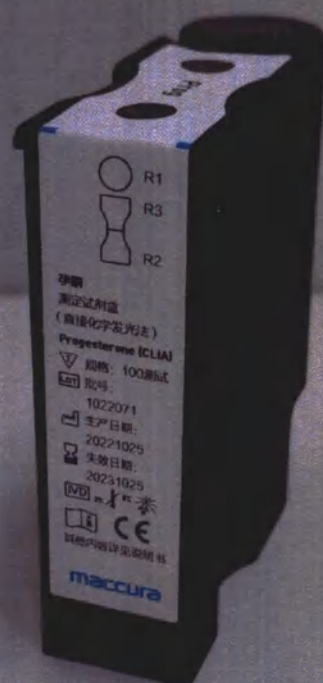


Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2, R3 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»

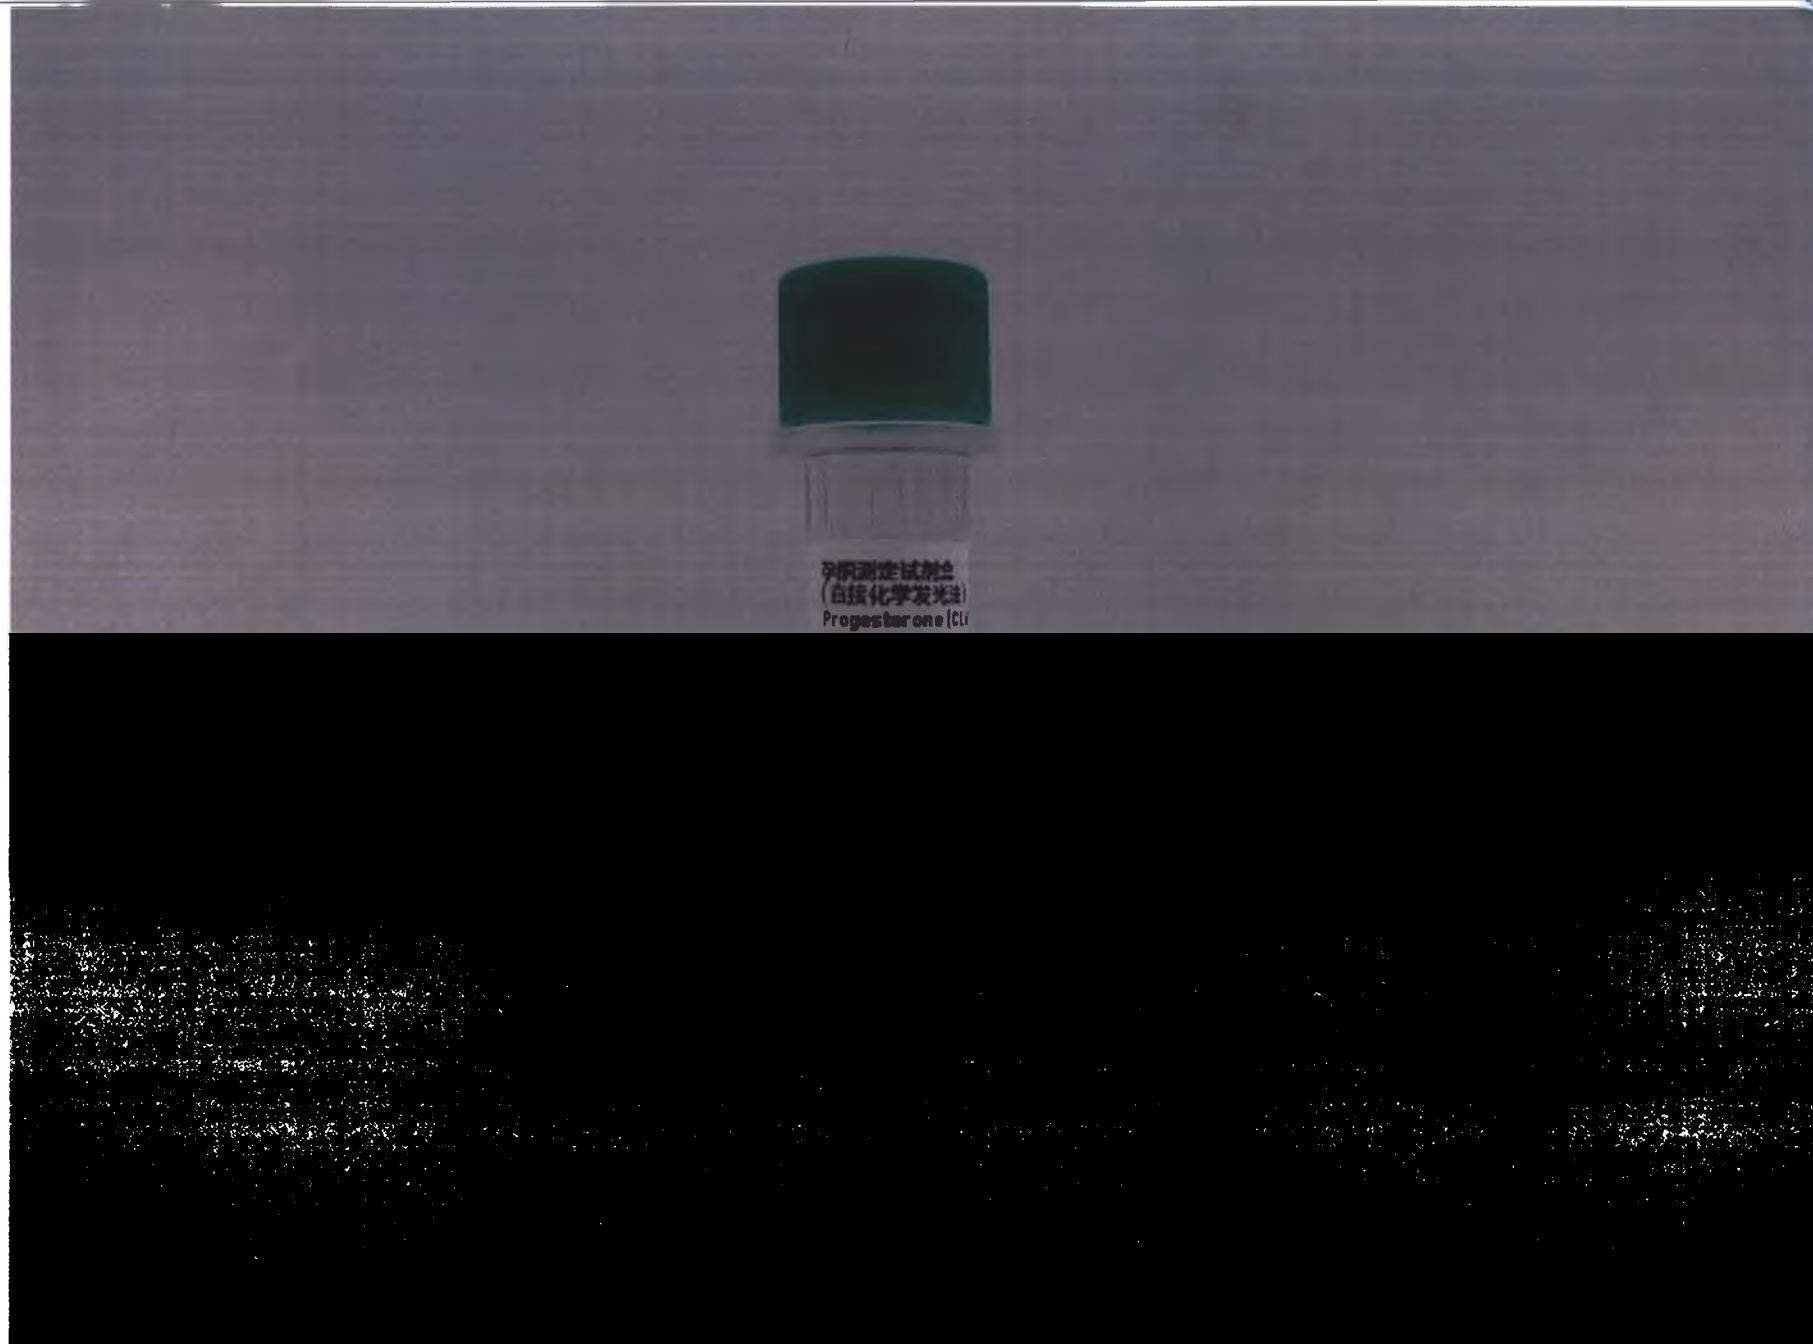

Внешний вид флакона Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1




Внешний вид флакона Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

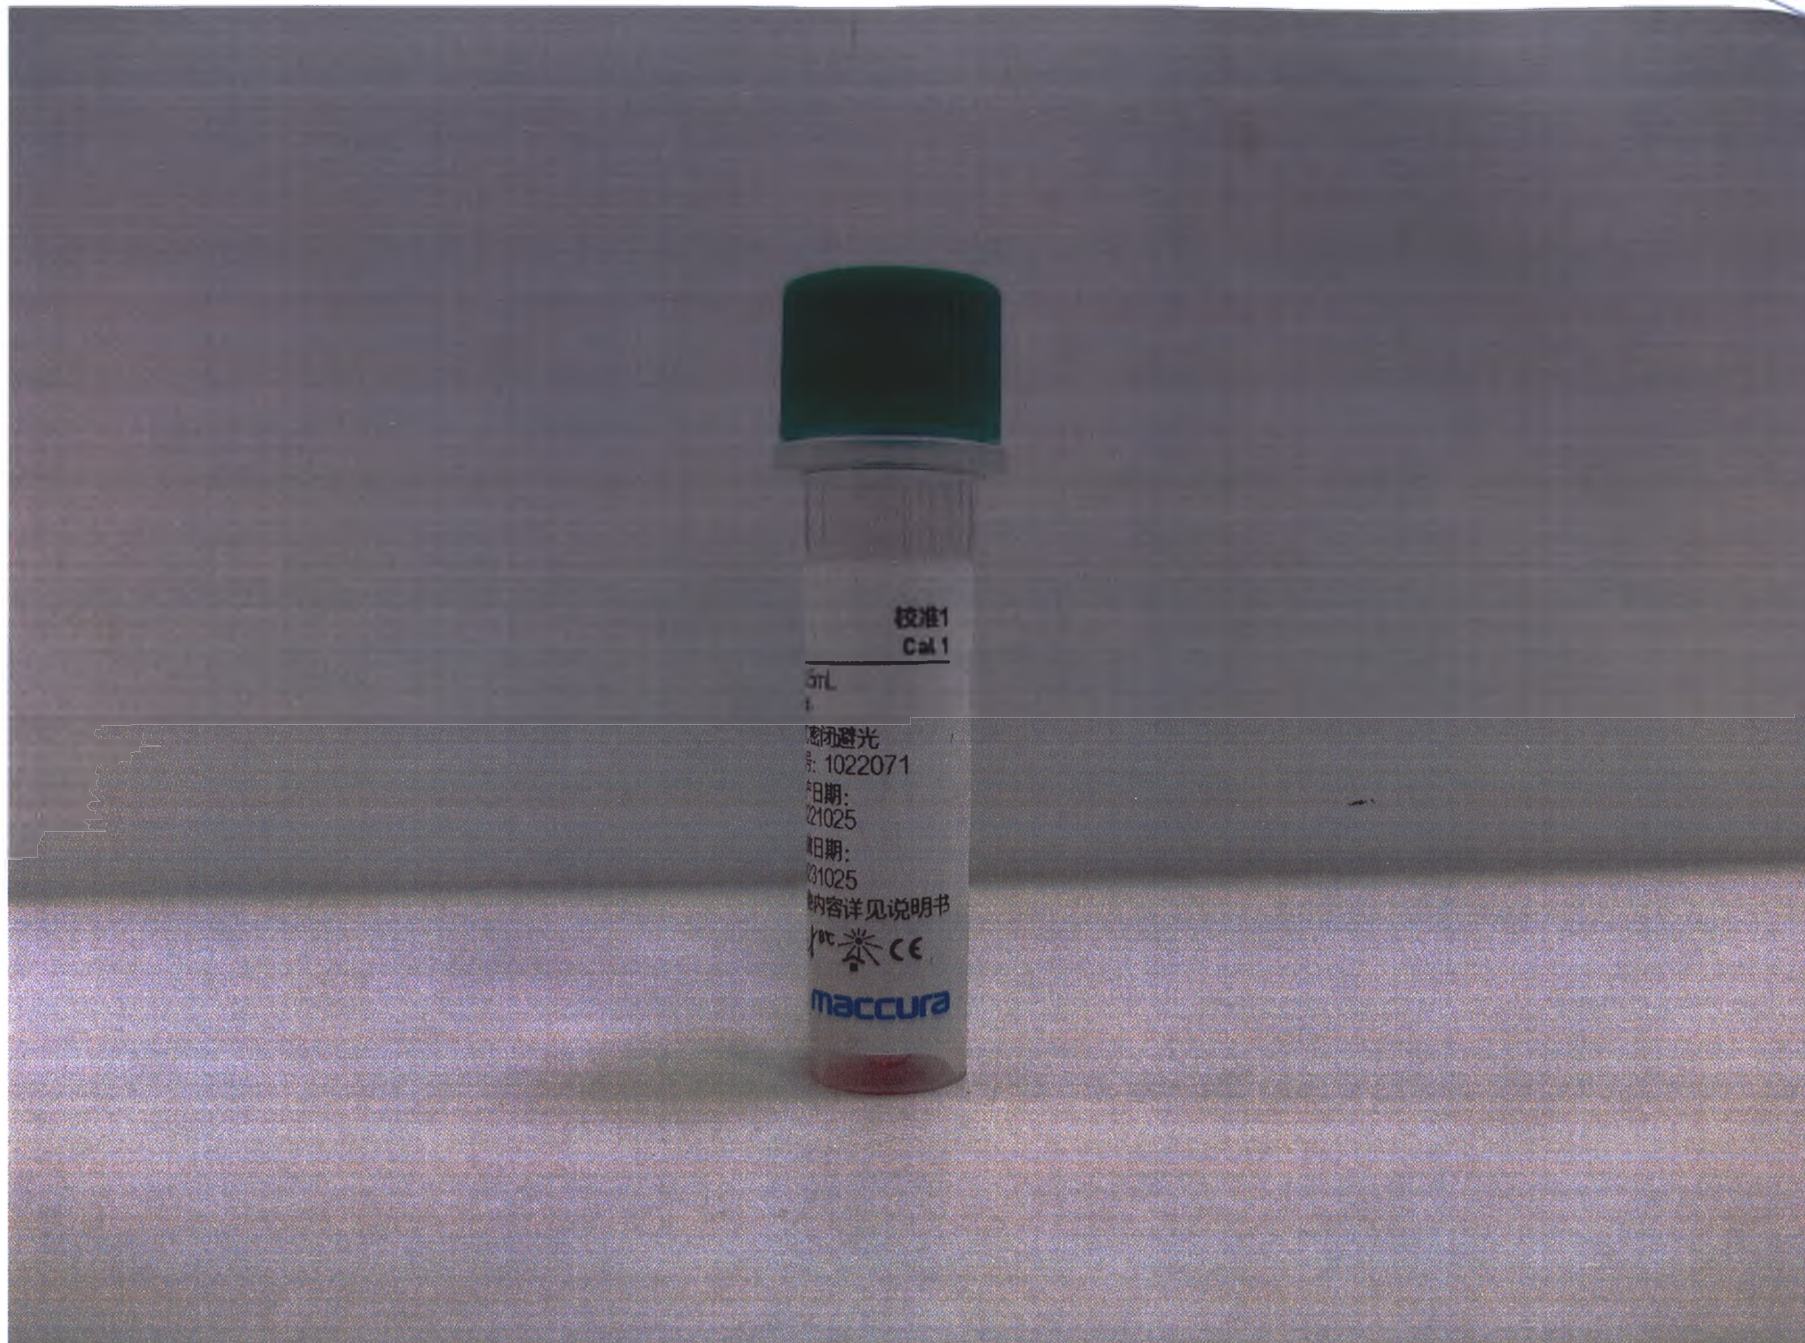


Внешний вид флакона Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3




Внешний вид флакона Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

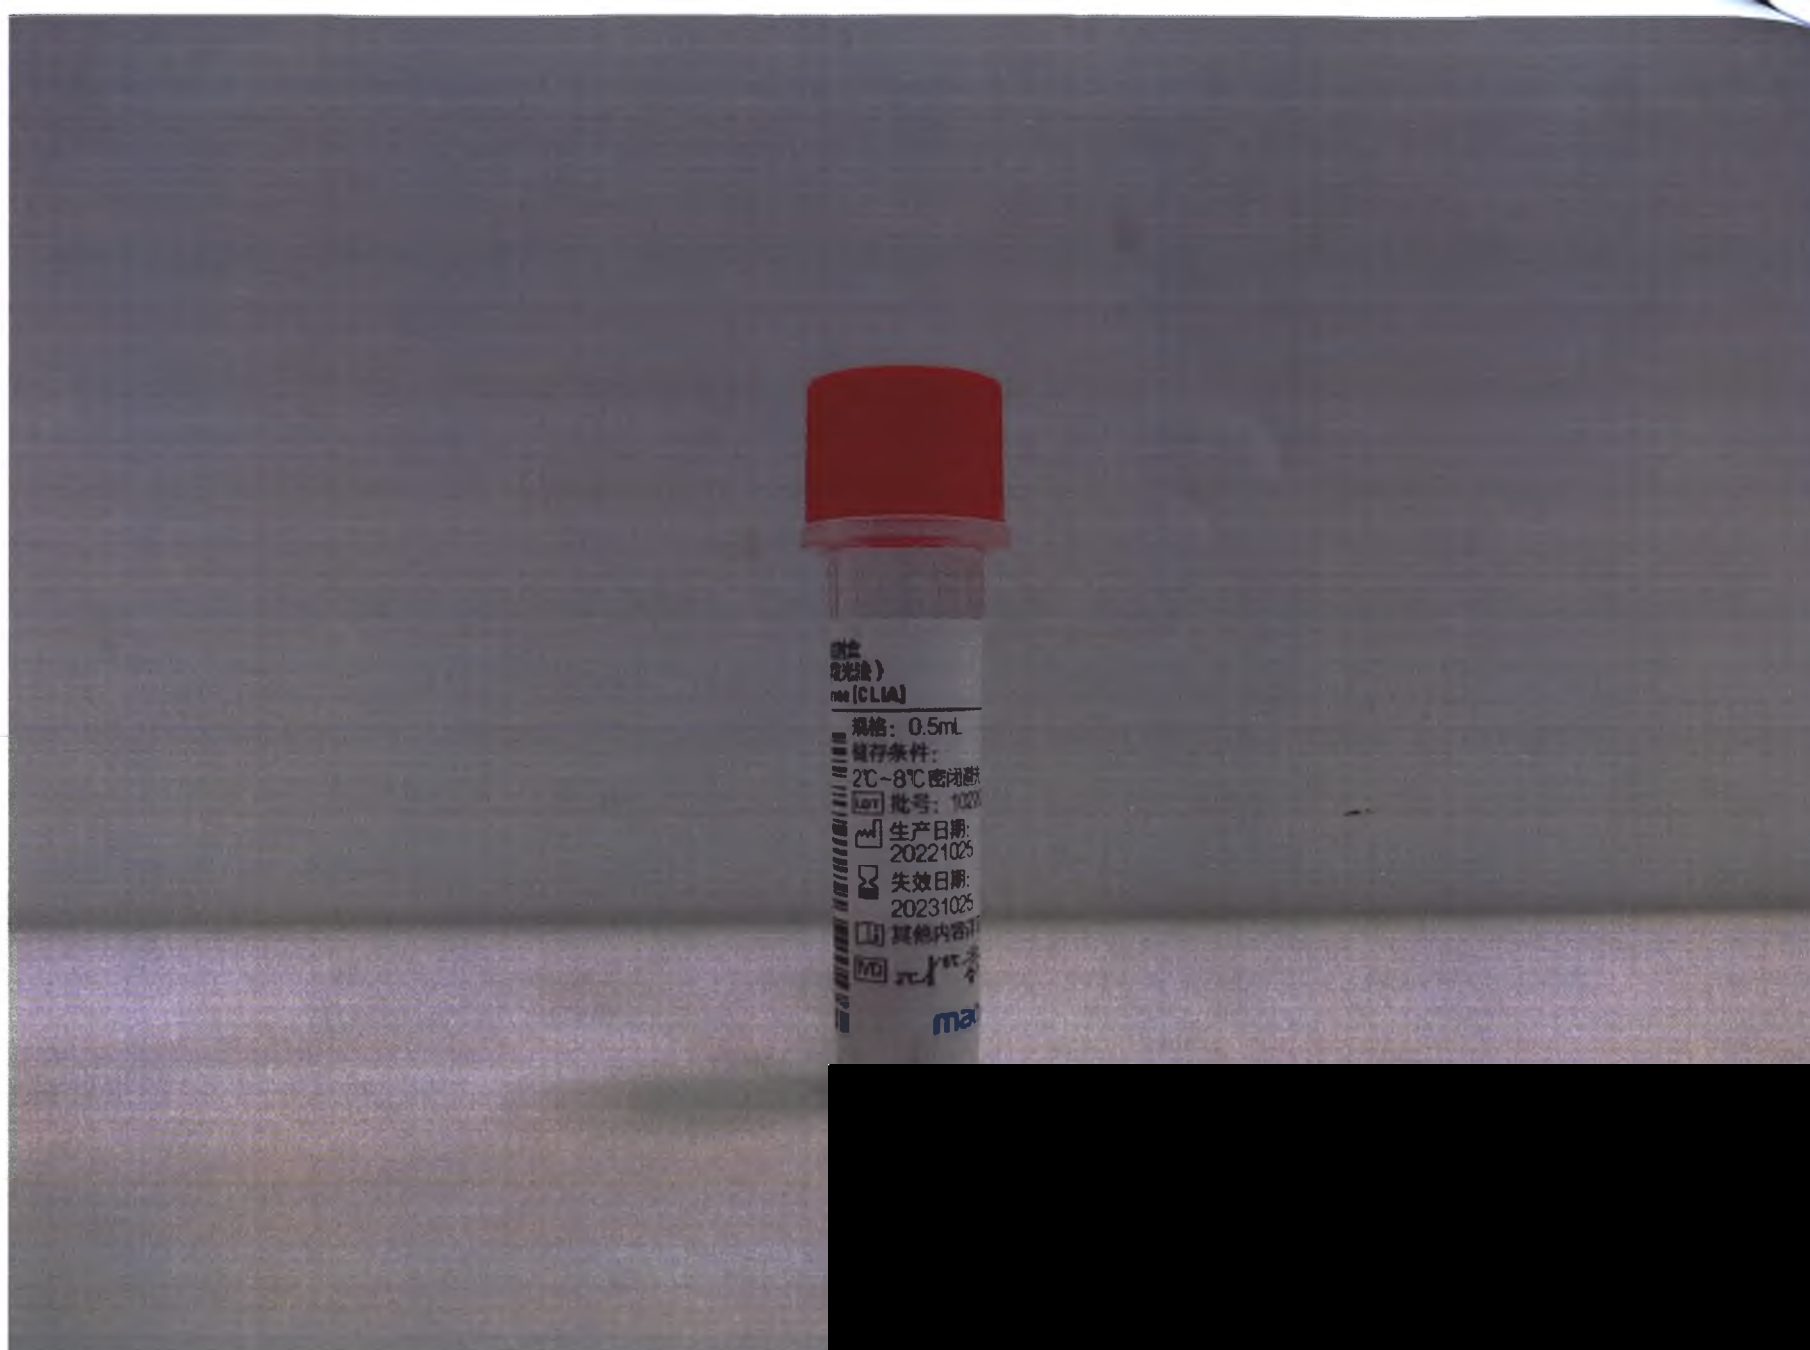

Внешний вид флакона Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

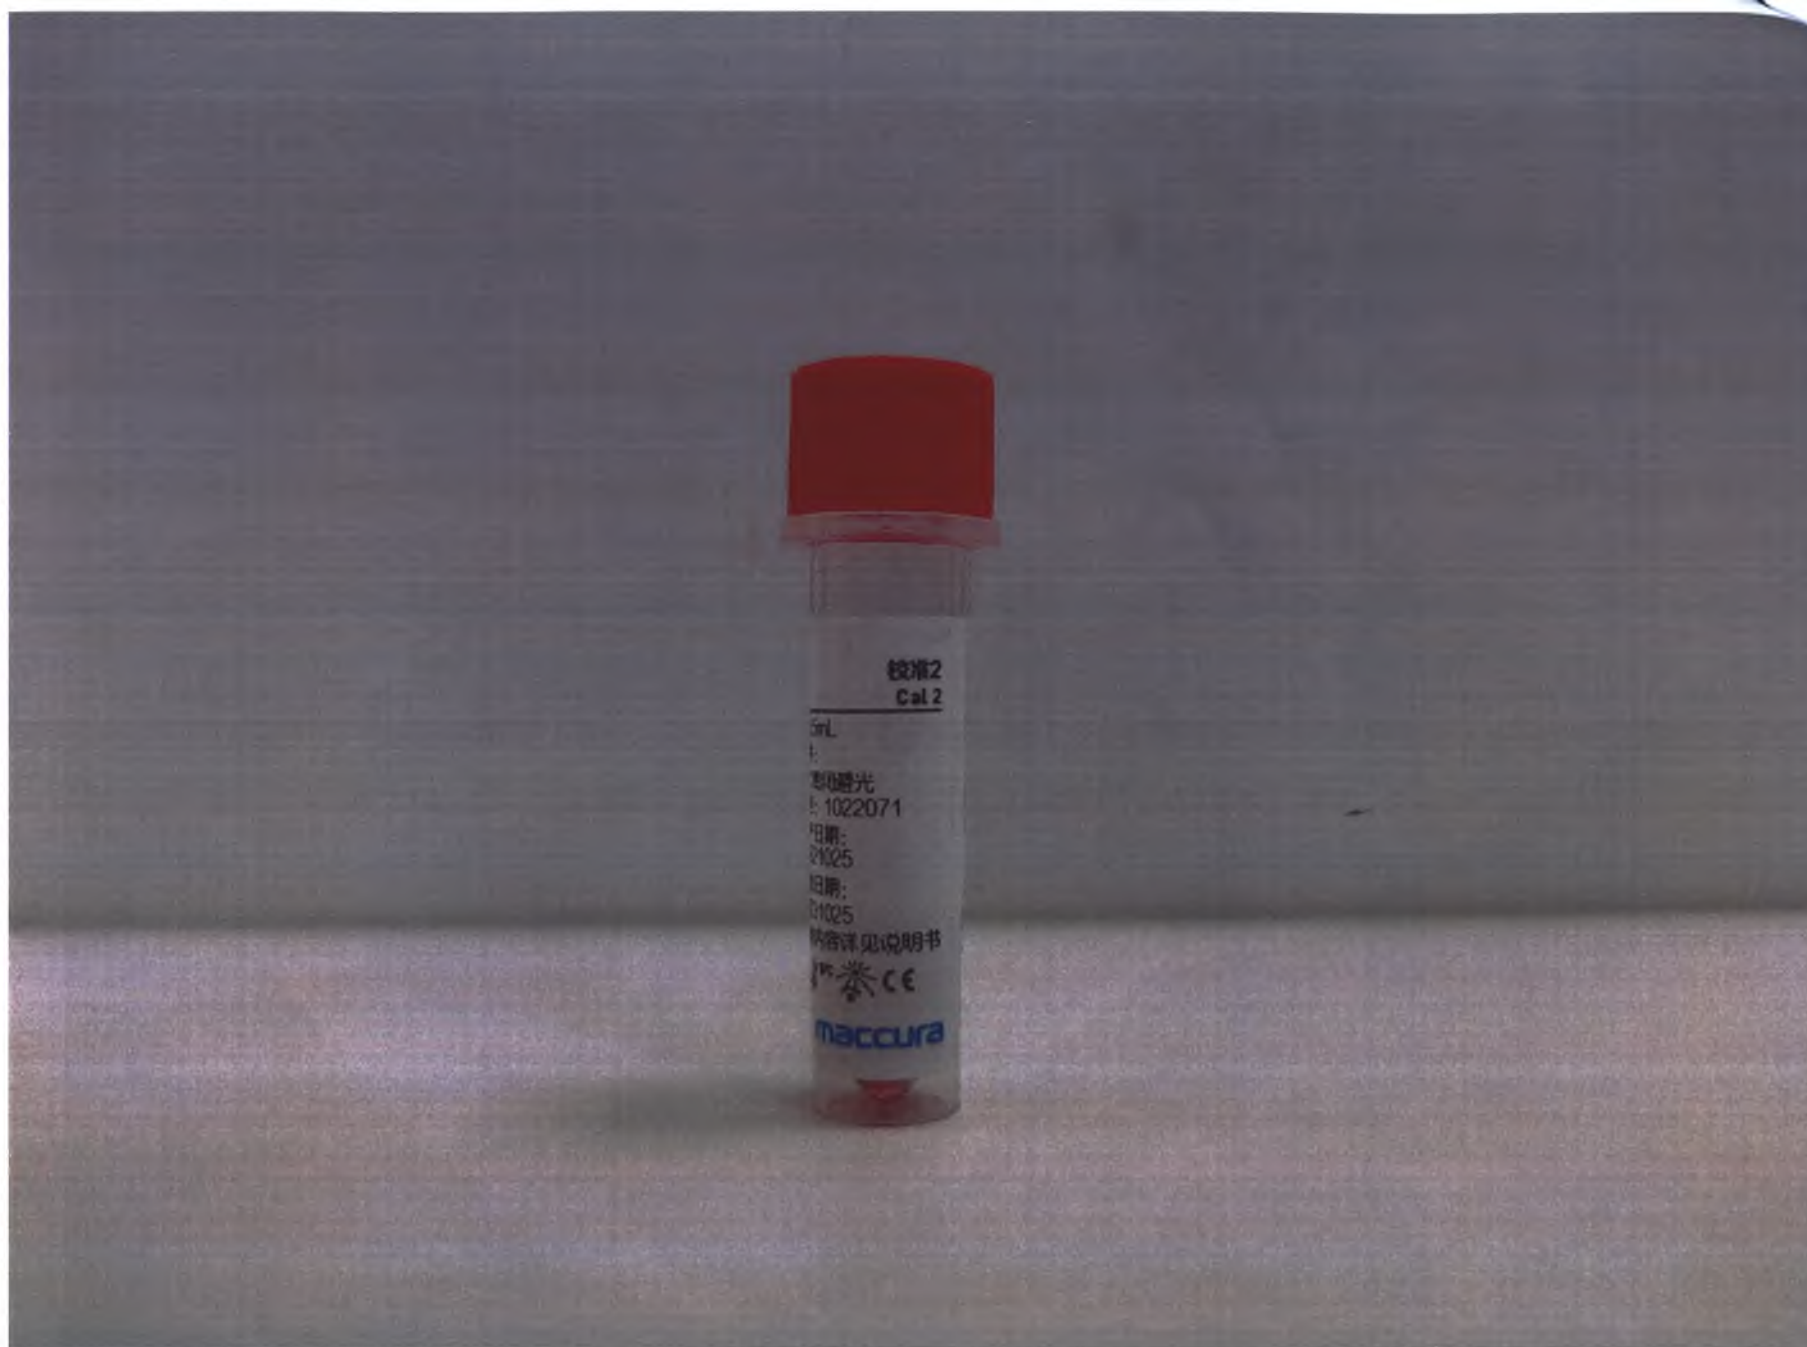

Внешний вид флакона Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

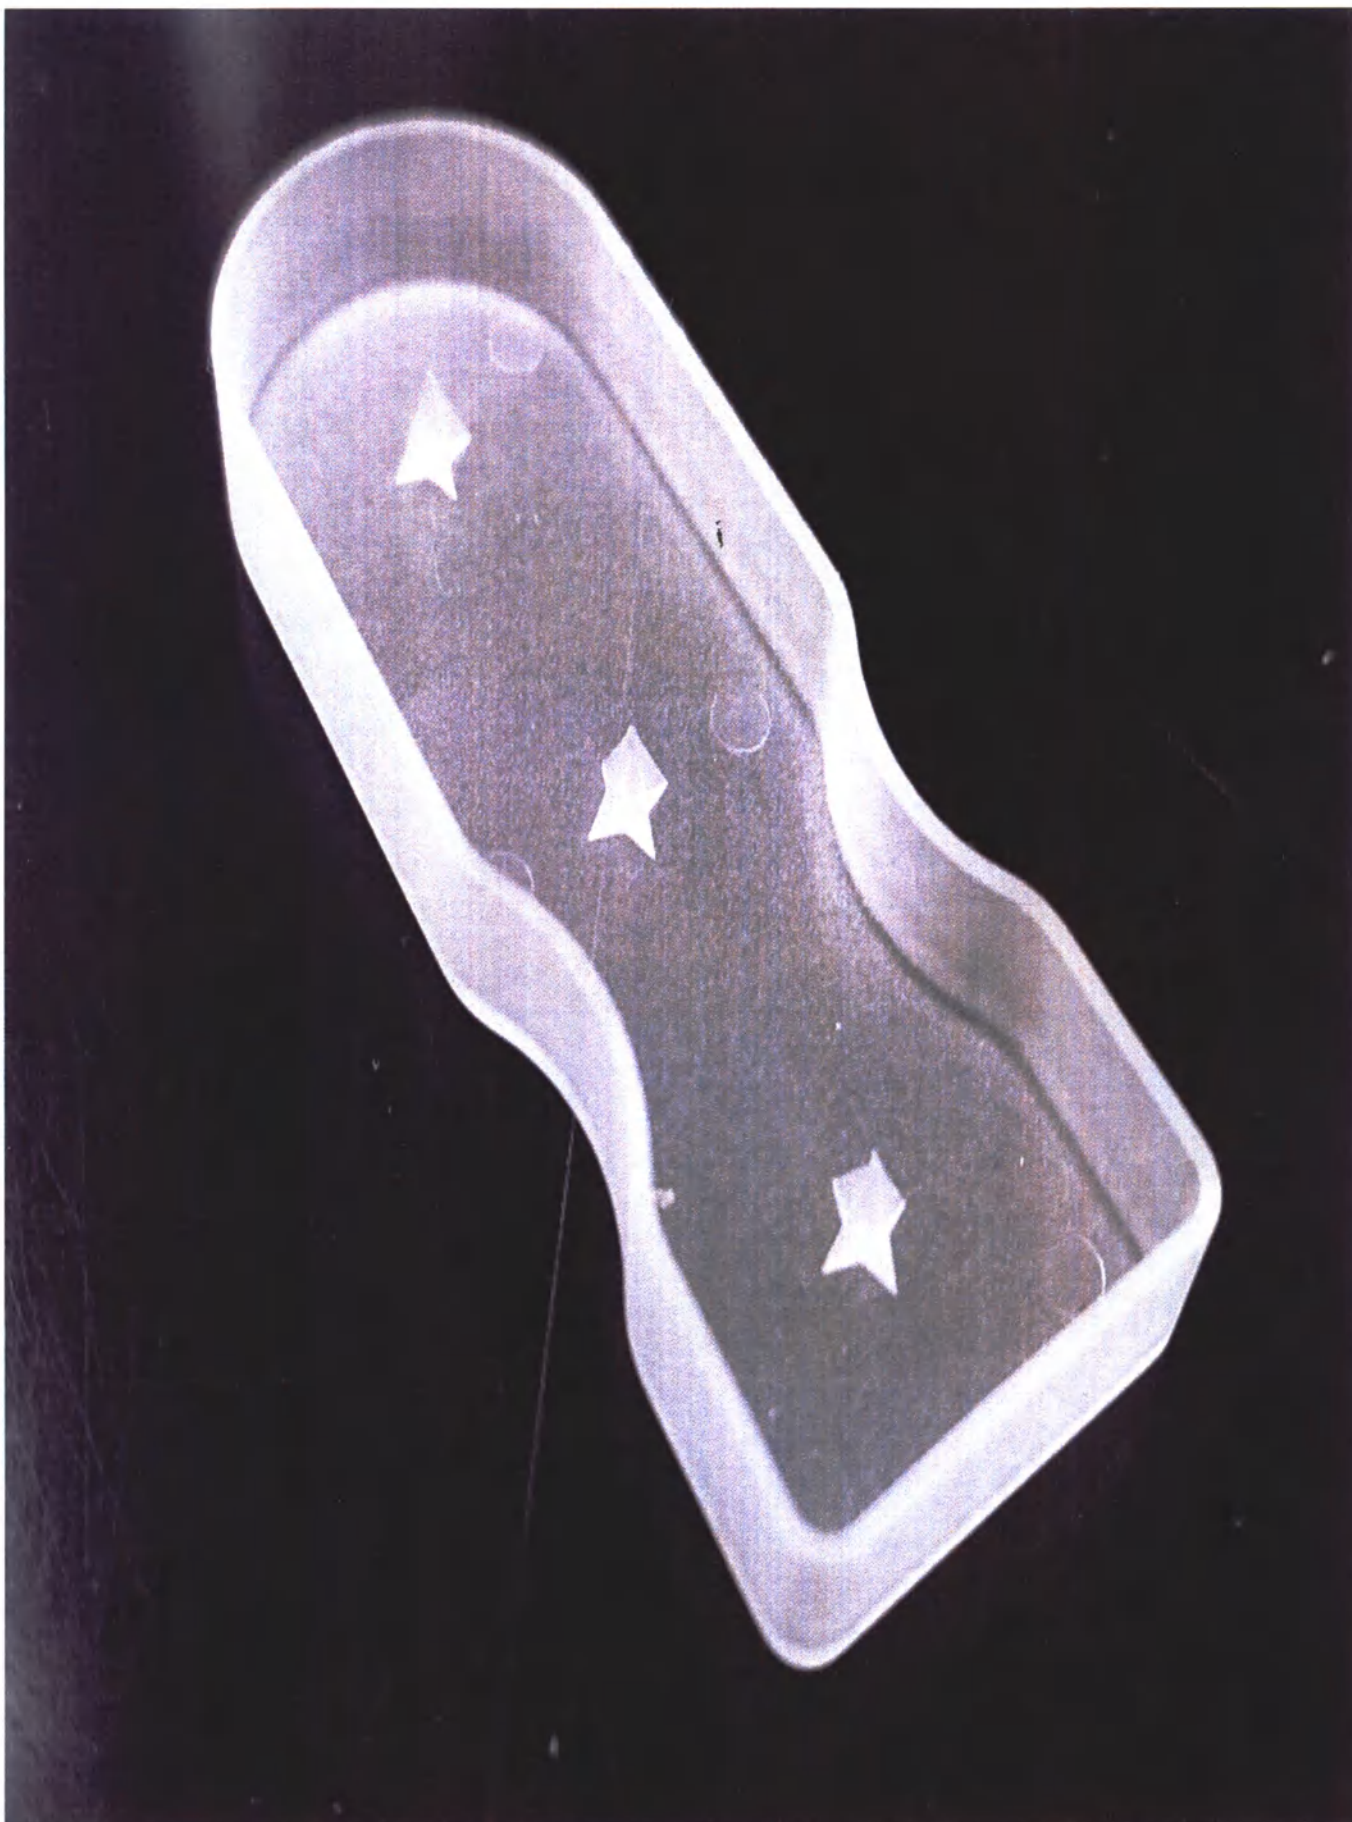

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Progesterone (CLIA)), набор на 200 тестов»



Фото транспортной упаковки

