

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«ФАРМ БСК»

Генеральный директор

Бундова С.М.



## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Стерильный набор БСК® для инъекций»



Рис. 1. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием)

# Micro-cannula Микро - канюля

Sterile BSK® injection kit  
Стерильный набор БСК® для инъекций

1 micro-cannula + 1 pre-hole needle per kit  
1 микро - канюля + 1 игла для прокола

EN: 20 Sterile injection kits  
1 micro-cannula +  
1 pre-hole needle per kit

RU: 20 Стерильных наборов для инъекций  
1 микро-канюля +  
1 игла для прокола

Стерильный набор БСК® для инъекций  
Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd.  
Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент Групп Ко. Лтд.  
No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6







Рис. 3. Общий вид маркированного торца коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием): Стерильный набор БСК® 14G/90 14G/40 в составе: микро-канюля 14G/90 мм, игла для прокола 14G/40 мм; Стерильный набор БСК® 16G/70 16G/40 в составе: микро-канюля 16G/70 мм, игла для прокола 16G/40 мм; Стерильный набор БСК® 16G/90 16G/40 в составе: микро-канюля 16G/90 мм, игла для прокола 16G/40 мм; Стерильный набор БСК® 18G/70 18G/40 в составе: микро-канюля 18G/70 мм, игла для прокола 18G/40 мм;



Стерильный набор БСК® для инъекций  
Sterile BSK® injection kit



Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтэрпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтэрпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

#### BSK® Micro-Cannula

REF LY-C-001

LOT 20221215

20221215

20271214

14G/90mm

14G/40mm

Рис. 4. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 14G/90 14G/40 в составе: микро-канюля 14G/90 мм, игла для

прокола 14G/40 мм;

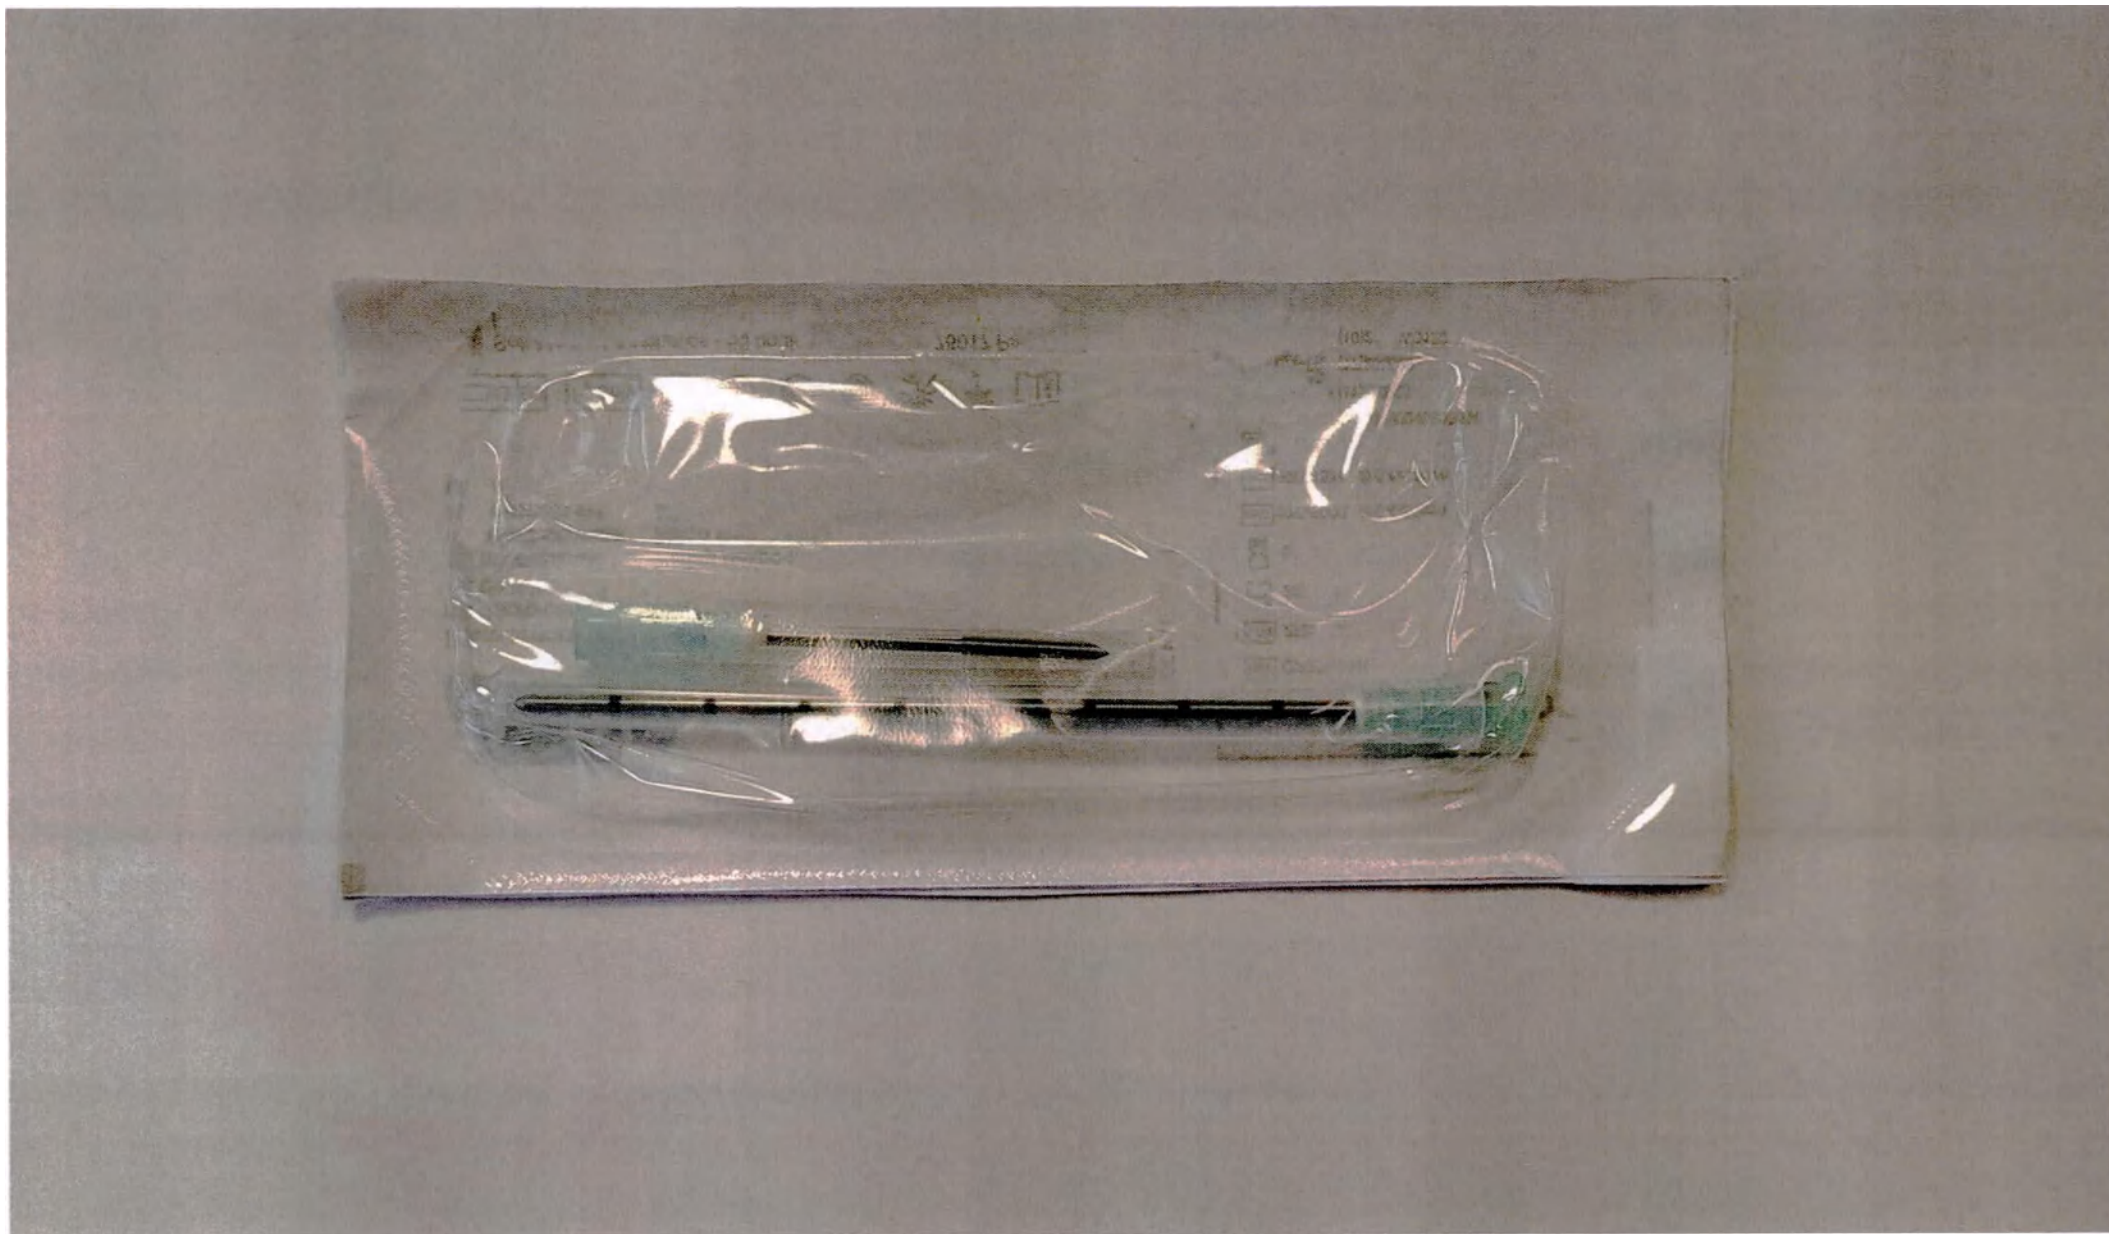


Рис. 5. Общий вид лицевой стороны блистера с медицинским изделием, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 14G/90 14G/40 в составе: микро-канюля 14G/90 мм, игла для прокола 14G/40 мм;



Рис.6. Общий вид медицинского изделия варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 14G/90 14G/40 в составе: микро-канюля 14G/90 мм, игла для прокола 14G/40 мм\*

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| REF                                                                                 | LY-C-002 |
| LOT                                                                                 | 20221215 |
|  | 20221215 |
|  | 20271214 |
|  | 16G/70mm |
|  | 16G/40mm |

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | LY-C-003 |
|  | 20221215 |
|  | 20221215 |
|  | 20271214 |
|  | 16G/90mm |
|  | 16G/40mm |


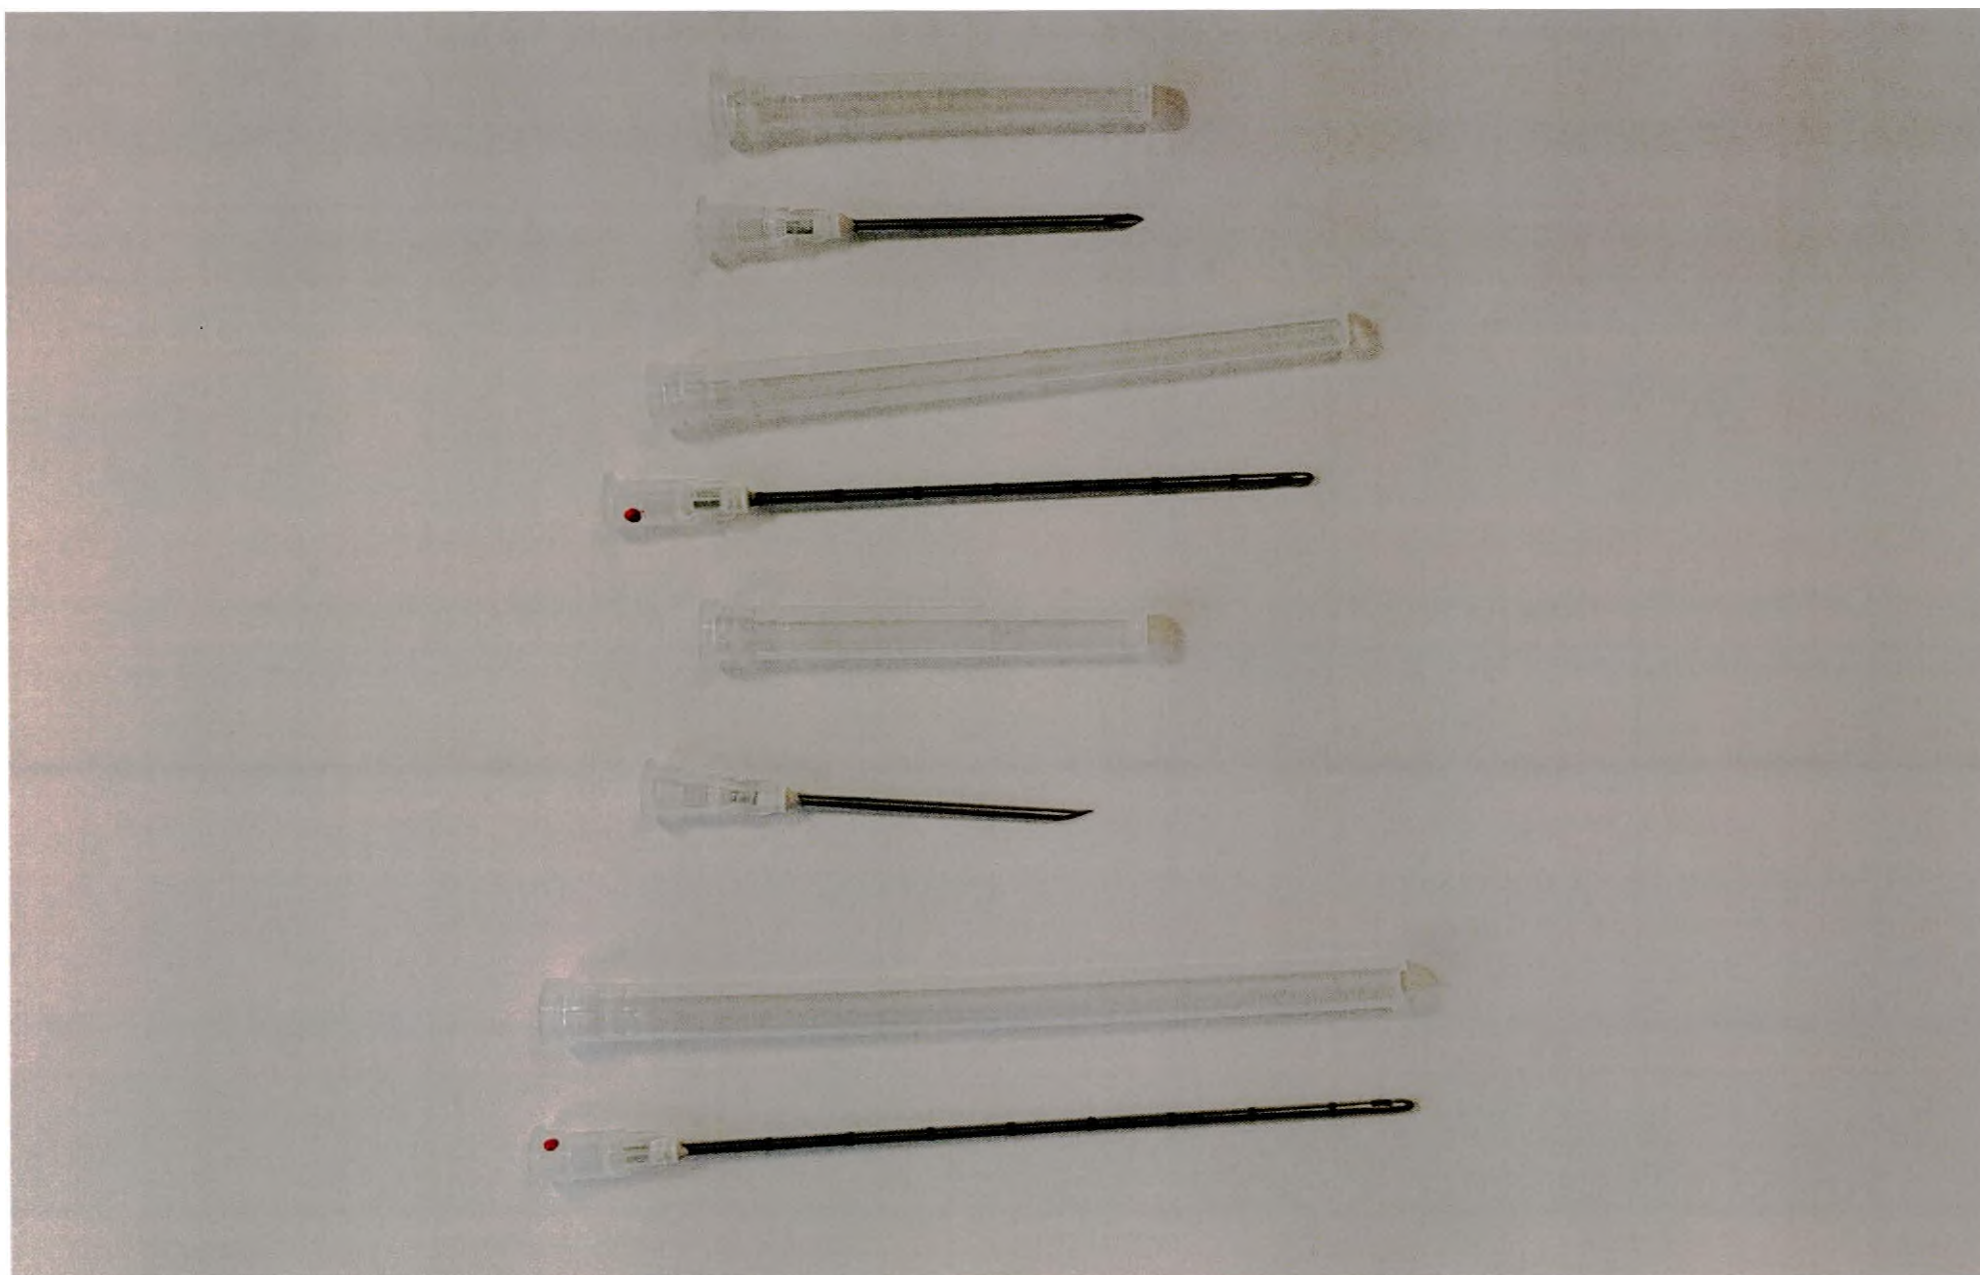


Рис.8. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 16G/70 16G/40 в составе: микро-канюля 16G/70 мм, игла для прокола 16G/40 мм; Стерильный набор БСК® 16G/90 16G/40 в составе: микро-канюля 16G/90 мм, игла для прокола 16G/40 мм;



Стерильный набор БСК® для инъекций  
Sterile BSK® injection kit



Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 858 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. No 858 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

#### BSK® Micro-Cannula

|     |          |
|-----|----------|
| REF | LY-C-004 |
| LOT | 20221215 |
|     | 20221215 |
|     | 20271214 |
|     | 18G/70mm |
|     | 18G/40mm |

Рис. 9. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 18G/70 18G/40 в составе: микро-канюля 18G/70 мм, игла для прокола 18G/40 мм;

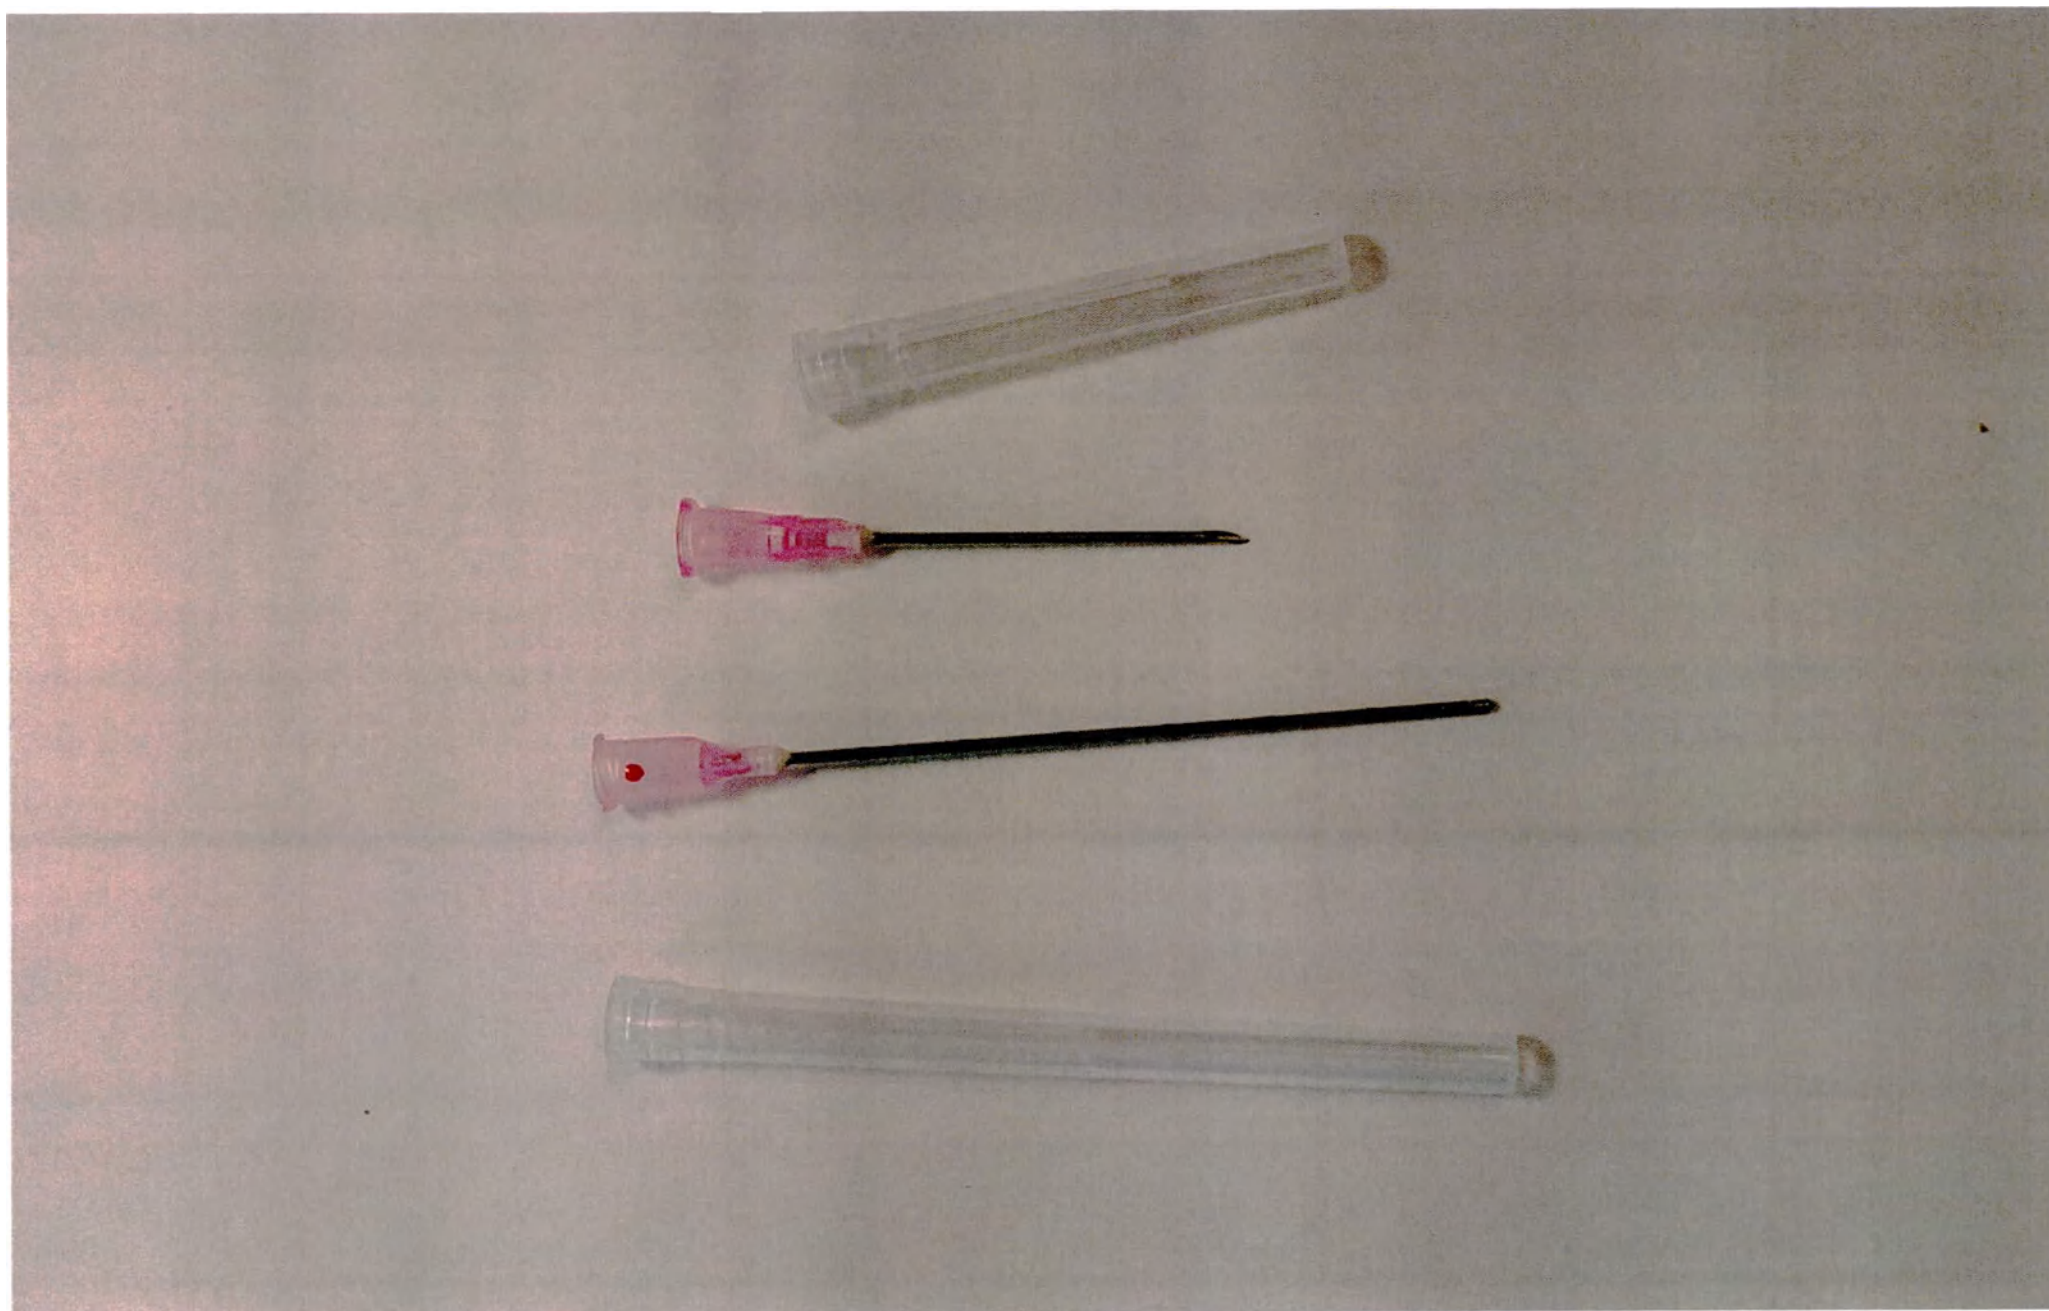


Рис.10. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 18G/70 18G/40 в составе: микро-канюля 18G/70 мм, игла для прокола 18G/40 мм;



Рис.11. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 22G/40 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/40 мм, игла для прокола 22G/25 мм; Стерильный набор БСК® 22G/50 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/50 мм, игла для прокола 22G/25 мм; 7. Стерильный набор БСК® 22G/70 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/70 мм, игла для прокола 22G/25 мм; Стерильный набор БСК® 22G/90 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/90 мм, игла для прокола 22G/25 мм;

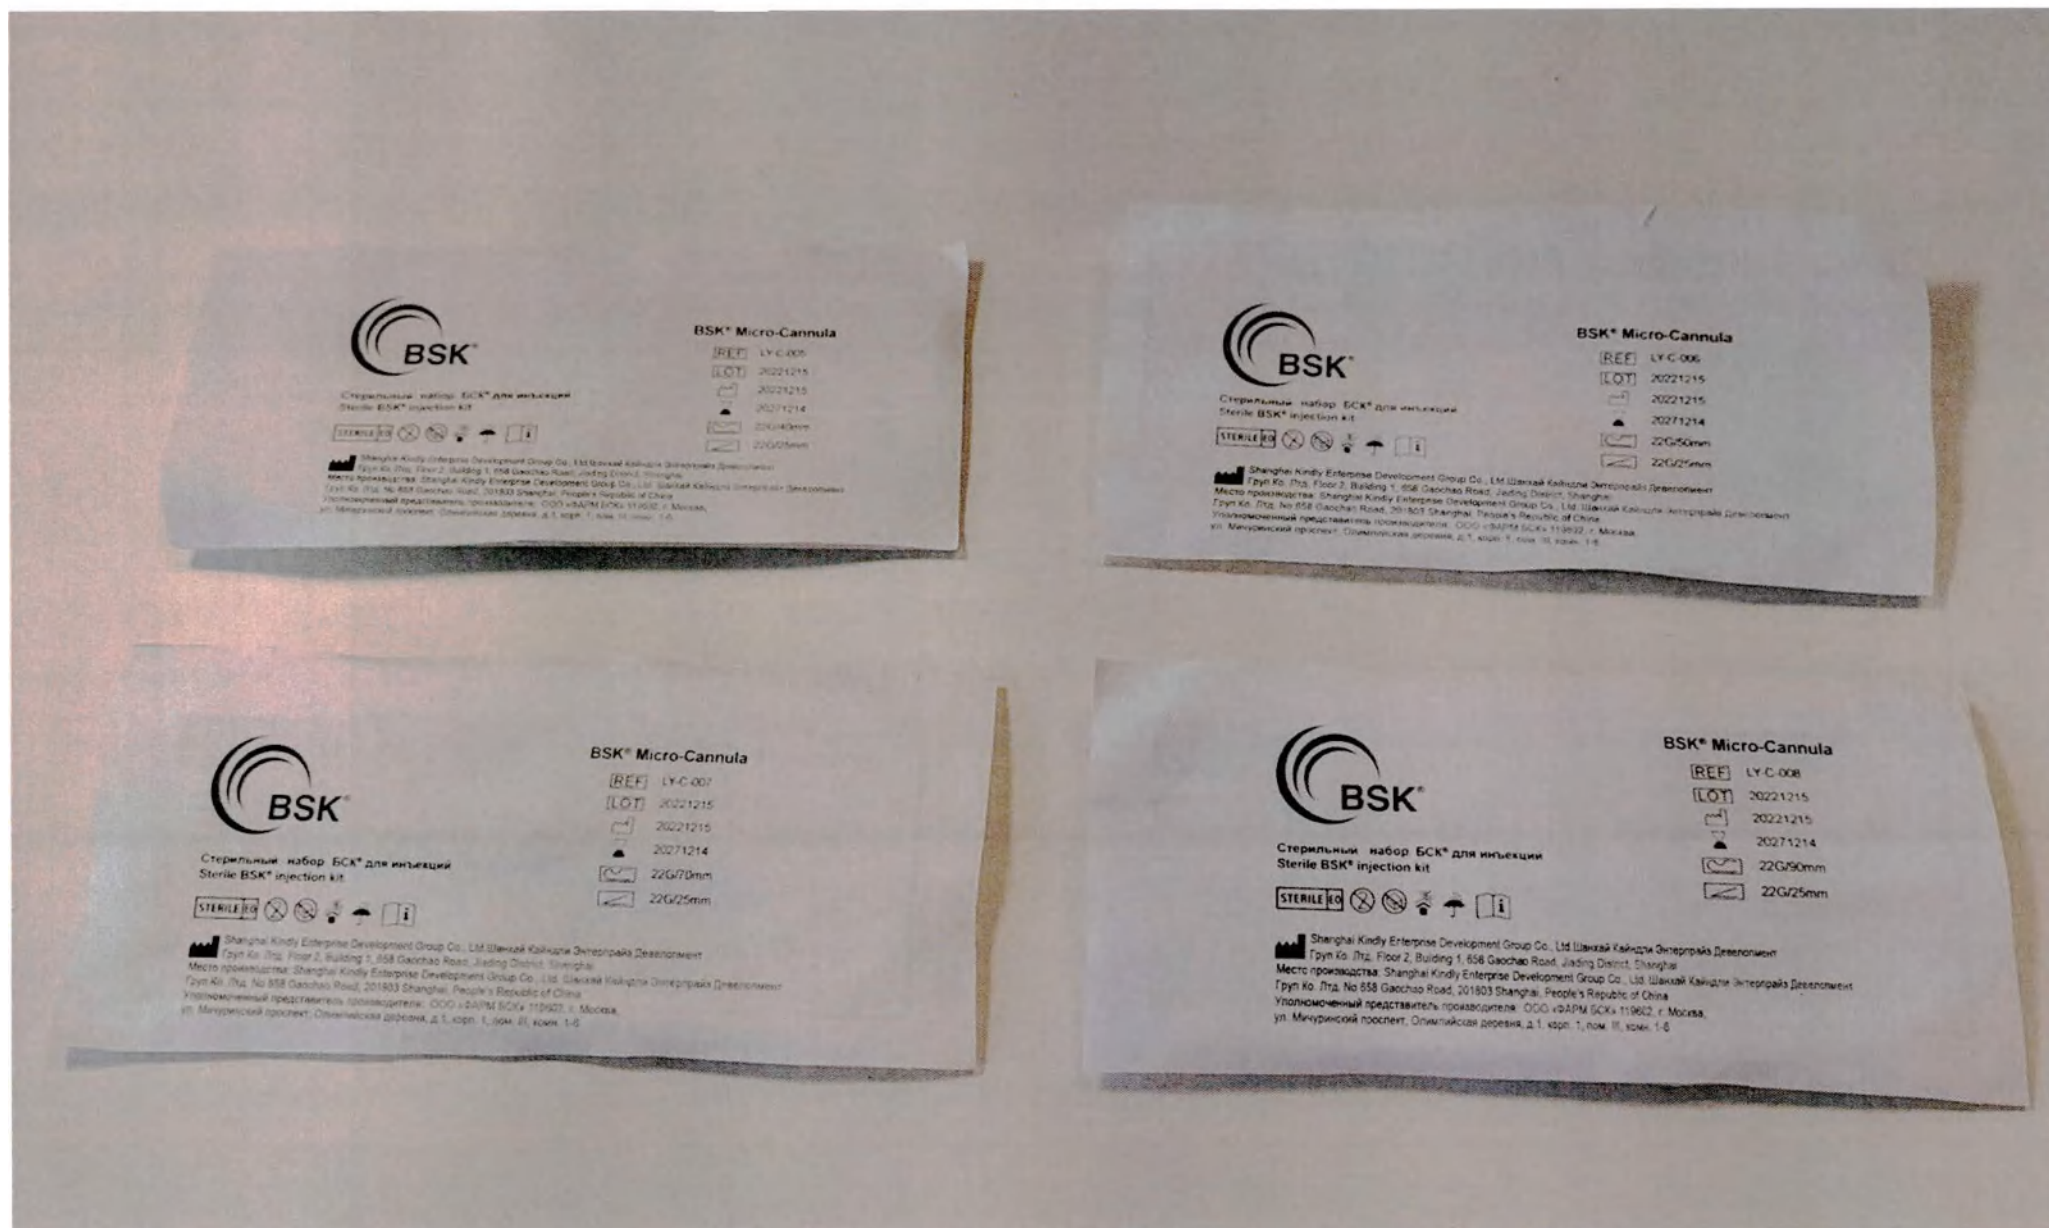


Рис. 12. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 22G/40 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/40 мм, игла для прокола 22G/25 мм; Стерильный набор БСК® 22G/50 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/50 мм, игла для прокола 22G/25 мм; 7. Стерильный набор БСК® 22G/70 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/70 мм, игла для прокола 22G/25 мм; Стерильный набор БСК® 22G/90 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/90 мм, игла для прокола 22G/25 мм;

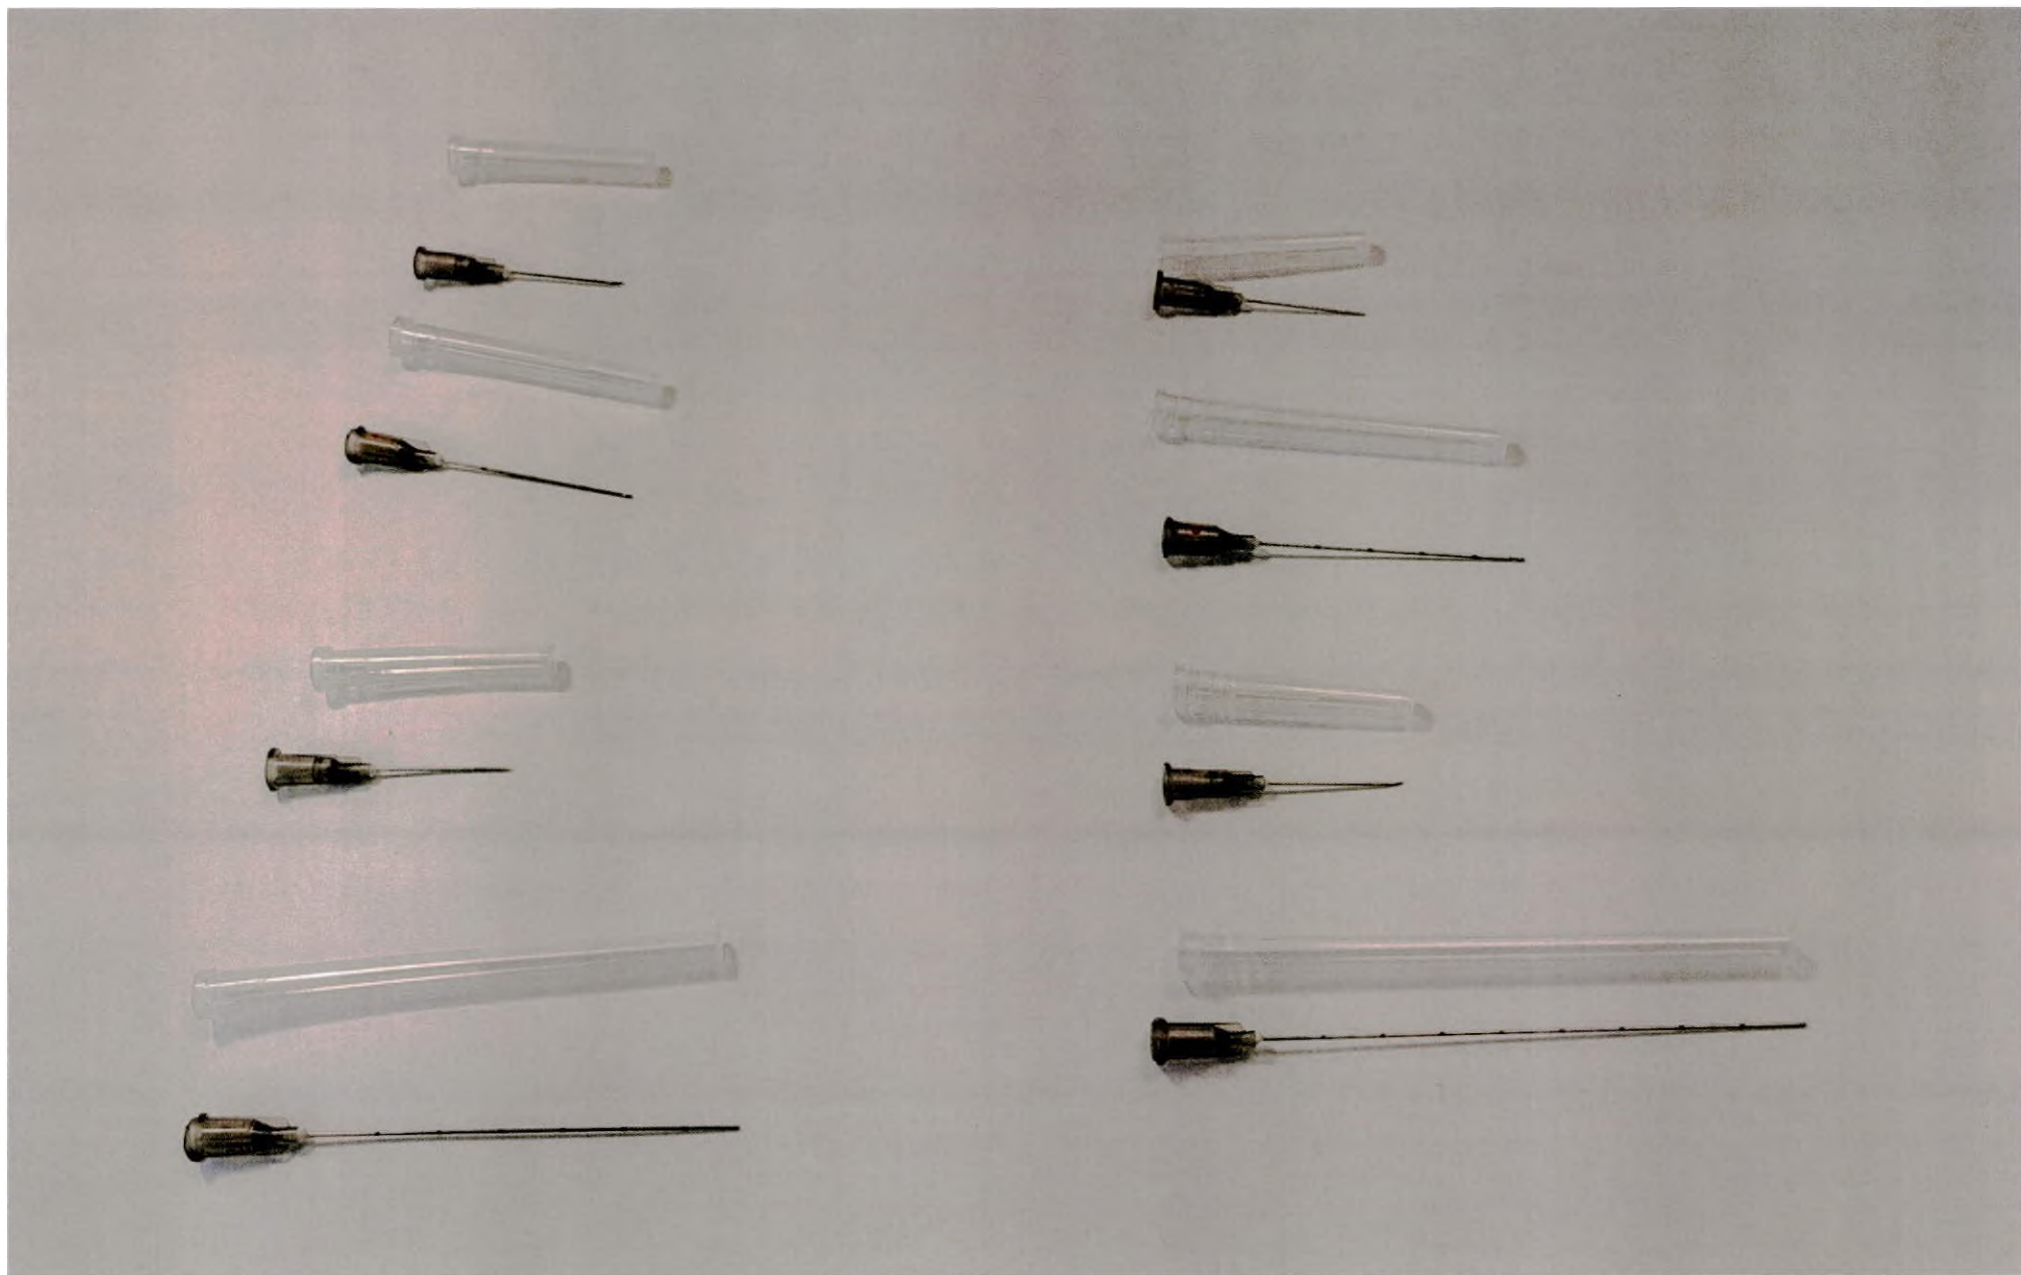


Рис.13. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 22G/40 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/40 мм, игла для прокола 22G/25 мм; Стерильный набор БСК® 22G/50 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/50 мм, игла для прокола 22G/25 мм; 7. Стерильный набор БСК® 22G/70 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/70 мм, игла для прокола 22G/25 мм; Стерильный набор БСК® 22G/90 22G/25 в составе: микро-канюля 22G/90 мм, игла для прокола 22G/25 мм.



Рис.14. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 23G/30 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/30 мм, игла для прокола 23G/25 мм; Стерильный набор БСК® 23G/50 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/50 мм, игла для прокола 23G/25 мм; Стерильный набор БСК® 23G/70 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/70 мм, игла для прокола 23G/25 мм;

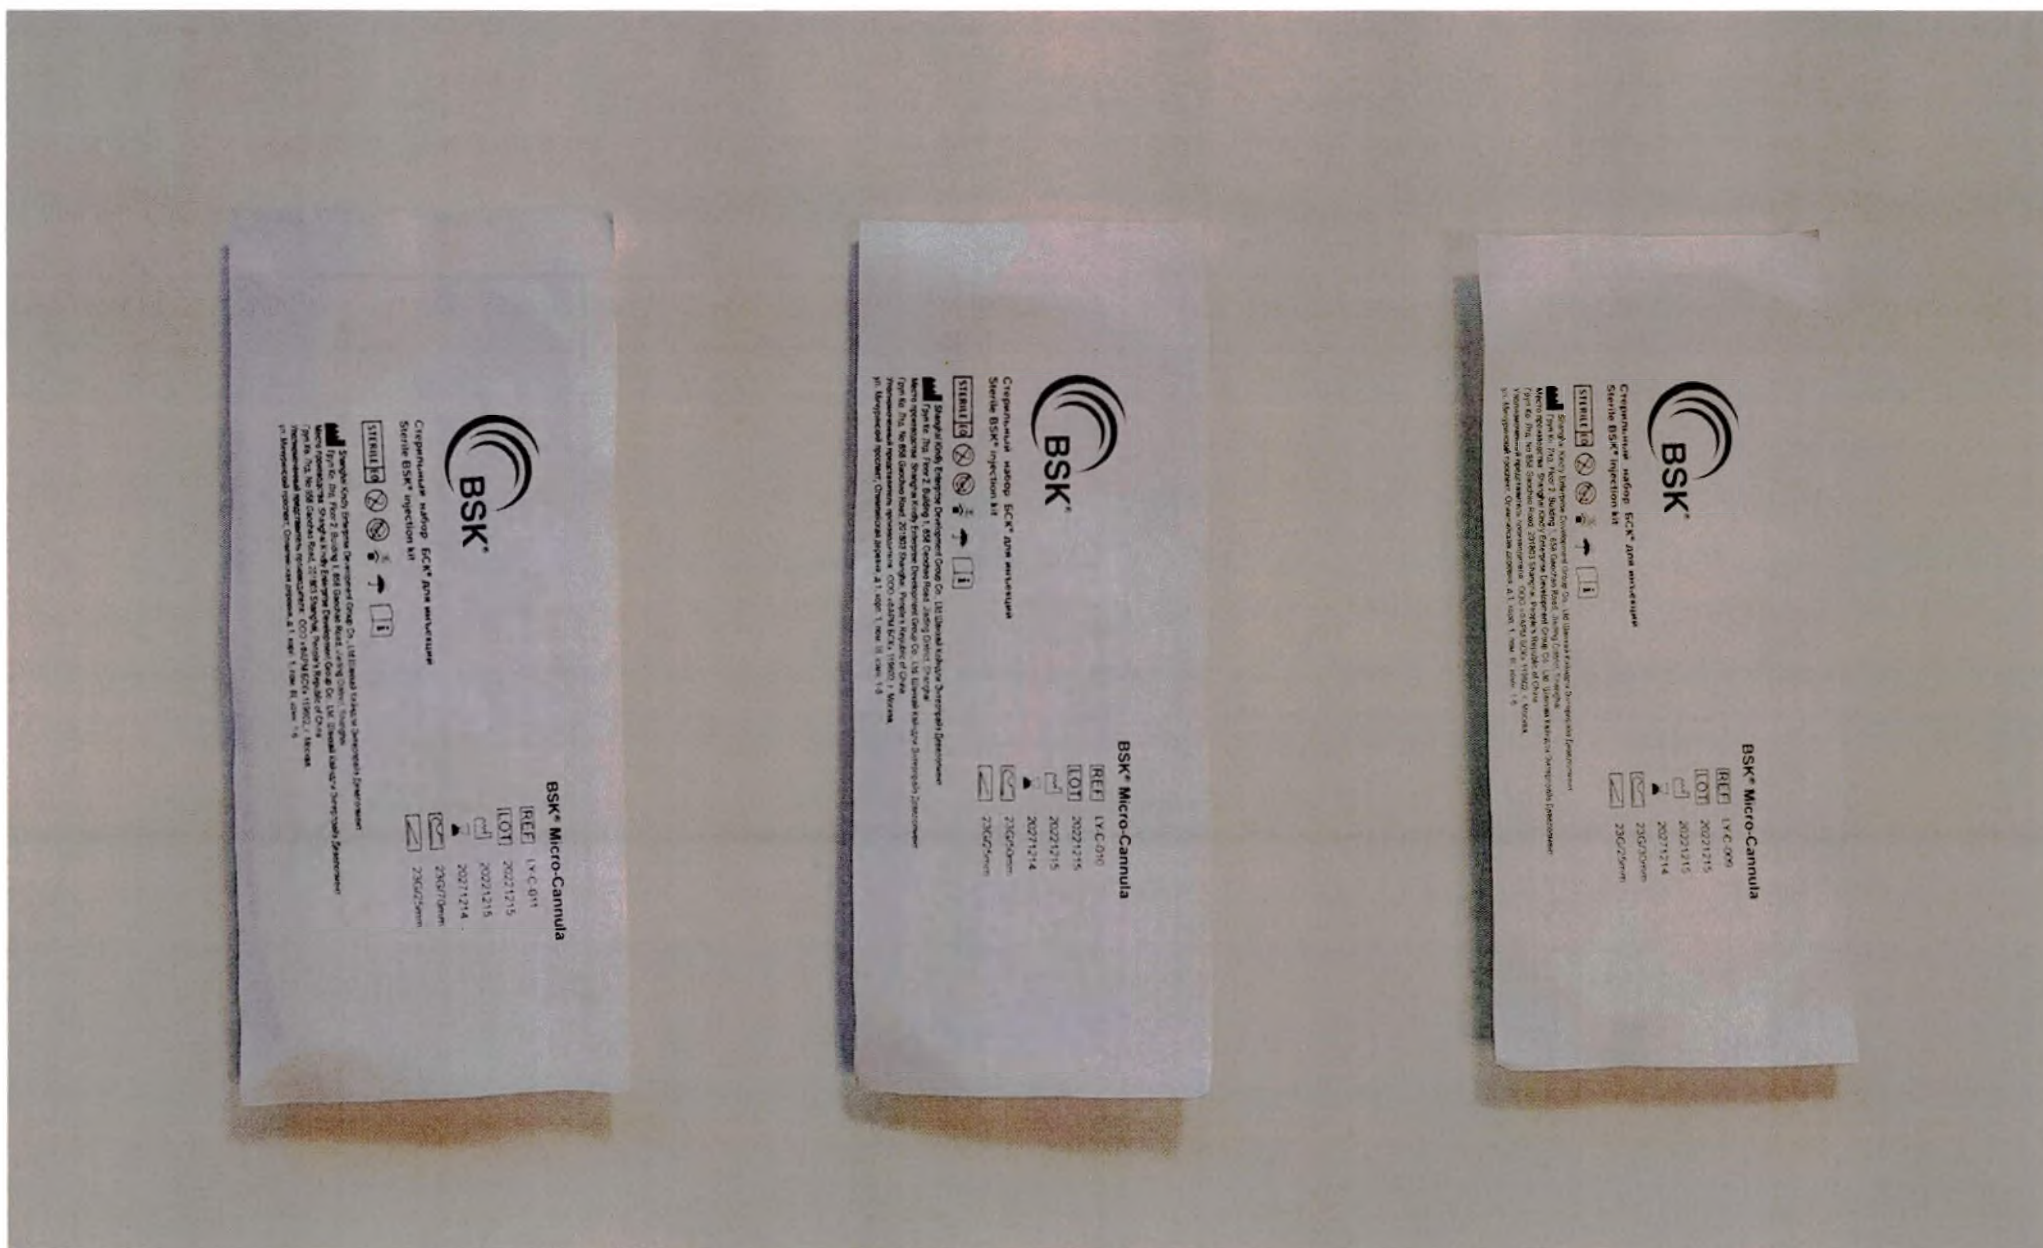


Рис. 15. Общий вид оборотной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 23G/30 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/30 мм, игла для прокола 23G/25 мм; Стерильный набор БСК® 23G/50 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/50 мм, игла для прокола 23G/25 мм; Стерильный набор БСК® 23G/70 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/70 мм, игла для прокола 23G/25 мм;

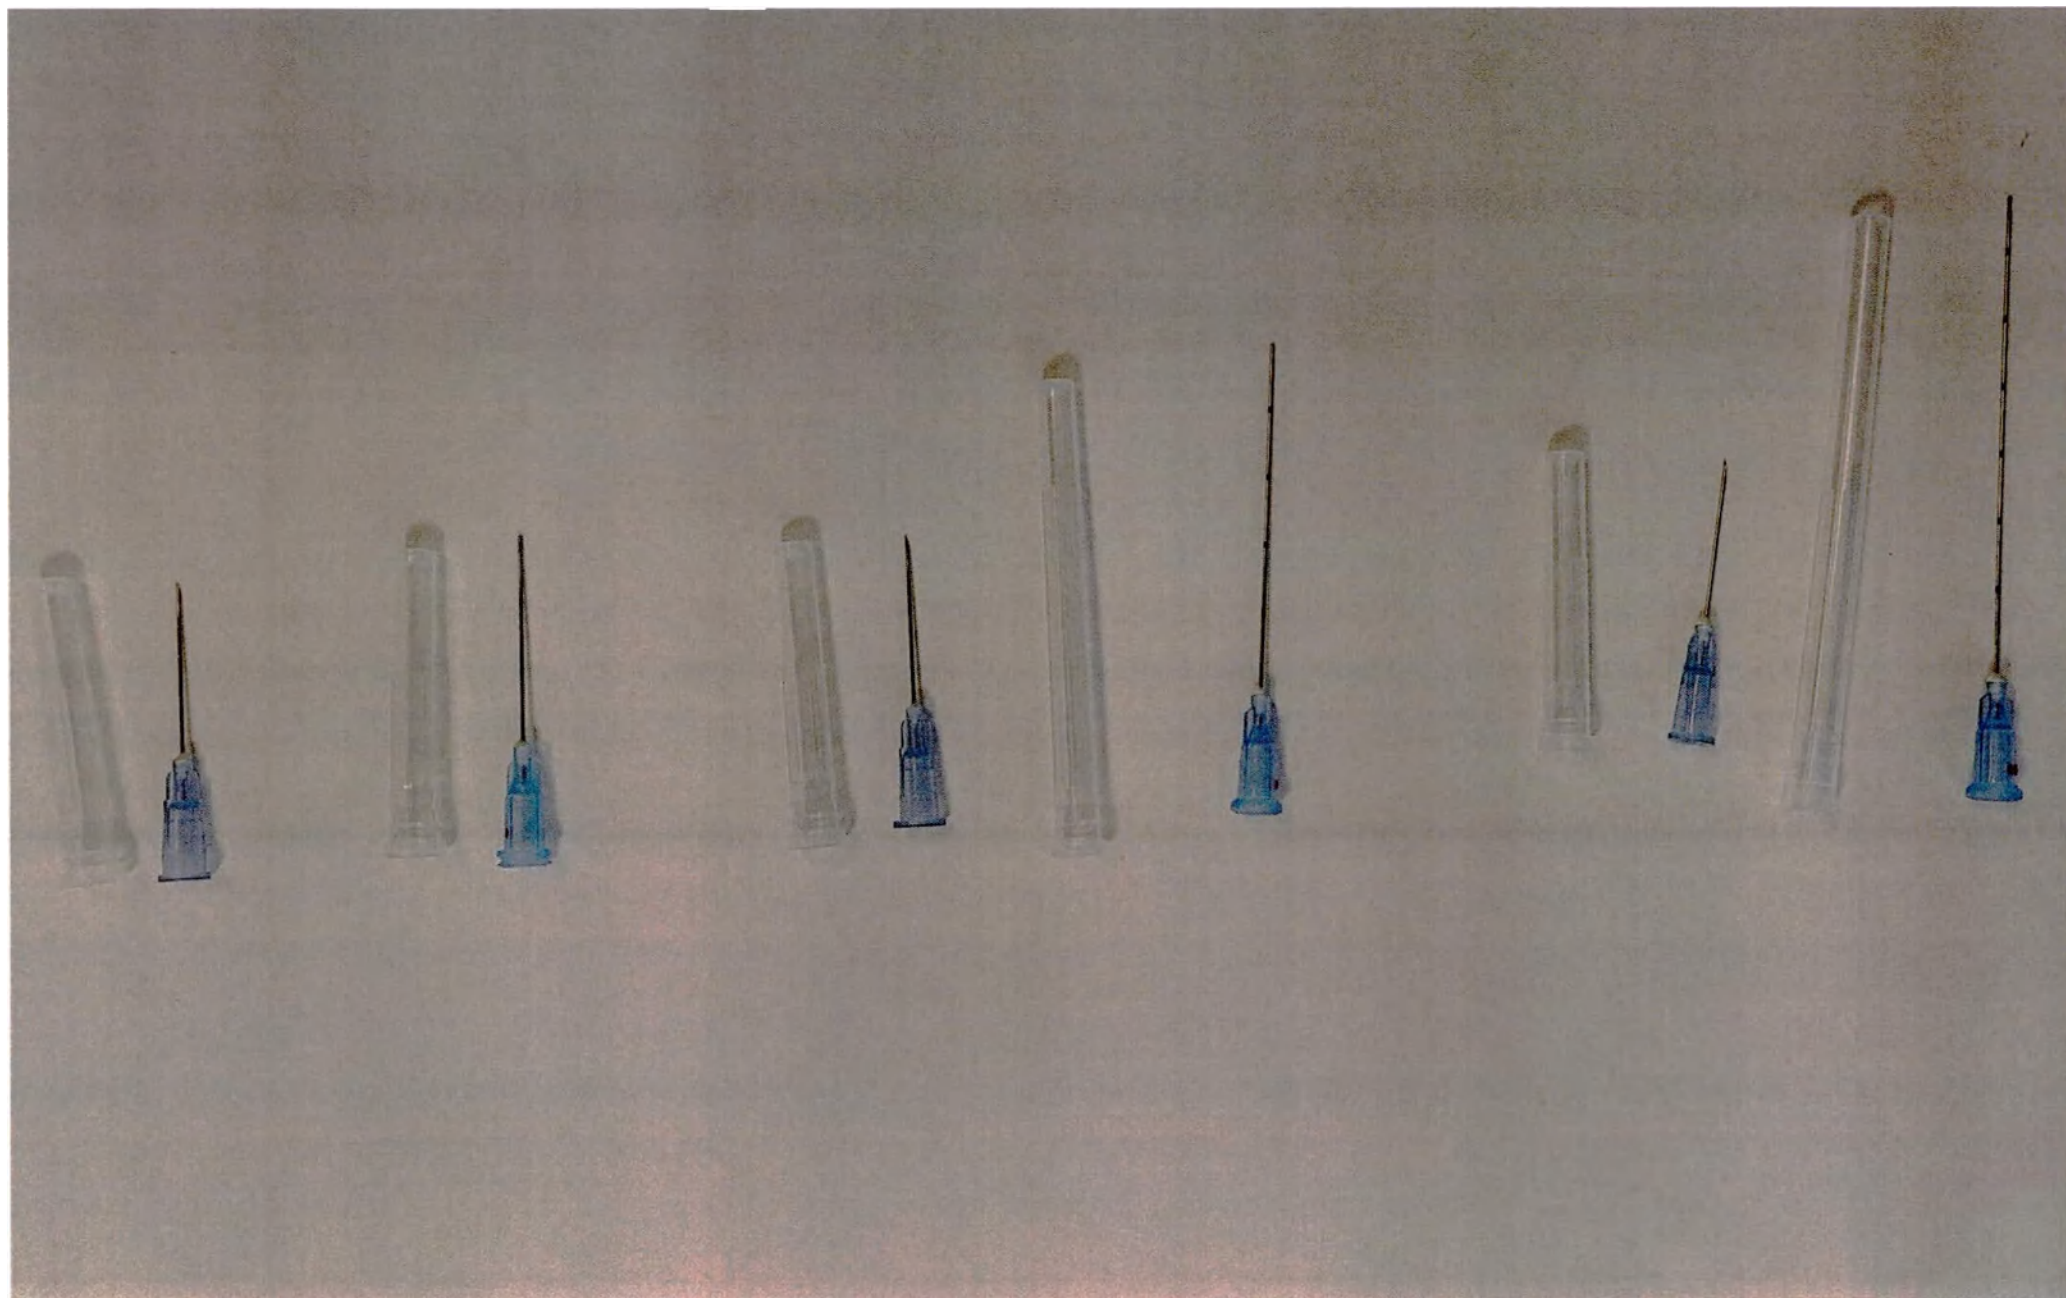


Рис. 16. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 23G/30 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/30 мм, игла для прокола 23G/25 мм; Стерильный набор БСК® 23G/50 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/50 мм, игла для прокола 23G/25 мм; Стерильный набор БСК® 23G/70 23G/25 в составе: микро-канюля 23G/70 мм, игла для прокола 23G/25 мм;

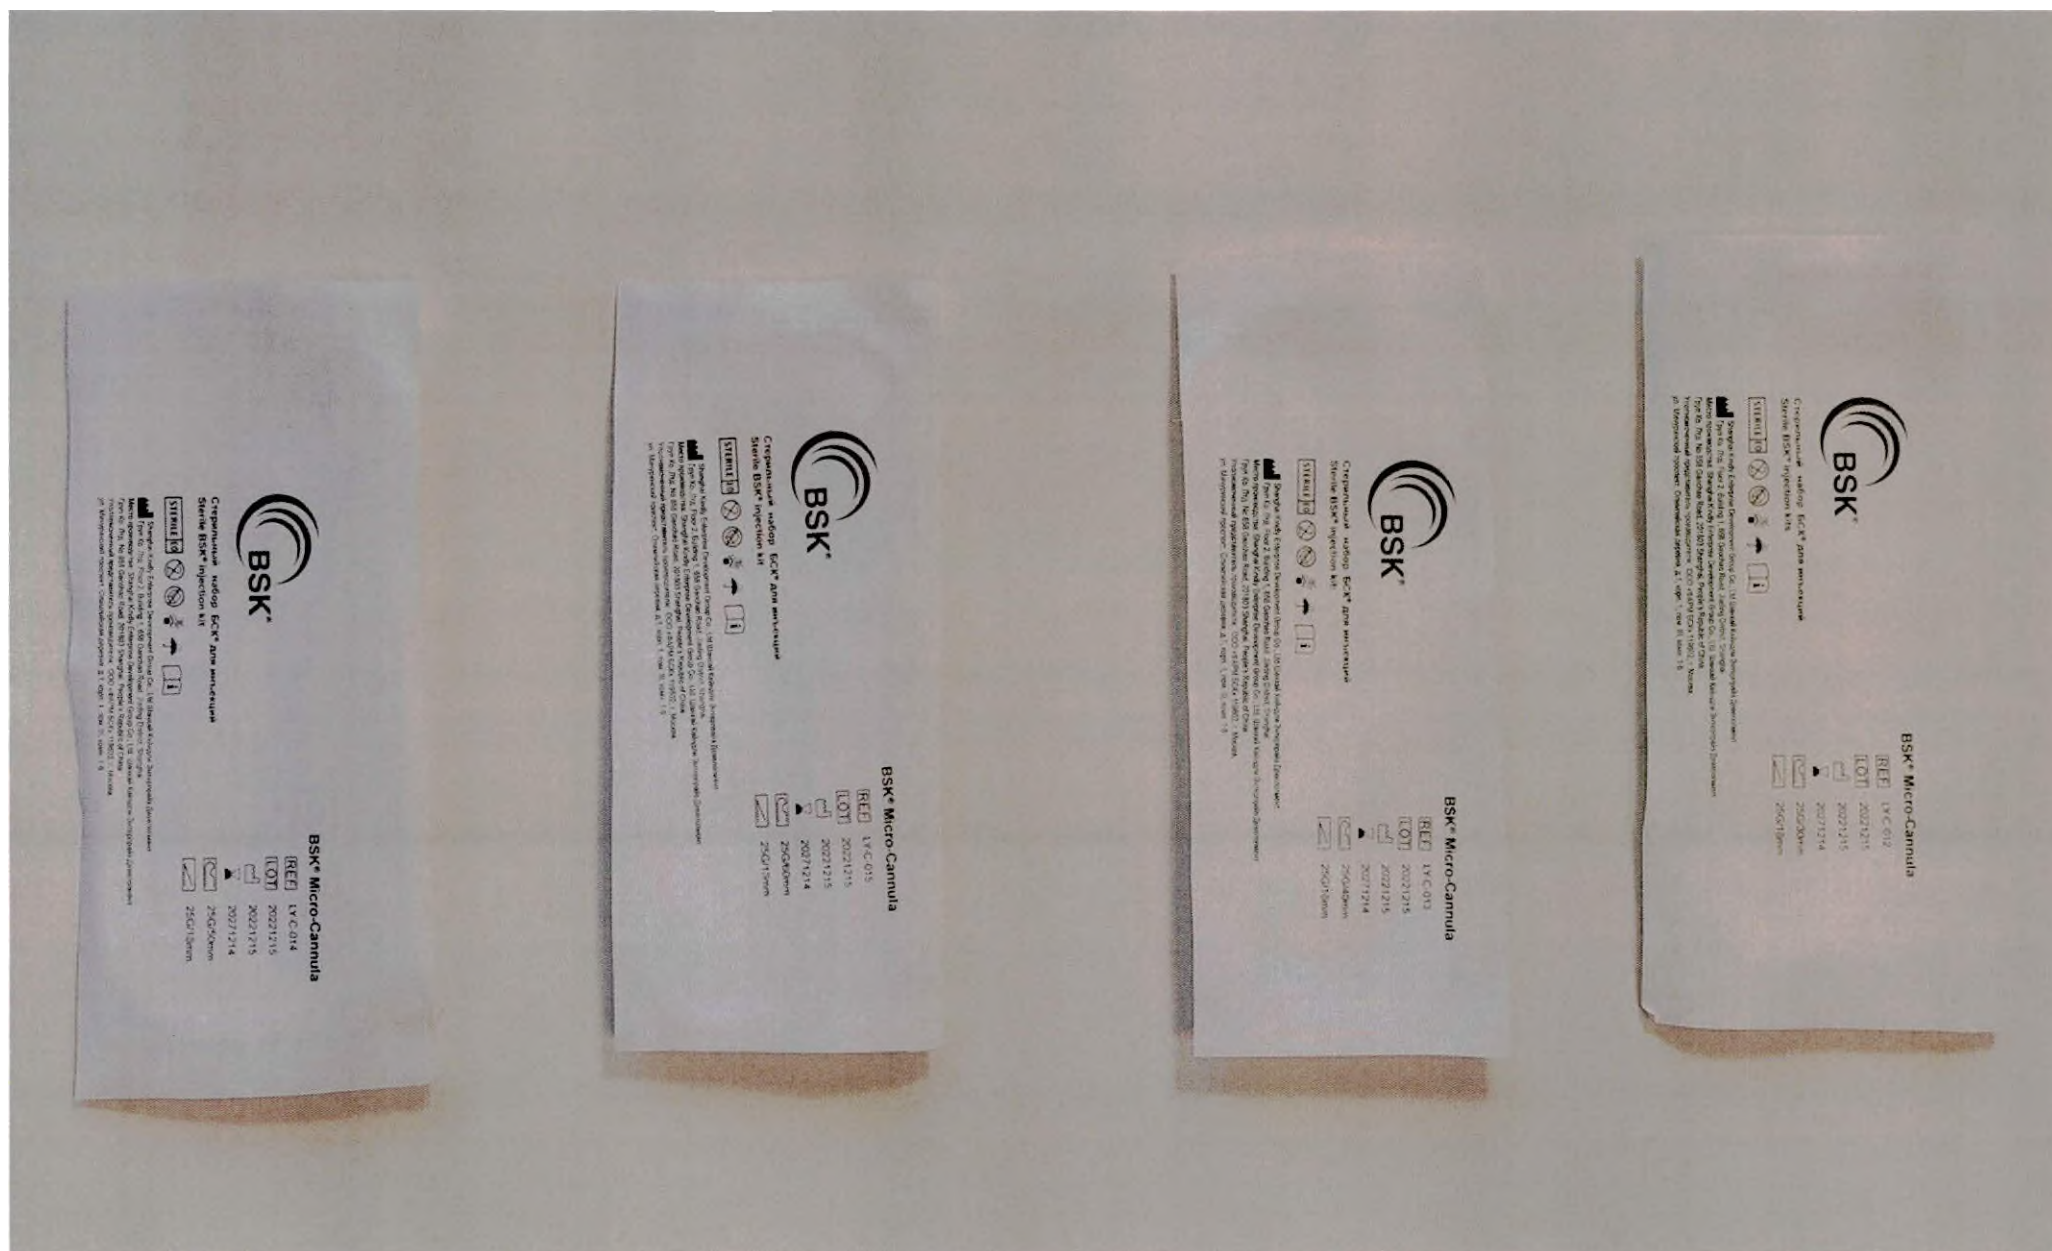


Рис. 17. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 25G/30 25G/18 в составе: микро-канюля 25G/30 мм, игла для прокола 25G/18 мм; Стерильный набор БСК® 25G/40 25G/18 в составе: микро-канюля 25G/40 мм, игла для прокола 25G/18 мм; Стерильный набор БСК® 25G/50 25G/18 в составе: микро-канюля 25G/50 мм, игла для прокола 25G/18 мм; Стерильный набор БСК® 25G/60 25G/18, в составе: микро-канюля 25G/60 мм, игла для прокола 25G/18 мм:

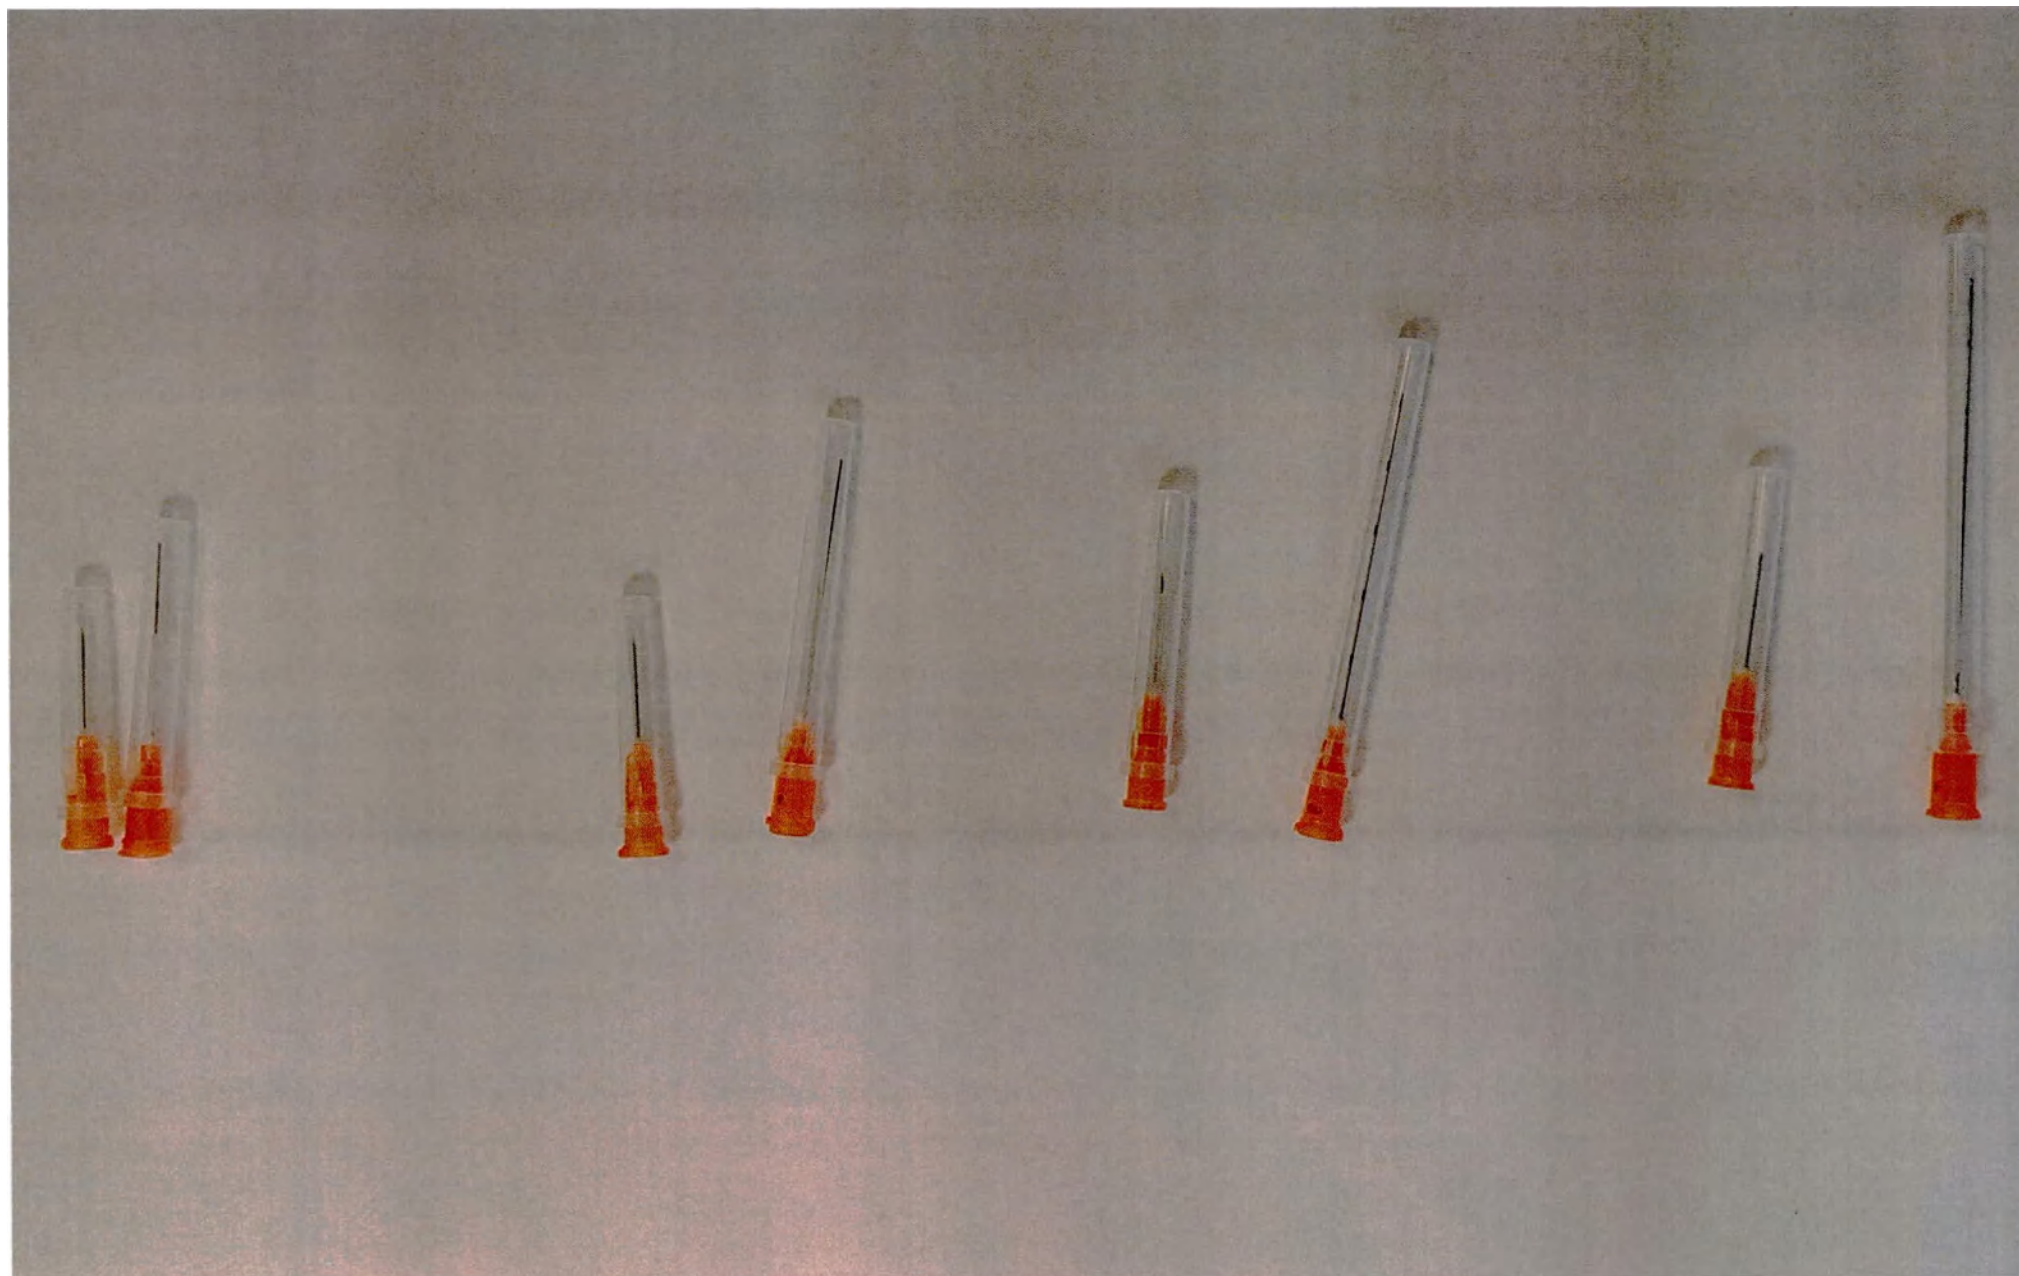



Рис. 18. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 25G/30 25G/18 в составе: микро-канюля 25G/30 мм, игла для прокола 25G/18 мм; Стерильный набор БСК® 25G/40 25G/18 в составе: микро-канюля 25G/40 мм, игла для прокола 25G/18 мм; Стерильный набор БСК® 25G/50 25G/18 в составе: микро-канюля 25G/50 мм, игла для прокола 25G/18 мм; Стерильный набор БСК® 25G/60 25G/18, в составе: микро-канюля 25G/60 мм, игла для прокола



Рис. 19. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) вариантов исполнения



Стерильный набор БСК® для инъекций  
Sterile BSK® Injection kit



Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

### BSK® Micro-Cannula

|     |          |
|-----|----------|
| REF | LY-C-016 |
| LOT | 20221215 |
|     | 20221215 |
|     | 20271214 |
|     | 26G/13mm |
|     | 26G/16mm |

Рис. 20. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 26G/13 26G/16, в составе: микро-канюля 26G/13 мм, игла для прокола 26G/16 мм;

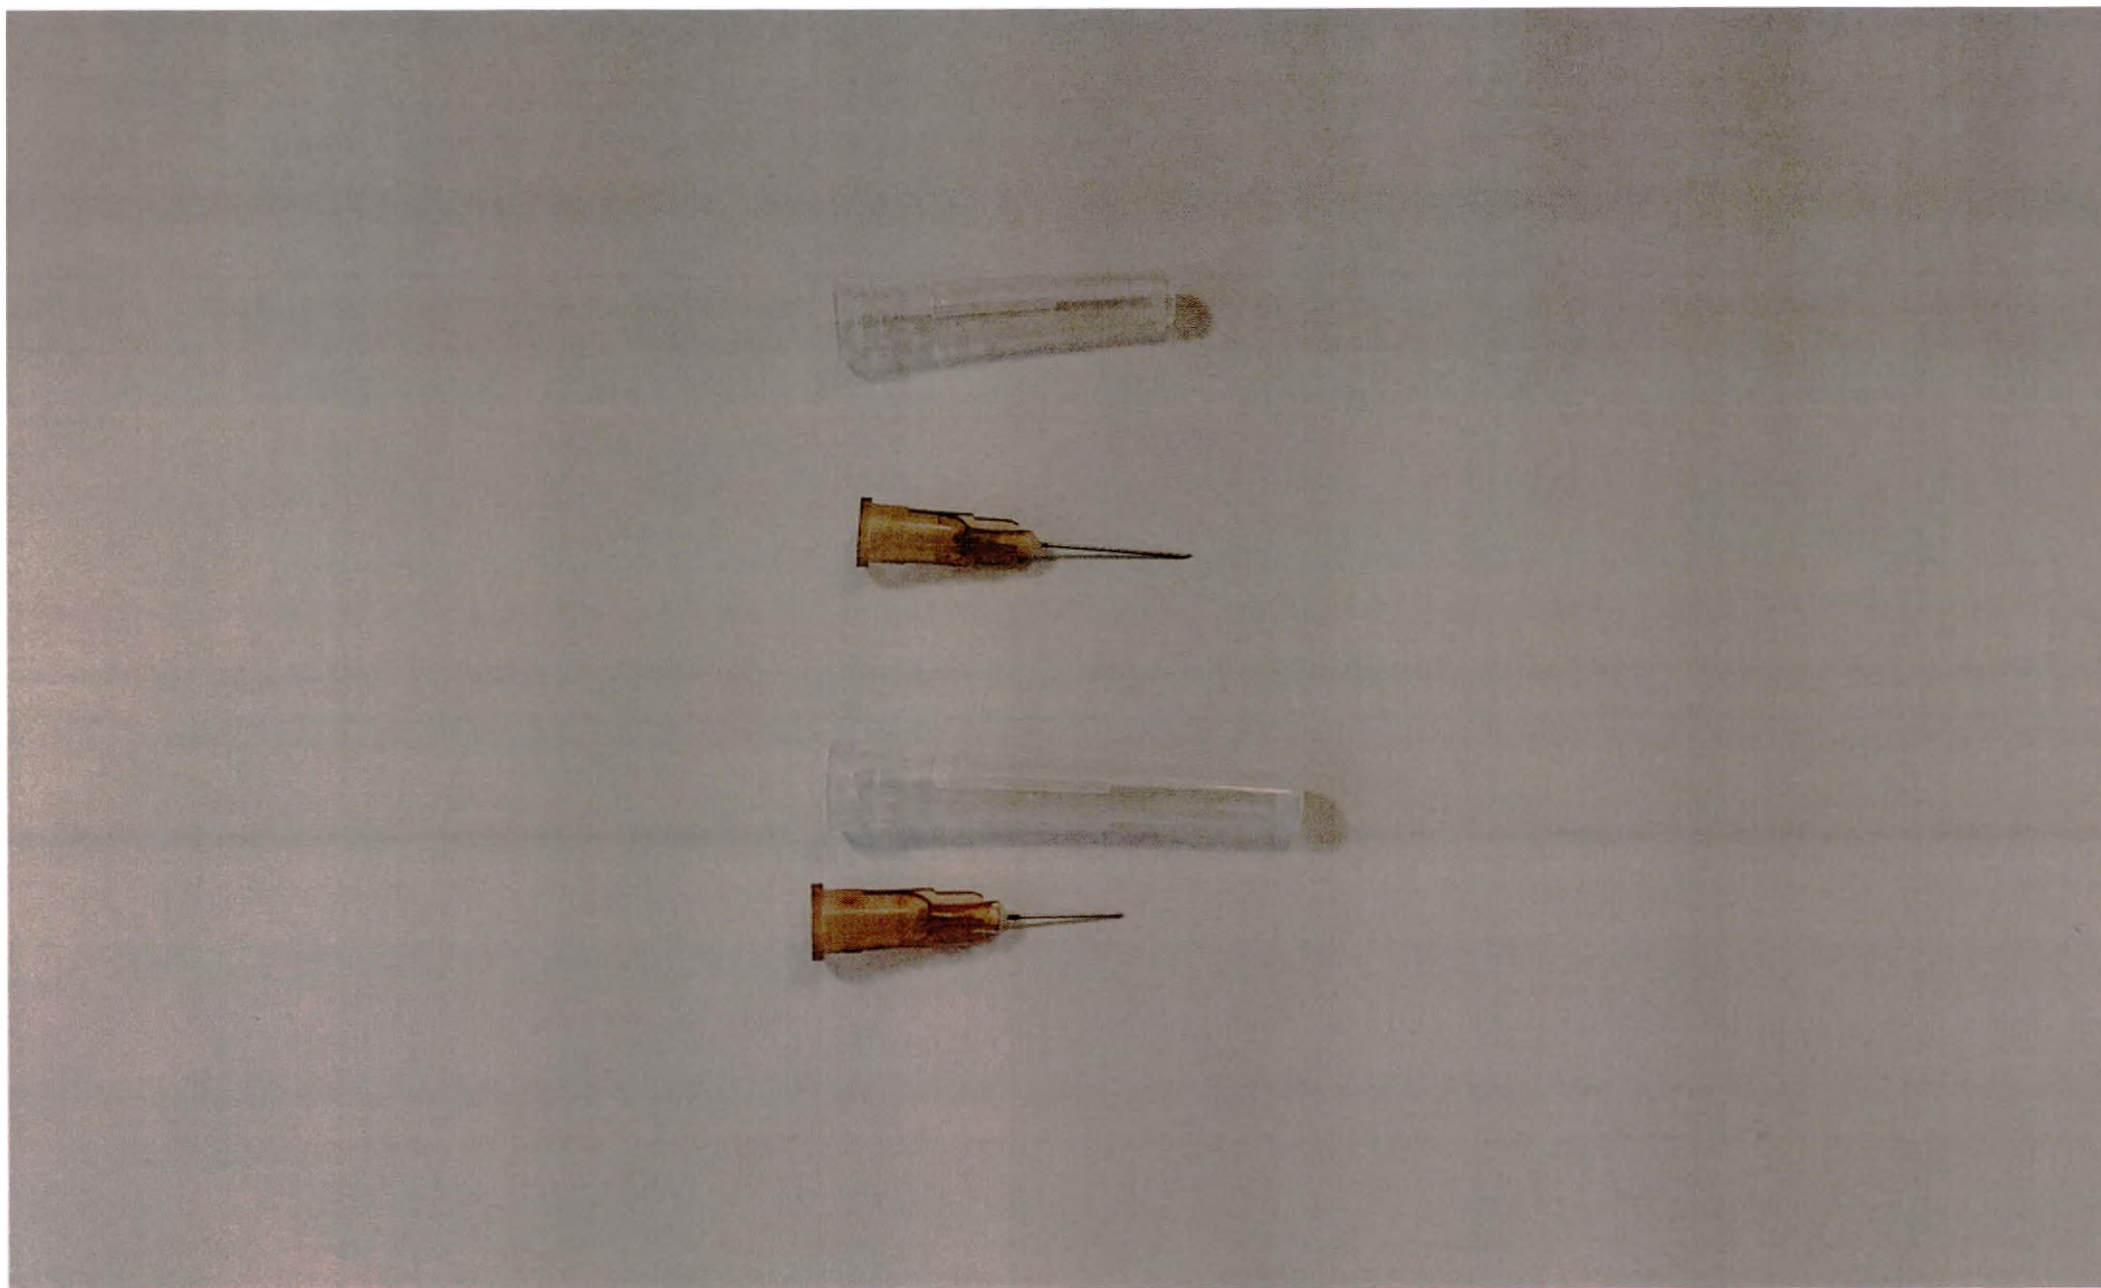


Рис. 21. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 26G/13 26G/16, в составе: микро-канюля 26G/13 мм, игла для прокола 26G/16 мм;



Рис.22. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 27G/25 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/25 мм, игла для прокола 27G/13 мм; Стерильный набор БСК® 27G/40 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/40 мм, игла для прокола 27G/13 мм; Стерильный набор БСК® 27G/50 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/50 мм, игла для прокола 27G/13 мм;

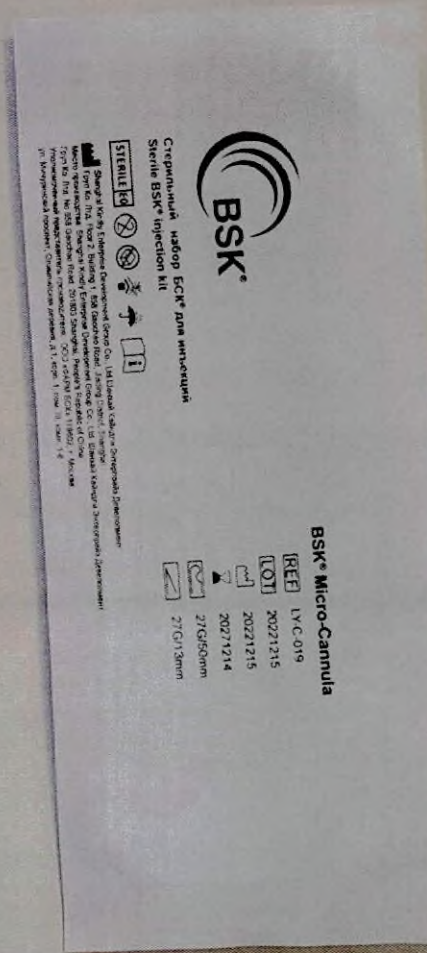
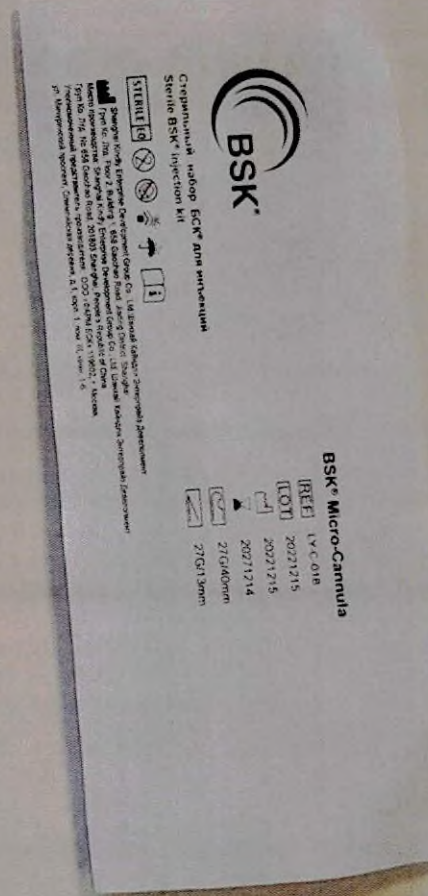


Рис. 23. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 27G/25 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/25 мм, игла для прокола 27G/13 мм; Стерильный набор БСК® 27G/40 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/40 мм, игла для прокола 27G/13 мм; Стерильный набор БСК® 27G/50 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/50 мм, игла для прокола 27G/13 мм;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


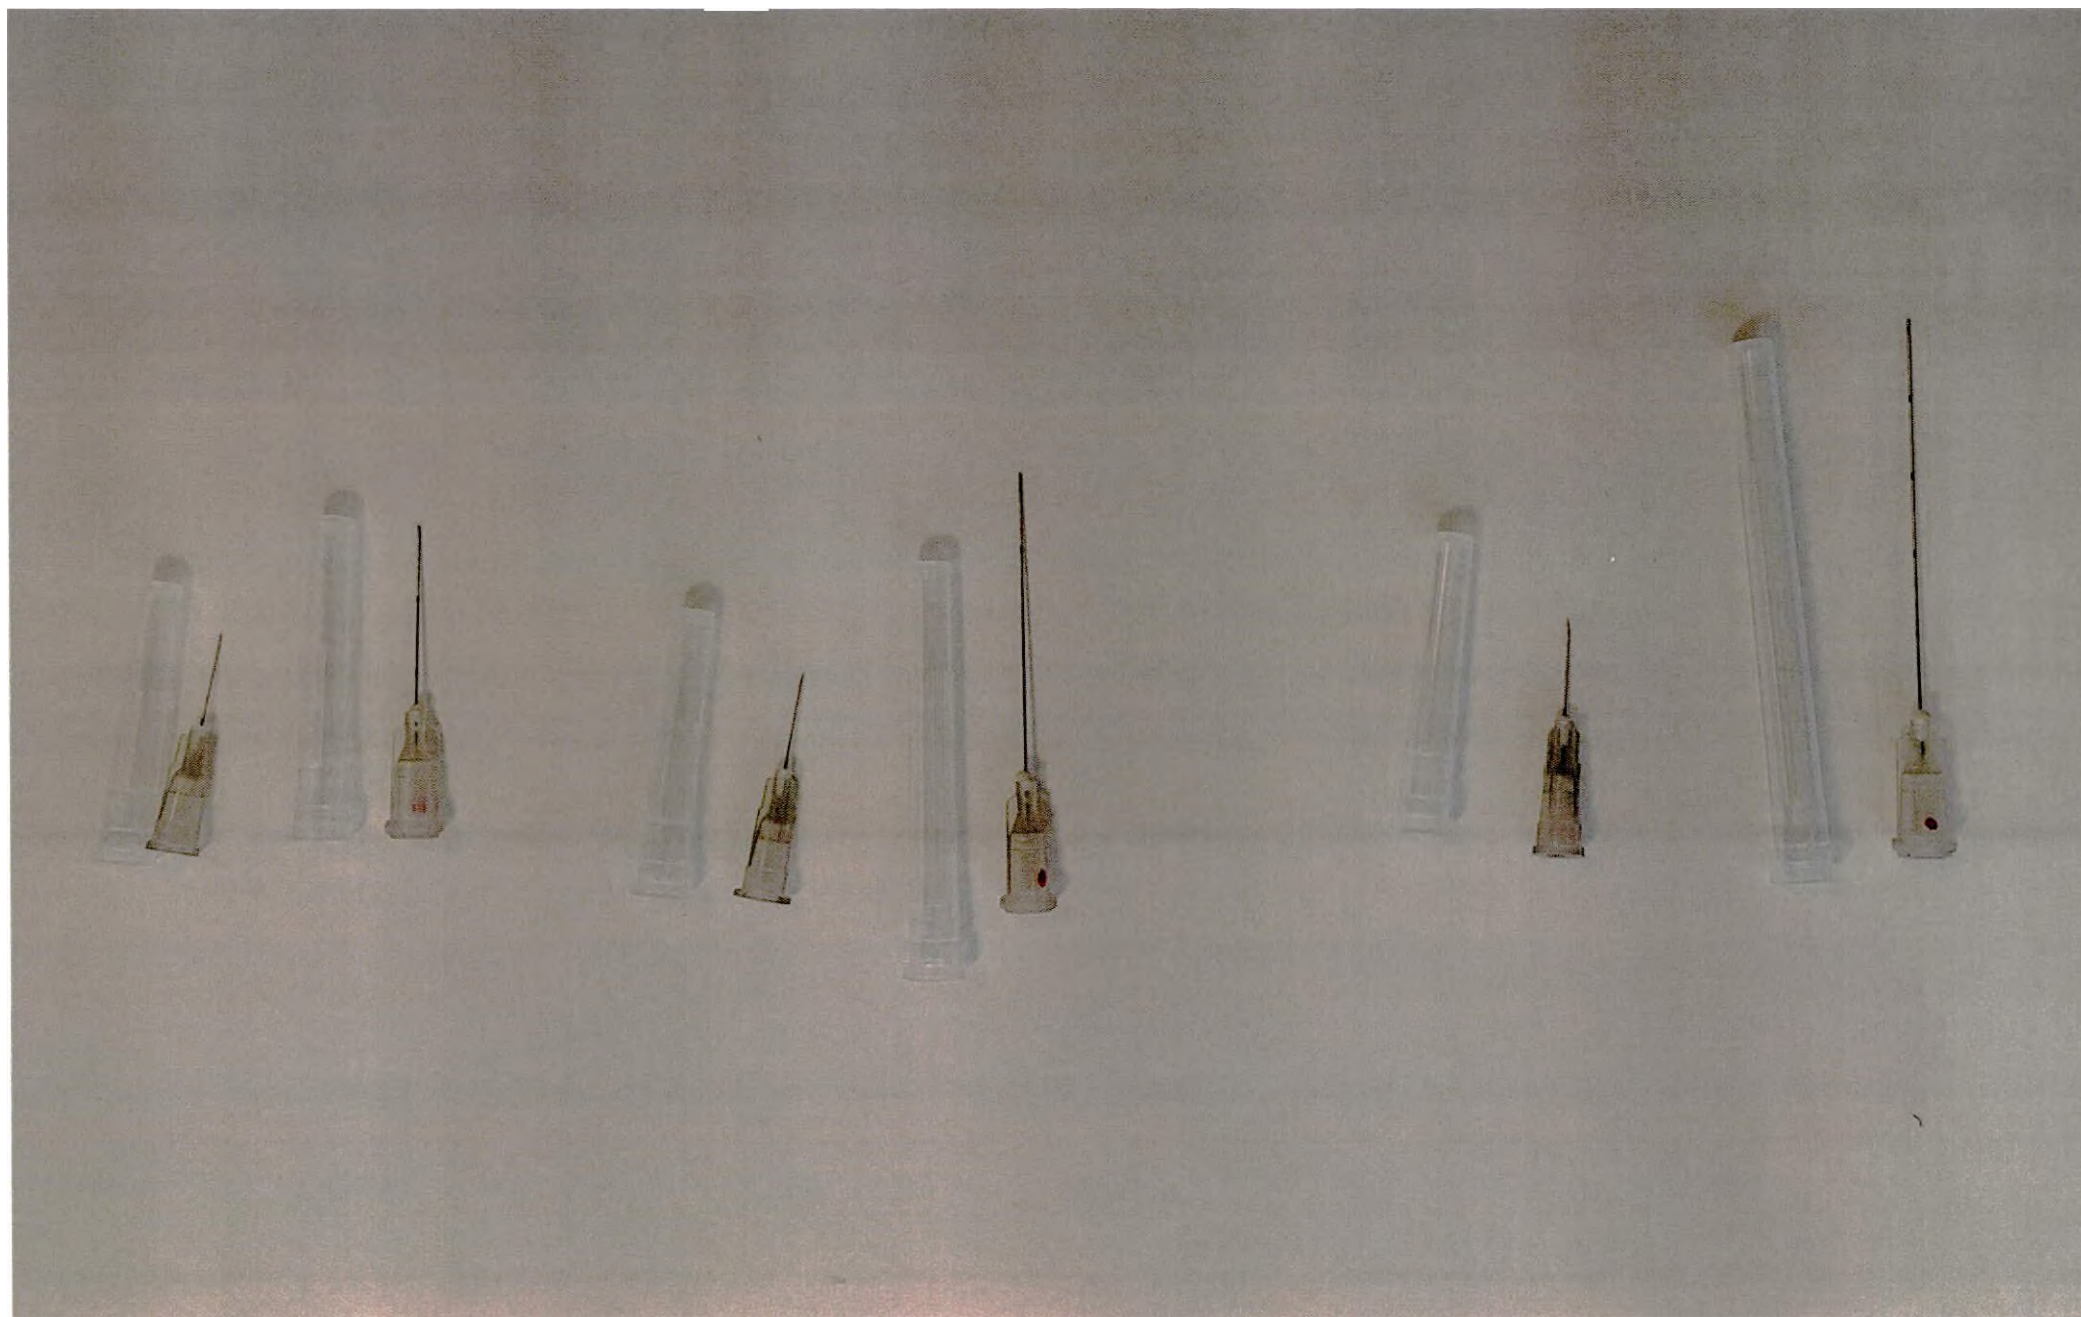


Рис. 24. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 27G/25 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/25 мм, игла для прокола 27G/13 мм; Стерильный набор БСК® 27G/40 27G/13 в составе: микро-канюля 27G/40 мм, игла для прокола 27G/13 мм; Стерильный набор БСК® 27G/50 27G/13 в





STERILE EO      

 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтэрпрайз Девелопмент Груп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтэрпрайз Девелопмент Груп Ко. Лтд. No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва, ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | LY-C-020 |
|  | 20221215 |
|  | 20221215 |
|  | 20271214 |
|  | 30G/25mm |
|  | 30G/13mm |

Рис. 26. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® 30G/25 30G/13 в составе: микро-канюля 30G/25 мм, игла для прокола 30G/13 мм;



Рис.27. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® 30G/25 30G/13 в составе: микро-канюля 30G/25 мм, игла для прокола


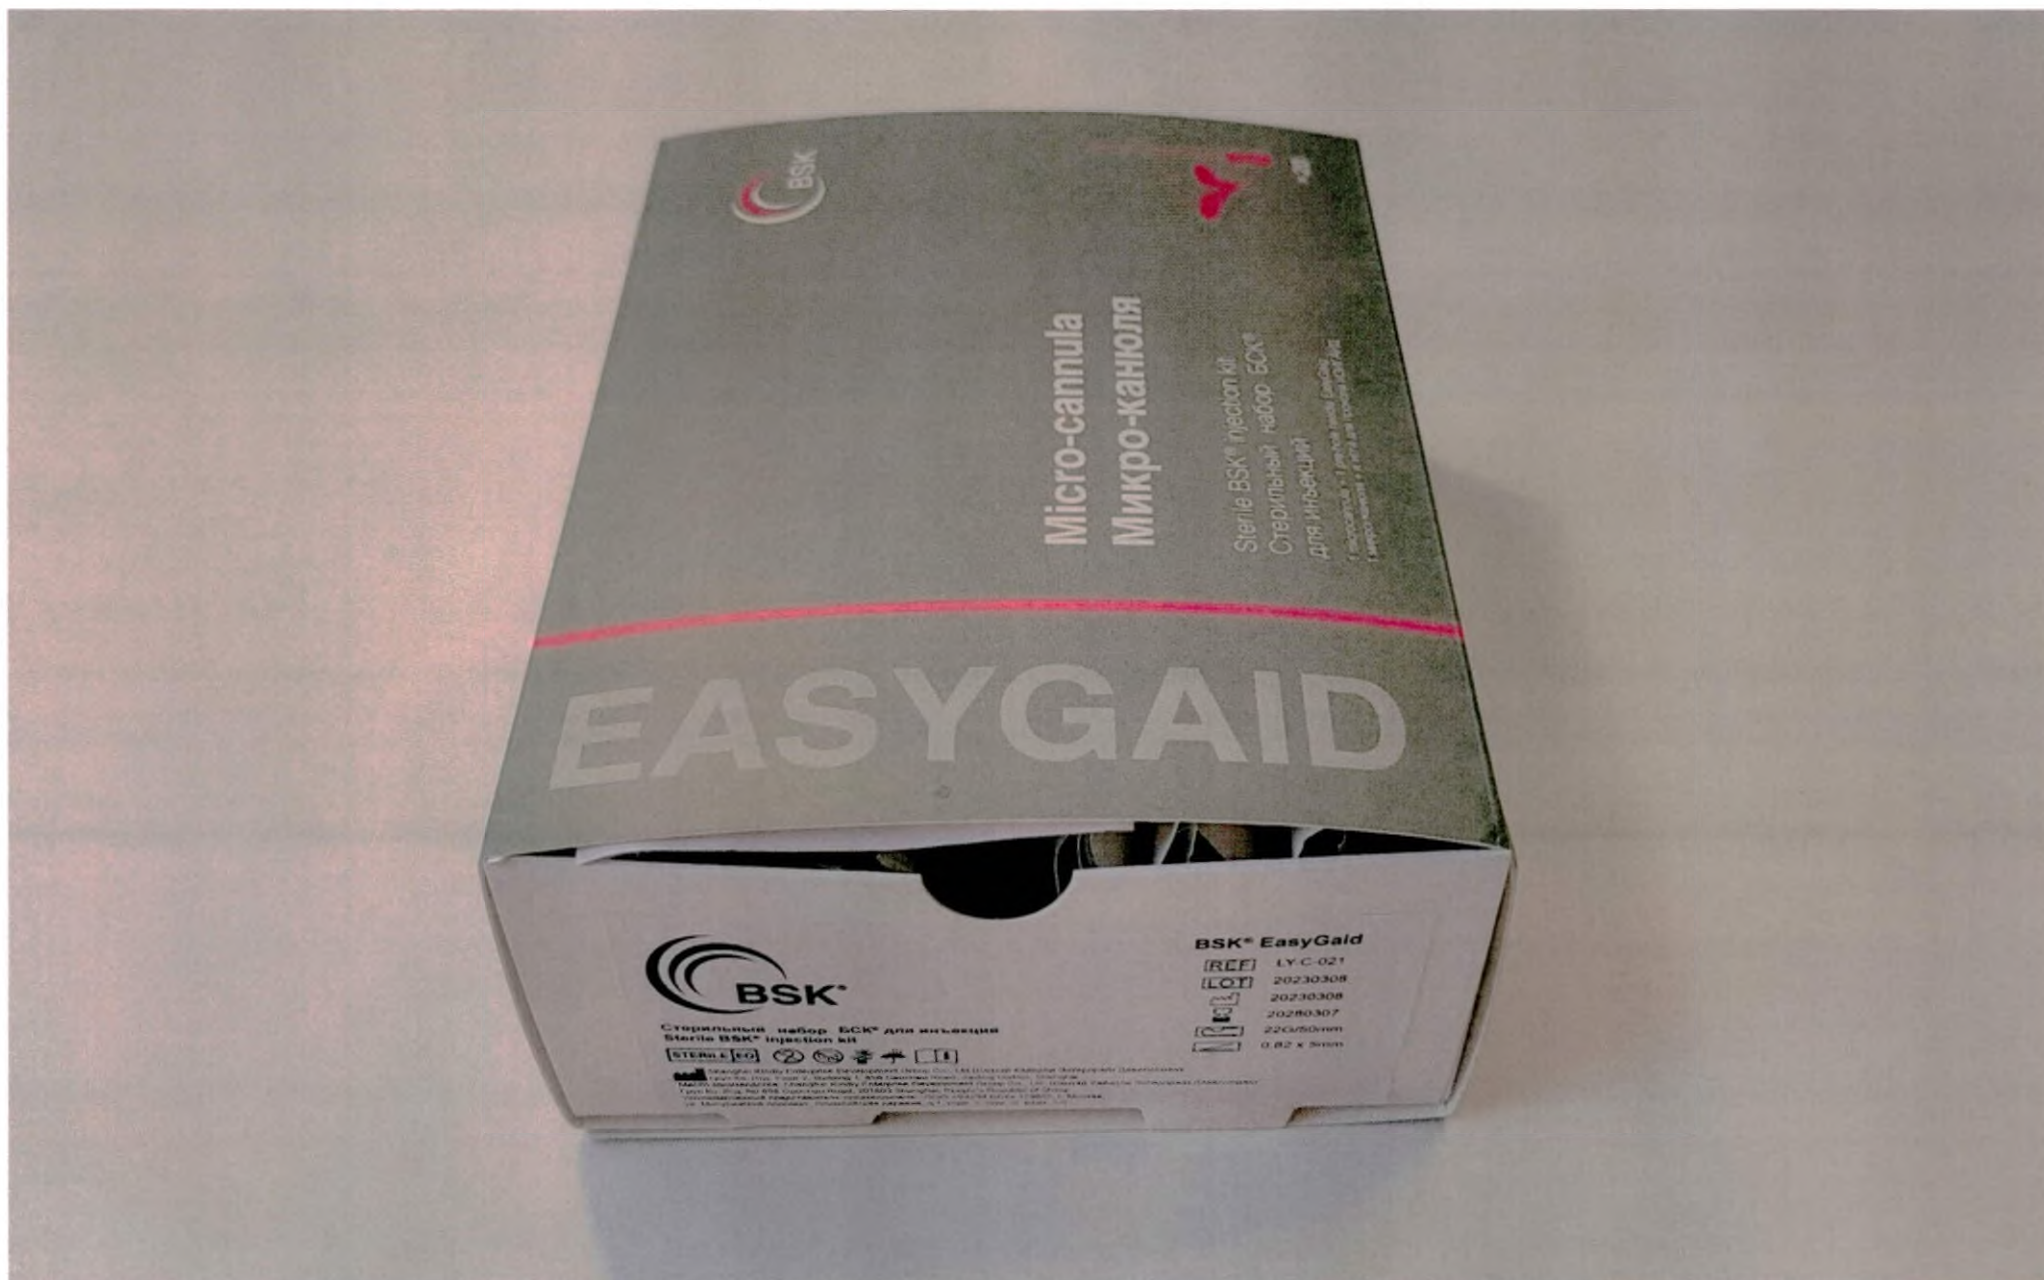


Рис.28. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигаид) 22G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 22G/50мм, игла для прокола 0,82x5 мм;



Стерильный набор БСК® для инъекций  
Sterile BSK® injection kit



Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Группа Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Группа Ко. Лтд. No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

### BSK® EasyGaid

|     |             |
|-----|-------------|
| REF | LY-C-021    |
| LOT | 20230308    |
|     | 20230308    |
|     | 20280307    |
|     | 22G/50mm    |
|     | 0,82 x 5 mm |

Рис. 29. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 22G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 22G/50мм, игла для прокола 0,82x5 мм;



Рис. 30. Общий вид лицевой стороны блистера с медицинским изделием, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигаид) 22G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 22G/50мм, игла для прокола 0,82x5 мм;

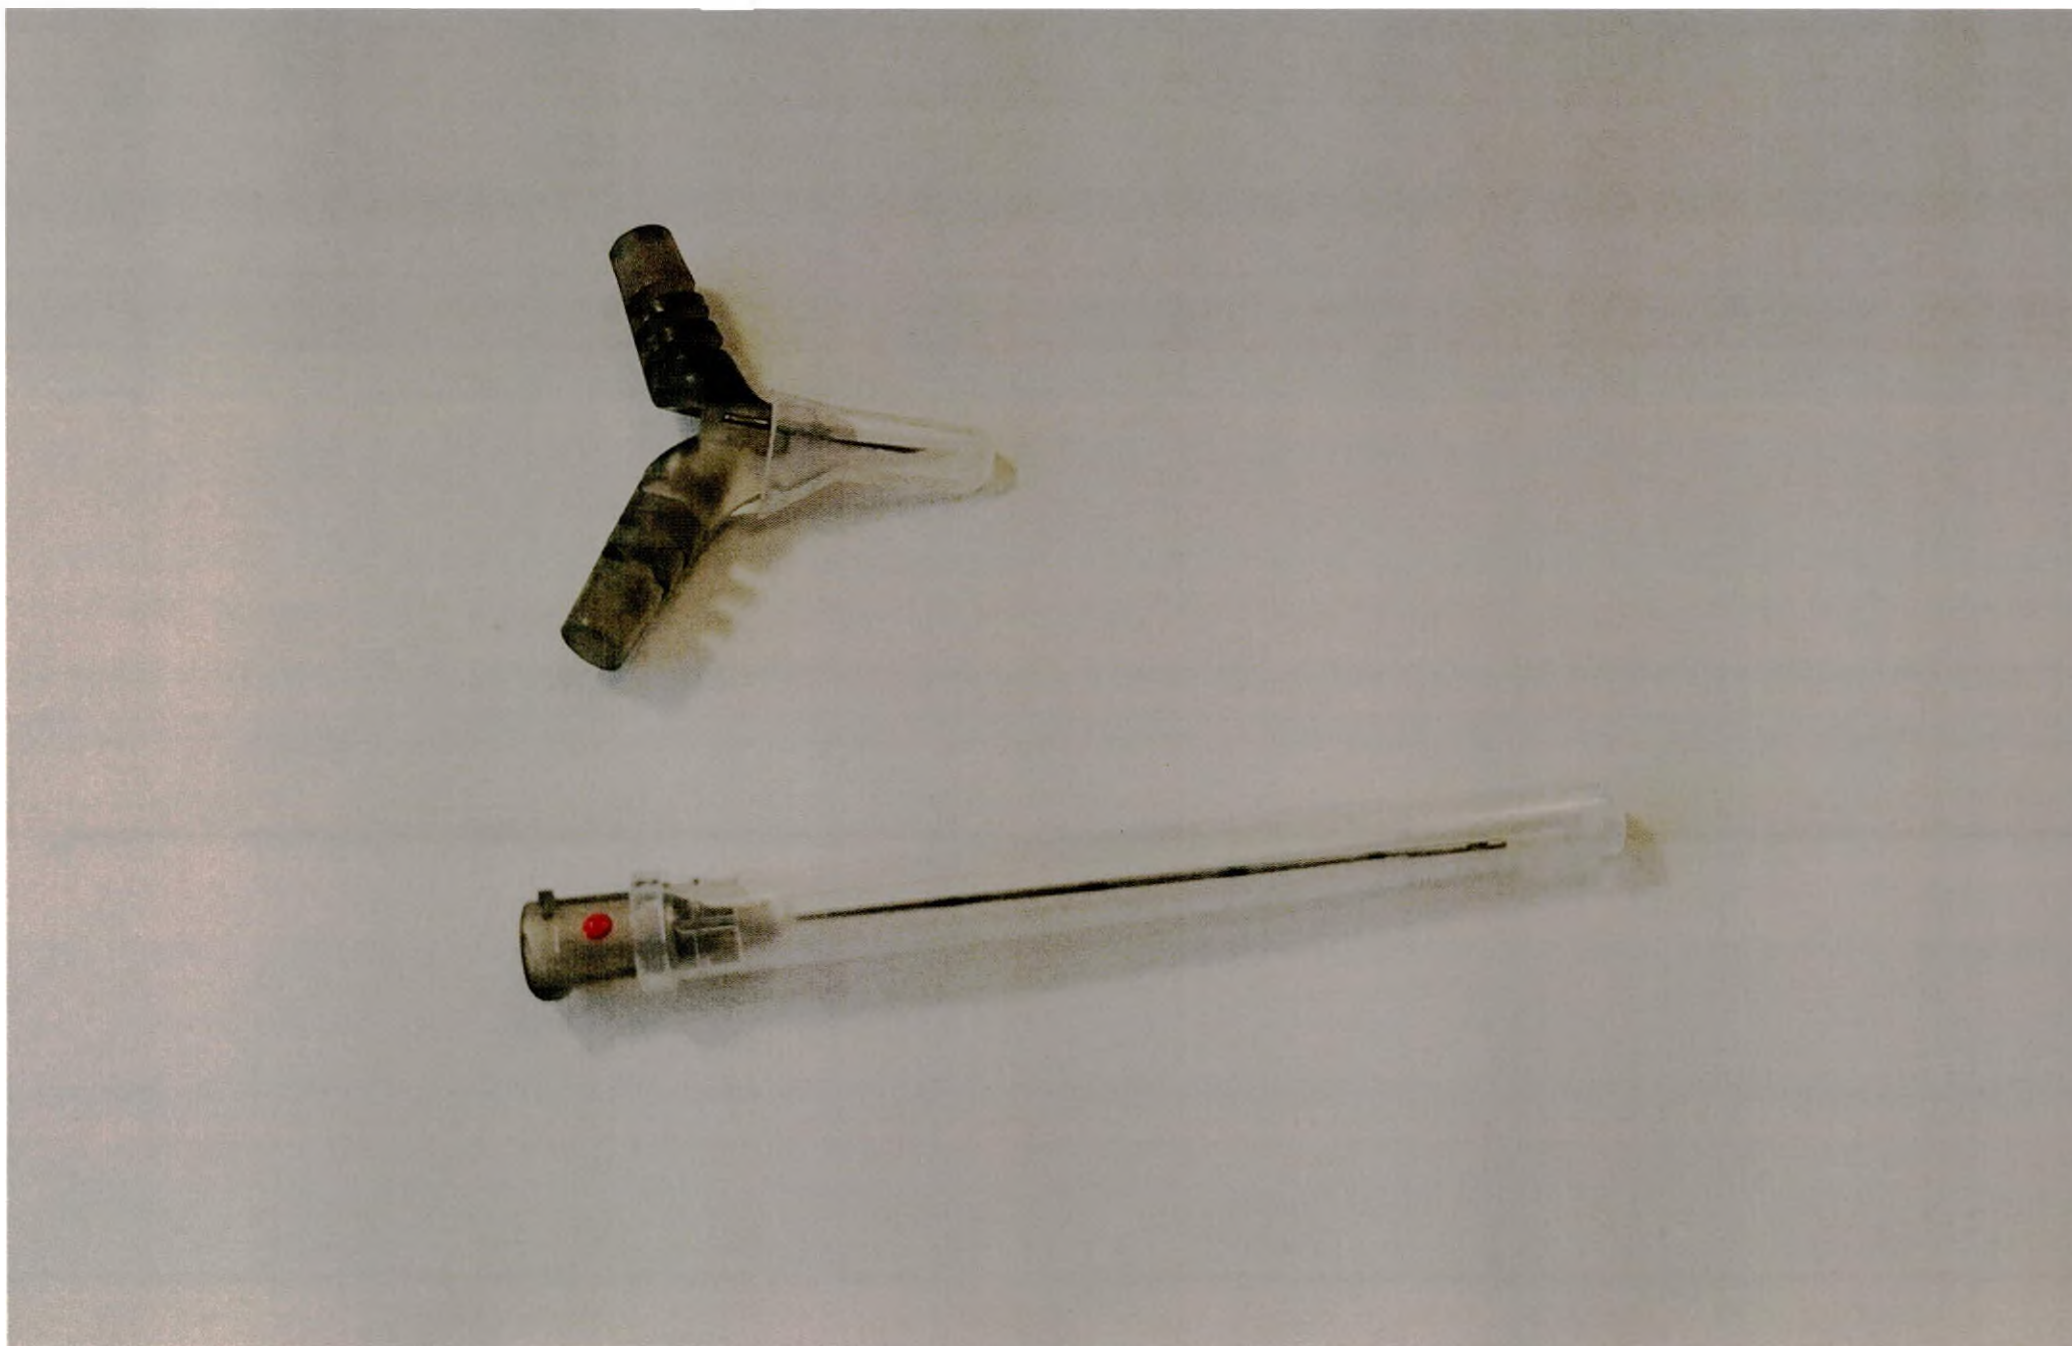


Рис.31. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 22G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля


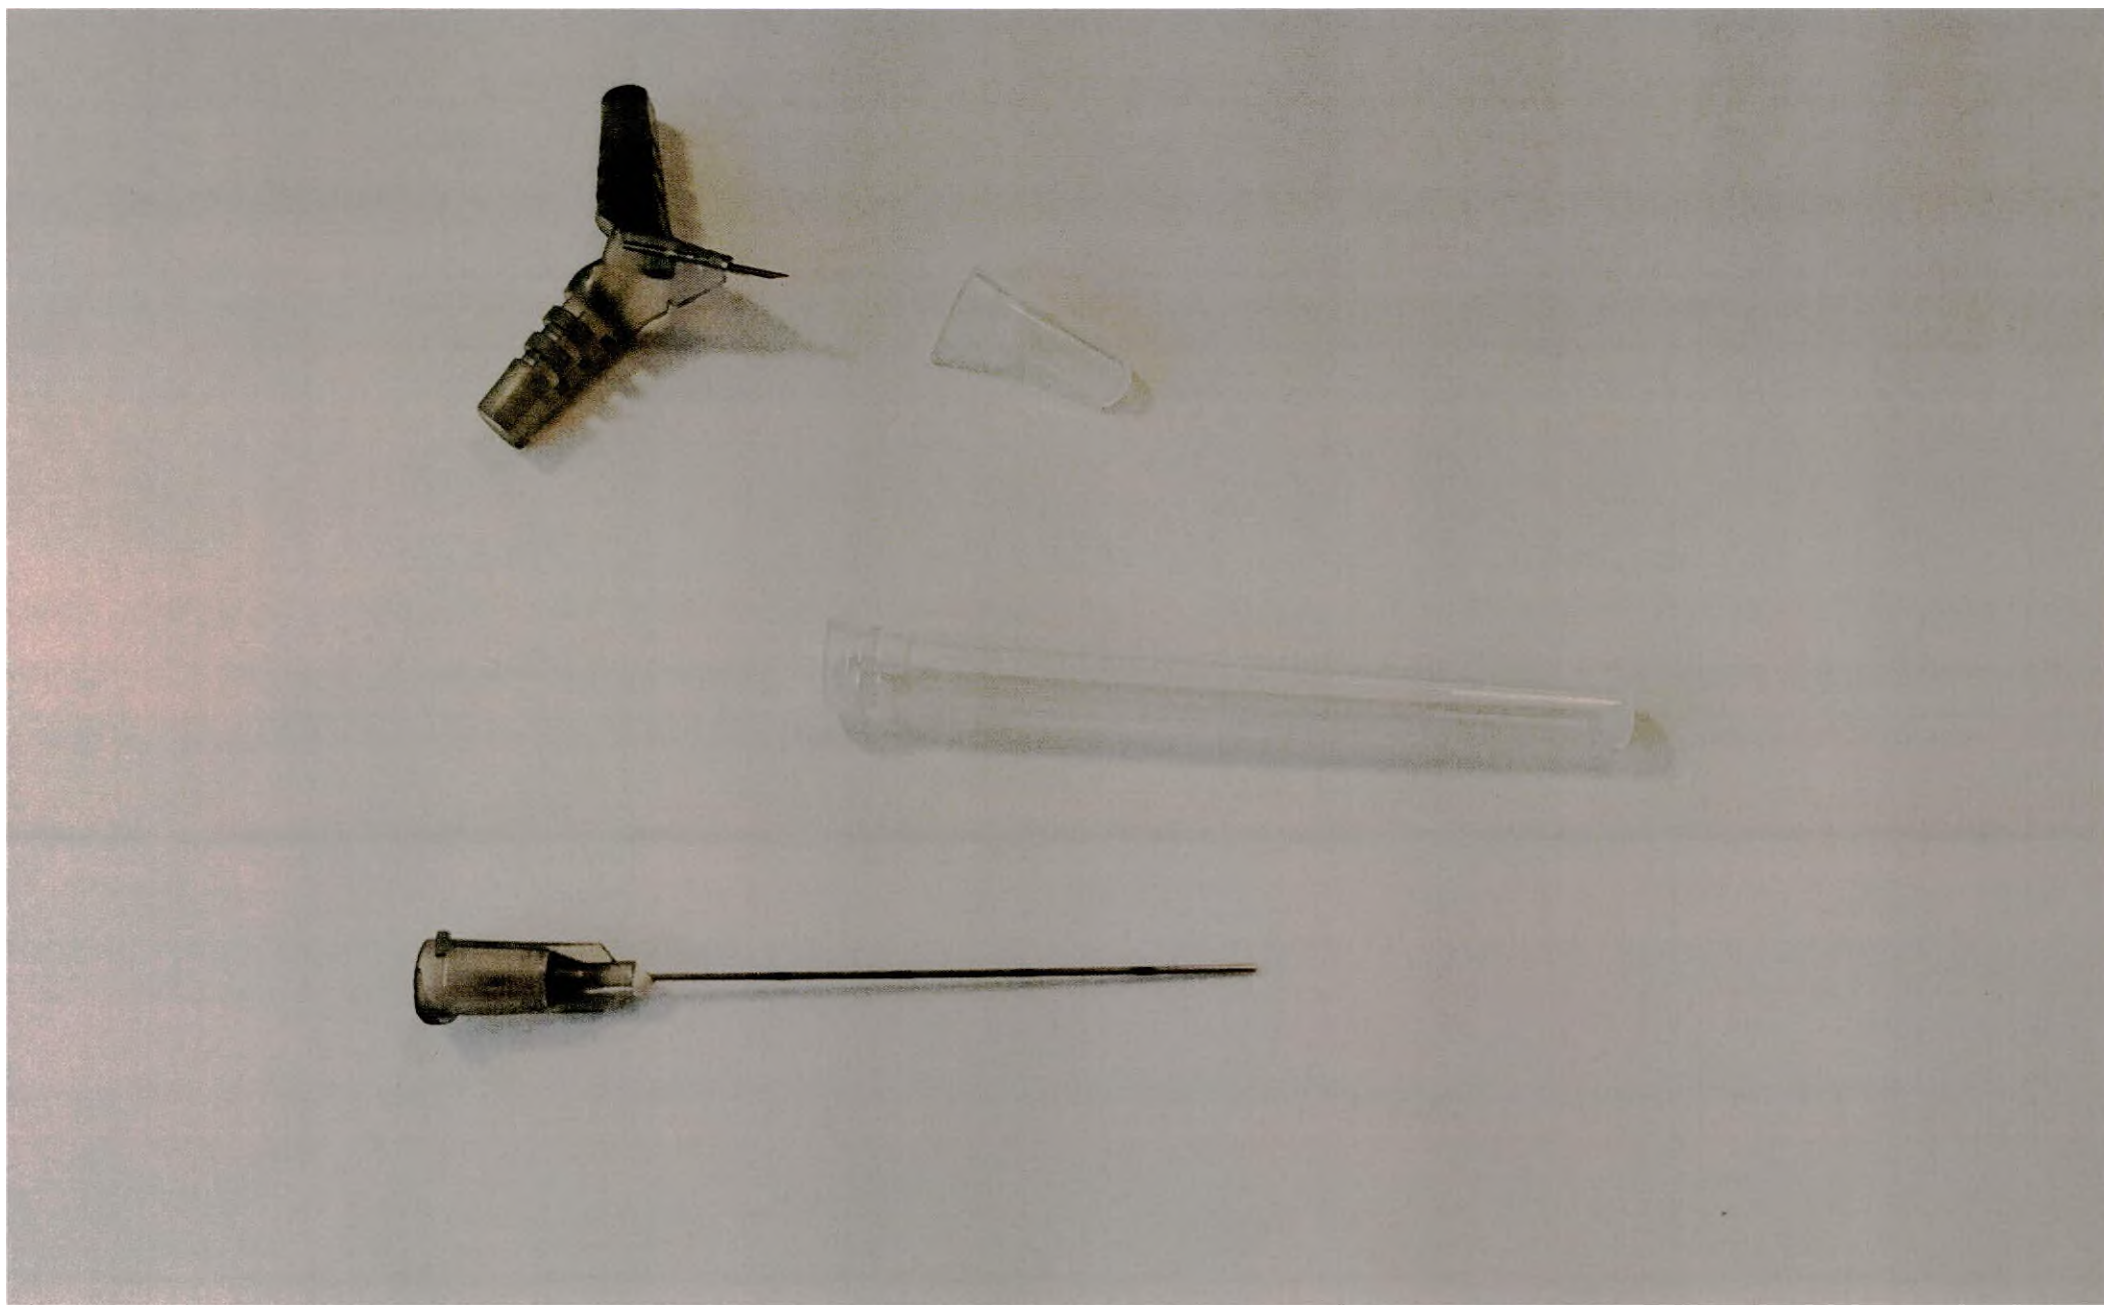


Рис. 32. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигаид) 22G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 22G/50мм, игла для прокола 0,82x5 мм;



Стерильный набор БСК® для инъекций  
Sterile BSK® injection kit



Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

### BSK® EasyGaid

|     |             |
|-----|-------------|
| REF | LY-C-022    |
| LOT | 20230308    |
|     | 20230308    |
|     | 20280307    |
|     | 23G/70mm    |
|     | 0,82 x 5 mm |

Рис. 33. Общий вид оборотной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигаид) 23G/70 0,82x5 в составе: микро-канюля 23G/70 мм, игла для прокола 0,82x5 мм;

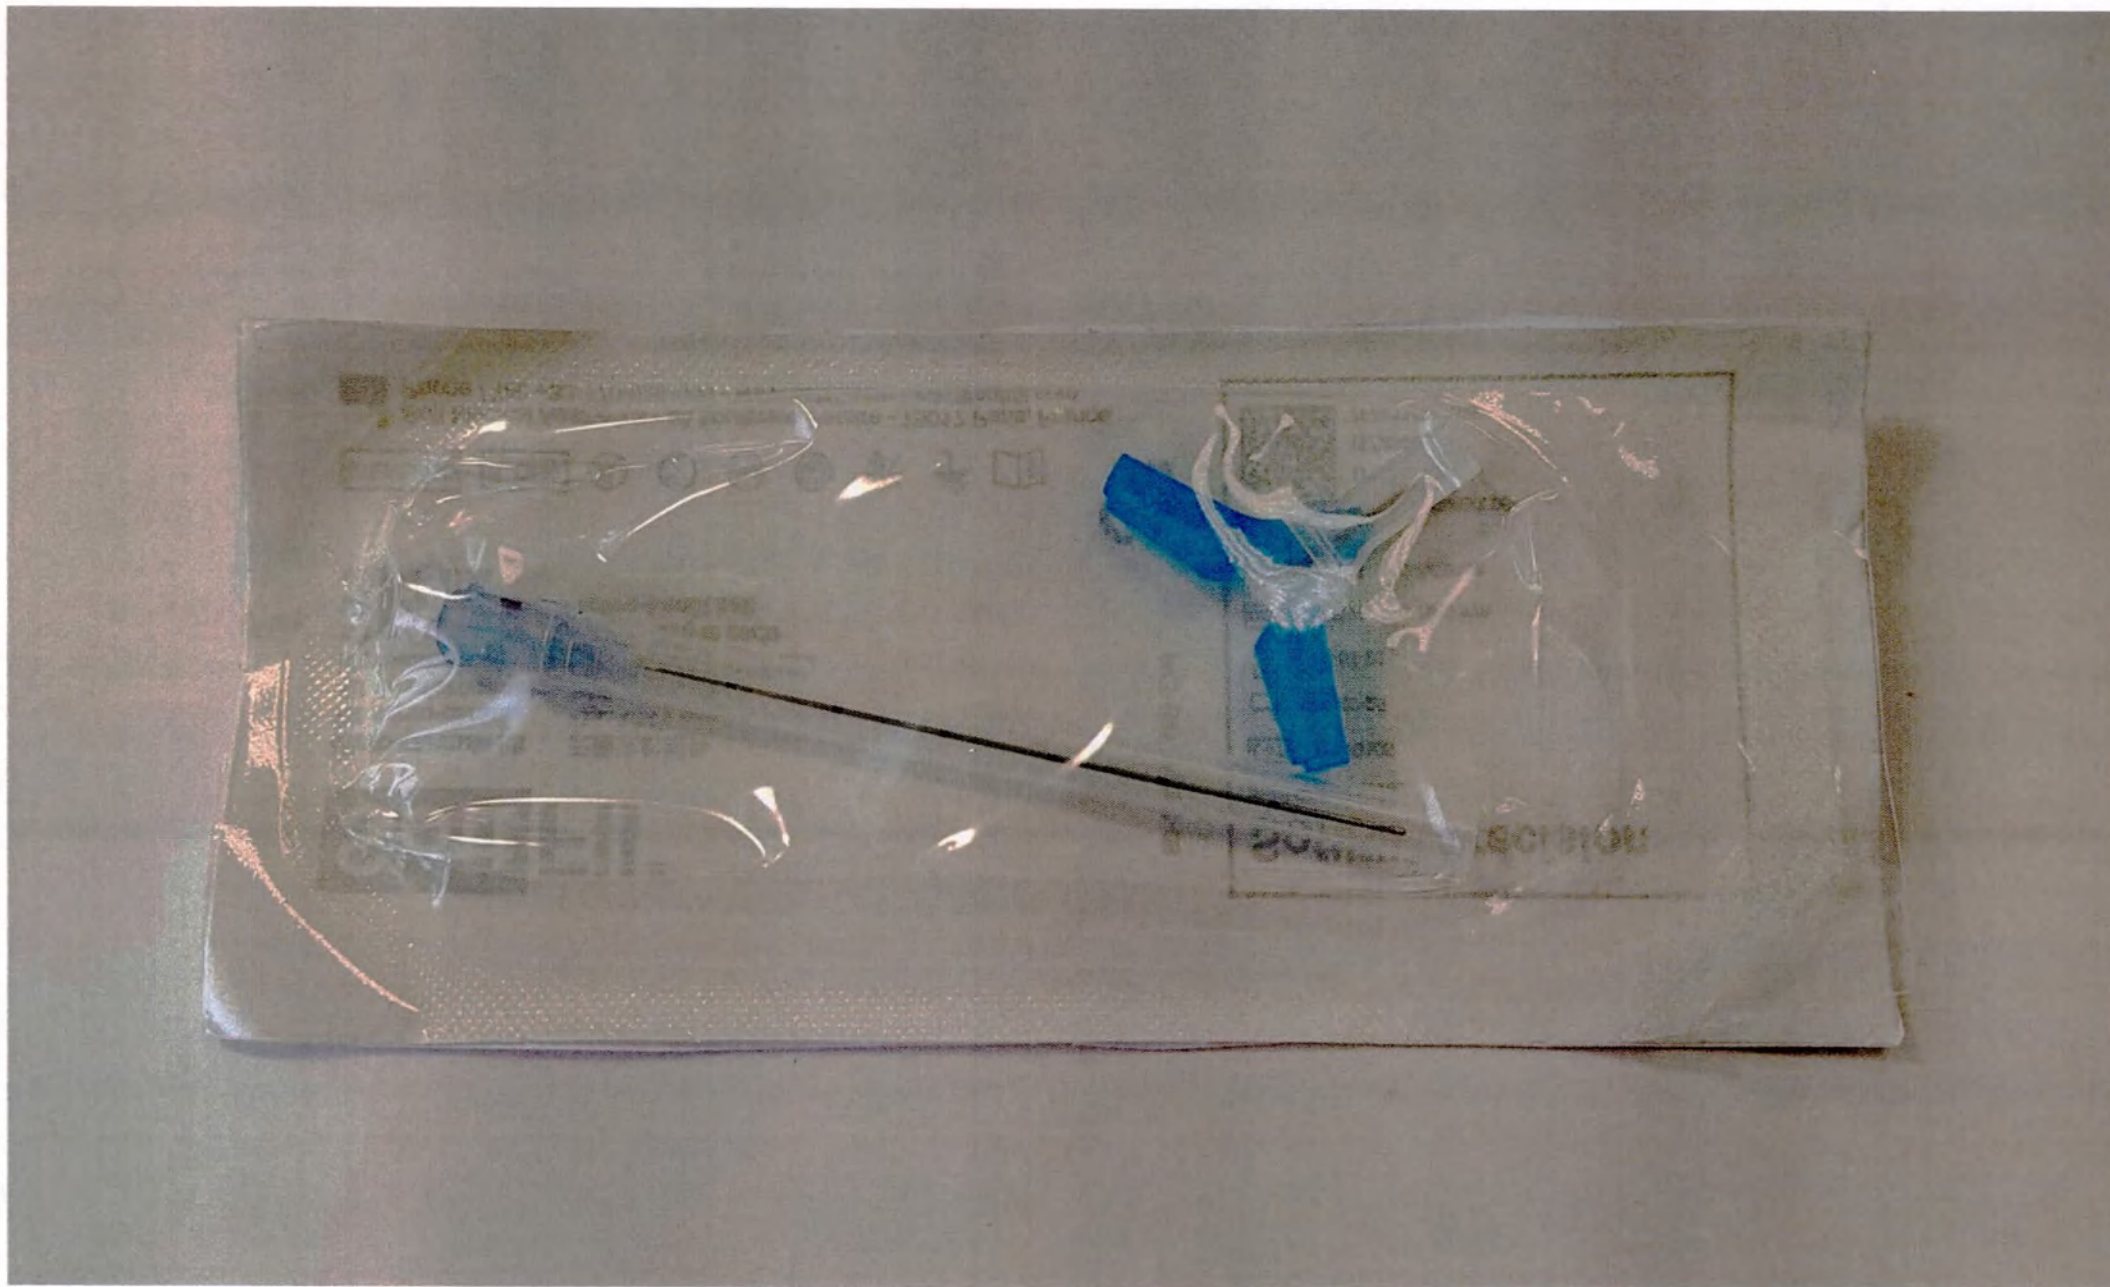


Рис. 34. Общий вид лицевой стороны блистера с медицинским изделием, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 23G/70 0,82x5 в составе: микро-канюля 23G/70 мм, игла для прокола 0,82x5 мм;

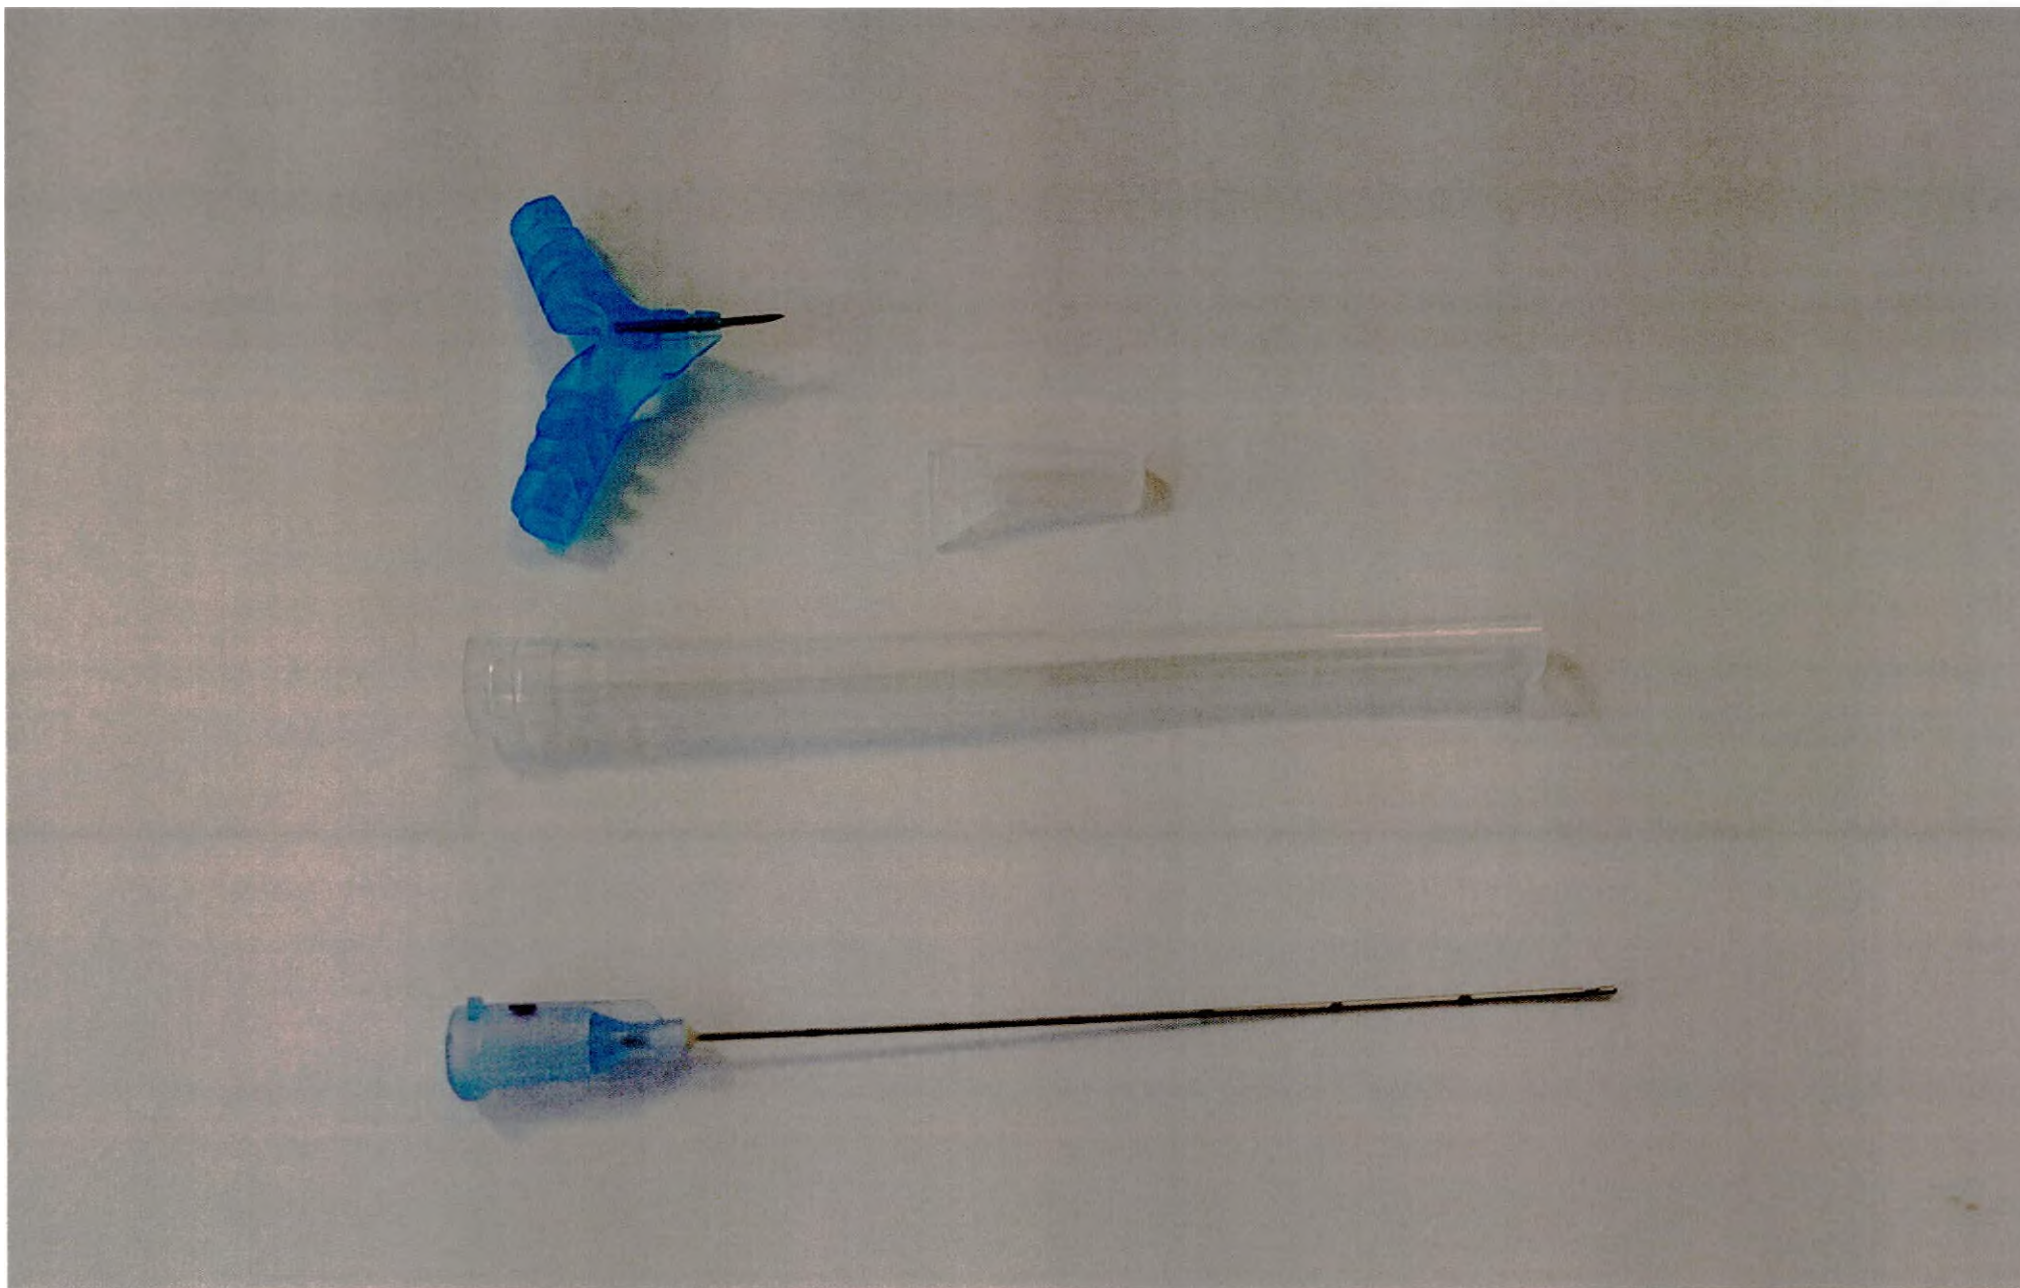


Рис. 35. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 23G/70 0,82x5 в составе: микро-канюля 23G/70 мм, игла для прокола 0,82x5 мм;



Рис. 36. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/40 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/40 мм, игла для прокола 0,82x5 мм; Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/50 мм, игла для прокола 0,82x5 мм; Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/60 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/60 мм, игла для прокола 0,82x5 мм;

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REF                                                                                 | LY-C-023    |
| LOT                                                                                 | 20230308    |
|  | 20230308    |
|  | 20280307    |
|  | 25G/40mm    |
|  | 0.82 x 5 mm |

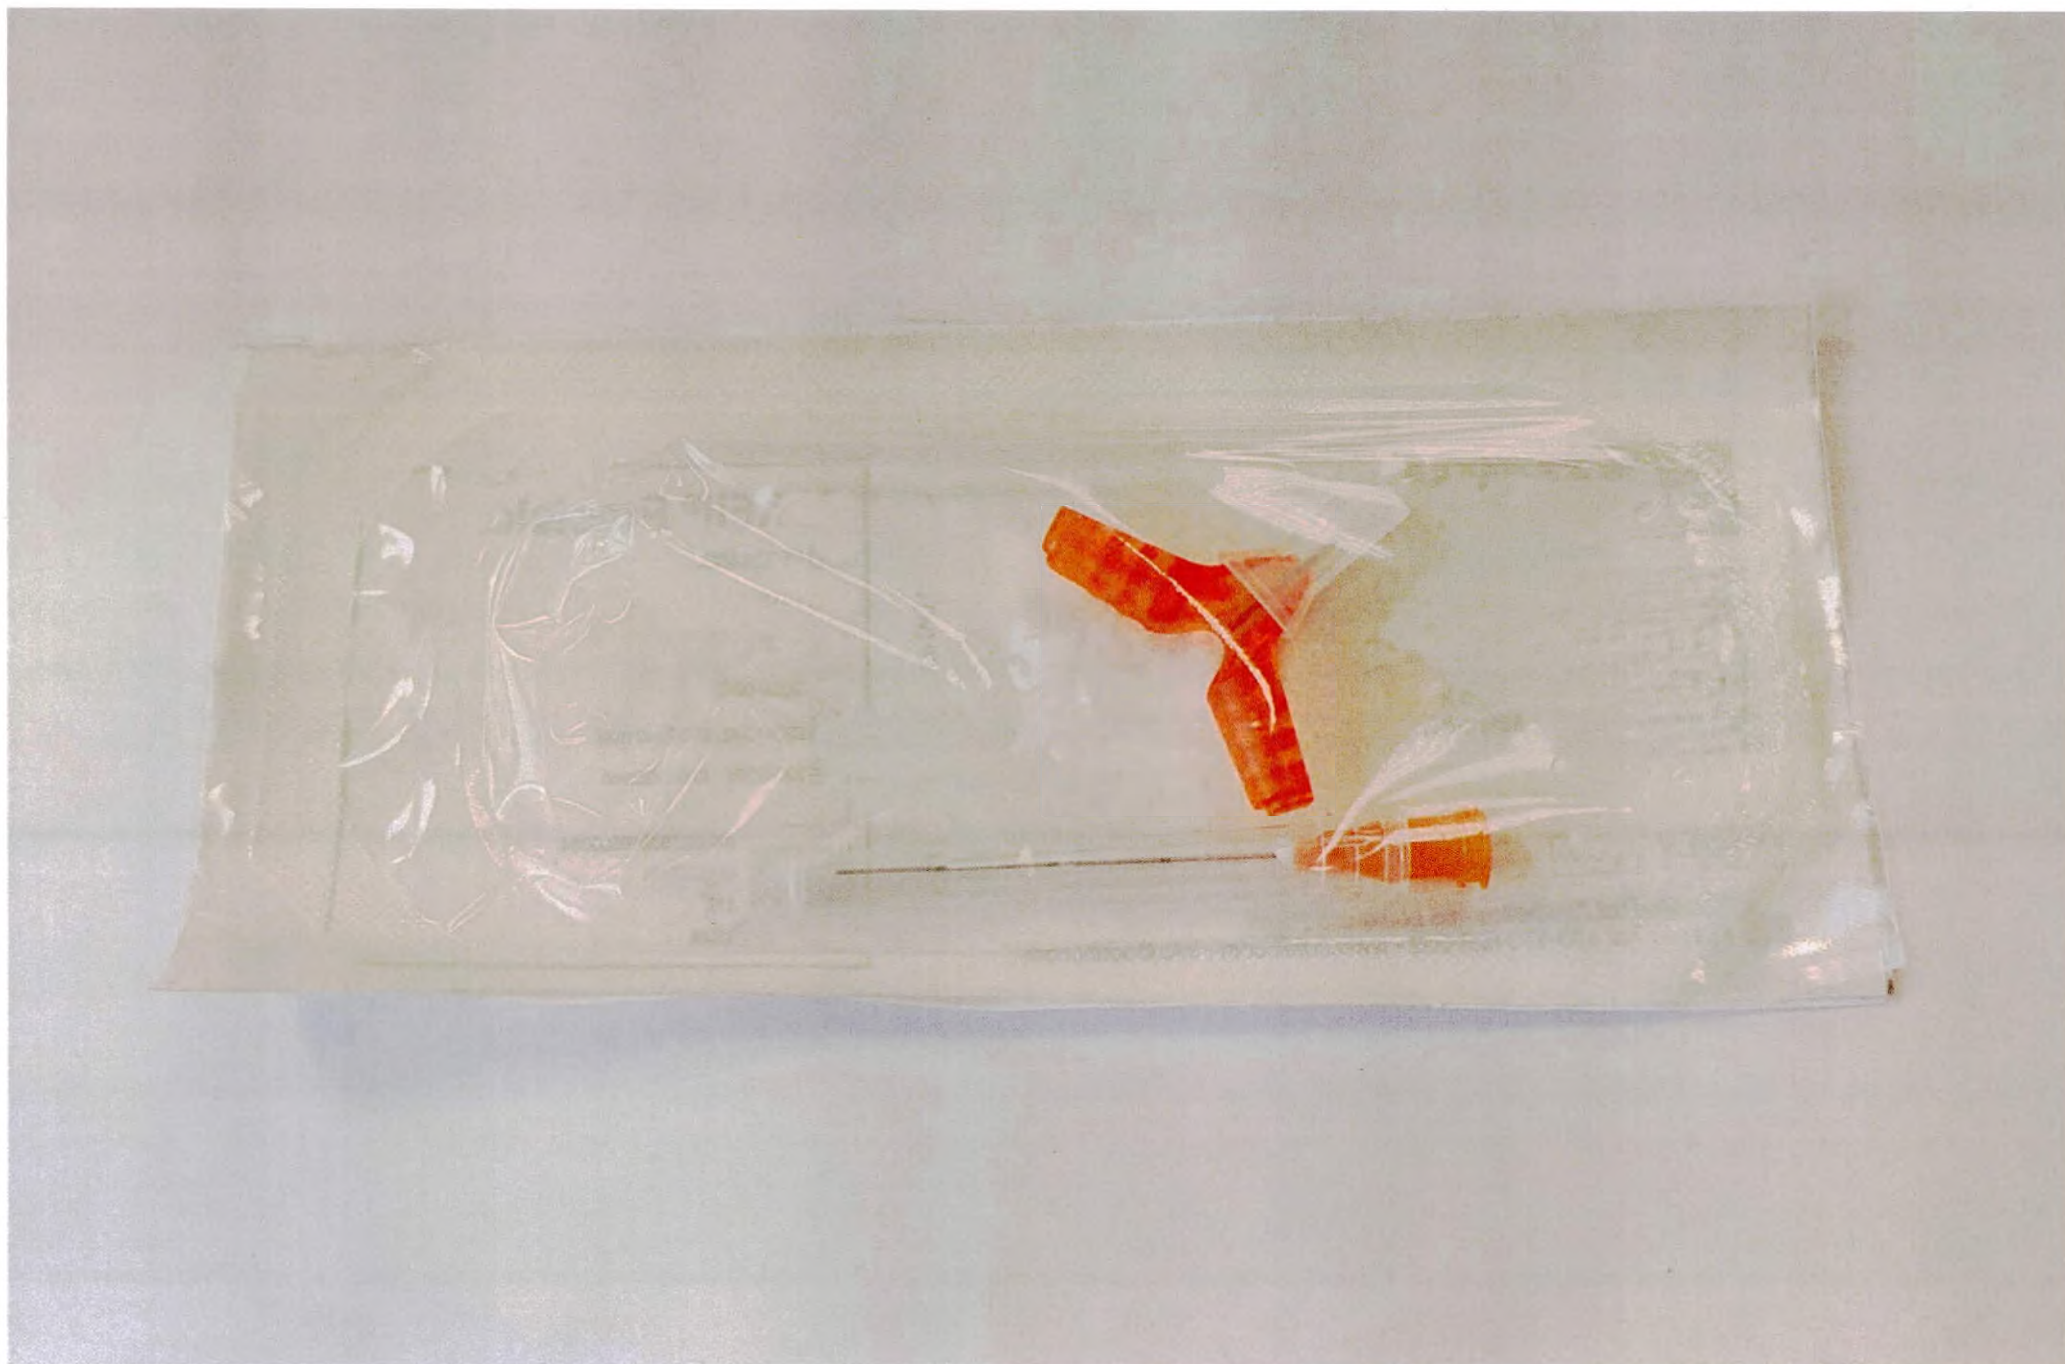


Рис. 38. Общий вид лицевой стороны блистера с медицинским изделием, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/40 0,82x5 в


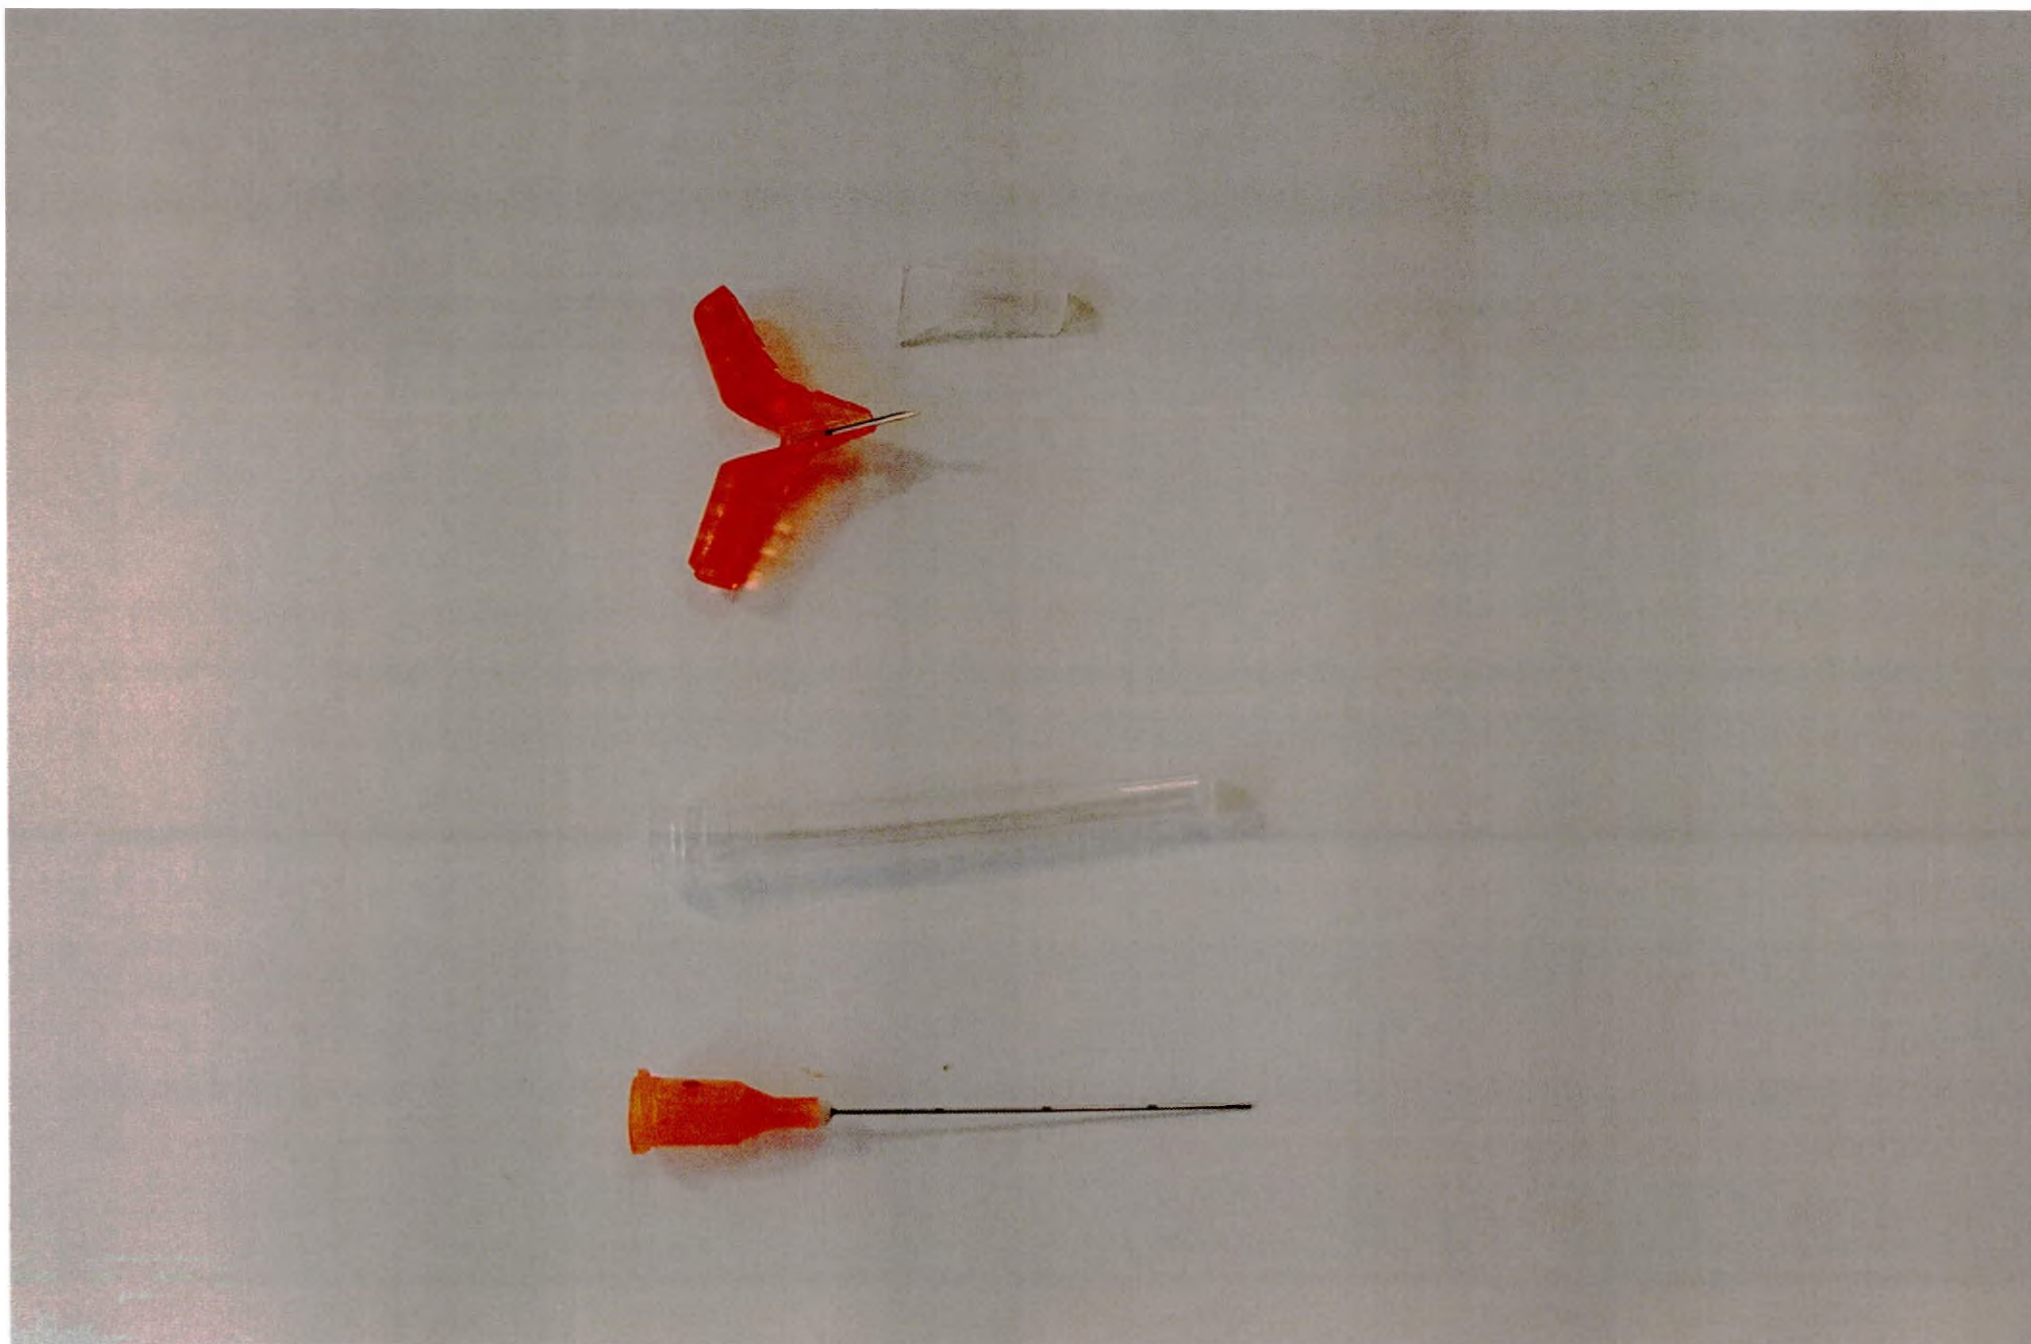


Рис. 39. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/40 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/40 мм, игла для прокола 0,82x5 мм.



Стерильный набор БСК® для инъекций  
Sterile BSK® injection kit



Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Груп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Груп Ко. Лтд. No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

### BSK® EasyGaid

|     |             |
|-----|-------------|
| REF | LY-C-024    |
| LOT | 20230308    |
|     | 20230308    |
|     | 20280307    |
|     | 25G/50mm    |
|     | 0,82 x 5 mm |

Рис. 40. Общий вид обратной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигаид) 25G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/50 мм, игла для прокола 0,82x5 мм;

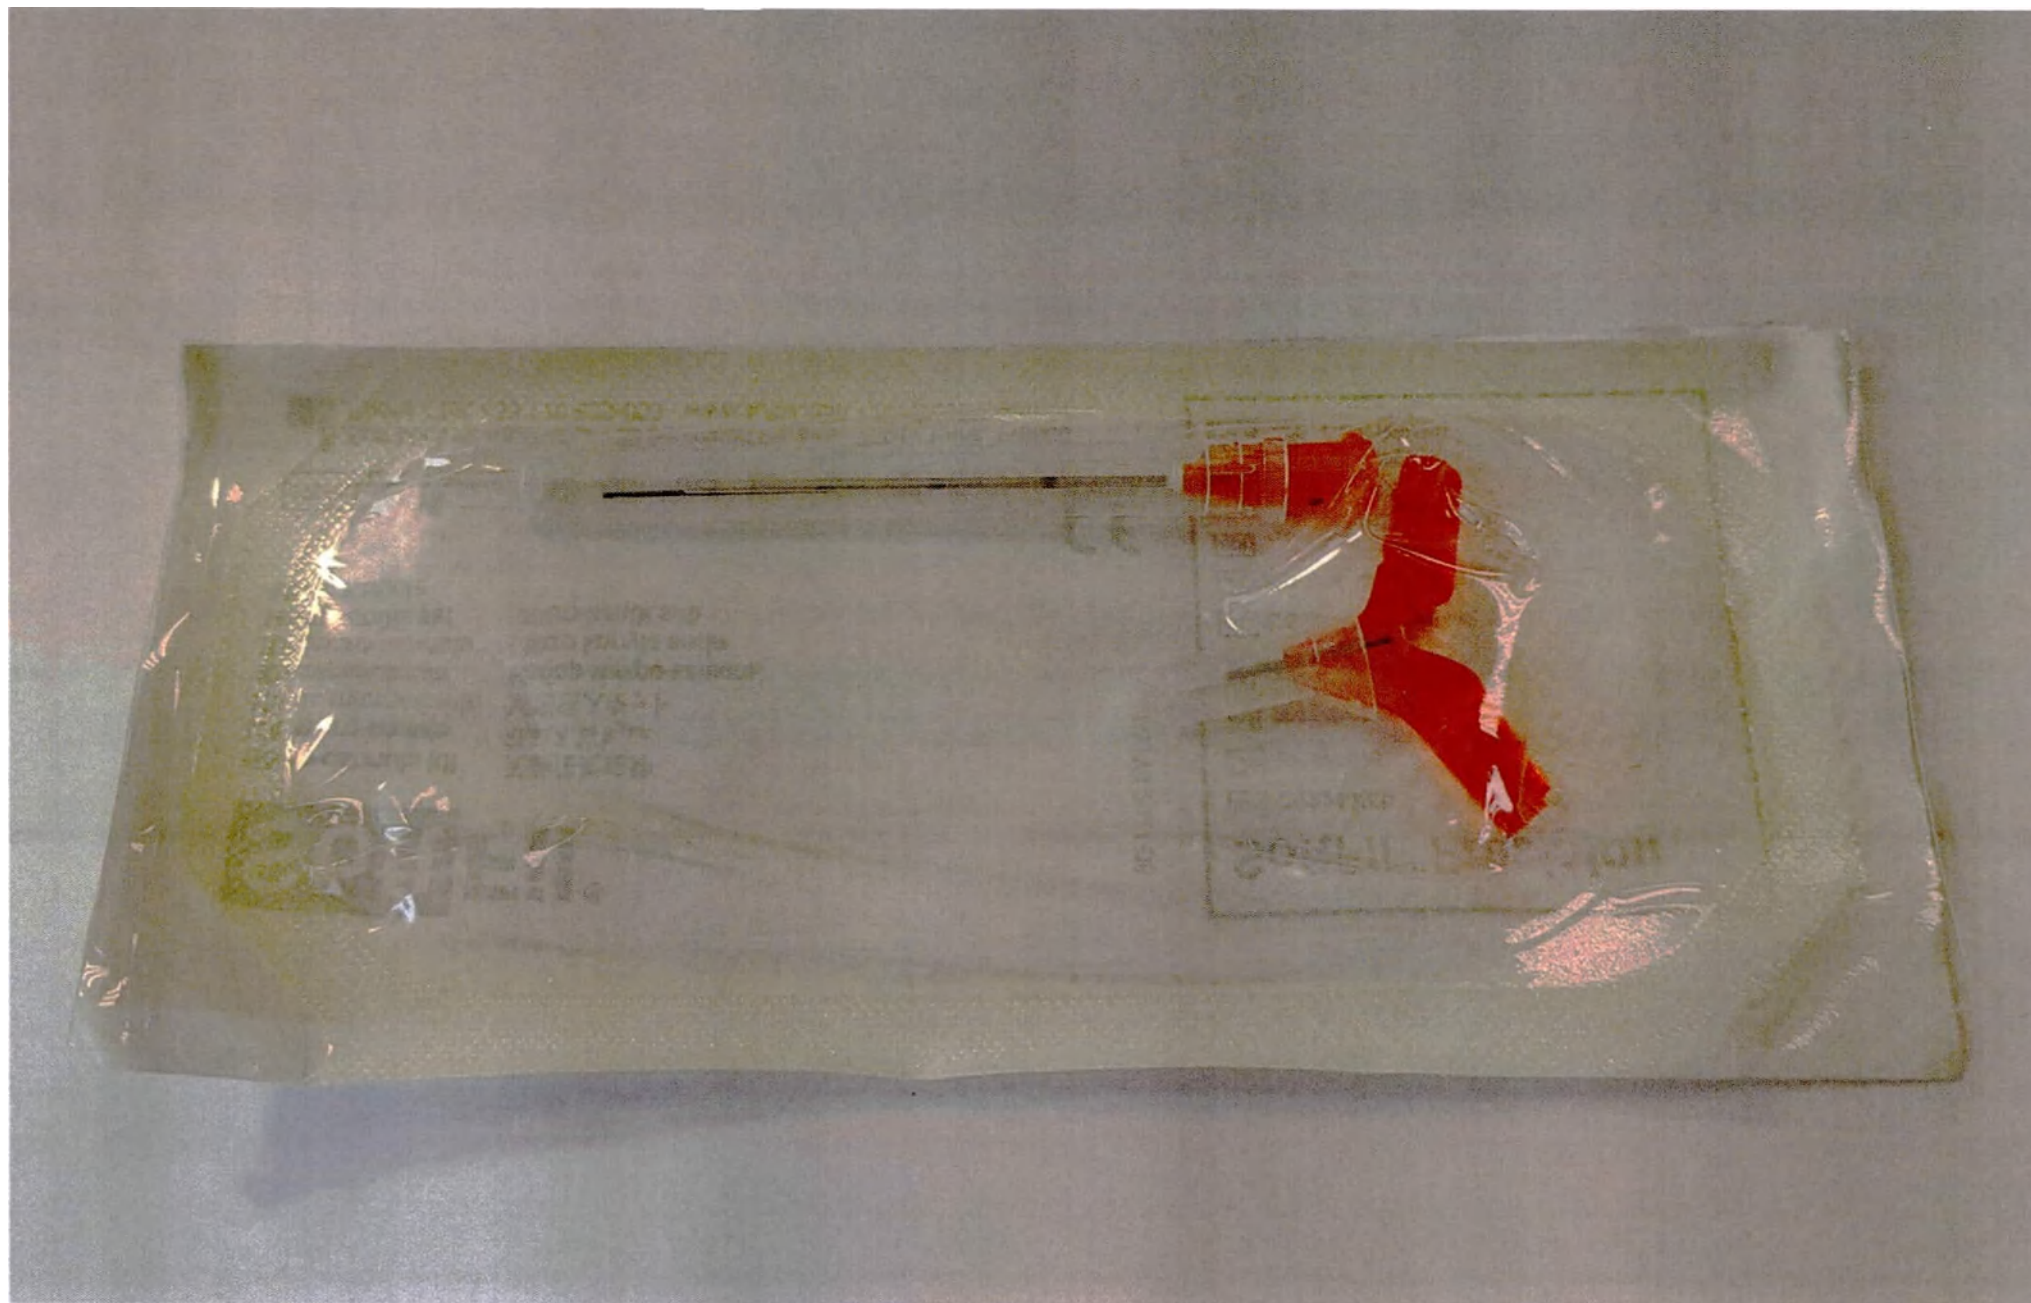


Рис. 41. Общий вид лицевой стороны блистера с медицинским изделием, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/50 мм. игла для прокола 0,82x5 мм;


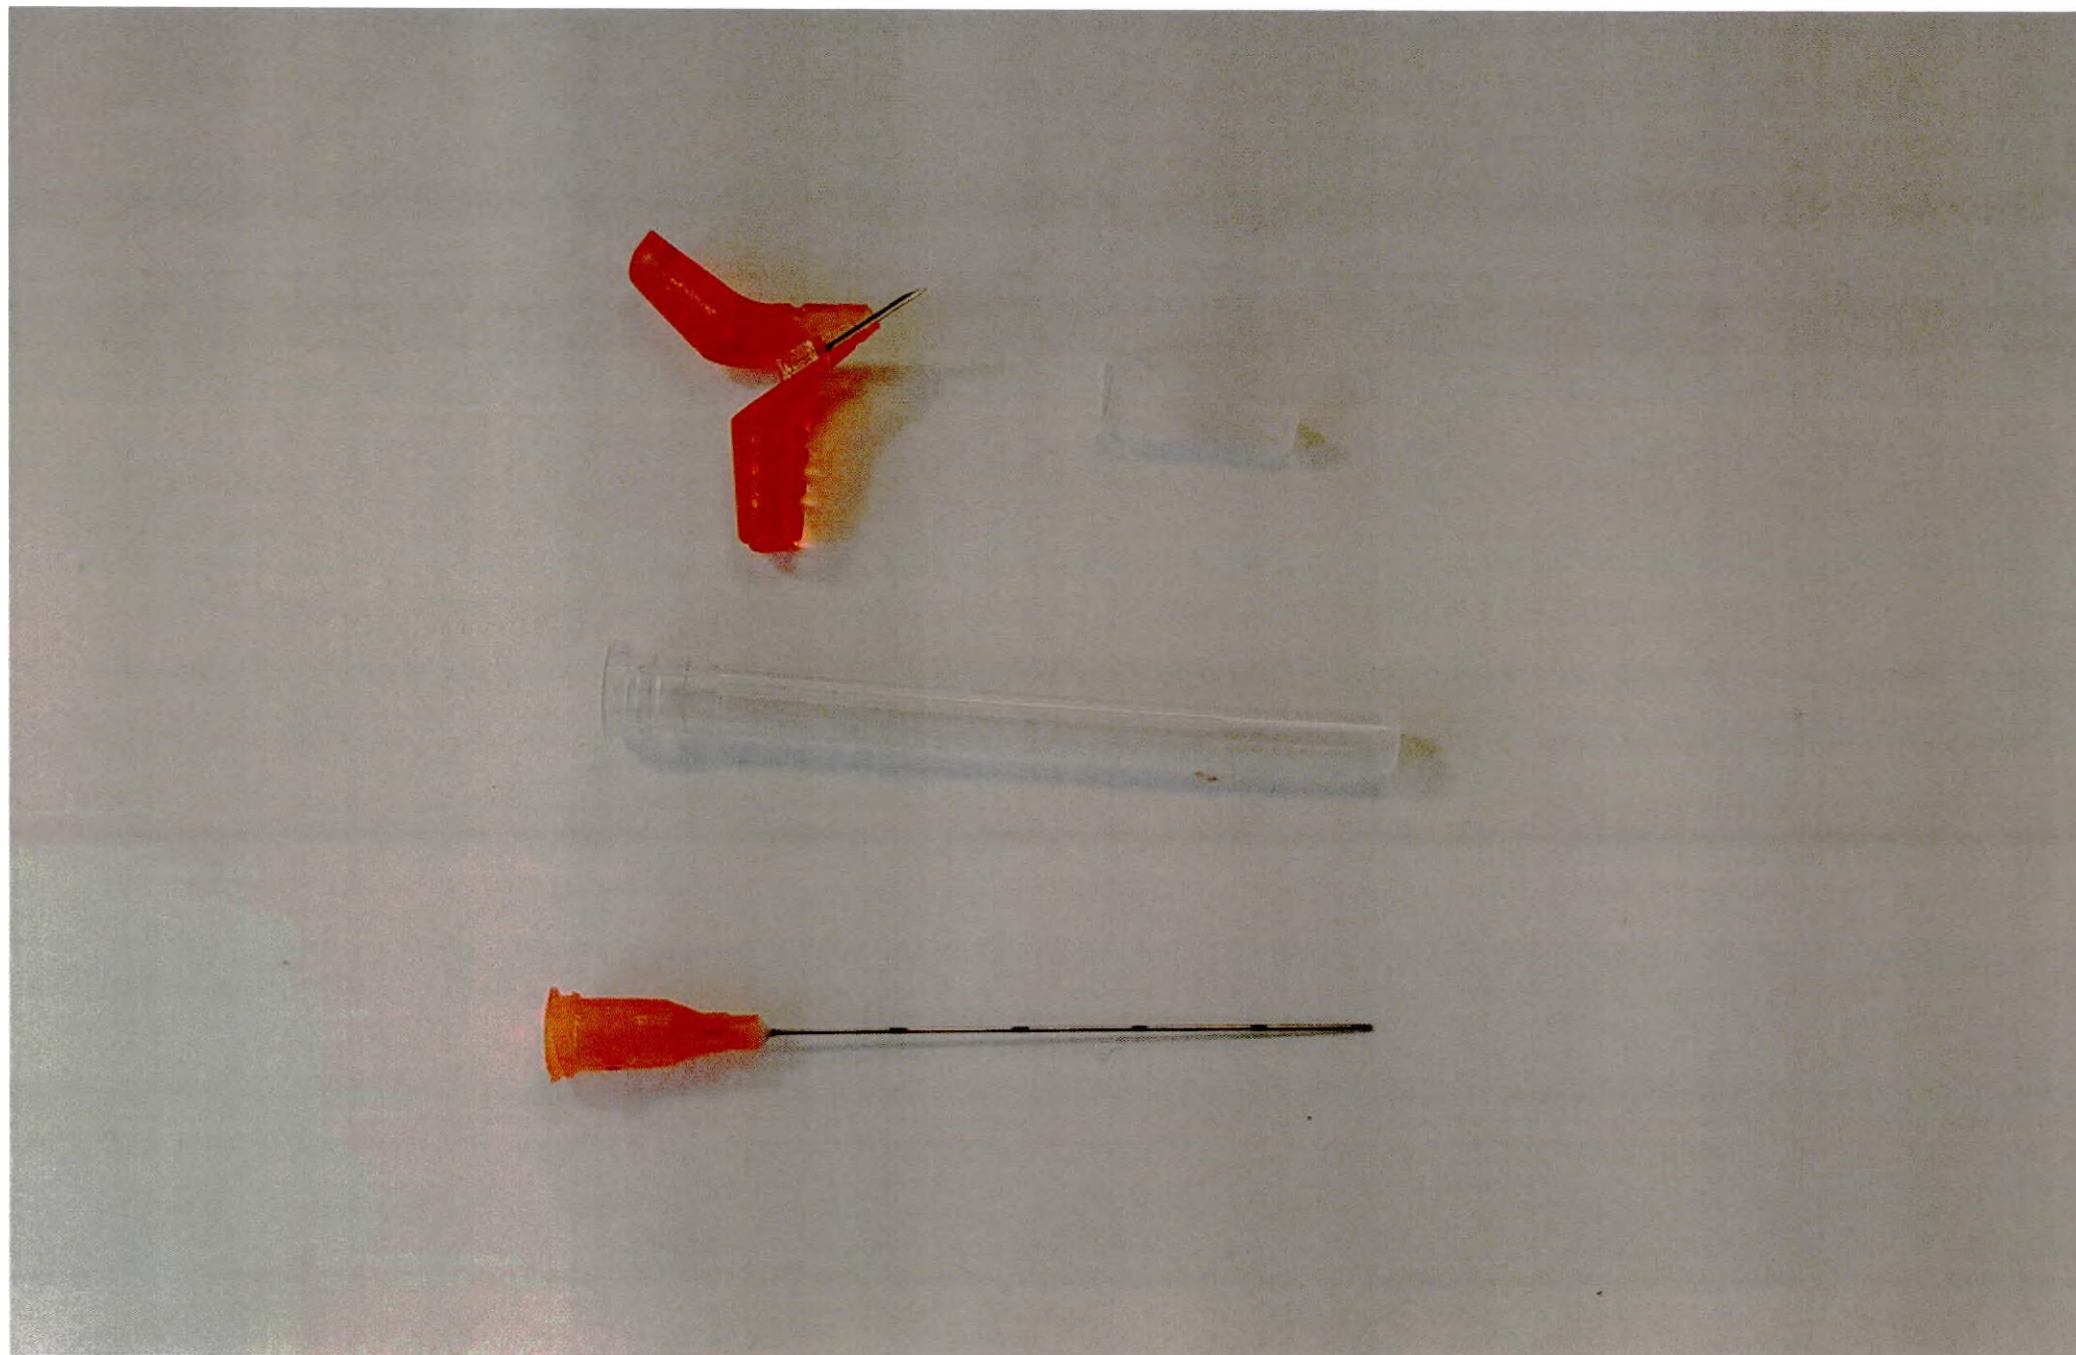


Рис. 42. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/50 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/50



ООО ЦРПИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

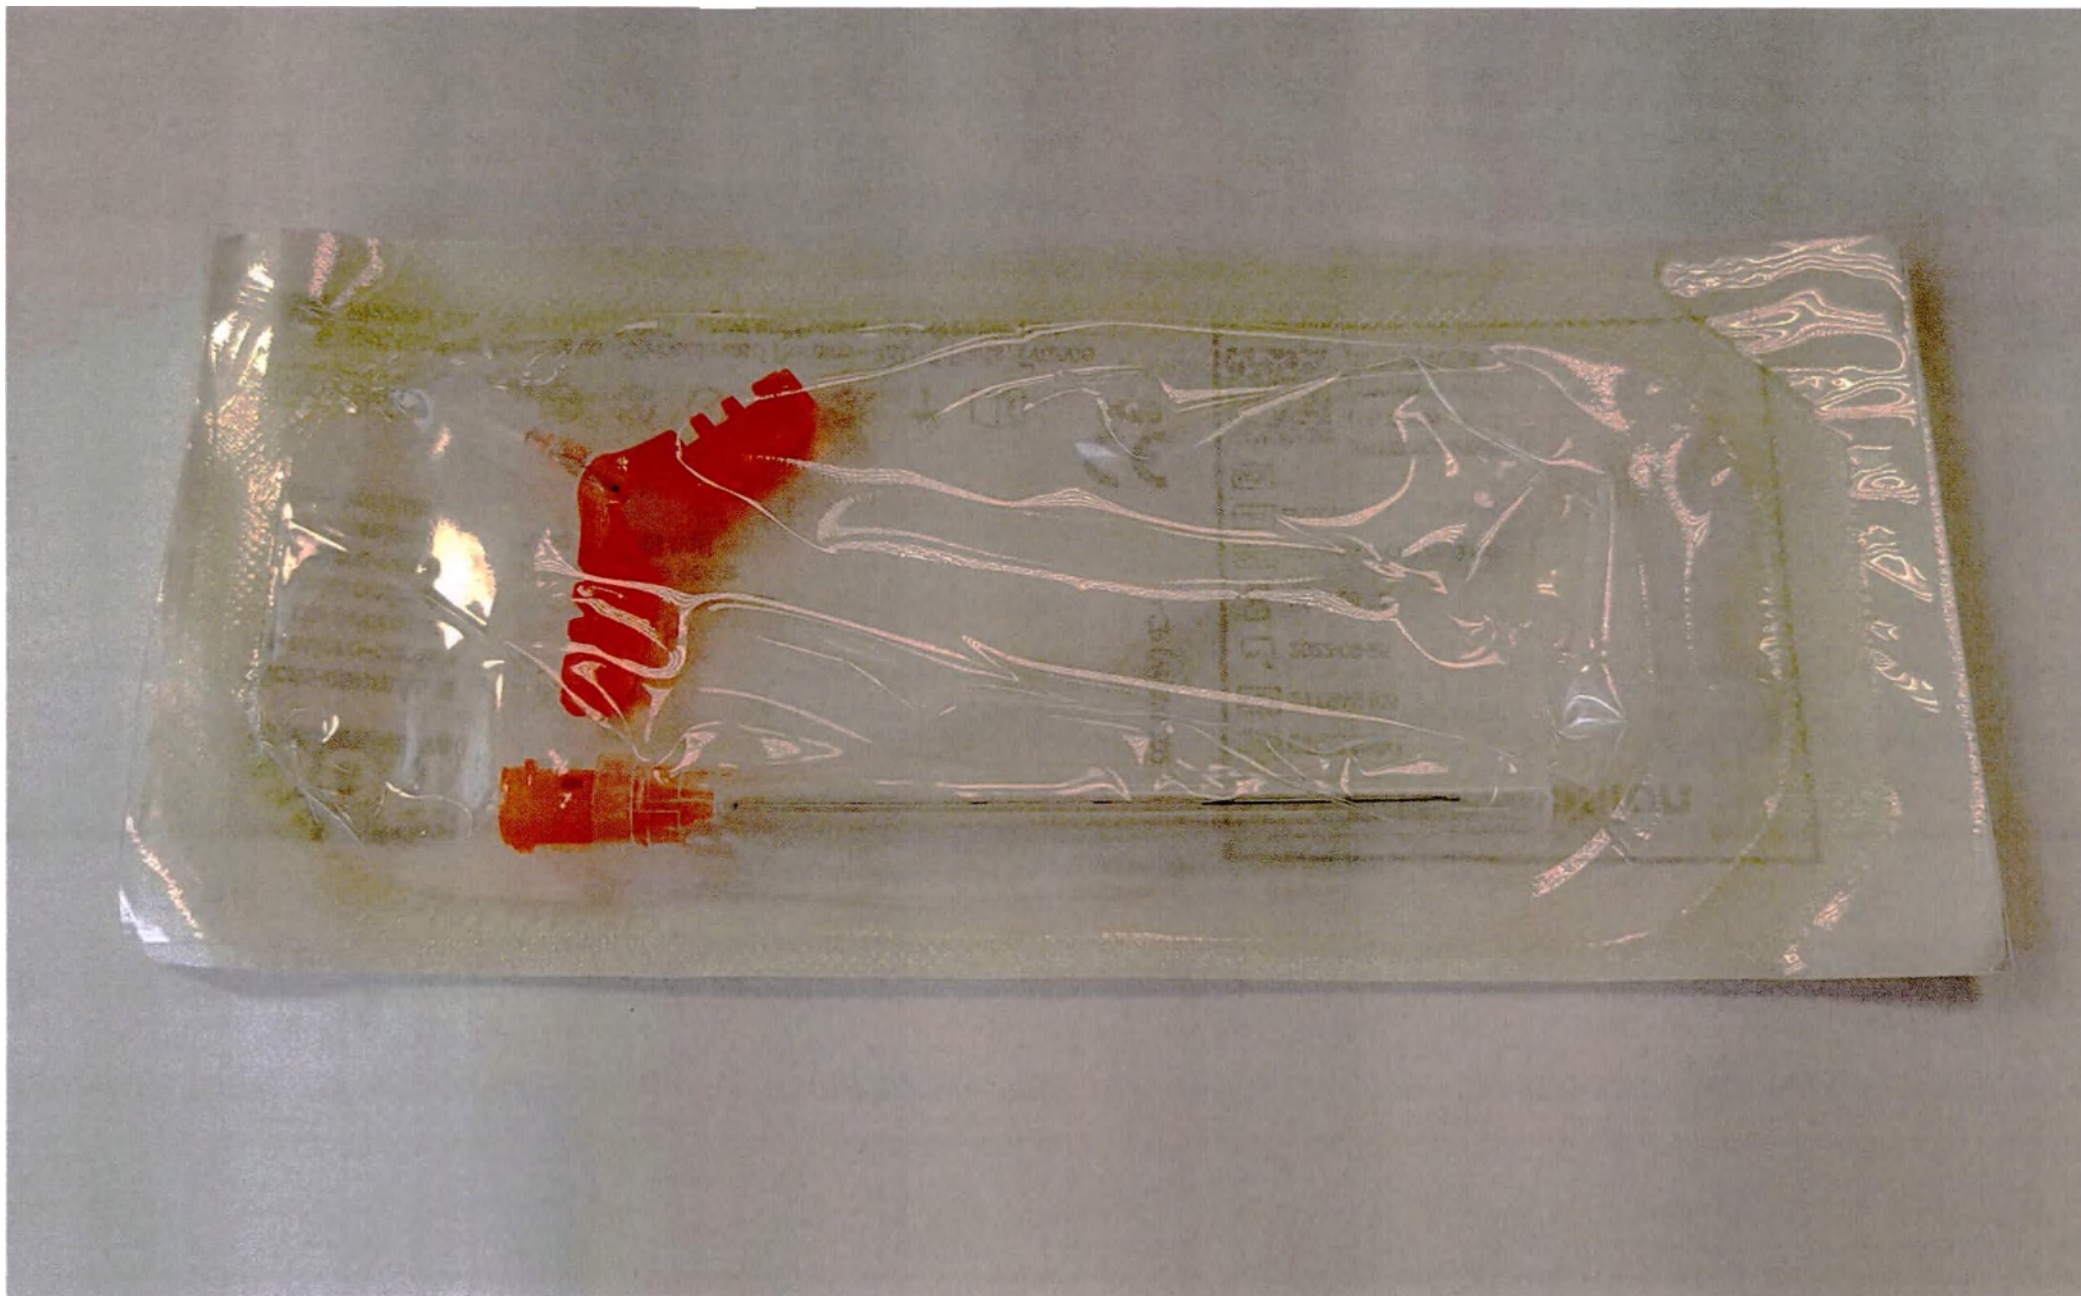


Рис. 44. Общий вид лицевой стороны блистера с медицинским изделием, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигаид) 25G/60 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/60 мм, игла для прокола 0,82x5 мм;

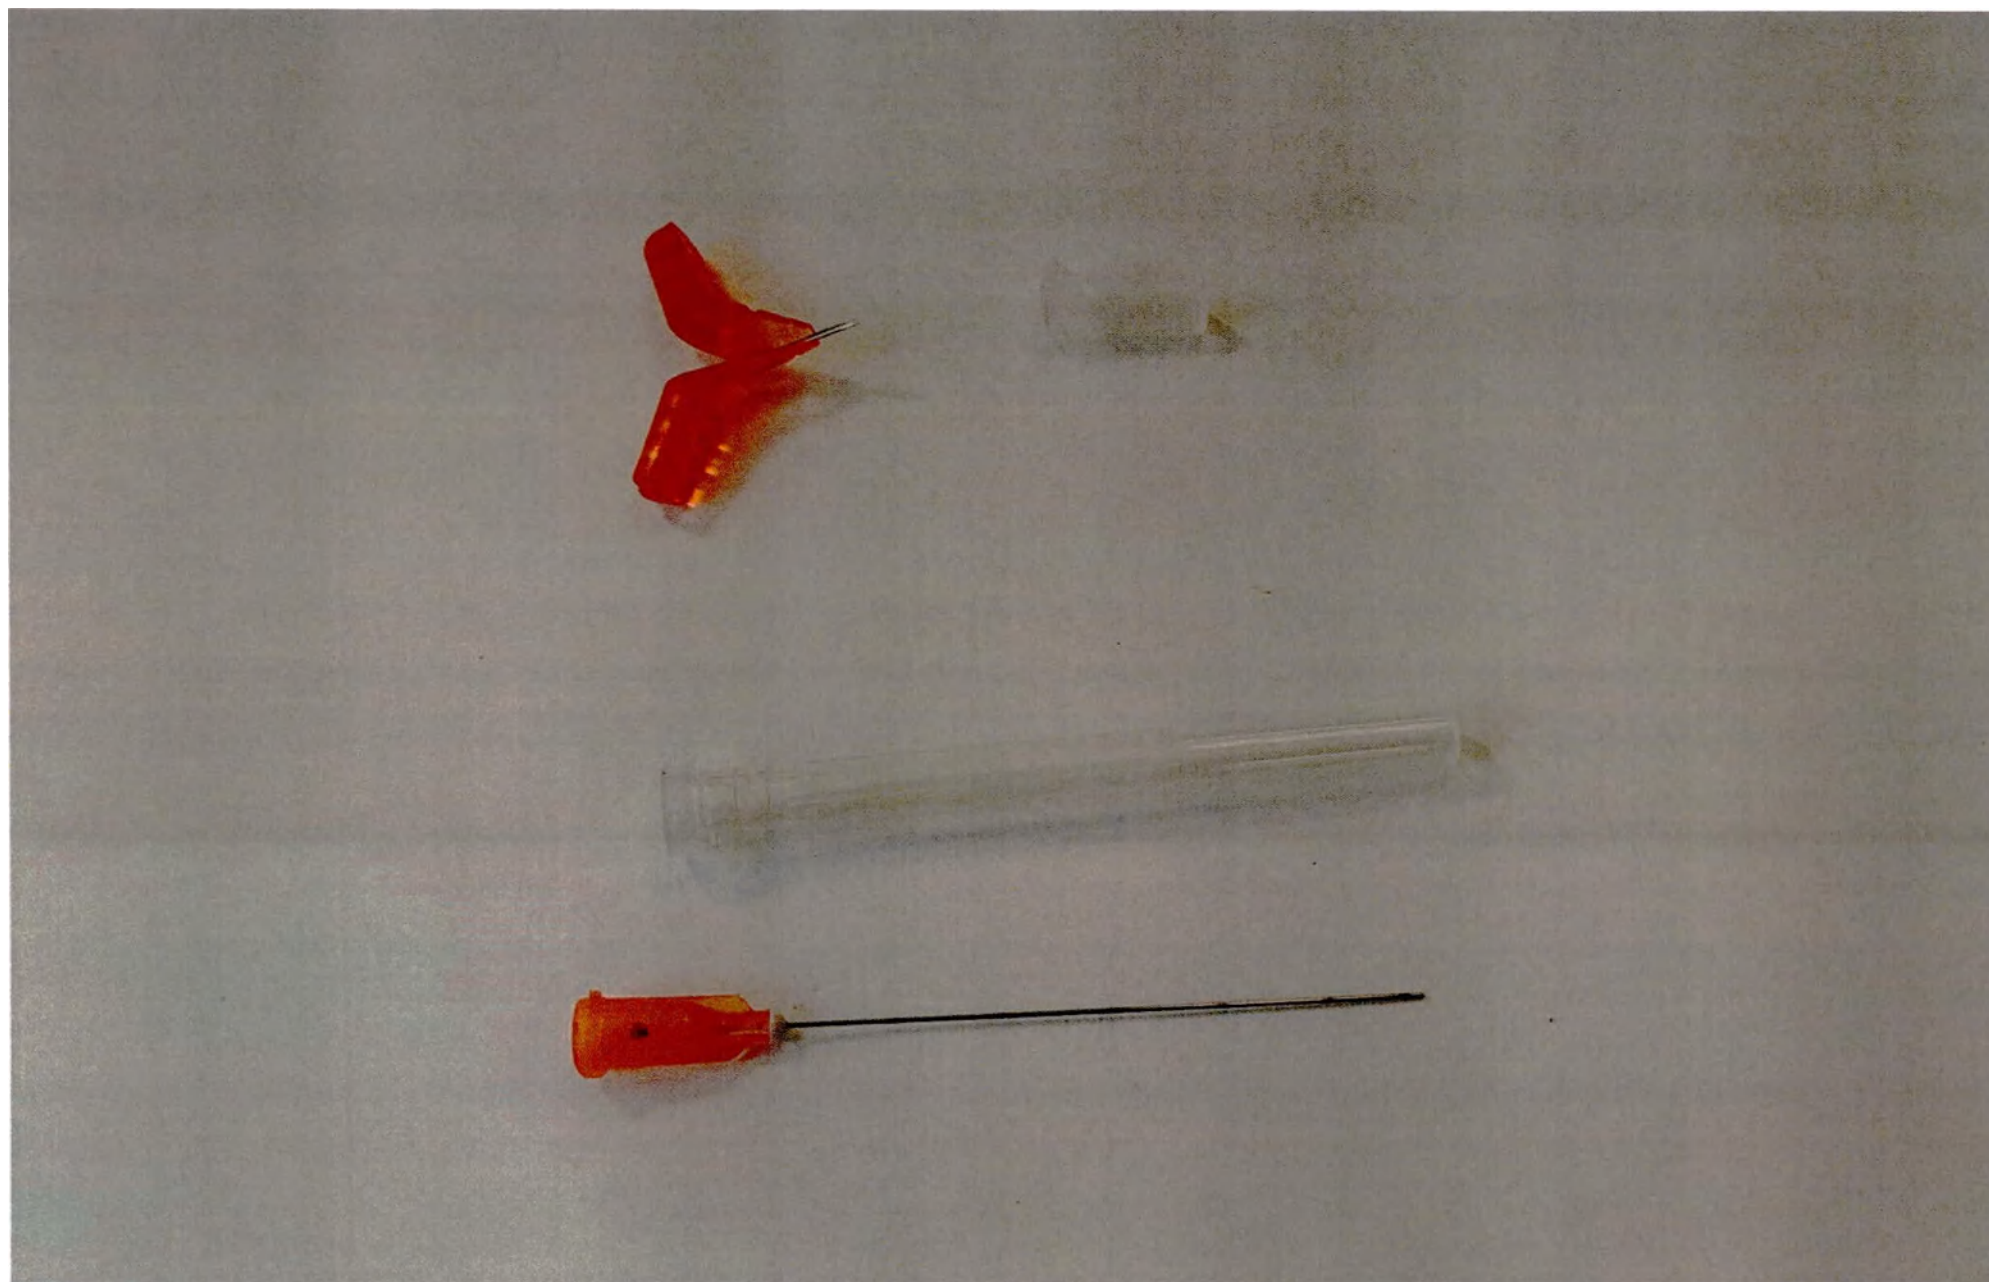


Рис. 45. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 25G/60 0,82x5 в составе: микро-канюля 25G/60 мм, игла для прокола 0,82x5 мм;


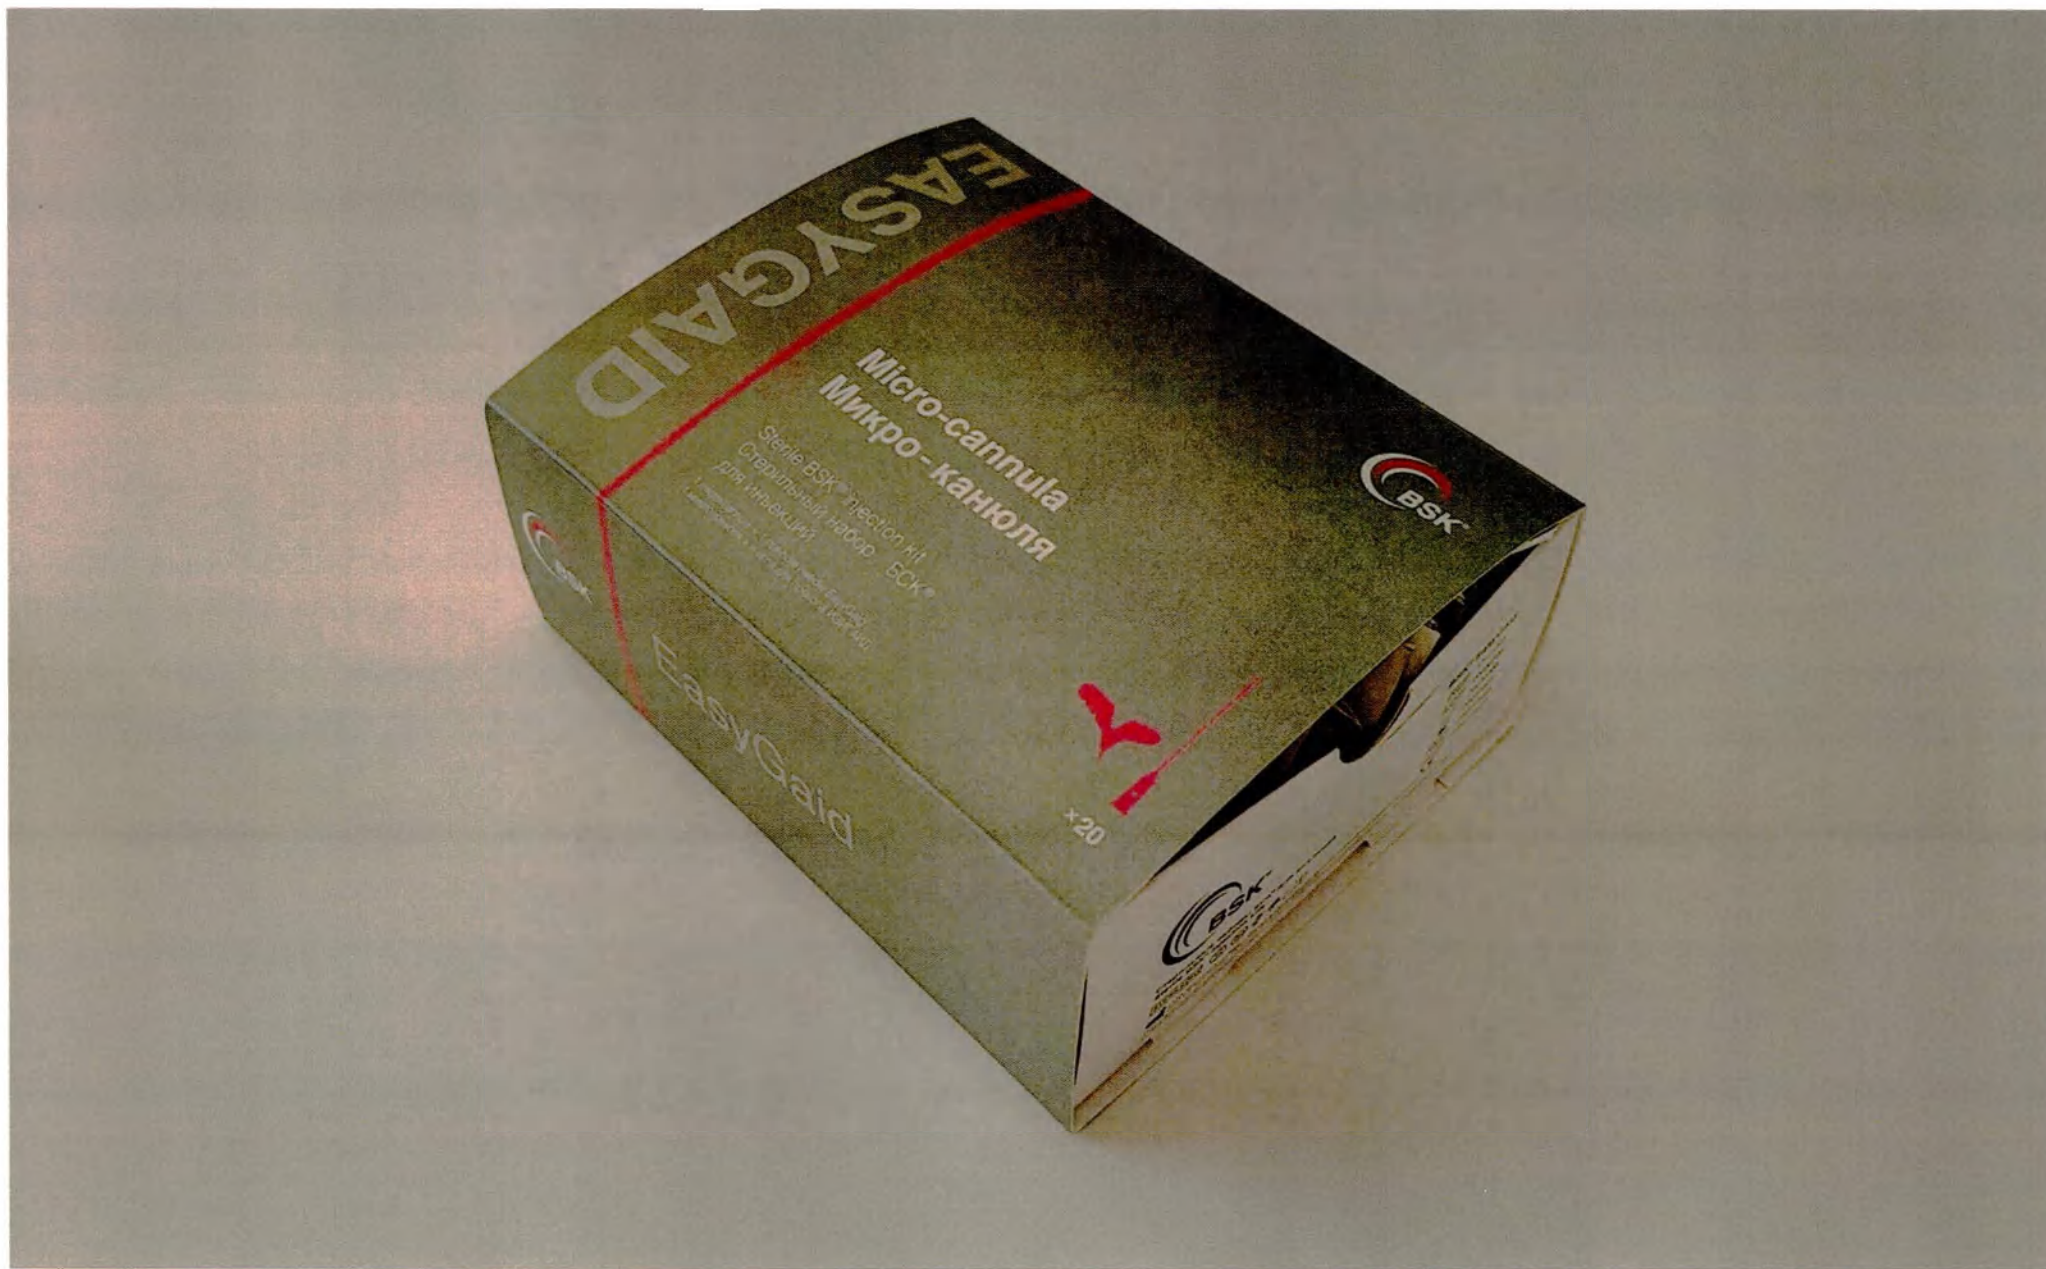


Рис.46. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 27G/40 0,82x5 в составе: микро-канюля 27G/40, игла для прокола 0,82x5 мм;



Стерильный набор БСК® для инъекций  
Sterile BSK® injection kit



Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jiading District, Shanghai  
Место производства: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайндли Энтерпрайз Девелопмент  
Групп Ко. Лтд. No 658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China  
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ФАРМ БСК» 119602, г. Москва,  
ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6

### BSK® EasyGaid

|     |             |
|-----|-------------|
| REF | LY-C-026    |
| LOT | 20230308    |
|     | 20230308    |
|     | 20280307    |
|     | 27G/40mm    |
|     | 0,82 x 5 mm |

Рис. 47. Общий вид оборотной стороны блистера, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 27G/40 0,82x5 в составе: микро-канюля 27G/40, игла для прокола 0,82x5 мм.



Рис. 48. Общий вид лицевой стороны блистера с медицинским изделием, для варианта исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигайд) 27G/40 0,82x5 в составе: микро-канюля 27G/40, игла для прокола 0,82x5 мм;

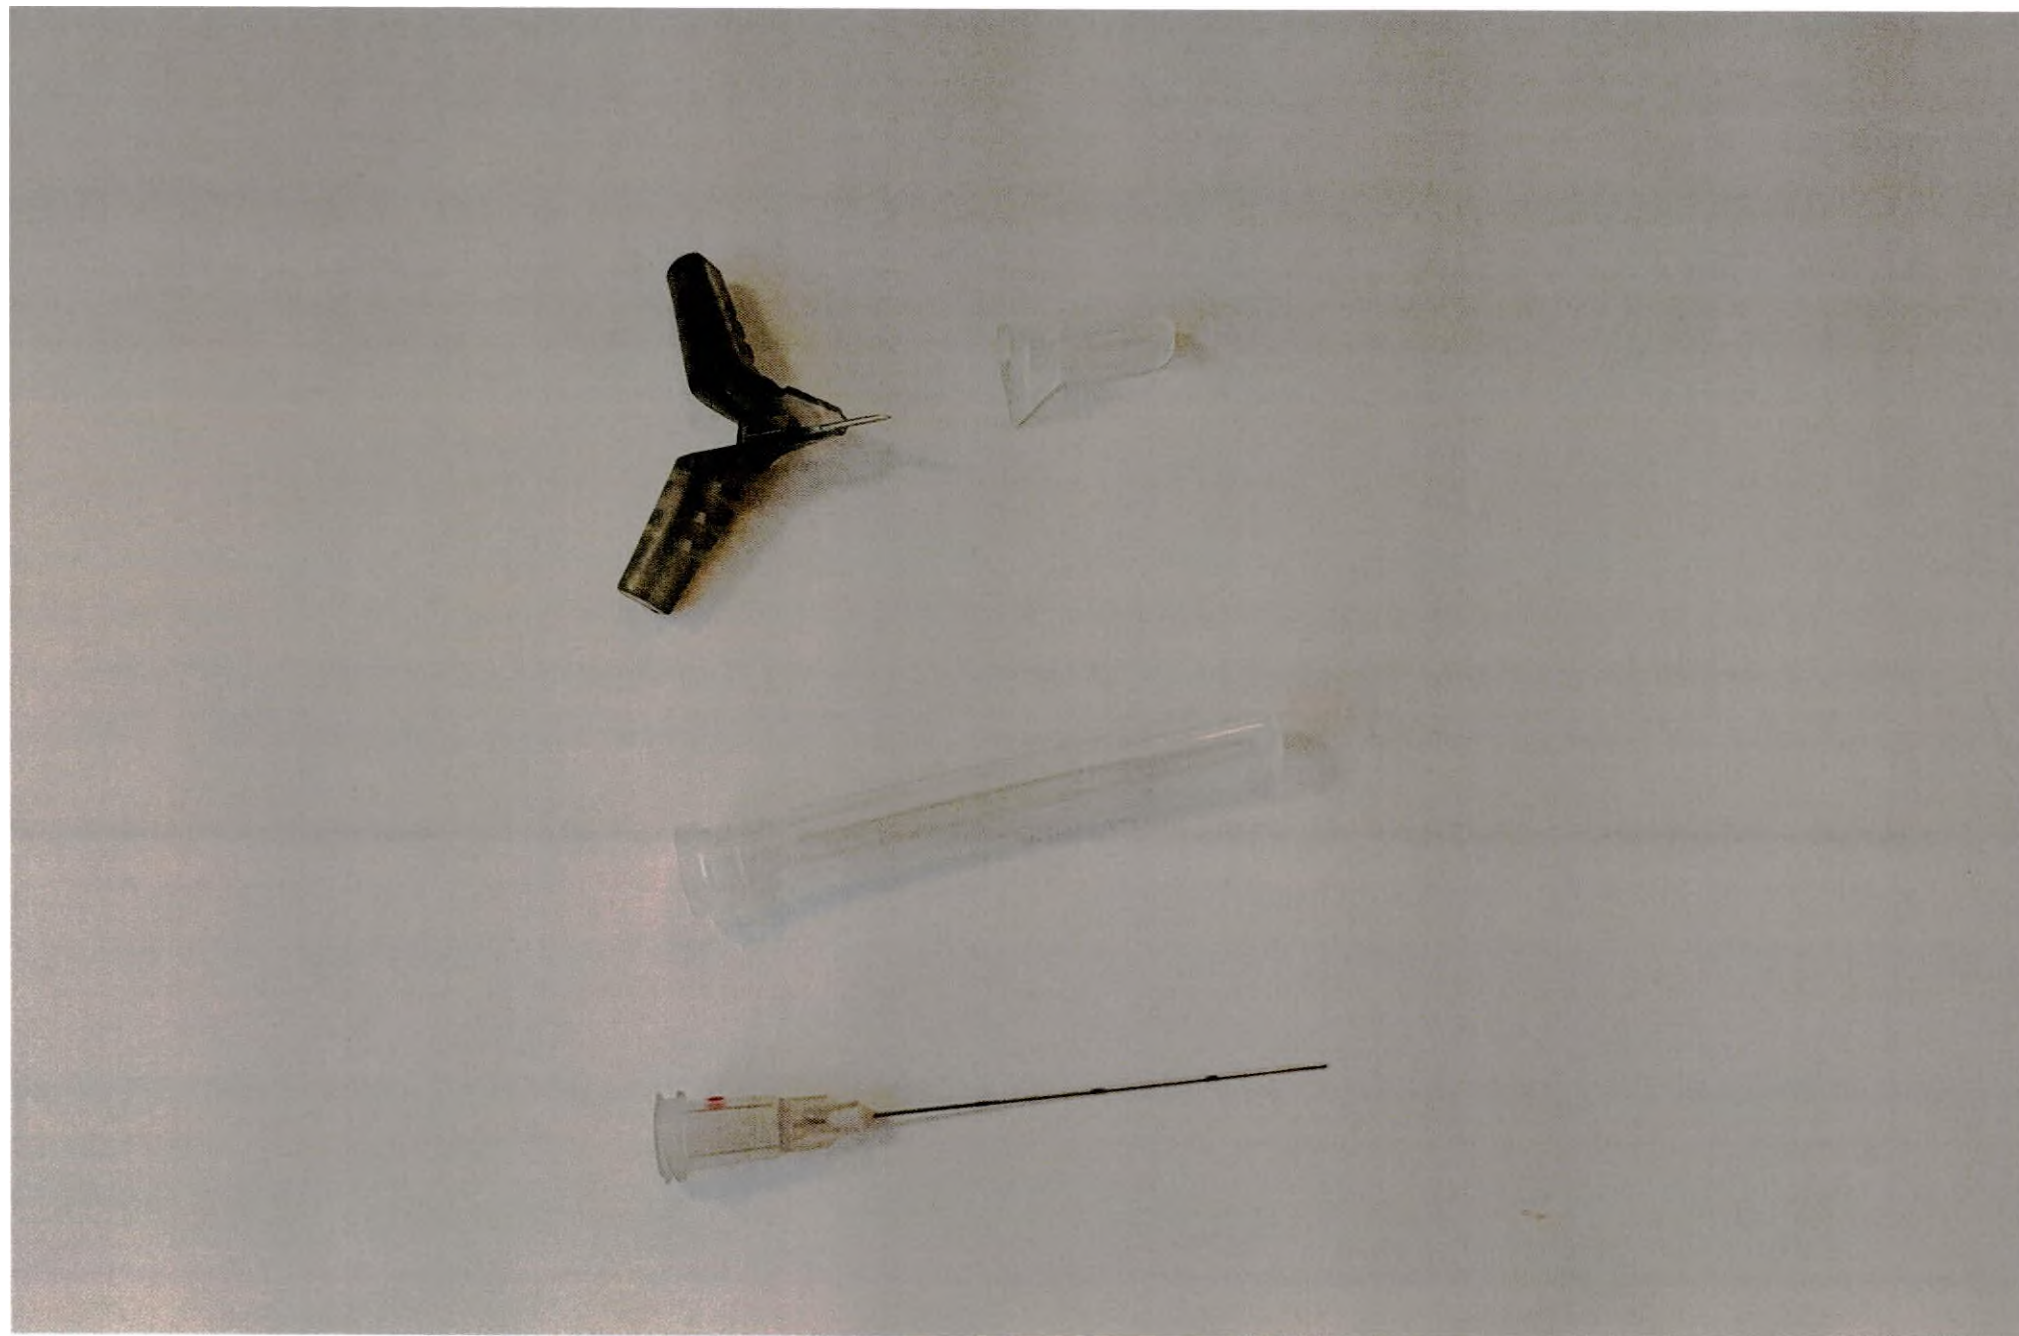


Рис. 49. Общий вид медицинского изделия вариантов исполнения: Стерильный набор БСК® EasyGaid (Изигаид) 27G/40 0,82x5 в составе: микро-микро-канюля 27G/40, игла для прокола 0.82x5 мм:

Стерильный набор БСКВ для инъекций  
Вариант исполнения (указывается вариант исполнения)  
Масса нетто: XX, масса брутто (не должна превышать 50 кг, а при отправке почтовой посылкой - 20 кг) XX;  
номер партии XXXXXXXX. Исполнять до XXXXXXXXXX.  
В транспортной упаковке XXX уп с содержанием каждой:  
Назначение: Медицинское изделие предназначено для использования в пластической хирургии, дерматологии и косметологии. Используется для введения изделий с эстетической термическо-ионной щелью (мезотерапевтические изделия, биоревитализанты, биосенсарты) или наполнителей для придания дополнительного объема ткани в косметических или реконструктивных целях (например филлеров на основе гиалуроновой кислоты).  
Стерильно. Не токсично. Срок годности: 5 лет. Годен до: см. на бланке.  
Условия хранения: Хранить при температуре от 5 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.  
Производитель медицинского изделия:  
Shanghai Kindy Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайдинь Энтэрпрайз Девелопмент Груп Ко. Лтд. Floor 2, Building 1, 658 Gaochao Road, Jieding District, Shanghai. Тел.: +0049-40-2513175  
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ БСК» 119092, г. Москва, ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп. 1, пом. III, комн. 1-6 Тел.: +0049-40-2513175  
Место производства медицинского изделия: Shanghai Kindy Enterprise Development Group Co., Ltd. Шанхай Кайдинь Энтэрпрайз Девелопмент Груп Ко. Лтд. N658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, People's Republic of China

Прошито и пронумеровано

скреплено печатью 51 г

Генеральный директор

ООО «ФАРМ ВСК»

С.М. Бунд

МП 4.12.2024 2024 г.

