

Вариант 1. Макет маркировки медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»



Вариант 1. Общий вид медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Вариант 1. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

FRAUTEST

5 ТЕСТ-ПОЛОСОК

ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ 99%

ovulation

2 ДНЯ
для зачатия



PREMIUM
QUALITY

Вариант 1. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Вариант 1. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

 **FRAUTEST**

Тест-полоска для определения овуляции, в составе:
тест-полоска в индивидуальной упаковке – 5 шт.
инструкция по применению-вкладыш – 1 шт.




**ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ**



4 601834 008086

Произведено по заказу и под контролем: ООО «БОЛЕАР». Производитель: Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China. Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зяянг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шидзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика. Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика. Уполномочен: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-8, стр. 103. Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.frautest.ru. Импортёр в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмад», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4, тел.: +375 (17) 373-63-20. Для самотестирования. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от _____ г.


Вариант 1. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

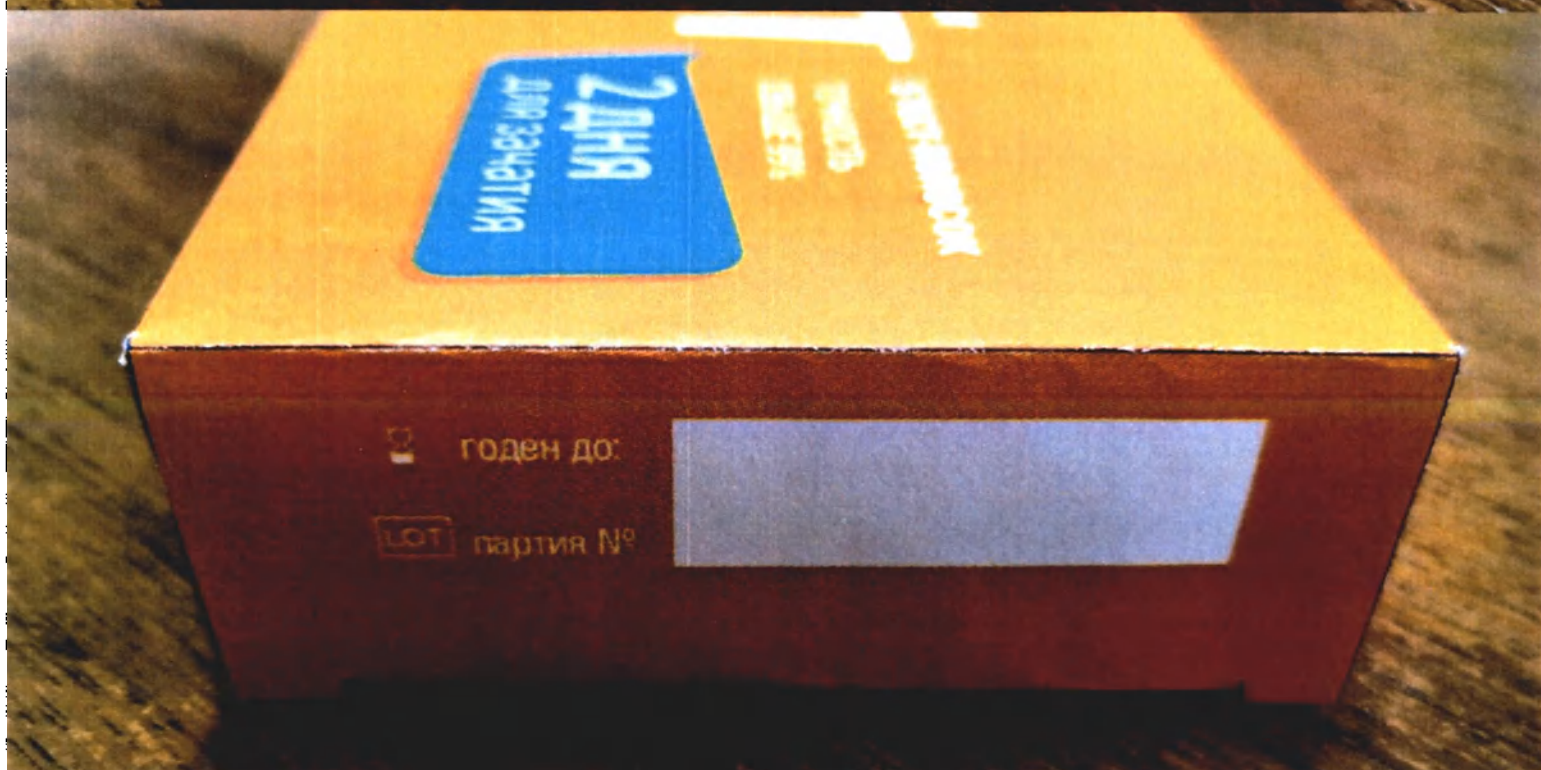

Вариант 2. Макет маркировки медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»



Вариант 2. Общий вид медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

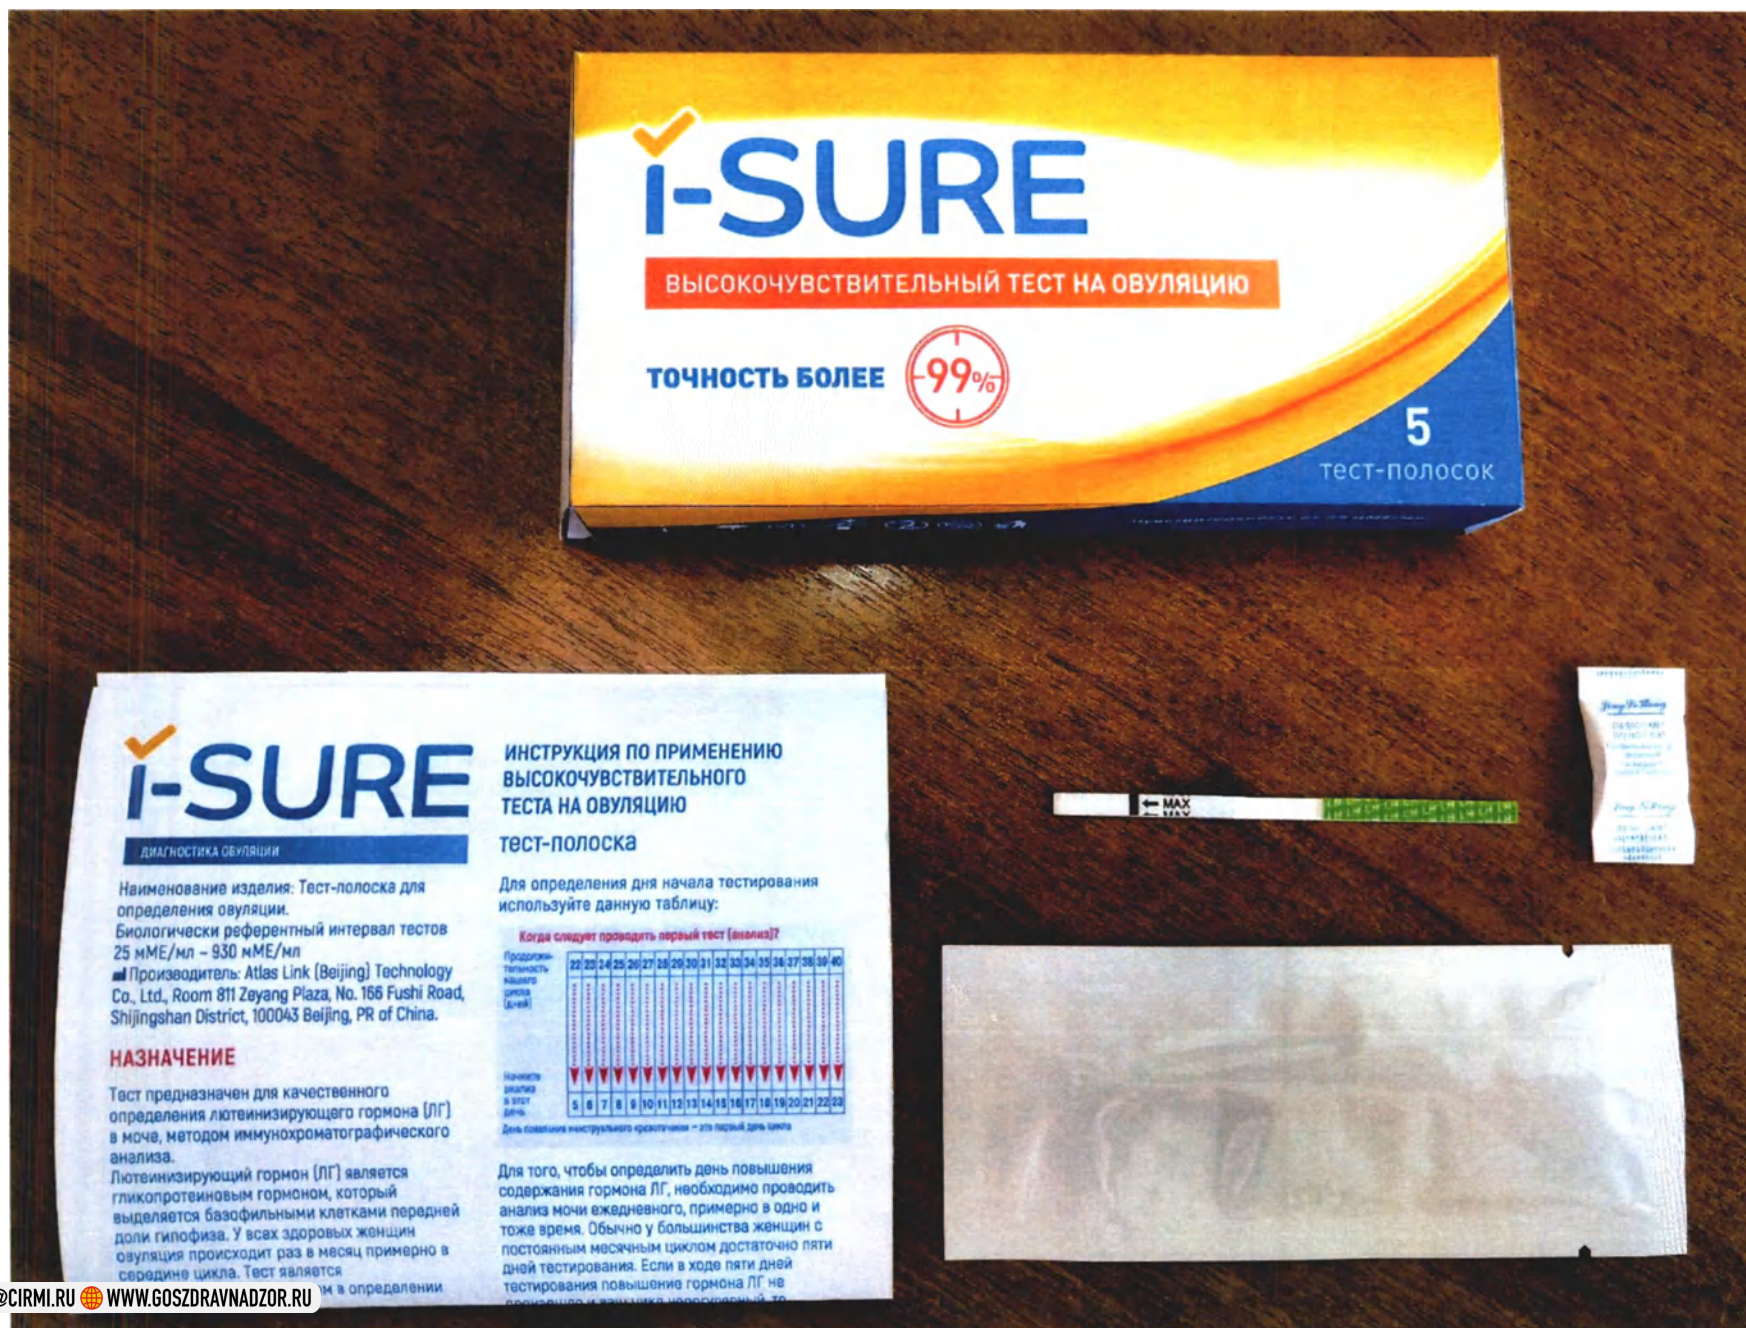

Вариант 2. Потребительская упаковка медицинского изделия
«Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в
индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по
применению-вкладыш - 1 шт.»



Вариант 2. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ


i-SURE

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна.

Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Чувствительность - 25 мМЕ/мл.

Для самотестирования

Не использовать по истечении срока годности.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от _____ г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30 °С
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

 **Производитель:** Atlaslink (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China. Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603 Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.



Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Тест-полоска для определения овуляции, в составе:

- тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.
- инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68.

Произведено по заказу: АО «ЭРКАФАРМ», Россия, 105005
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный
ул. Бакунинская, д. 14 стр. 1, этаж 3, помещ. I, комната 5А.



4 601834 006563

5

ТЕСТ-ПОЛОСОК

Вариант 2. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Вариант 2. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Вариант 3. Макет маркировки медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»



Вариант 3. Общий вид медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



itest®

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование изделия: Тест-полоска для определения овуляции.
Производитель: Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China.

Назначение: Тест предназначен для качественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче, методом иммунохроматографического анализа.

Тест позволяет выявлять в пробе мочи лютеинизирующий гормон (ЛГ).

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) является гликопротеиновым гормоном, который выделяется базофильными клетками передней доли гипофиза, основной функцией которого является стимуляция овуляции, выделение лютеинизирующего гормона.

Тест является вспомогательным средством в обнаружении овуляции.

В качестве анализируемой пробы может быть использована моча, собранная в чистую и сухую емкость, а также струя мочи, которая направляется на приемную часть теста.

Так как ЛГ синтезируется рано утром и проявляется в моче в течение дня, лучшее время для сбора мочи – между 10:00 и 20:00, приблизительно в одно и тоже время каждый день.

Перед проведением теста следует сократить количество употребляемой жидкости и воздержаться от мочеиспускания в течение 2-3 часов перед проведением тестирования.



КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ?

Продолжительность вашего цикла (дни)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
Начало анализа в этот день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

День появления менструальных кровотечений — это первый день цикла

День появления менструальных кровотечений — это первый день цикла

Перед определением начала тестирования следует рассчитать продолжительность вашего цикла. Цикл отсчитывается от первого дня менструации до первого дня следующей менструации.

Женщинам репродуктивного возраста для того, чтобы определить день начала тестирования, необходимо от числа дней менструального цикла отнять 17 дней. У большинства женщин цикл постоянный и продолжается 28 дней. В случае непостоянного цикла выберите для отсчета наиболее короткий цикл.

К примеру, если Ваш цикл длится 28 дней, то тестирование необходимо начать на 11-ый день после начала цикла. Для определения дня начала тестирования используйте данную таблицу.

Для того, чтобы определить день повышения содержания гормона ЛГ, необходимо проводить анализ мочи ежедневно, примерно в одно и тоже время. Обычно у большинства женщин с постоянным менструальным циклом достаточно пяти дней тестирования. Если в ходе пяти дней тестирования повышение гормона ЛГ не произошло и ваш цикл нерегулярный, то необходимо продолжить тестирование еще 2-3 дня. Если в ходе трех менструальных циклов повышение содержания гормона не обнаружено, необходимо обратиться к врачу.

Для наиболее благоприятных дней наступают с момента резкого повышения (положительный тест) содержания гормона овуляции. Наиболее высокая вероятность зачатия за два дня до овуляции и в благоприятные дни самой овуляции.

Вариант 3. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Вариант 3. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Вариант 3. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

itest®

**Тест-полоска для определения овуляции, в составе:
тест-полоска в индивидуальной упаковке – 5 шт.
инструкция по применению-вкладыш – 1 шт.**




**ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**



Произведено по заказу и под контролем: ООО «БОЛЕАР». **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China. Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд. комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика. **Место производства:** Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика. **Упаковано:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 38-й, стр. 103. **Уполномоченный представитель:** ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел. +7 (495) 787-92-68. **Импортер в РБ:** ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4, тел. +375 (17) 373-83-20. Для самотестирования. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от _____ г.

18

Вариант 3. Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-полоска для определения овуляции, в составе: тест-полоска в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

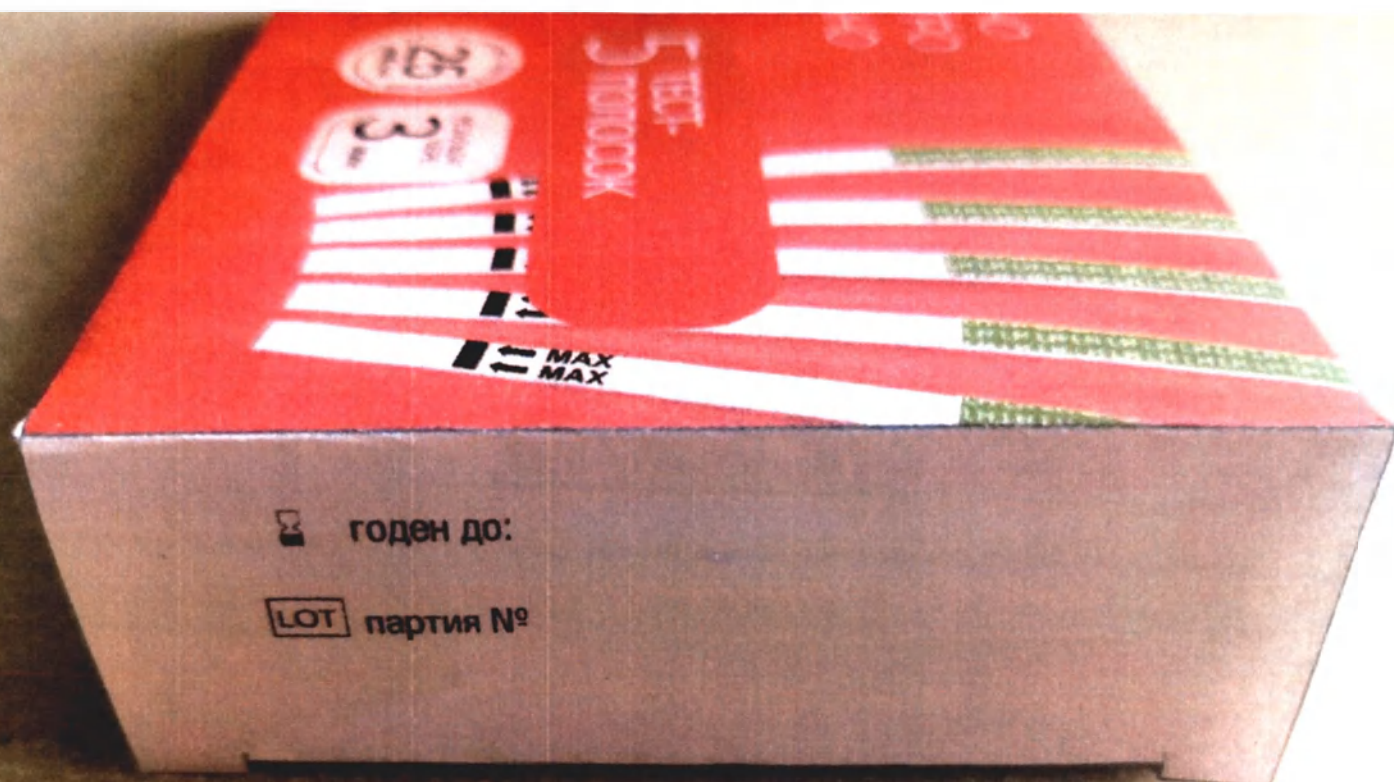

Макет маркировки медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 1 шт.; пипетка - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 1 шт.; пипетка - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 1 шт.; пипетка - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

Тест для определения О В У Л Я Ц И И

1 | тест-
кассета

лучших 2 дня

для зачатия

25 мМЕ/мл

чувствительность

Удобно | Легко | Просто

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 1 шт.; пипетка - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

ТЕСТ-КАССЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките тест-кассету и пипетку.
- С помощью пипетки закапайте 4 капли мочи в круглое отверстие тест-кассеты.
- Положите тест-кассету на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 1 шт.; пипетка - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Тест-кассета в индивидуальной упаковке — 1 шт.

Пипетка — 1 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Производитель: Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке -1 шт.; пипетка - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1шт.»



Макет маркировки медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 2 шт.; пипетка - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: Тест-кассета в индивидуальной упаковке – 2 шт.; Пипетка – 2 шт.; Инструкция по применению-вкладыш – 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке -2 шт.; пипетка - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»




Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 2 шт.; пипетка - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

ТЕСТ-КАССЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките тест-кассету и пипетку.
- С помощью пипетки закапайте 4 капли мочи в круглое отверстие тест-кассеты.
- Положите тест-кассету на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 2 шт.; пипетка - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Тест-кассета в индивидуальной упаковке — 2 шт.

Пипетка — 2 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan Distrtrict, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зеянг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.


Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 2 шт.; пипетка - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Макет маркировки медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 3 шт.; пипетка - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: Тест-кассета в индивидуальной упаковке – 3 шт.; Пипетка – 3 шт.; Инструкция по применению-вкладыш – 1 шт.»

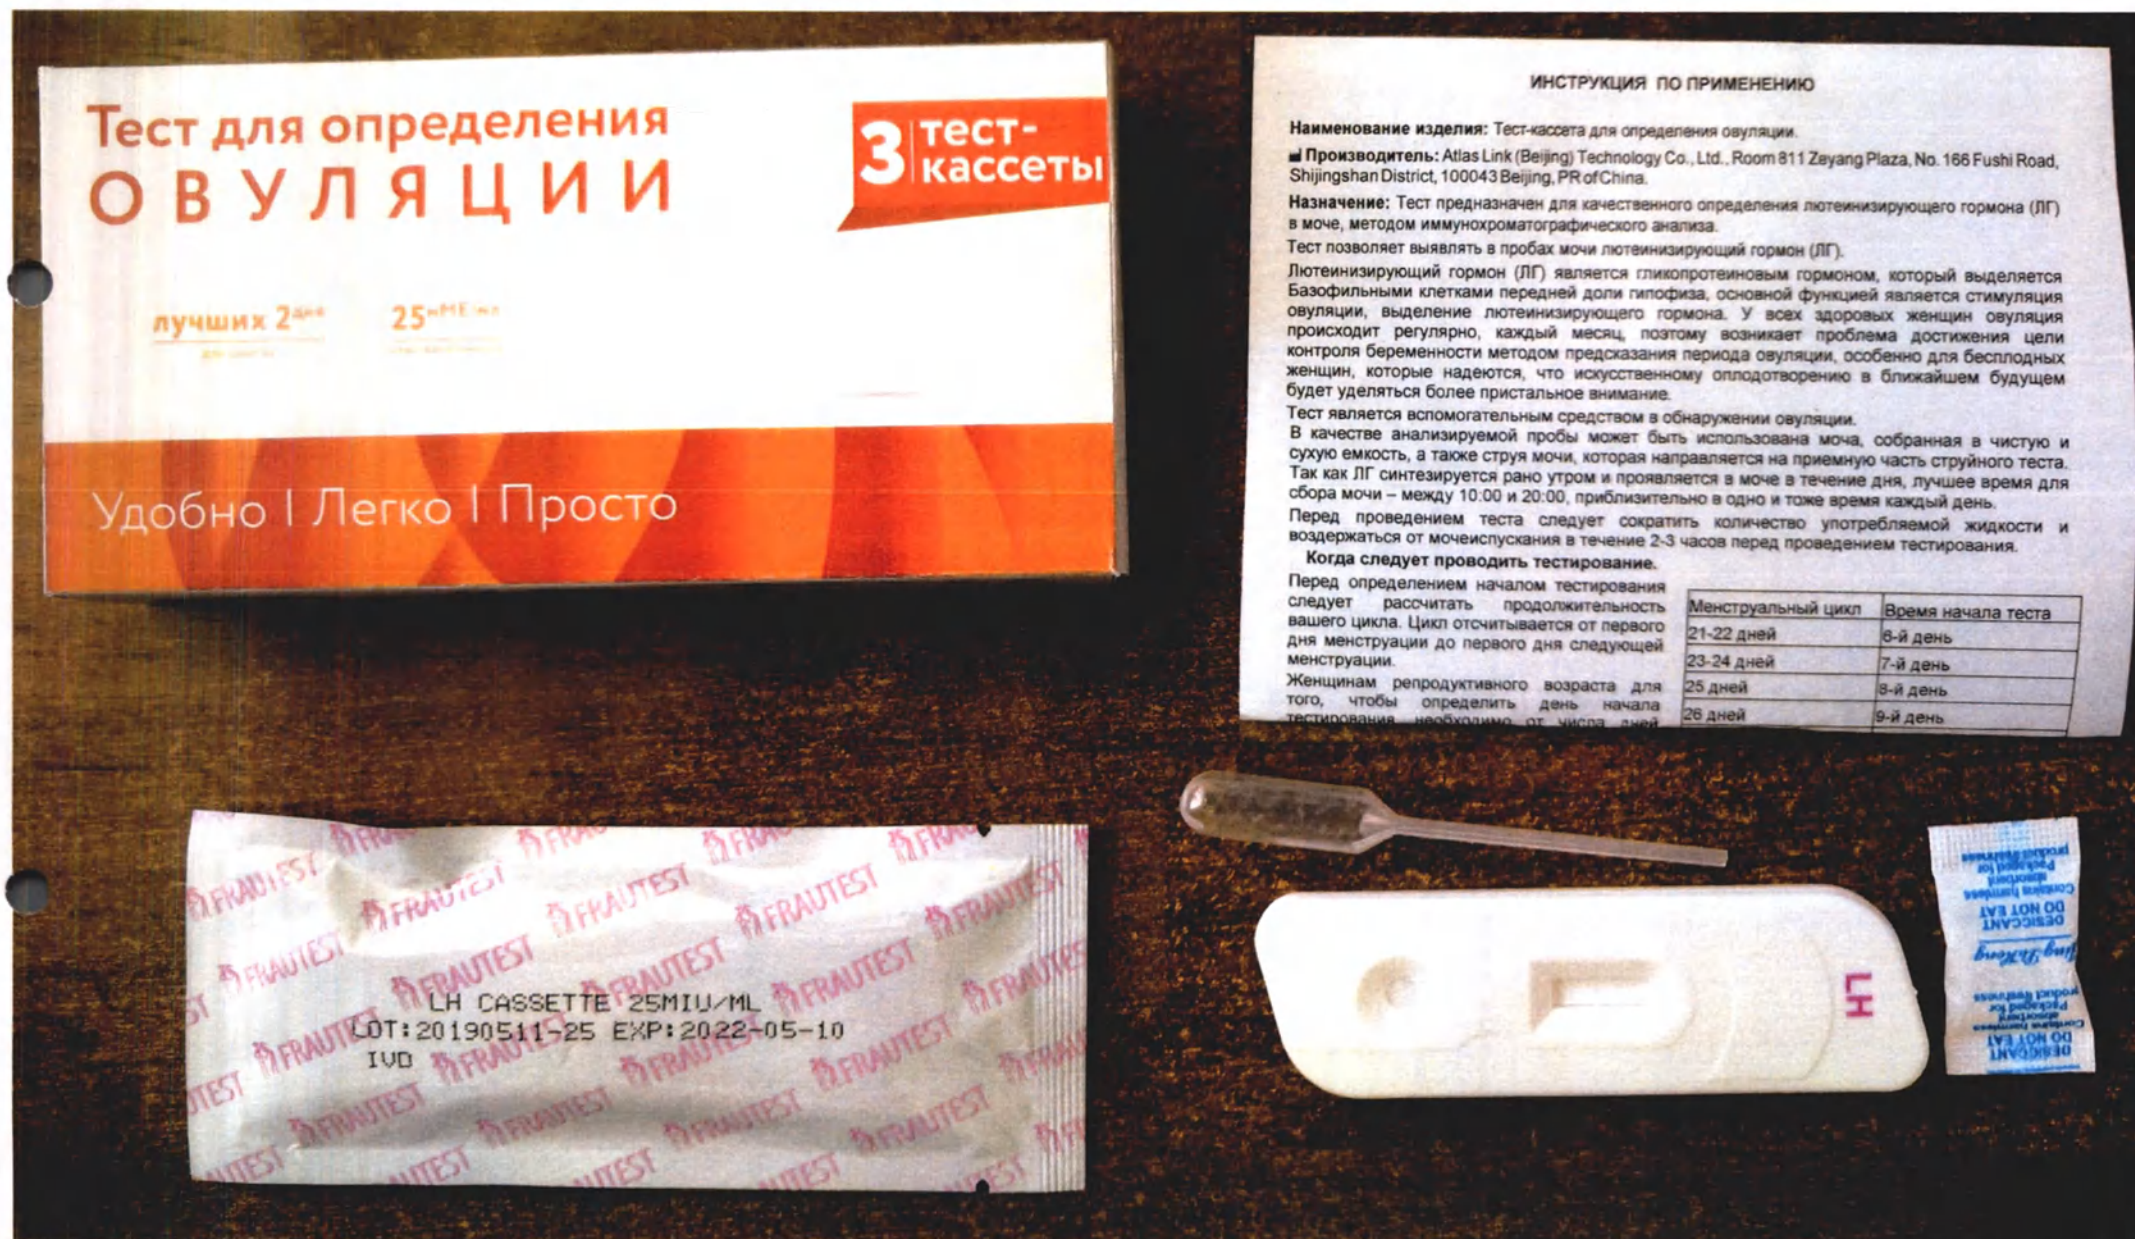

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 3 шт.; пипетка - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 3 шт.; пипетка - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

ТЕСТ-КАССЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките тест-кассету и пипетку.
- С помощью пипетки закапайте 4 капли мочи в круглое отверстие тест-кассеты.
- Положите тест-кассету на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля, появление полоски, соответствующей контрольной линии	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/появление полоски, темнее контрольной линии	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 3 шт.; пипетка - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Тест-кассета в индивидуальной упаковке — 3 шт.

Пипетка — 3 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 3 шт.; пипетка - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Макет маркировки медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 4 шт.; пипетка - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 4 шт.; пипетка - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

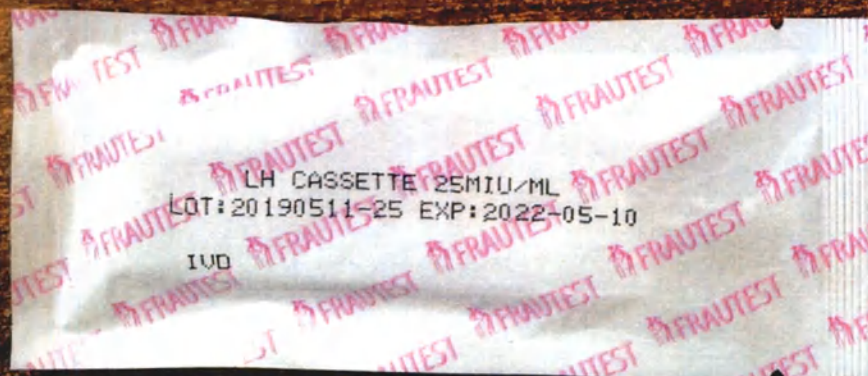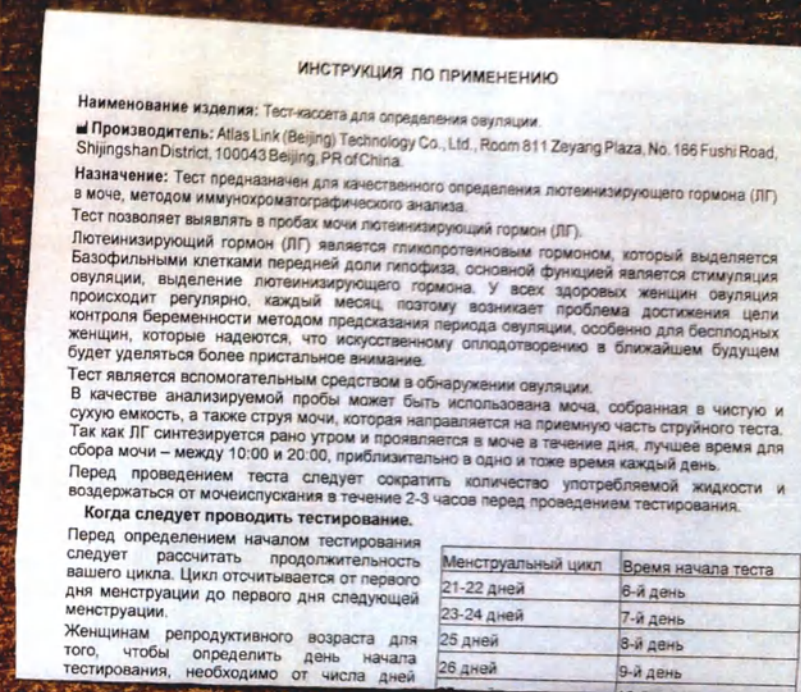

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 4 шт.; пипетка - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 4 шт.; пипетка - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

ТЕСТ-КАССЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките тест-кассету и пипетку.
- С помощью пипетки закапайте 4 капли мочи в круглое отверстие тест-касеты.
- Положите тест-кассету на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.

Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 4 шт.; пипетка - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Тест-кассета в индивидуальной упаковке — 4 шт.

Пипетка — 4 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 4 шт.; пипетка - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

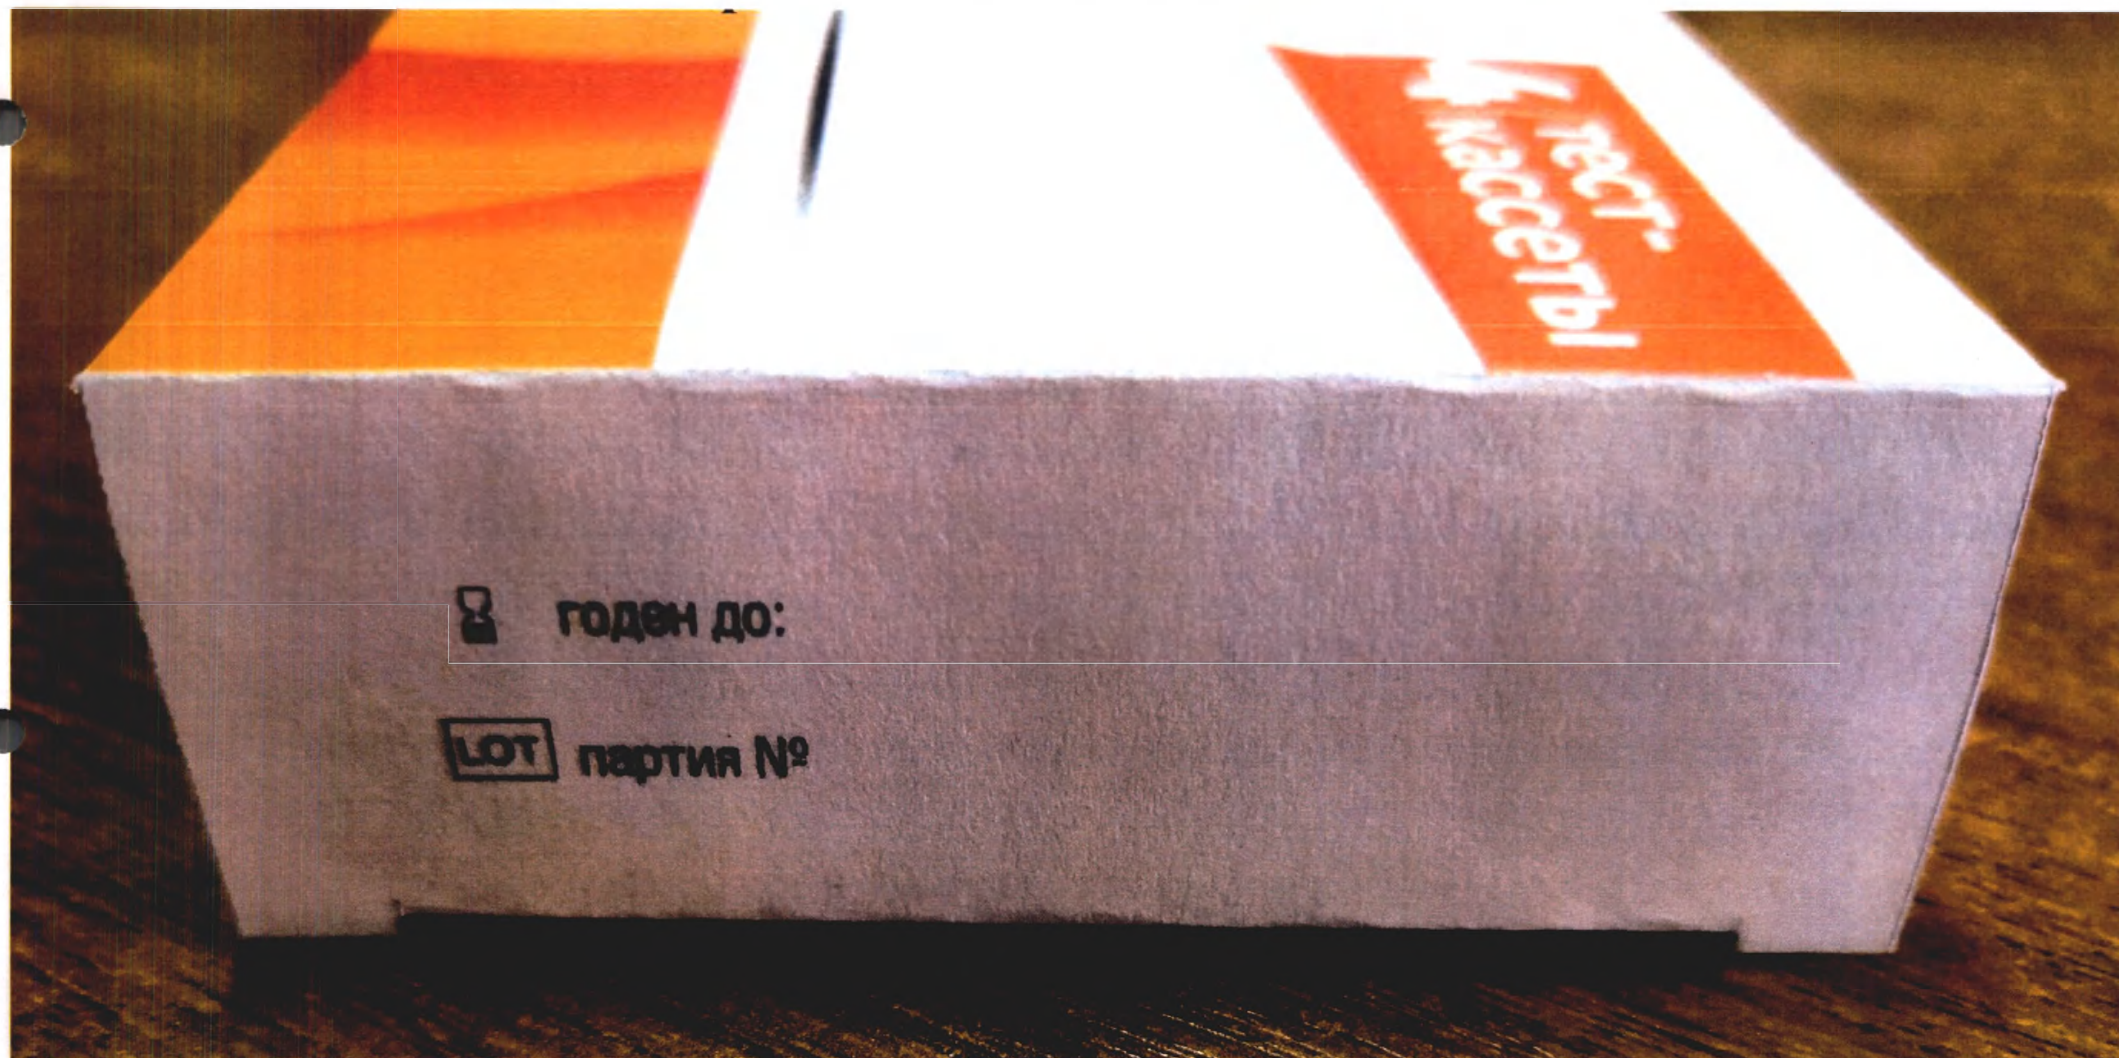

Макет маркировки медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 5 шт.; пипетка - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 5 шт.; пипетка - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

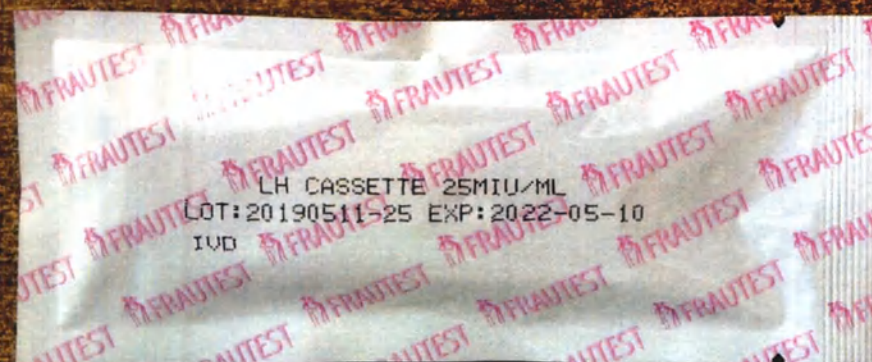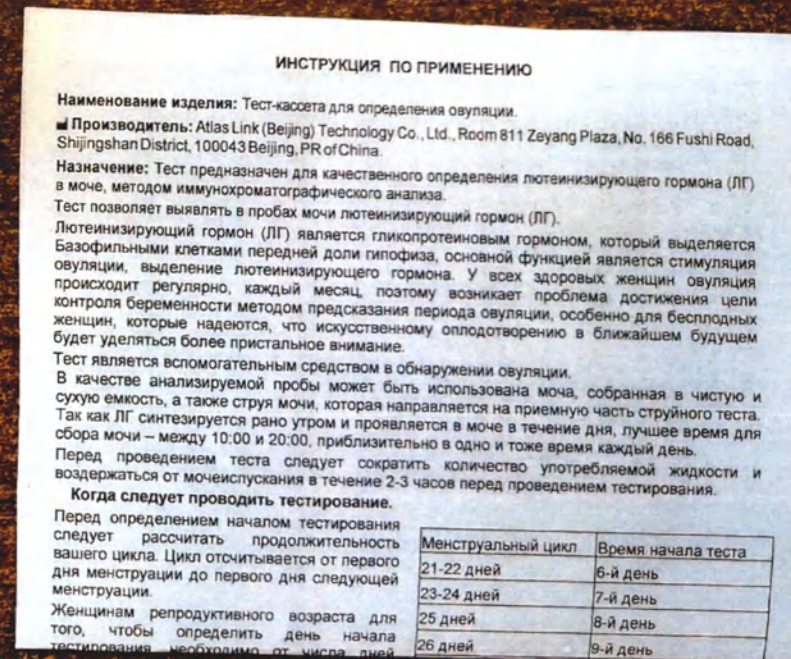

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 5 шт.; пипетка - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 5 шт.; пипетка - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

ТЕСТ-КАССЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките тест-кассету и пипетку.
- С помощью пипетки закапайте 4 капли мочи в круглое отверстие тест-кассеты.
- Положите тест-кассету на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/ появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/ появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 5 шт.; пипетка - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Тест-кассета в индивидуальной упаковке — 5 шт.

Пипетка — 5 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan Distrtrict, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зеянг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.



Потребительская упаковка медицинского изделия «Тест-кассета для определения овуляции, в составе: тест-кассета в индивидуальной упаковке - 5 шт.; пипетка - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

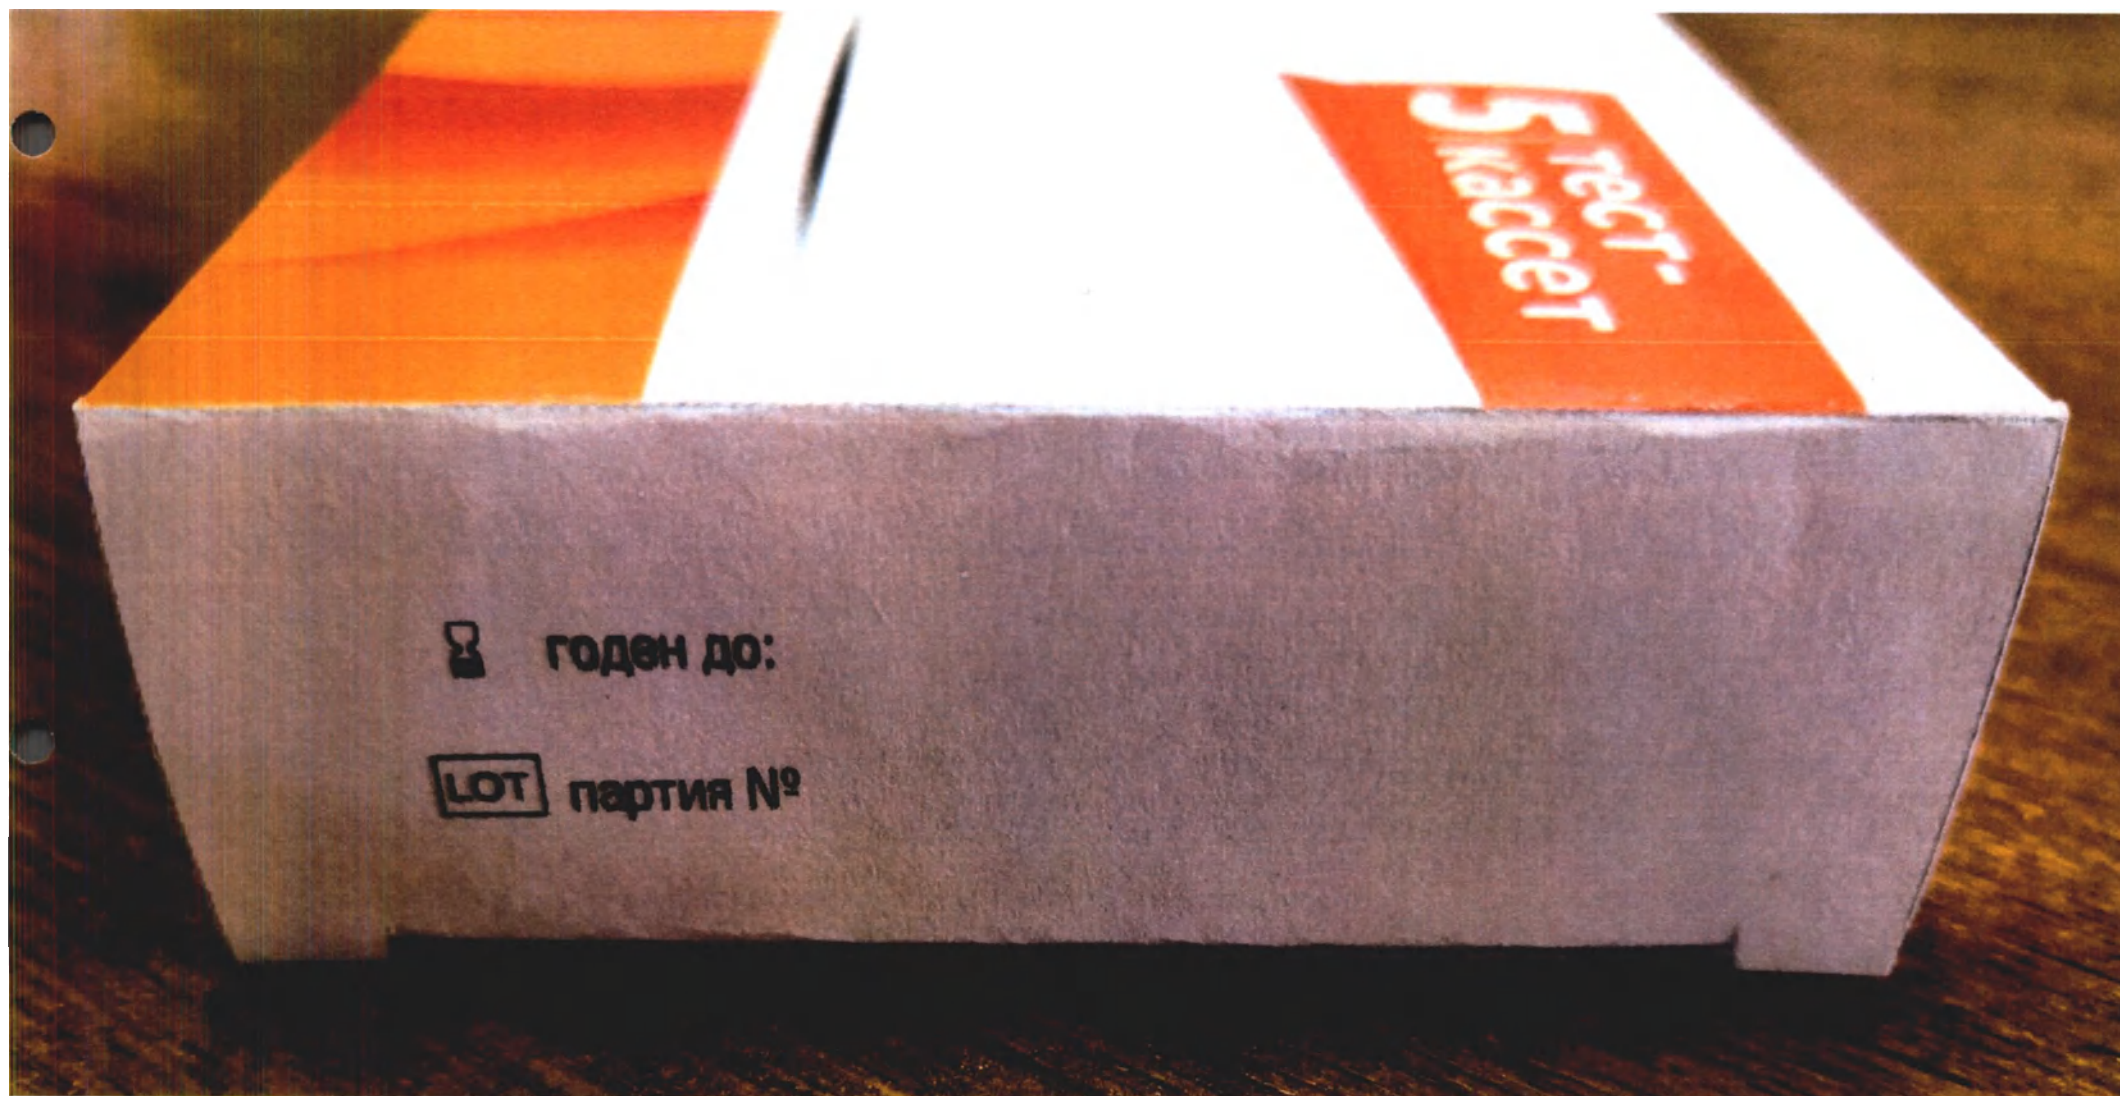


Макет маркировки медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

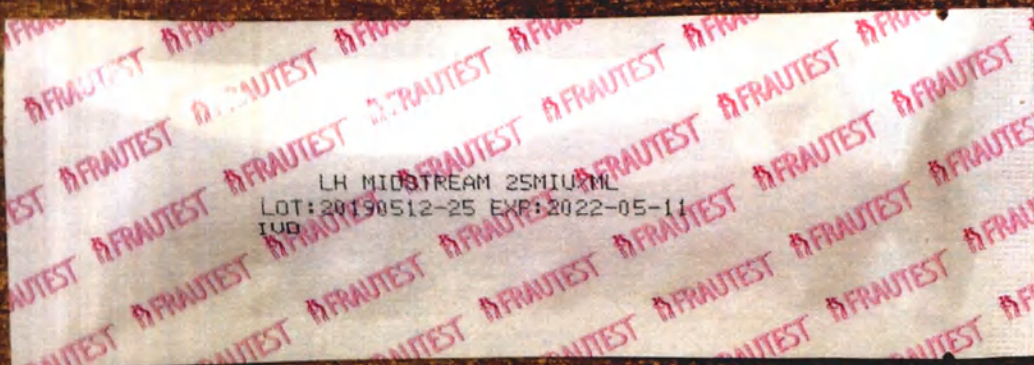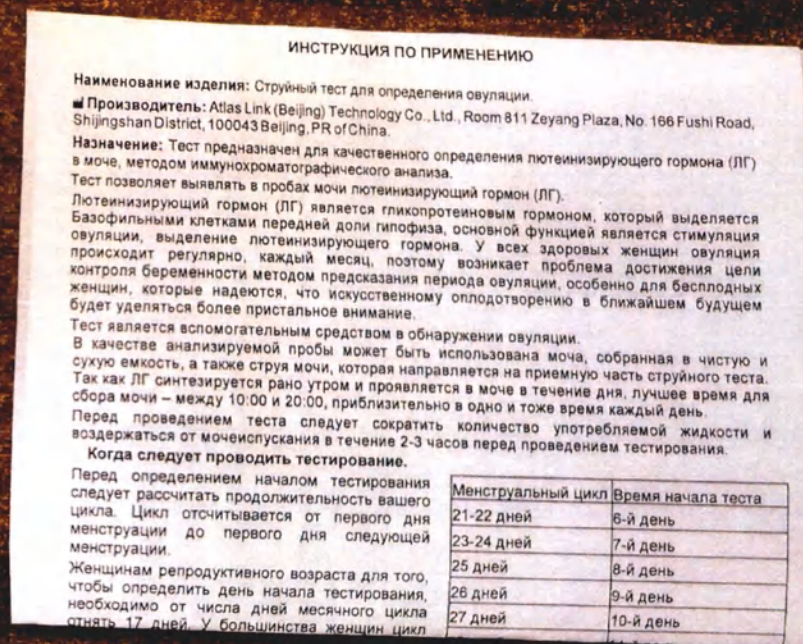

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

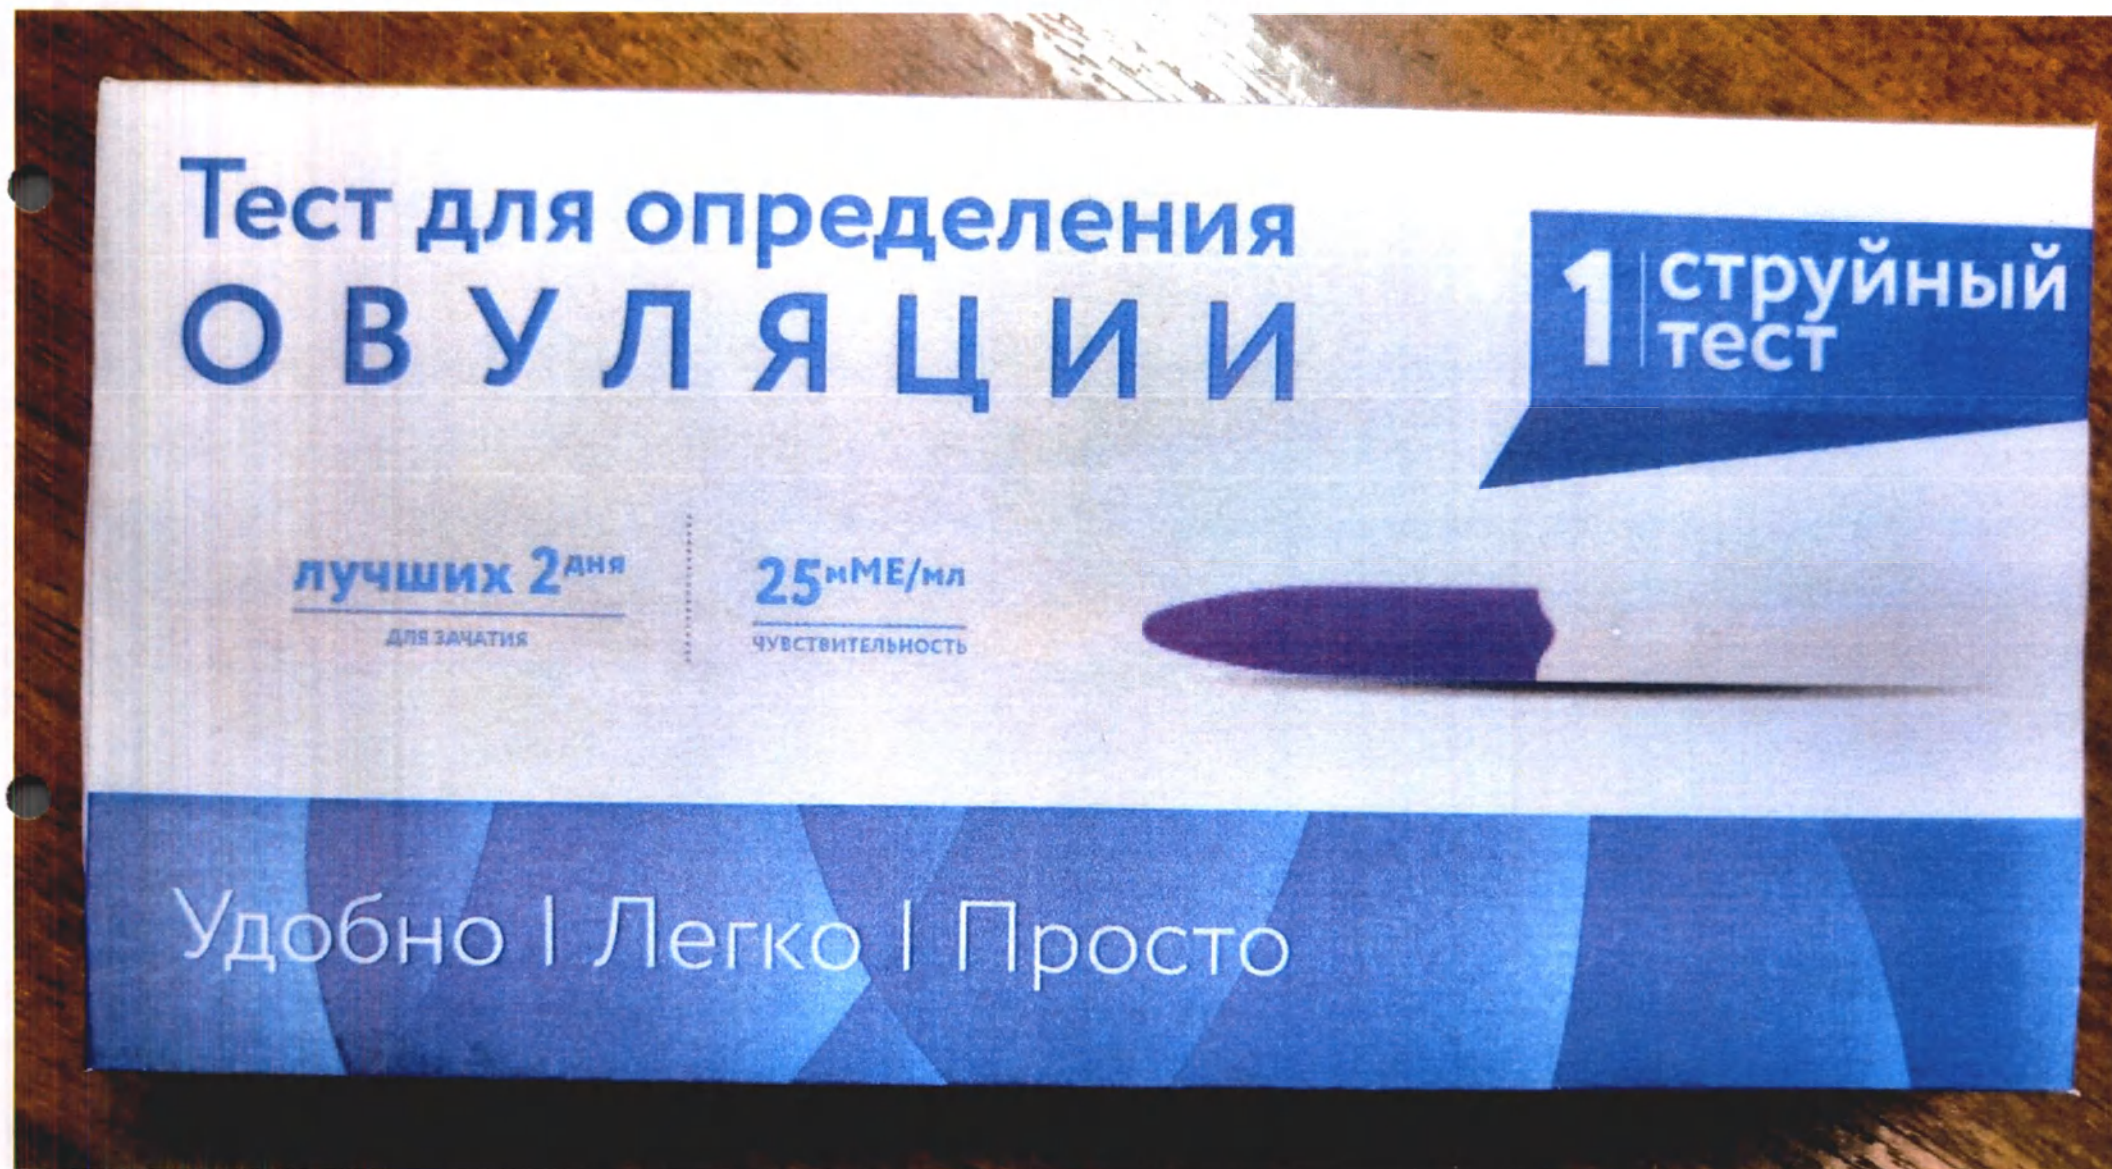

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките струйный тест. Снимите защитный колпачок.
- Подставьте приемную часть теста до стрелки под струю мочи на 10 секунд. Наденьте защитный колпачок.
- Положите тест на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Струйный тест в индивидуальной упаковке — 1 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan Distrtrict, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зеянг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.


Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 1 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Макет маркировки медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»

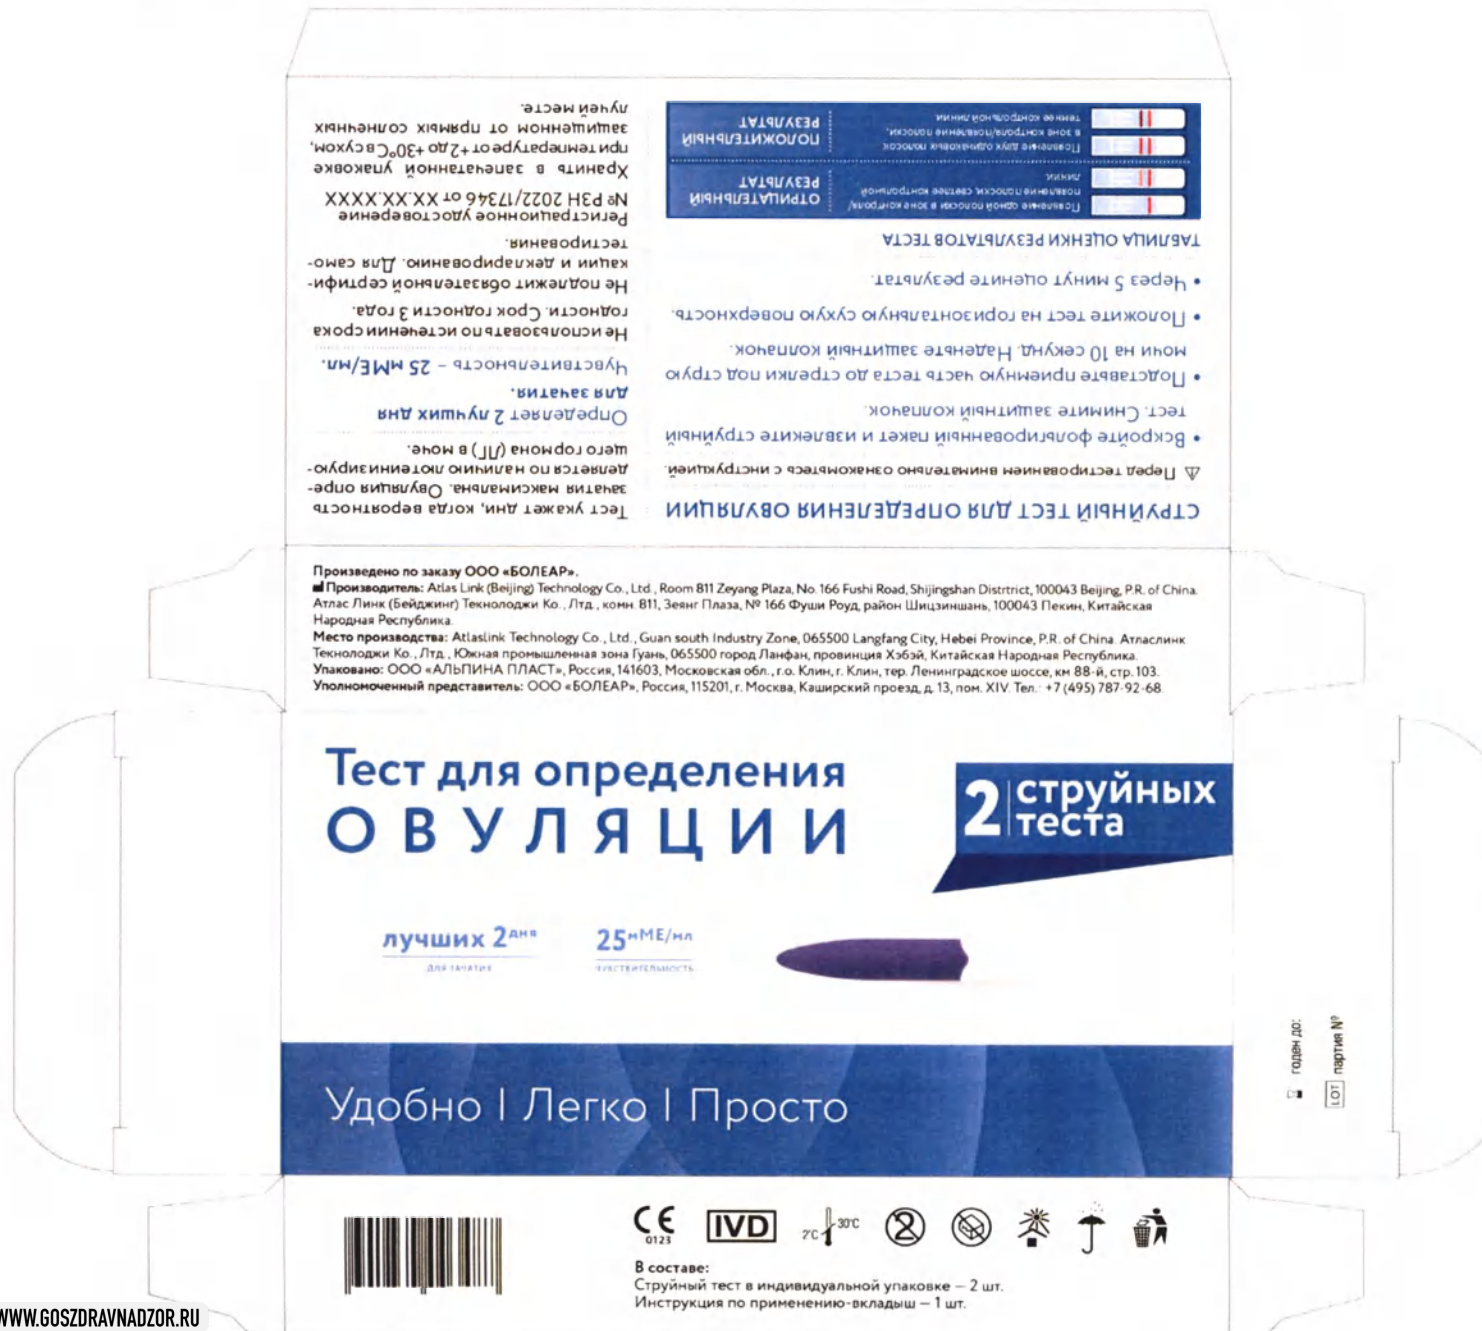

Общий вид медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките струйный тест. Снимите защитный колпачок.
- Подставьте приемную часть теста до стрелки под струю мочи на 10 секунд. Наденьте защитный колпачок.
- Положите тест на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/ появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Струйный тест в индивидуальной упаковке — 2 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan Distrtrict, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.



Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 2 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Макет маркировки медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

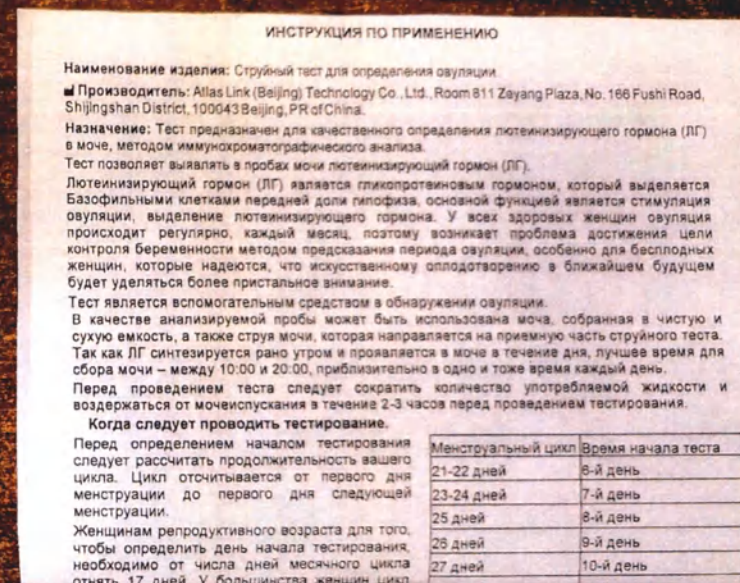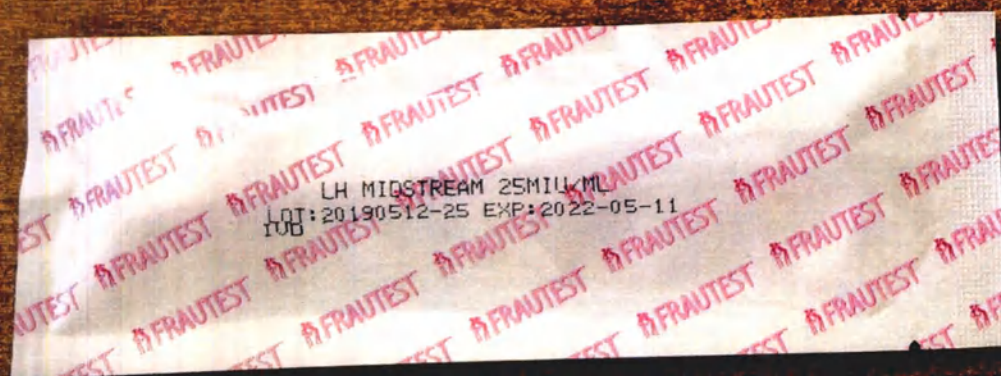

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1шт.»




Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките струйный тест. Снимите защитный колпачок.
- Подставьте приемную часть теста до стрелки под струю мочи на 10 секунд. Наденьте защитный колпачок.
- Положите тест на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/ появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/ появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Струйный тест в индивидуальной упаковке — 3 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.


Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 3 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Макет маркировки медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

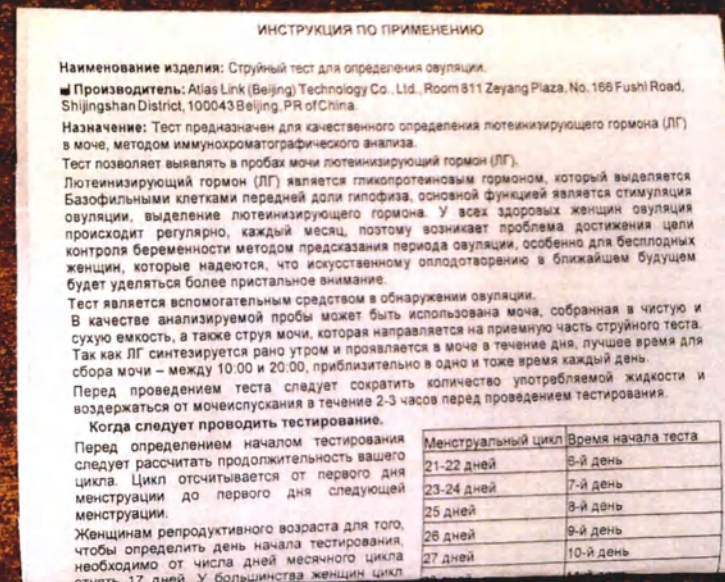

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»




Потребительска упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките струйный тест. Снимите защитный колпачок.
- Подставьте приемную часть теста до стрелки под струю мочи на 10 секунд. Наденьте защитный колпачок.
- Положите тест на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/ появление полоски, светлее контрольной линии.	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/ появление полоски, темнее контрольной линии.	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Струйный тест в индивидуальной упаковке — 4 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan Distrtrict, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.

Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.



Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 4 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Макет маркировки медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш -1 шт.»



Общий вид медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

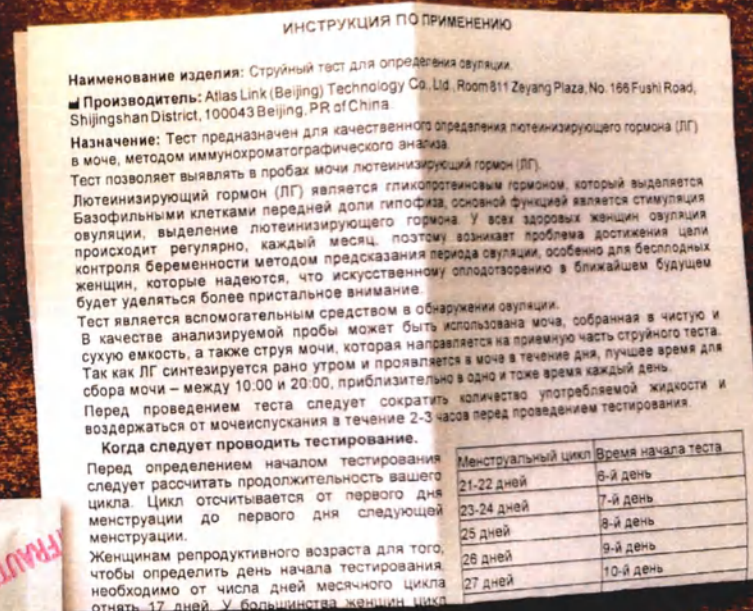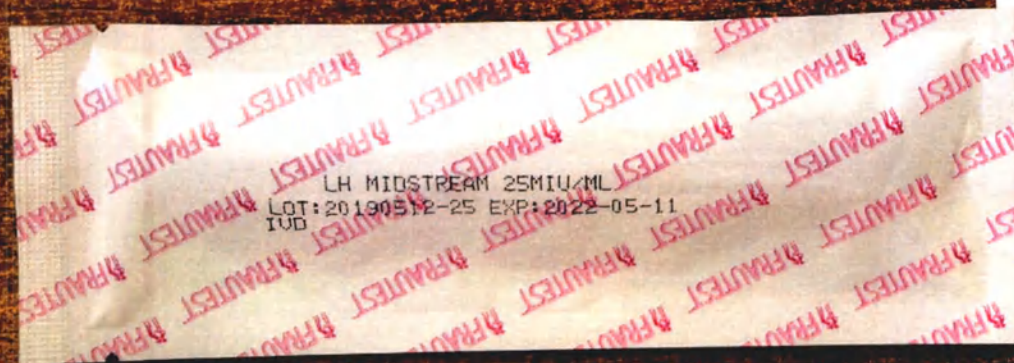

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

⚠ Перед тестированием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Вскройте фольгированный пакет и извлеките струйный тест. Снимите защитный колпачок.
- Подставьте приемную часть теста до стрелки под струю мочи на 10 секунд. Наденьте защитный колпачок.
- Положите тест на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 5 минут оцените результат.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

	Появление одной полоски в зоне контроля/появление полоски, светлее контрольной линии	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Появление двух одинаковых полосок в зоне контроля/появление полоски, темнее контрольной линии	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест укажет дни, когда вероятность зачатия максимальна. Овуляция определяется по наличию лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче.

Определяет 2 лучших дня для зачатия.

Чувствительность – 25 мМЕ/мл.


Не использовать по истечении срока годности. Срок годности 3 года.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Для само-тестирования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17346 от XX.XX.XXXX

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от +2 до +30°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»



В составе:

Струйный тест в индивидуальной упаковке — 5 шт.

Инструкция по применению-вкладыш — 1 шт.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


■ **Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No.166 Fushi Road, Shijingshan Distrtrict, 100043 Beijing, P.R. of China.
Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика.

Место производства: Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, P.R. of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

Упаковано: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское шоссе, км 88-й, стр. 103.


Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

Потребительская упаковка медицинского изделия «Струйный тест для определения овуляции, в составе: струйный тест в индивидуальной упаковке - 5 шт.; инструкция по применению-вкладыш - 1 шт.»

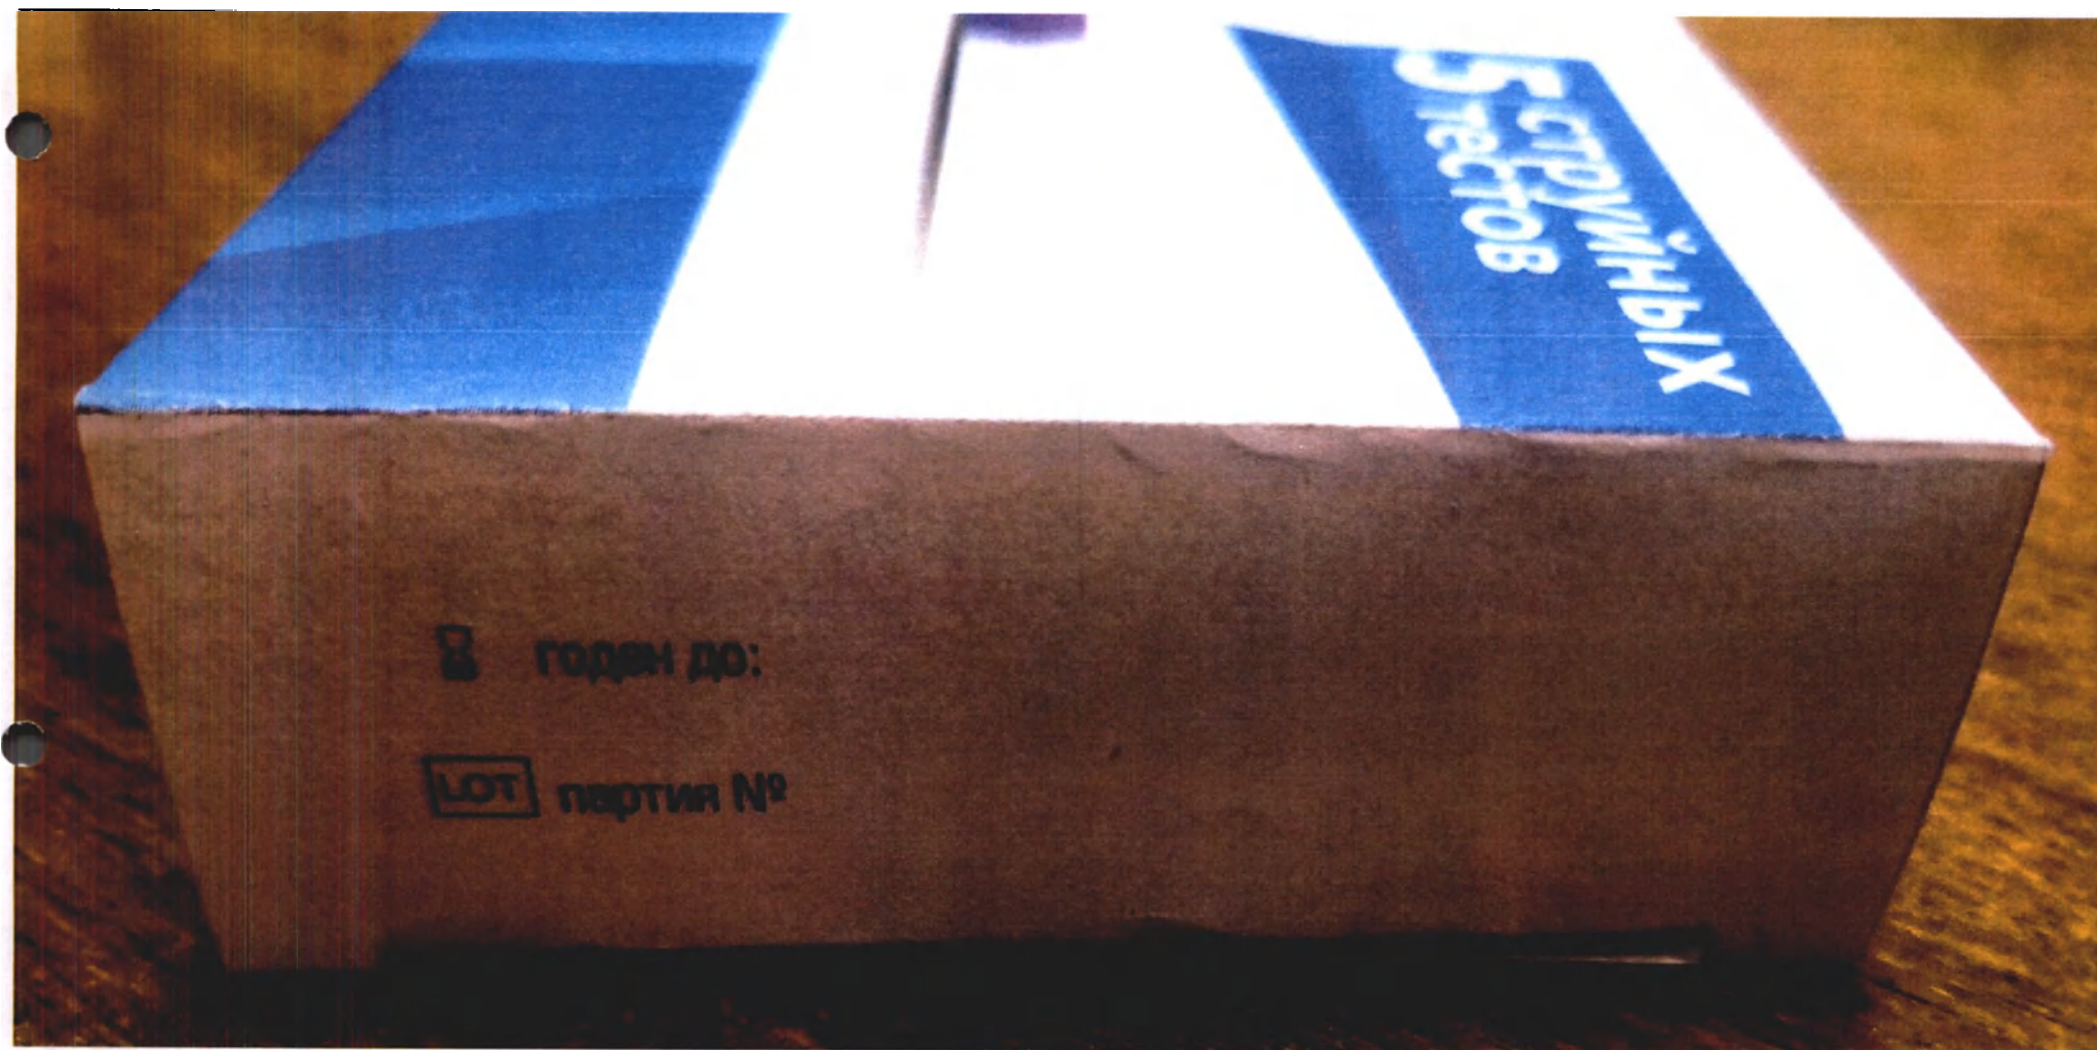



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 48 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"


Е.А.Колобова