



REGICOM
est. 2008



REGICOM in Kazakhstan

Address: Almaty, 050000, st. Abylai Khan
122, office 12/13

Phone: +7 (727) 267-31-20

Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)

Mobile: +7 701-789-90-00

E-mail: i.kozlov@regicompany.com

REGICOM in Russia

Address: Moscow, Shmitovskiy proezd, house 39,
building 2, apartment 10

Phone: +7 495 609-41-15

Mobile: +7 969-197-44-33

Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)

E-mail: i.kozlov@regicompany.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «РЕГИКОМ»

Козлов И.

2024 г.



Фотографические изображения Версия 3

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 в вариантах исполнения
производства компании Acandis GmbH» («Акандис ГмбХ»)

1. Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2, в составе:


1.1. Стент нитиноловый саморасширяющийся, размеры (мм): 6,0 x 25- 1 шт.

1.2. Транспортный проводник J-формы, диаметр: 3F (1,0 мм); длина – 2000 мм - 1 шт.

1.3. Интродьюсер, размеры: 3F (1,0 мм) – 1 шт.

1.4. Инструкция по применению – 1 шт.

1.5. Этикетка – 1 шт.

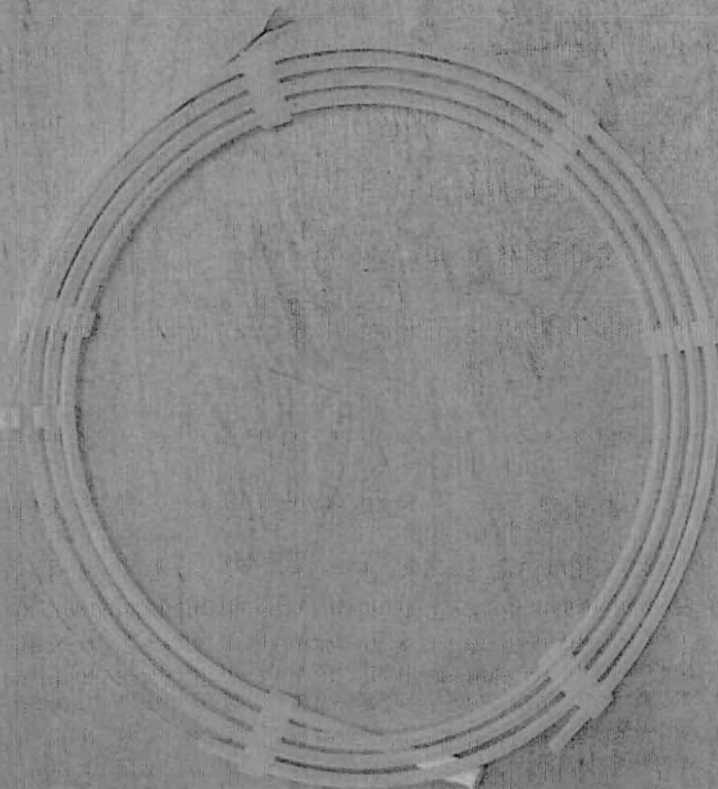

xcan^{dis}
«Ханс-Системс»
Трансфер-Финанс (Приват)
119040, г. Москва
Тел: +7 (495) 7231 1500
www.xcandis.com

**Устройство для эмболизации сосудов
DERIVO® 2 6,0 x 25 мм**


CE 0297

REF 01-107032 LOT 200709043

Рекомендуемый диаметр сосуда	От 5,0 мм до 6,0 мм
------------------------------	---------------------

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2



A	6,0 мм	5,5 мм	5,0 мм
B	25 мм	37 мм	45 мм

Размеры раскрытого изделия
Диаметр 6,2 мм Длина 20 мм

Рекомендуемый микрокатетер для доставки
NeuroSlider® 27 (DLC)

Требуемый микрокатетер для доставки
B, D 0,027 дюйма

Конфигурация транспортного проводника: J-форма

Fig. D

STERILEEO

2023-07-30

MD: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 6,0 x 25 мм

UDI: 01-107032 200709043

MD: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 6,0 x 25 мм


UDI: 01-107032 200709043

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 6,0 x 25 мм


Рекомендуемый микрокатетер: NeuroSlider® 27 (DLC)

LOT 200709043 2023-07-30 xcan^{dis}


Стент нитиноловый саморасширяющийся (вид изделия в раскрытом виде)

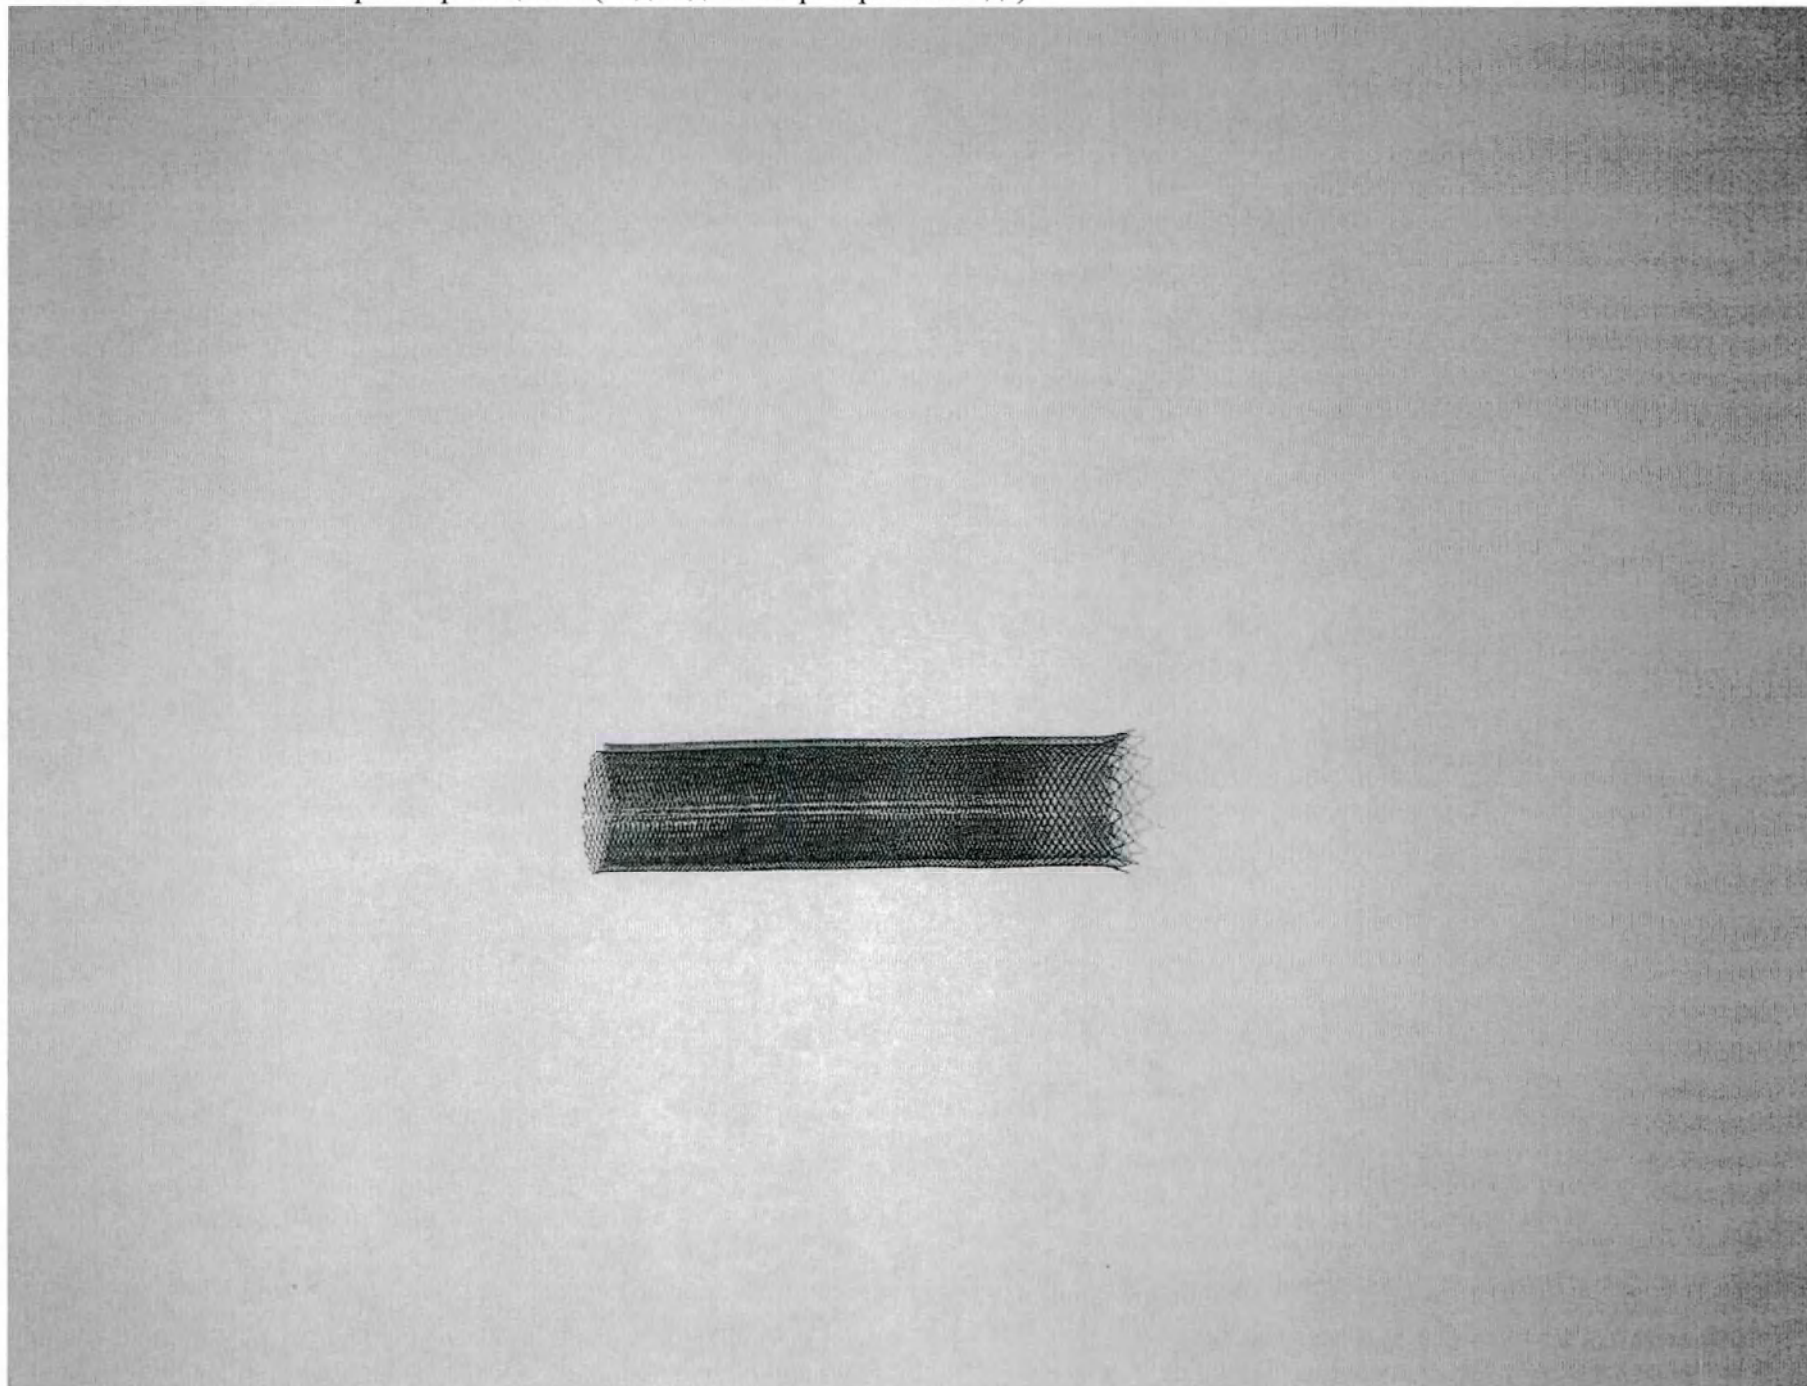



Транспортный проводник J-формы (общий вид)

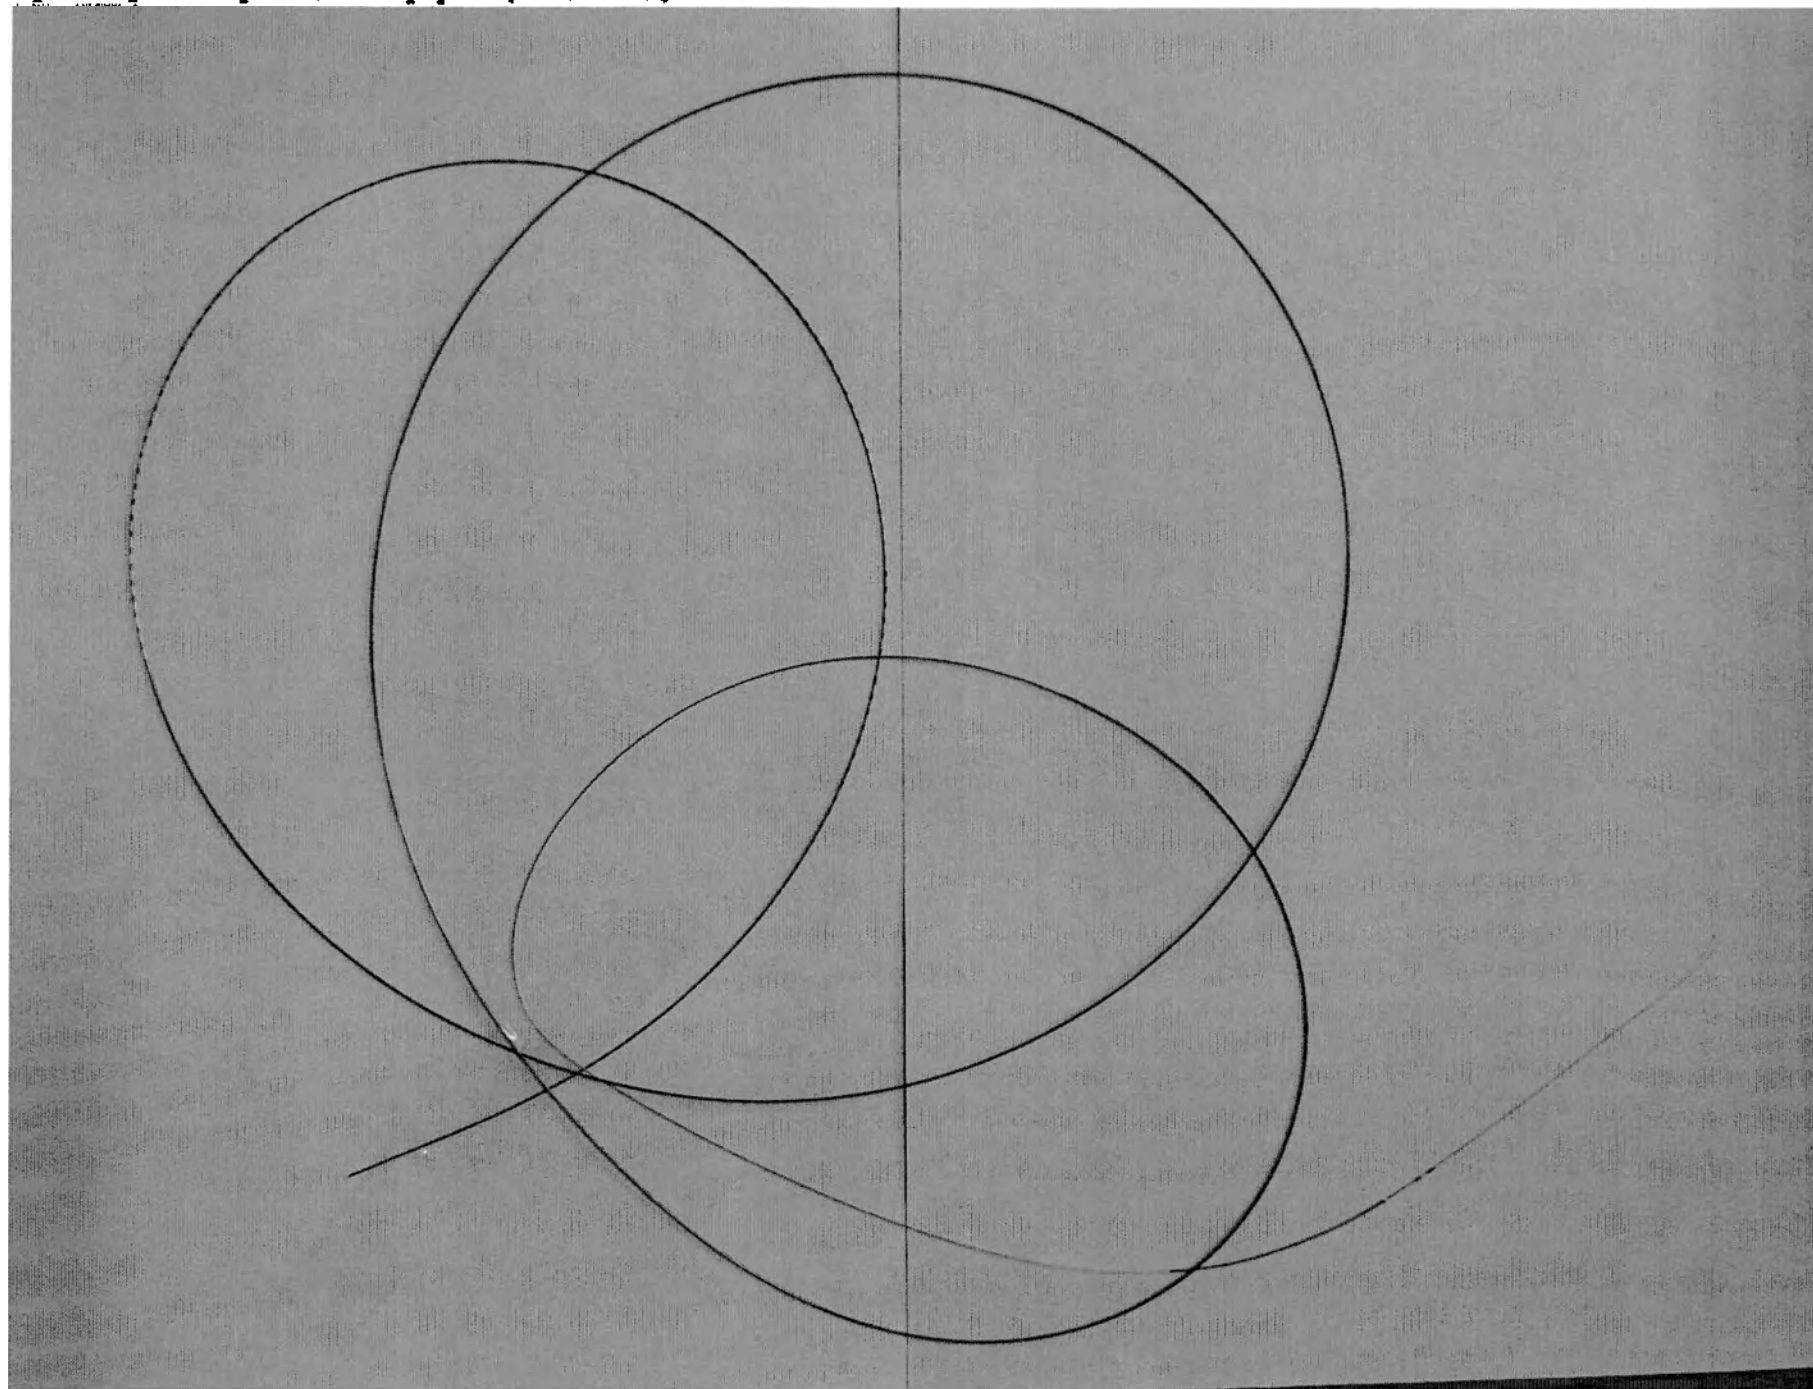

Транспортный проводник J-формы (вид кончика)

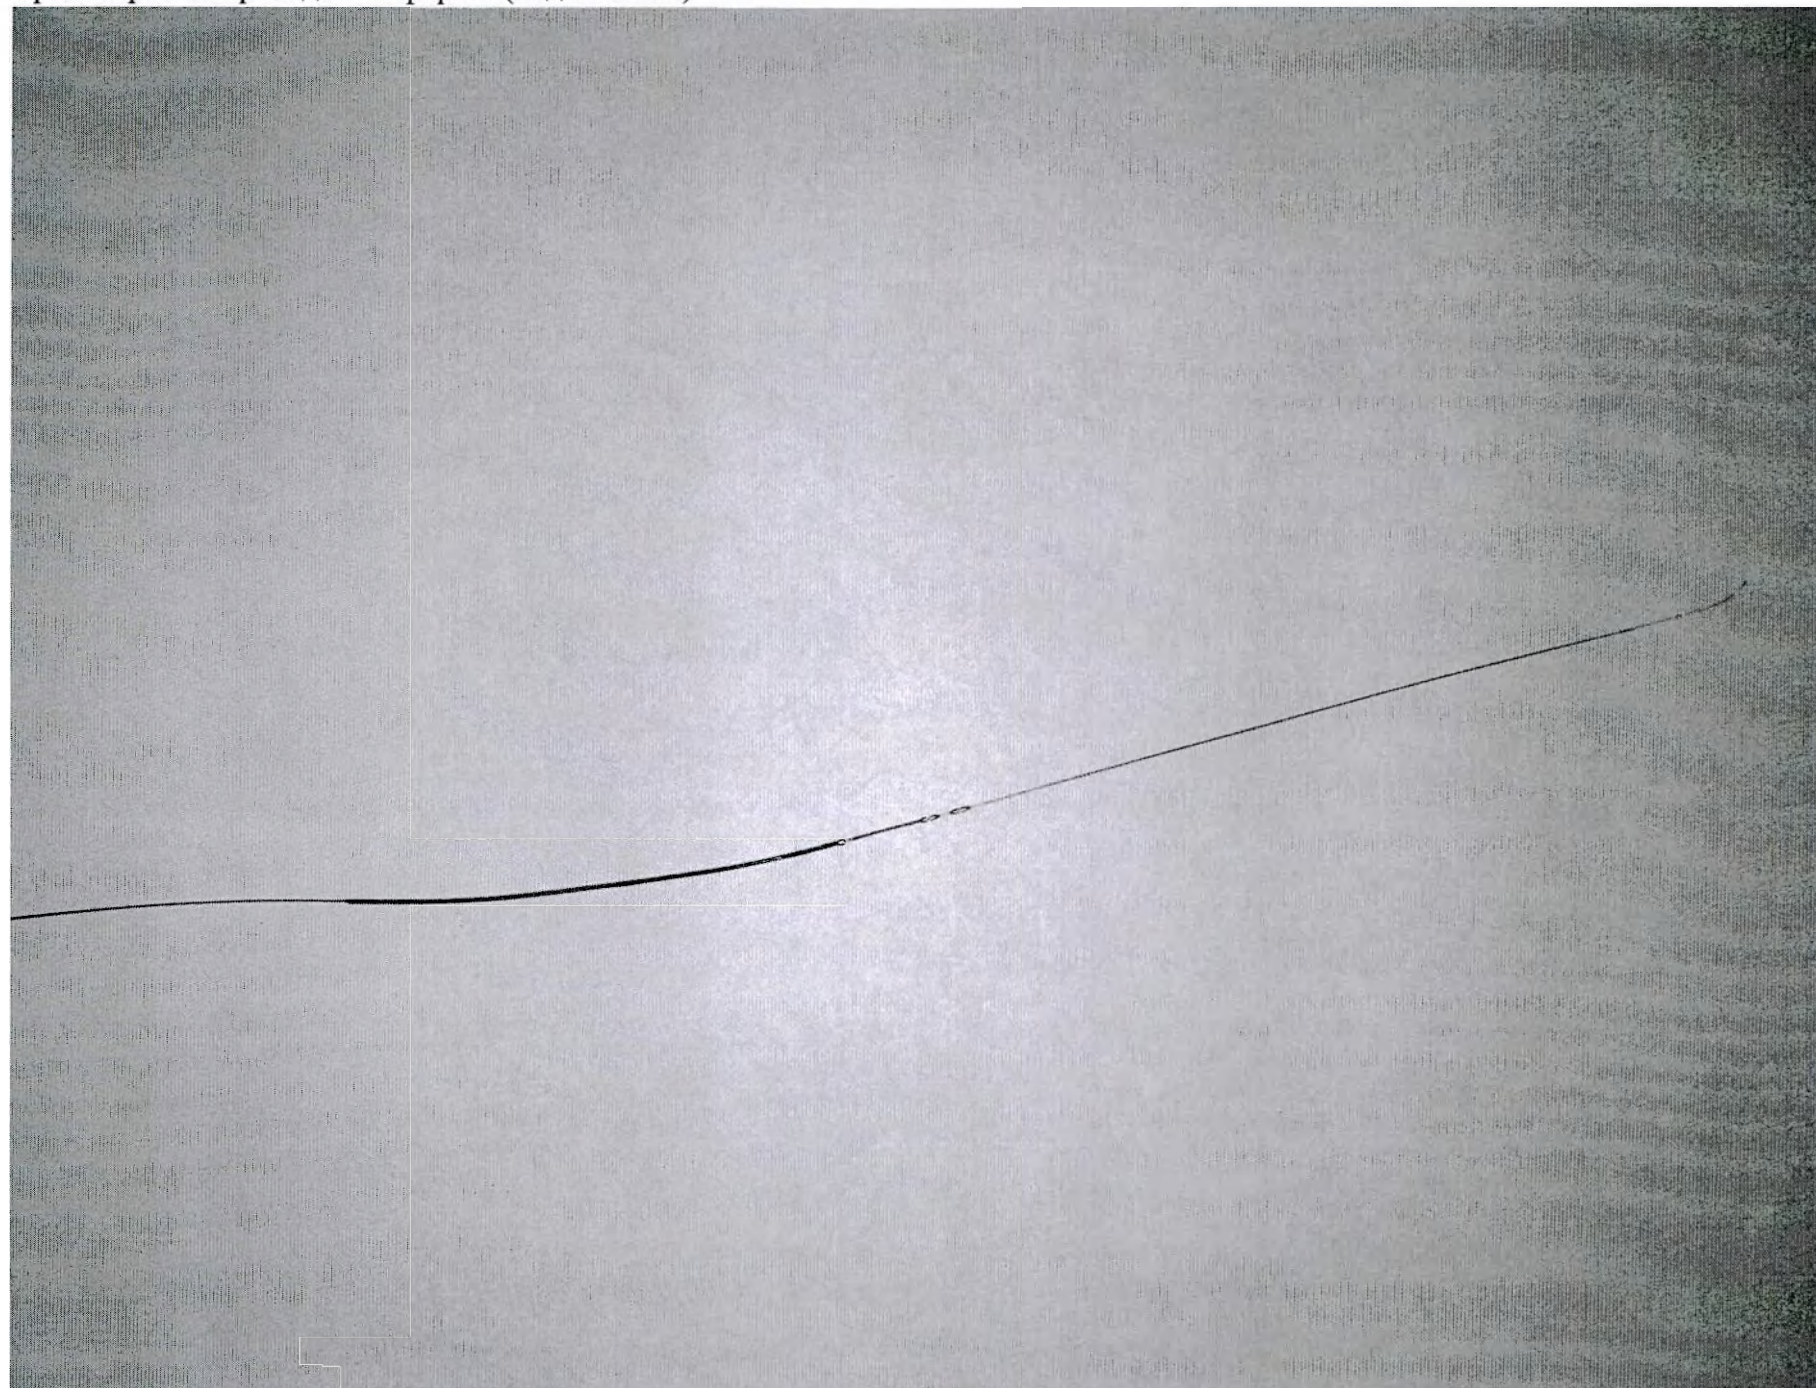

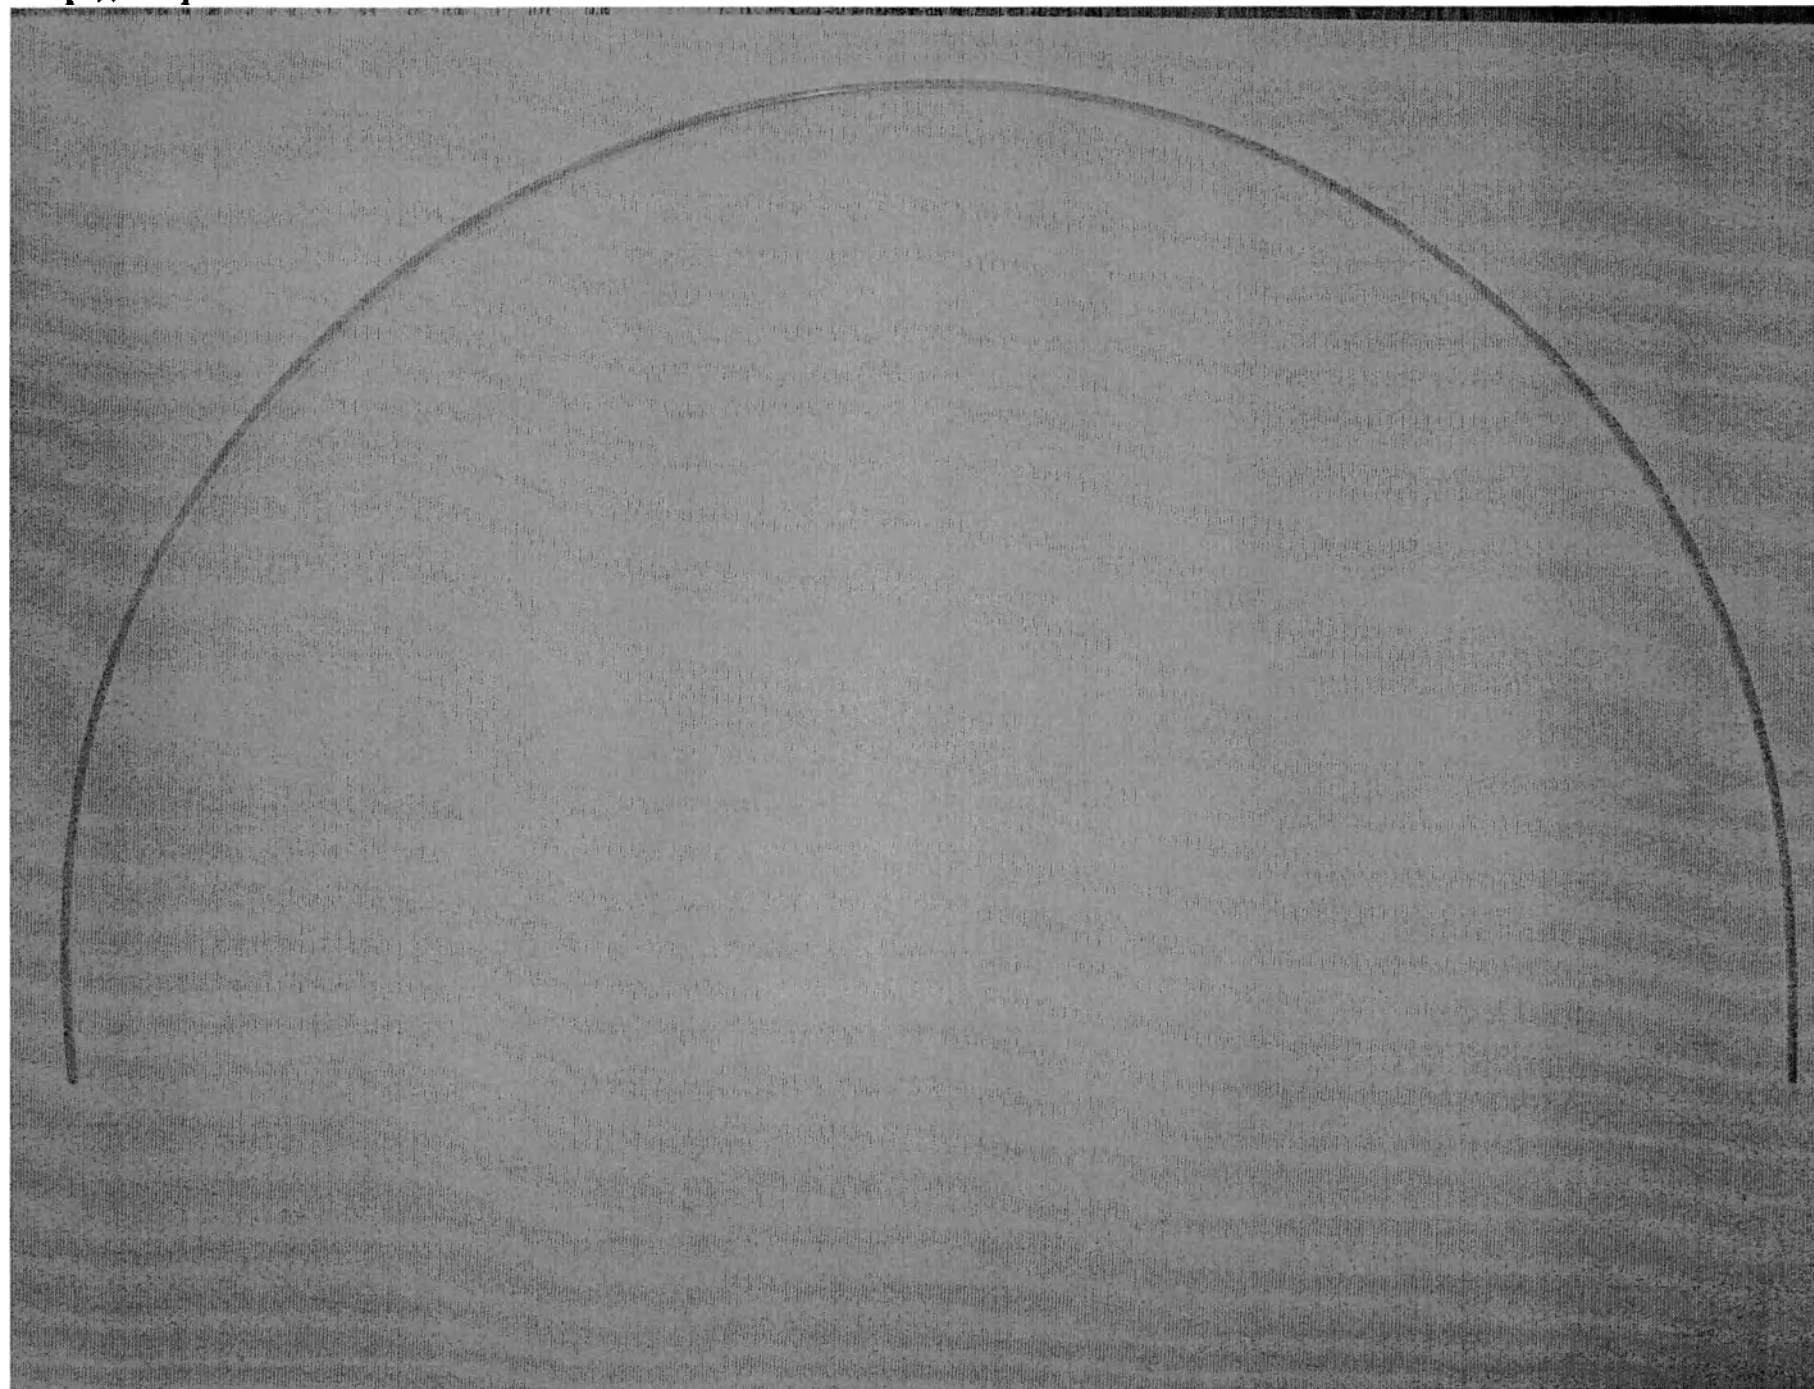

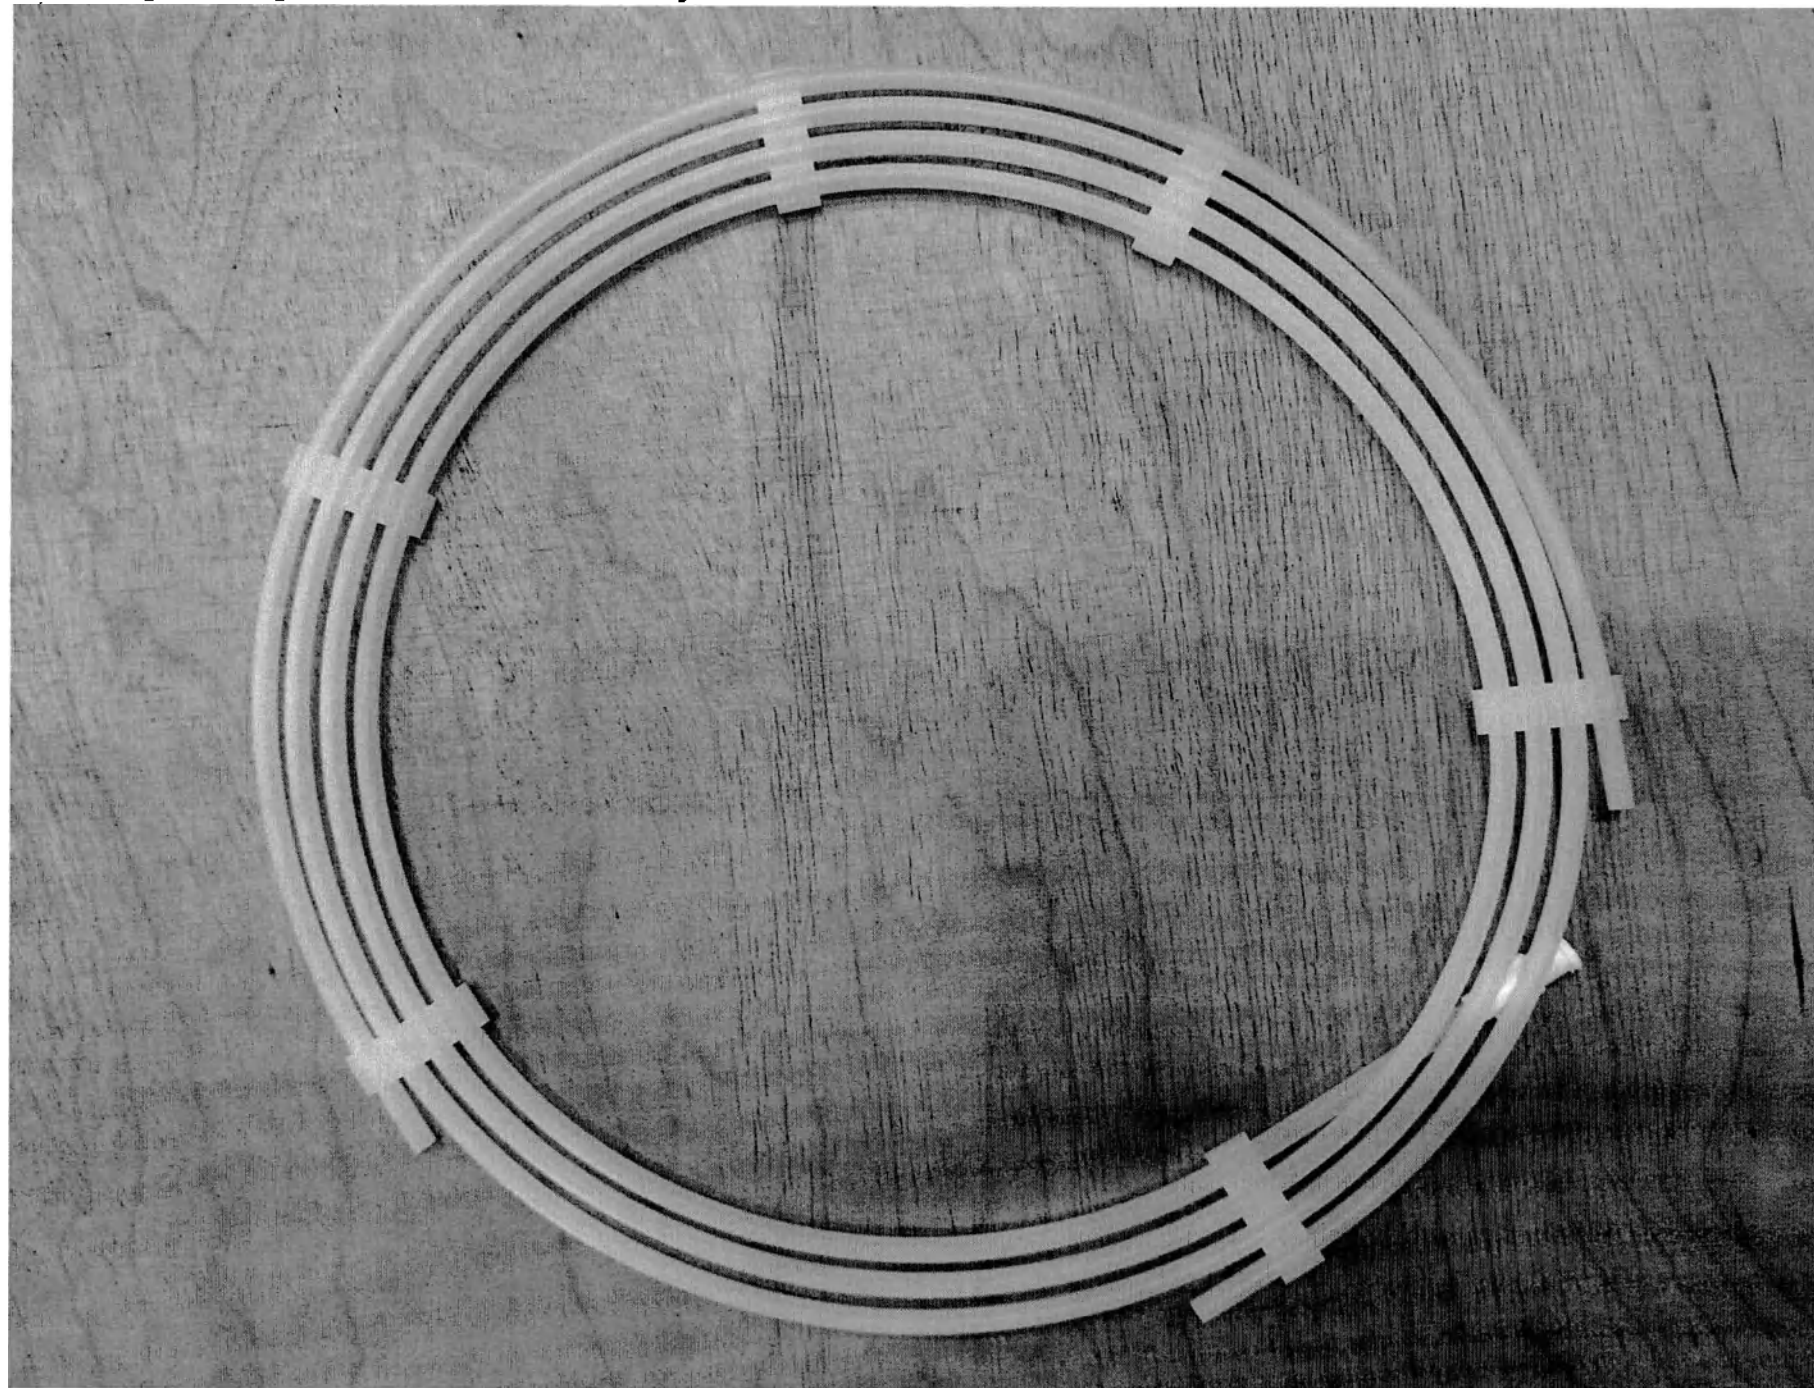

Вторичная упаковка, картонная коробка для Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

Вторичная упаковка представляет собой складную, белую, картонную коробку. В нее вкладывается инструкция по применению. Место вскрытия на оборотной стороне закрыто белой этикеткой.

Наименование: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2, в составе:

1. Стент нитиноловый саморасширяющийся, размеры (мм): ____ х ____ - 1 шт.
2. Транспортный проводник J-формы, диаметр: ____ F (____ мм); длина – 2000 мм - 1 шт.
3. Интродьюсер, размеры: ____ F (____ мм) – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Этикетка – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ», Россия

123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com



Апирогенно.

Нетоксично.

2. Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником, в составе:

2.1. Стент нитиноловый саморасширяющийся, размеры (мм): 4,0 x 40 - 1 шт.


2.2. Транспортный проводник с коротким наконечником прямой формы, диаметр: 3F (1,0 мм); длина – 2000 мм - 1 шт.

2.3. Интродьюсер, размеры: 3F (1,0 мм) – 1 шт.


2.4. Инструкция по применению – 1 шт.

2.5. Этикетка – 1 шт.


Стент нитиноловый саморасширяющийся (вид изделия в раскрытом виде)

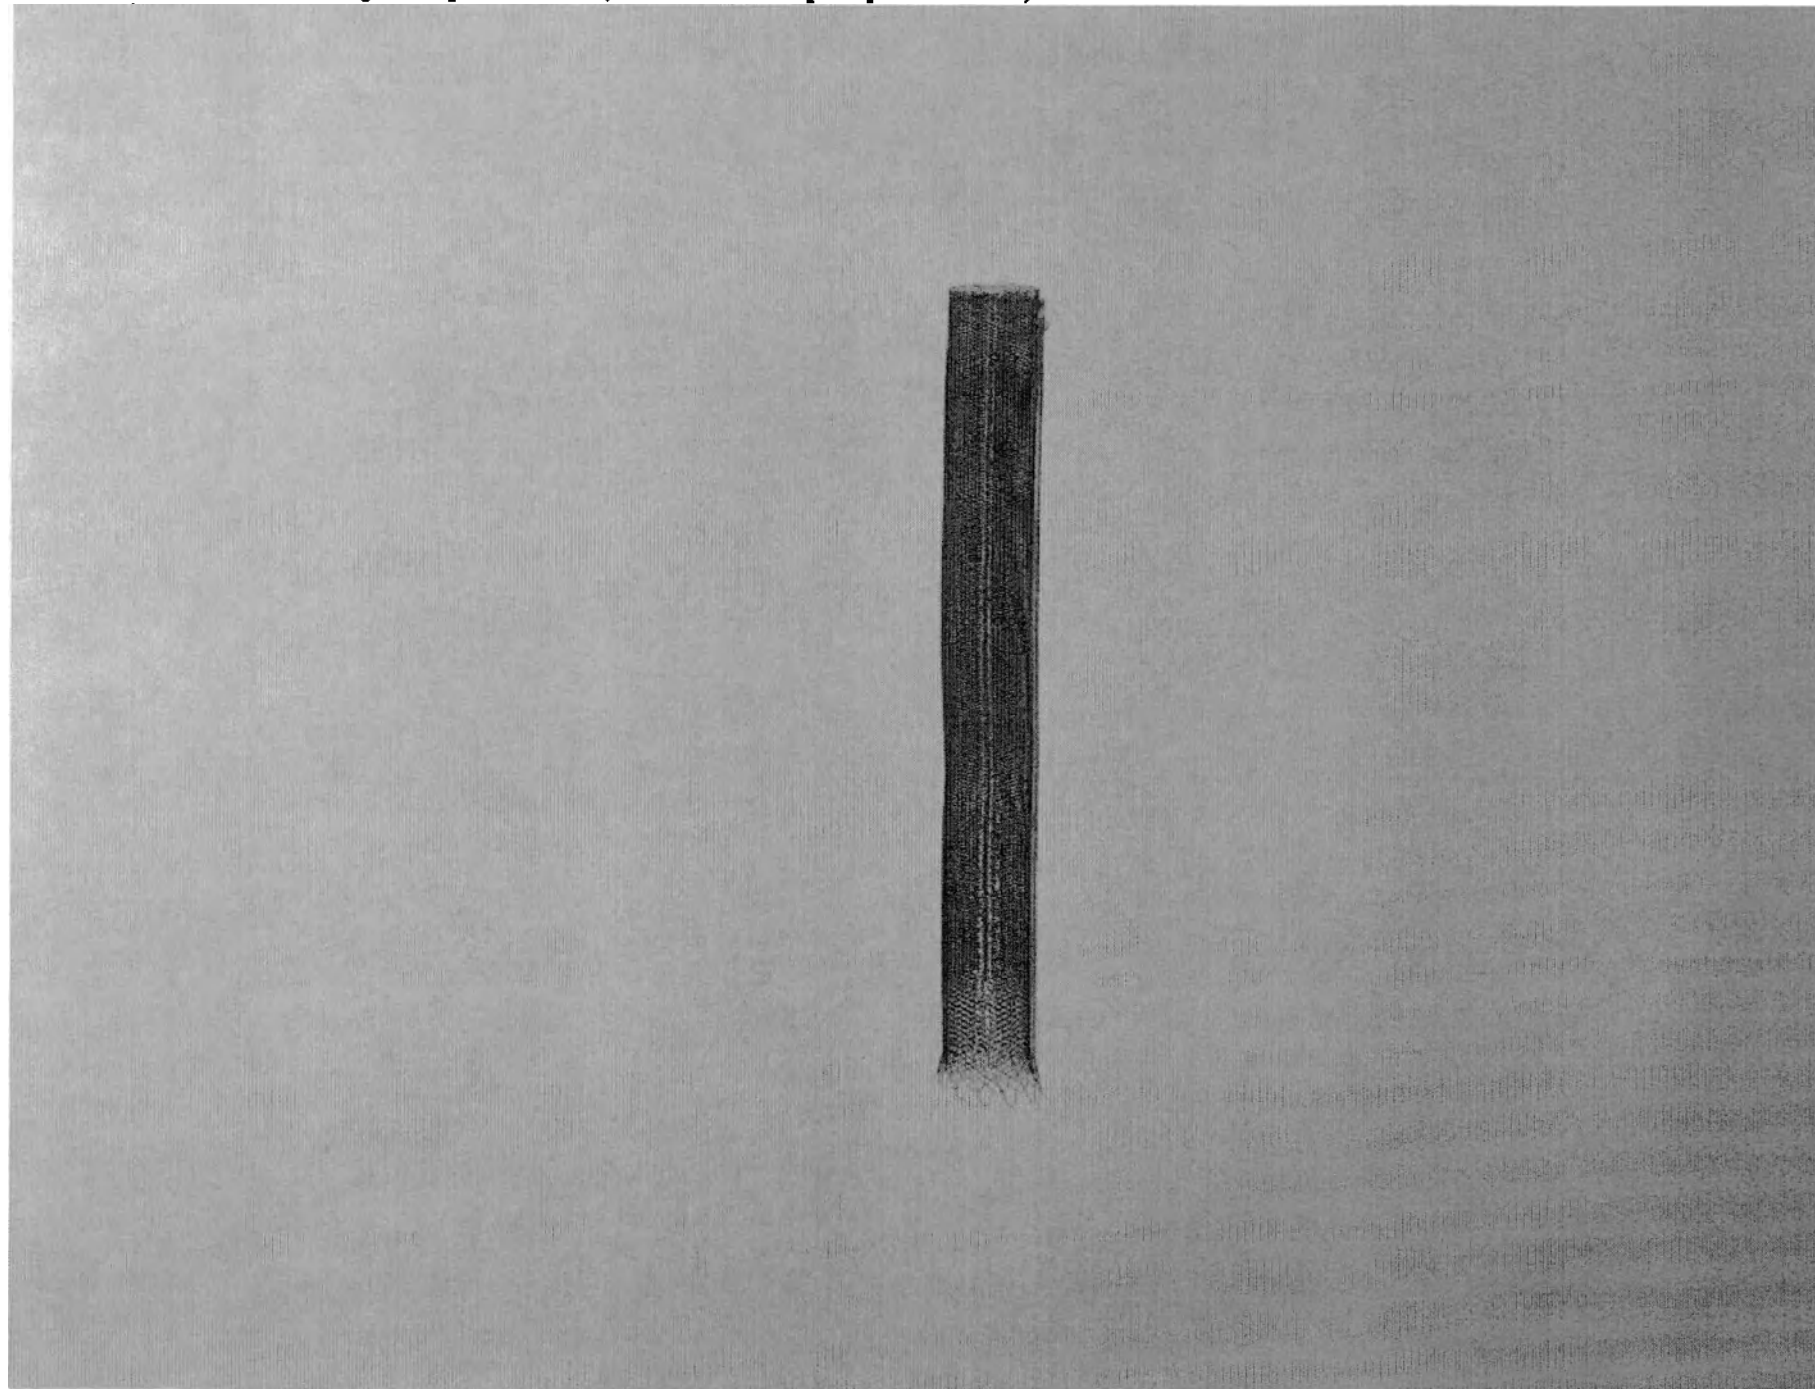


Транспортный проводник с коротким наконечником прямой формы (общий вид)

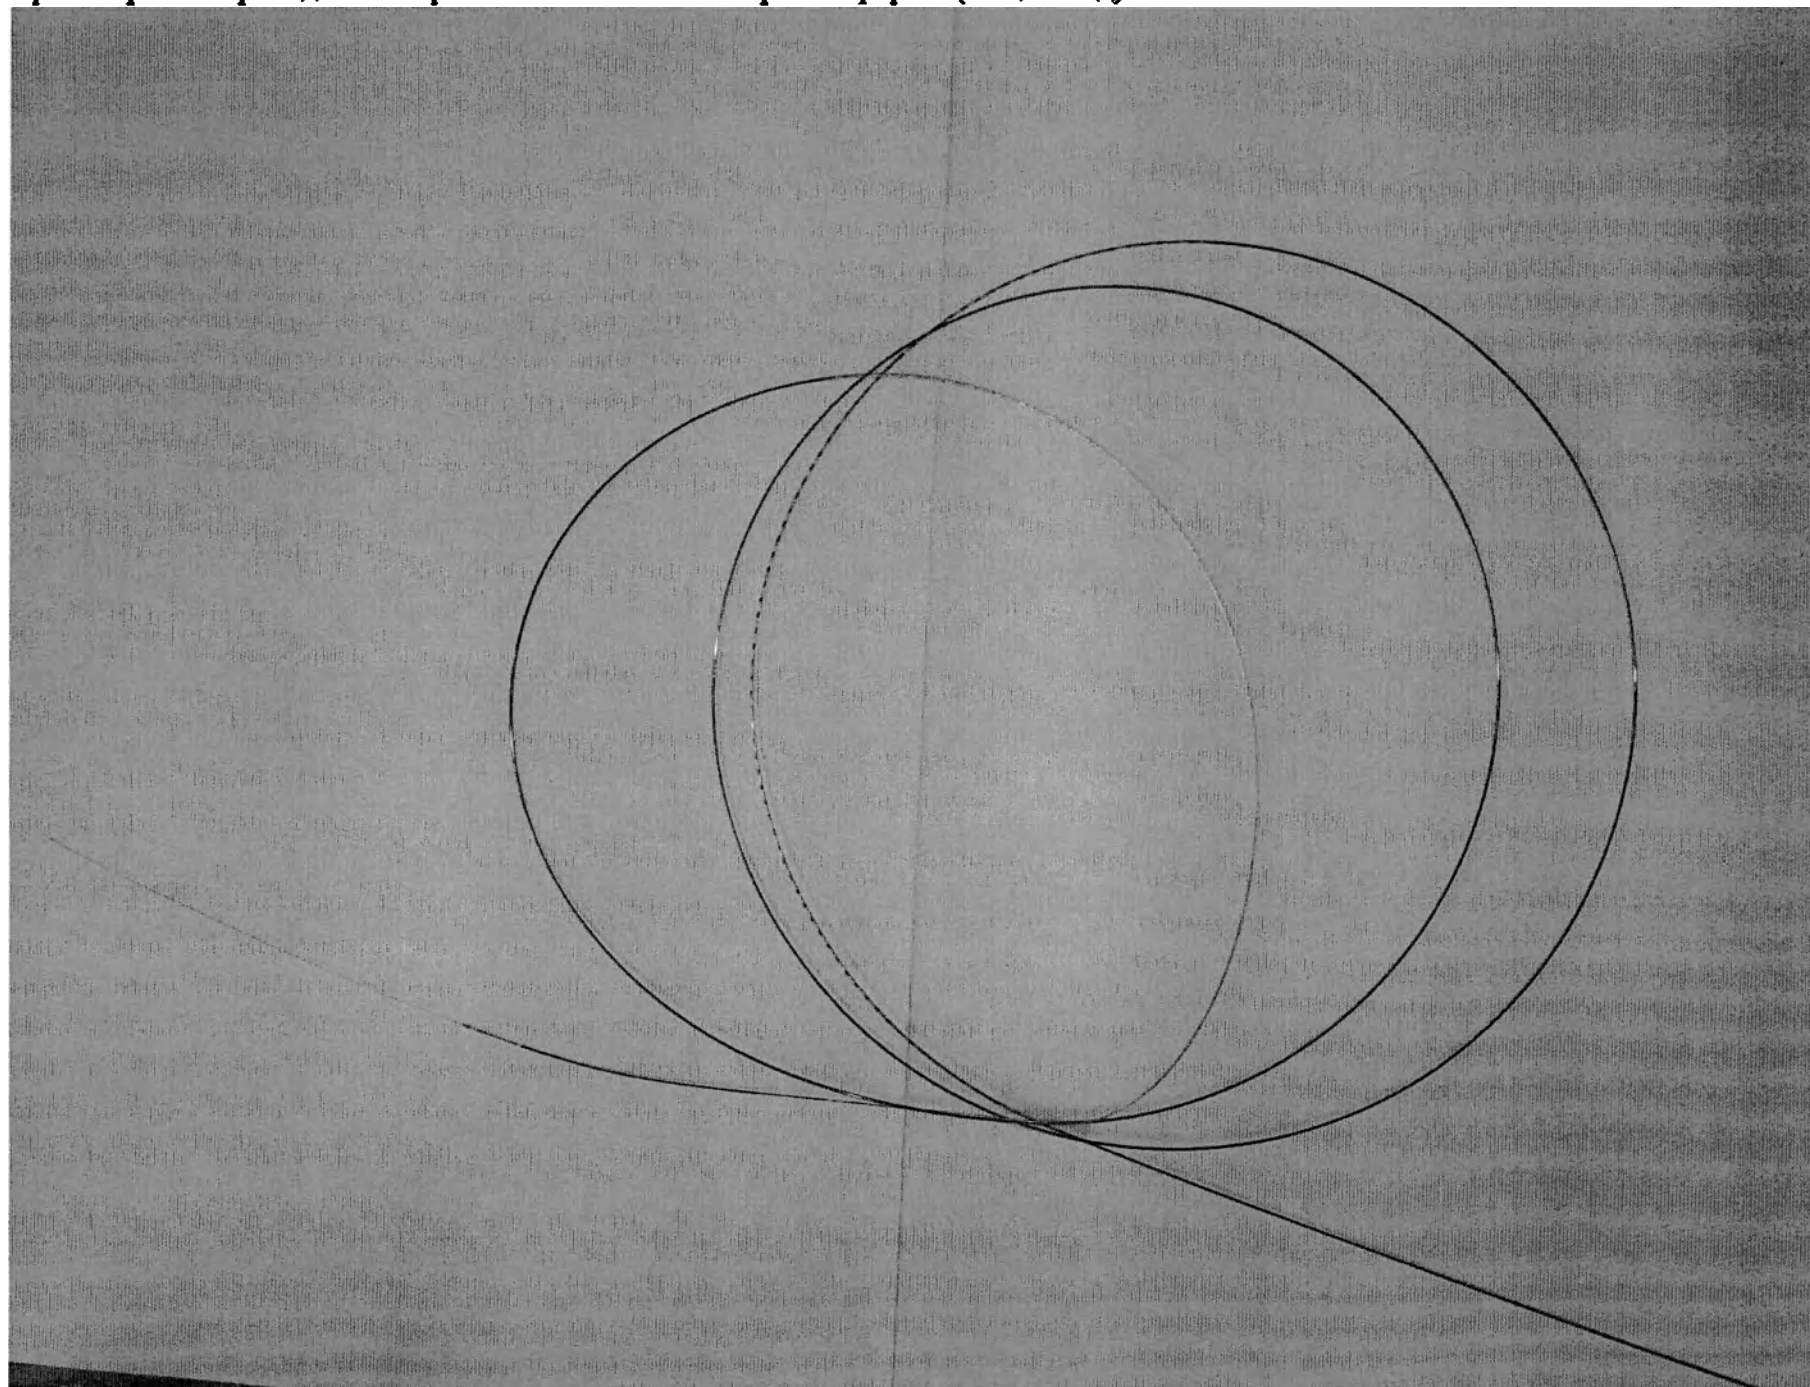

Транспортный проводник с коротким наконечником прямой формы (вид кончика)

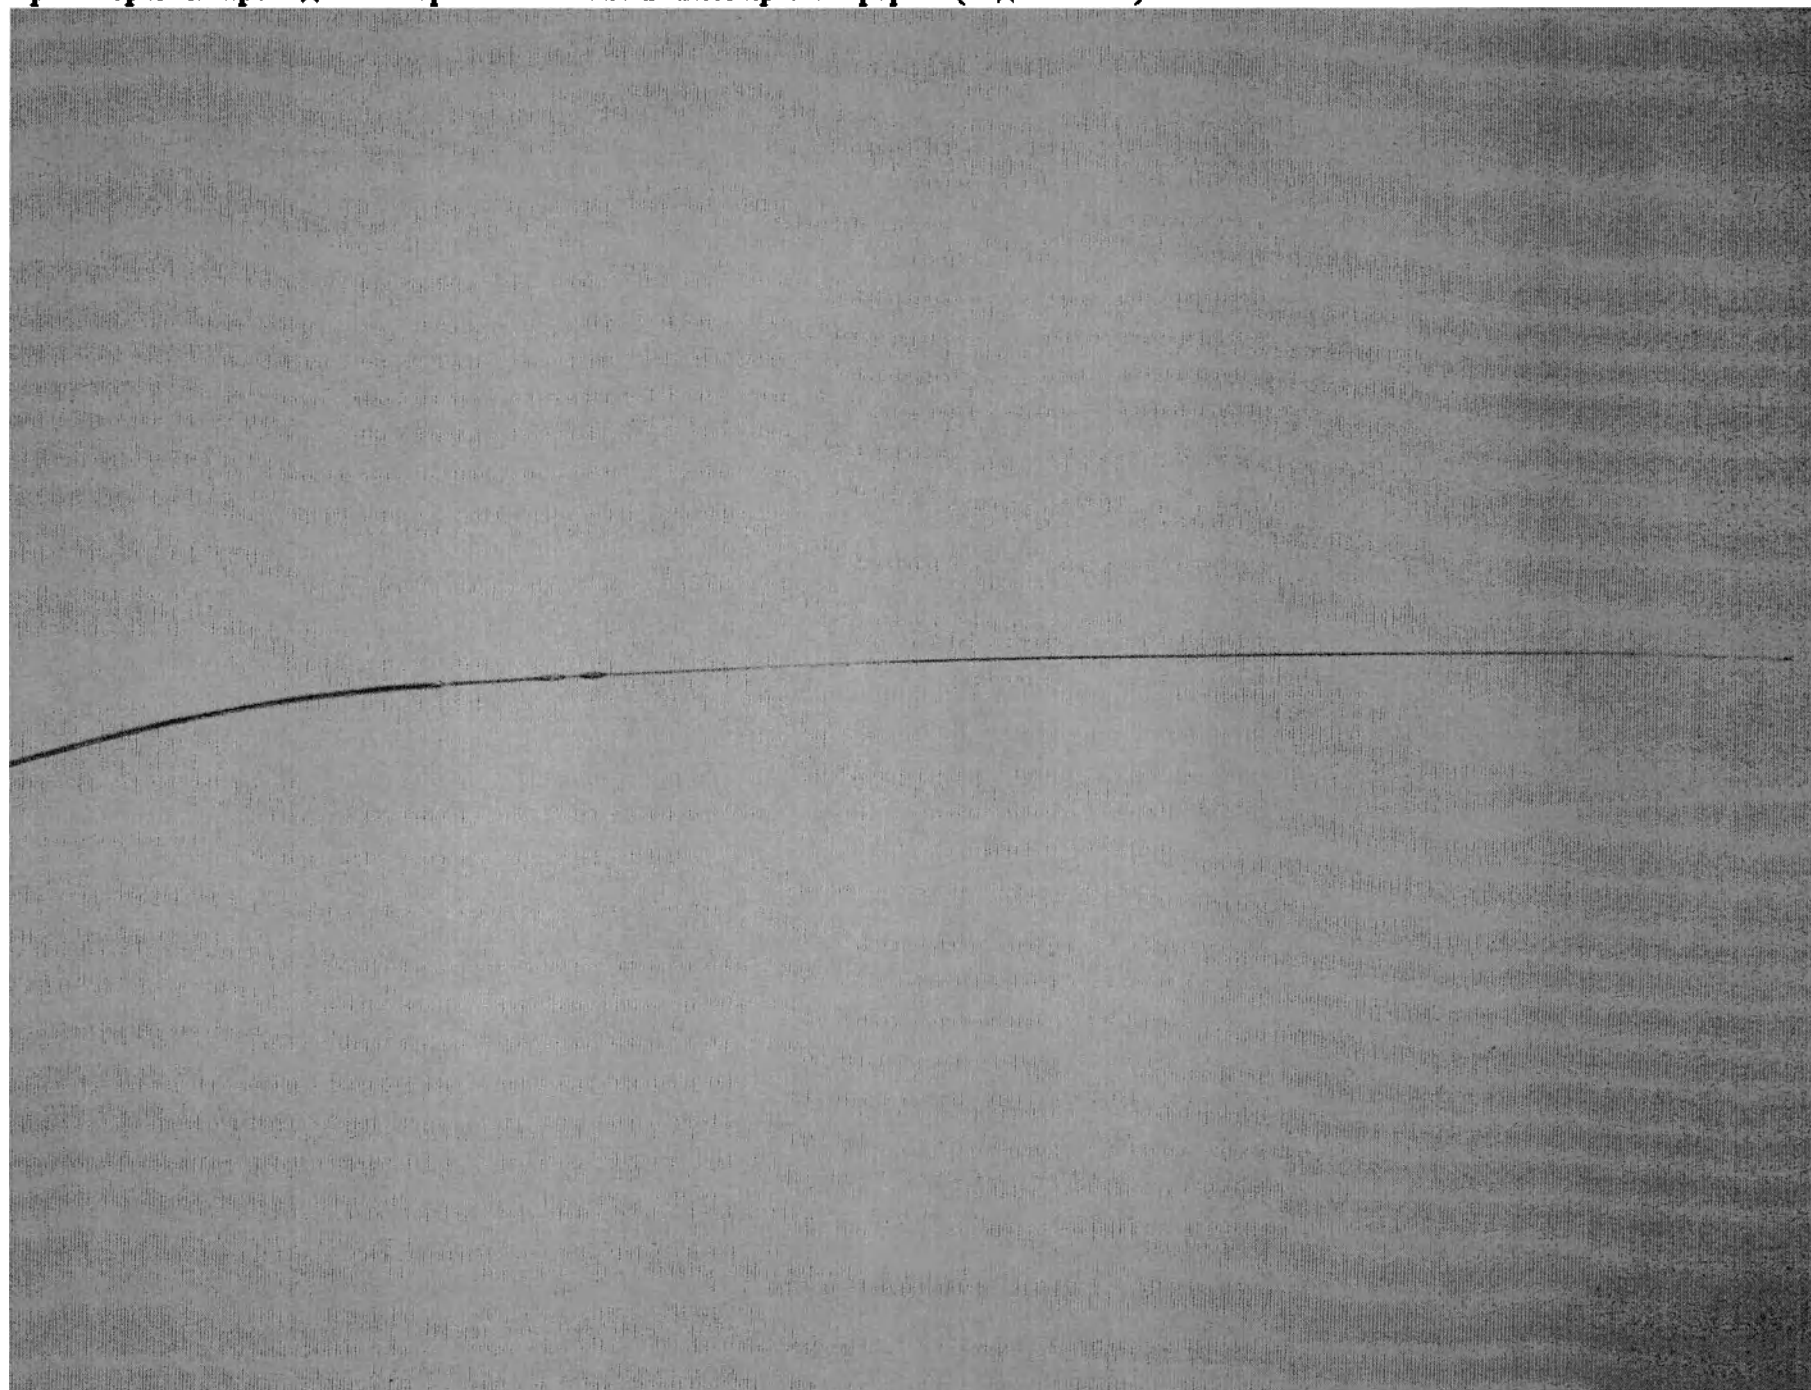

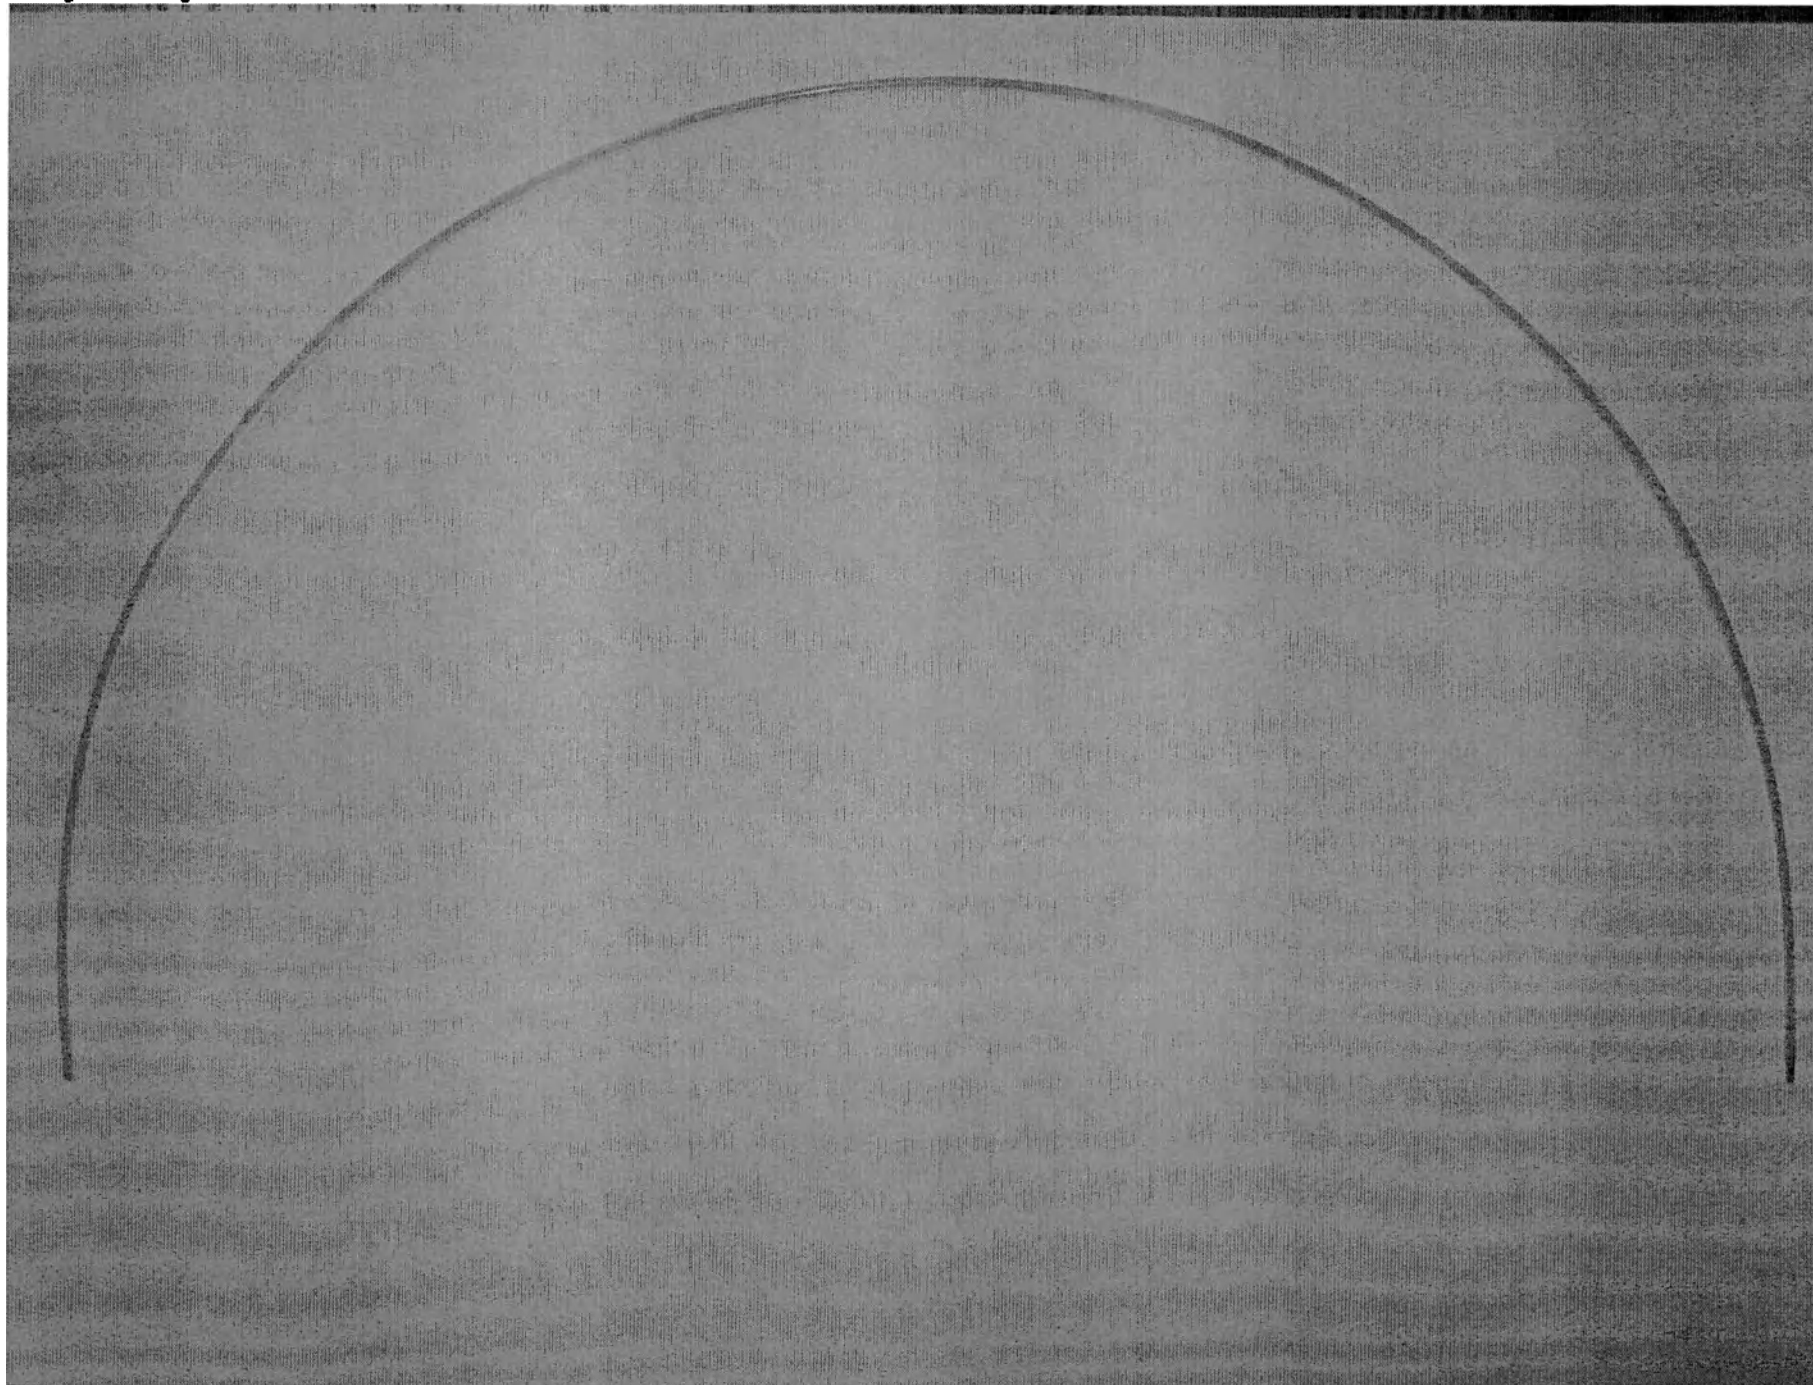


xcandis

Размеры раскрытого изделия
Диаметр 4,2 мм Длина 29 мм

CC-BY-NC-ND 4.0 International
© 2018 Pearson Education, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

xcandis

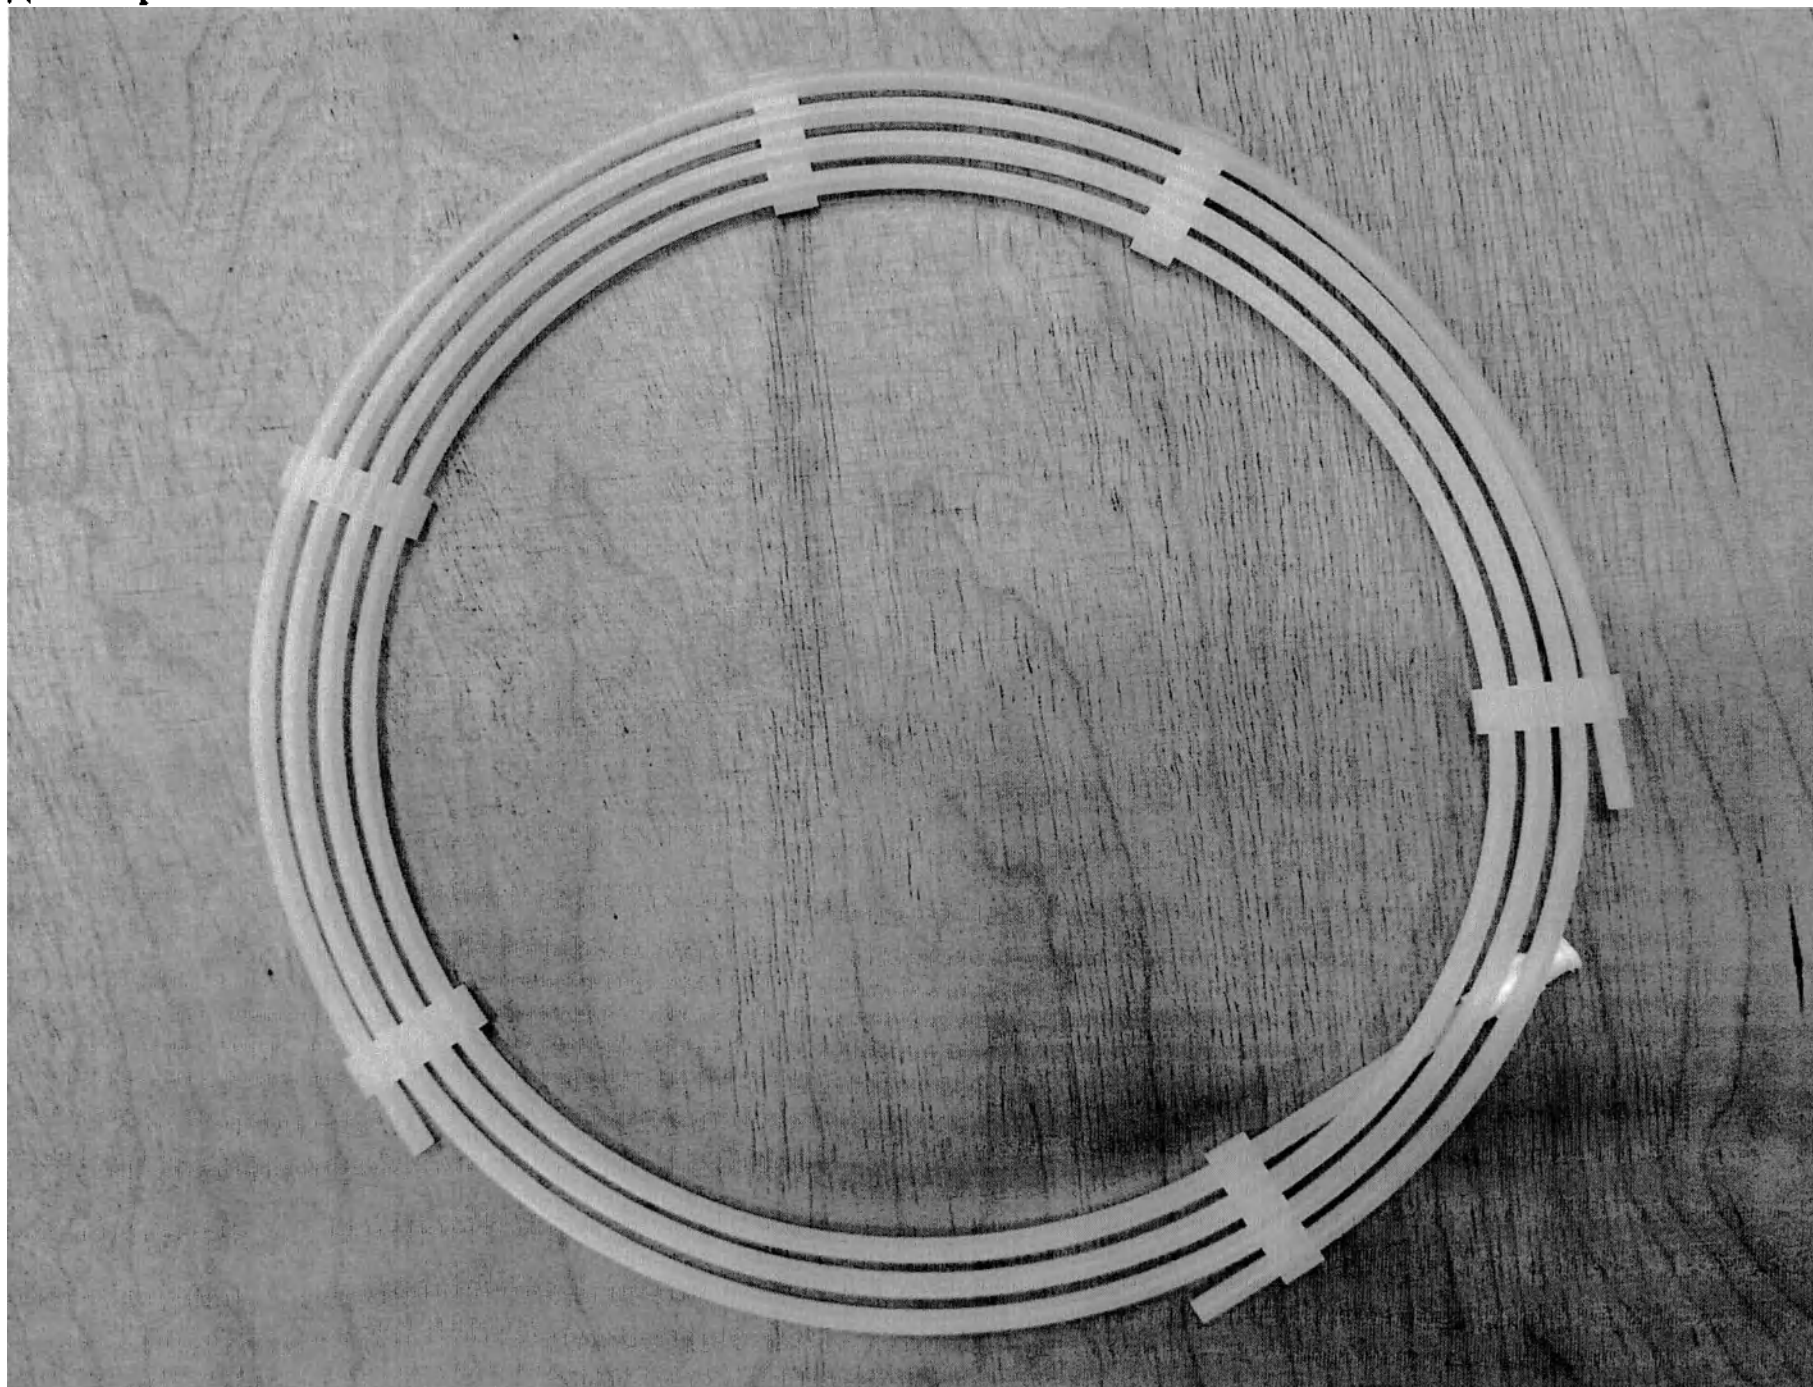

Вторичная упаковка, картонная коробка для Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником

Вторичная упаковка представляет собой складную, белую, картонную коробку. В нее вкладывается инструкция по применению. Место вскрытия на оборотной стороне закрыто белой этикеткой.

CE 0297

«Акандис ГмбХ»
Тулдор «Фарнтер-Штрассе 6»
Пффердахайм (Германия)
Тел. +49 7231 15500-0
www.akandis.com

REF 01-107039
LOT 200722002

Наименование: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником

1. Стент нитиноловый саморасширяющийся, размеры (мм): ____ х ____ - 1 шт.
2. Транспортный проводник с коротким наконечником прямой формы, диаметр: ____ F (____ мм); длина – 2000 мм - 1 шт.
3. Интродьюсер, размеры: ____ F (____ мм) – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Этикетка – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ», Россия

123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд

Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com



Апирогенно.


Нетоксично.

Фотографические изображения всех видов упаковки и маркировки изделия производителя

1. Первичная упаковка - Пакет Тайвек (Tyvek)



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с коротким наконечником
5,5 x 40 мм



acandis

«Акандис ГмбХ»
Теслер-Фармер-Штрассе 6,
75177, Пфорцхайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107052


LOT 201104014

Рекомендуемый диаметр сосуда

От 4,5 мм до 5,5 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

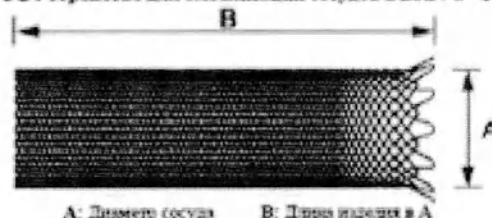

A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в A

Конфигурация транспортного проводника, прямой

A	5,5 мм	5,0 мм	4,5 мм
B	40 мм	60 мм	75 мм

Размер раскрытого изделия
Диаметр: 6,7 мм Длина: 31 мм

Рекомендуемый микрокатетер
для доставки:
NeuroSlider® 27 (DLC)

Требуемый микрокатетер
для доставки:
R1 0,027 дюйма

Рез. D



(01)04260650339493(17)231106(10)201104014

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
5,5 x 40 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ Y561:
(01)04260650339493
REF 01-107052
LOT 201104014

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
5,5 x 40 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ Y561:
(01)04260650339493
REF 01-107052
LOT 201104014

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
5,5 x 40 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ Y561:
(01)04260650339493
REF 01-107052
LOT 201104014



Устройство для эмболизации
сосудов DERIVO® 2
с коротким наконечником
5,5 x 40 мм



Рекомендуемый
микрокатетер
NeuroSlider® 27 (DLC)

LOT

201104014

2023-11-06

acandis

**Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2 6,0 x 25 mm**

acandis
GmbH
Tessdorfer Straße 6,
75177, Eppingen (Германия)
Tel.: +49 7231 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107032 **LOT** 200709043

Рабочий диаметр сосуда От 3,0 mm до 6,0 mm

Составляет:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

A	6,0 mm	6,5 mm	5,0 mm
B	25 mm	37 mm	45 mm

Размер пакуемого изделия
Диаметр: 6,2 mm Длина: 20 mm



A: Длина сосуда B: Длина изделия A

Конфигурация транскатетерного устройства J-форма

Fig. D

Рабочий диаметр катетера
для доставки
NeuroSider® 27 (DLC)
Транскатетерное устройство
RQ 0017 2x6mm

UDI **UD** **STERILE** **2007-07-10**

0110425065033295(17)330730(10)200709043

UDI **UD** **REF** **LOT**

0110425065033295 01-107032 200709043



UDI **UD** **REF** **LOT**

0110425065033295 01-107032 200709043

Устройство для эмболизации
сосудов DERIVO® 2
6,0 x 25 mm

Рабочий диаметр
катетера
NeuroSider® 27 (DLC)

LOT 200709043
2023-07-30



«Академия ГемХ»
Тюдор-Фарнер-Штрассе 6,
75177, Пффердинг (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.acadefix.com

REF 01-107057

LOT 216331011

Рекомендуемый диаметр сосуда

[Or 5.0 mm to 6.0 mm]

Содержание:

1. Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2



А: Диаметр сосуда В: Длина нити в А

Конфигурация транспортного средства: прямой

A	6,0 mm	5,5 mm	5,0 mm
B	40 mm	59 mm	72 mm

Размер: раскрытого изделия
Диаметр: 6,2 мм Длина: 11 см

Рекомендуемый минималитет
для доставки
NeuroSlider® 27 (DLC)

Требуемый микроинтервал
для доставки
ЭП 0,017 дюйма

Page D



STERILE EO 2024-01-06



(01)04150610339547;17;240408;10;21053101



MLD

Verpackungsdichte
maximalste
CO₂-Einsparung
DERIVO® 2
6 kg CO₂-Einsparung
pro Person pro Jahr
6,0 x 40 mm



MD

Устройство для
амбиоплазии
основное
DEPRIVO® 2
с коротким
настроением
д. 0 x 80 мм



MD

Устройство для
защиты от
скачков
DLS-100-2
с корпусом
из нержавеющей
стали 6.0 x 40 мм



ОСНОВНЫЕ УИМ:
(01)0426065033547
REF 01-107057
210331011




ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339547
RRP 01-107057
LOT 210331011



112

OCHO@HbE YMA:
(01)0426065033547
REF 01-107057
210331011



Peromegryson
magnatop
NeuroSlider® 27 (DLC)

LOT

216331021



2024-01-08

αcondis



Устройство для
эMBOLИЗАЦИИ СОСУДОВ
DERIVO® 2 7,0 x 20 mm



сАссемблея ТМБХ
Технолог-4-Фингер Штрассе 6,
75177, Ипперингем (Германия)
Тел. +49 7231 15500-0
www.acandis.com

REF

01-107059

LOT


200803006

Расширяемый диаметр сосуда

От 6,0 mm до 7,0 mm

Составляет:

1 x Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2

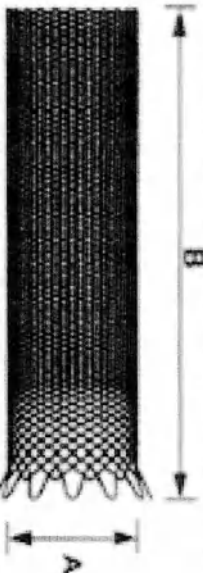

A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в A

Конфигурация расширяемого пространства: J-форма

A	7,0 mm	6,5 mm	6,0 mm
B	20 mm	25 mm	35 mm

Размер расширенного изделия
Диаметр: 7,0 mm Длина: 16 mm

Полное название изделия
для поставки
NeuroBridge® 30
NeuroSlider® 30 D.L.C.
Трёхкомпонентный катетер
для сосудов
EL 0,039 дюйма


Рис. D



STERILE



2023-09-09



(01)0420060339561(1)7230906(1)0200803006

MD	Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2 7,0 x 20 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УПАКОВКИ	REF	01-107059
MD	Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2 7,0 x 20 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УПАКОВКИ	LOT	200803006
MD	Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2 7,0 x 20 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УПАКОВКИ	REF	01-107059
MD	Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2 7,0 x 20 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УПАКОВКИ	LOT	200803006
MD	Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2 7,0 x 20 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УПАКОВКИ	REF	01-107059
MD	Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2 7,0 x 20 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УПАКОВКИ	LOT	200803006



Устройство для эмБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ DERIVO® 2 7,0 x 20 mm



Расширяемый катетер
NeuroBridge® 30
NeuroSlider® 30 D.L.C.



200803006
2023-09-09





Устройство для
эндолимбного сосуда
DERIVO® 2 8,0 x 30 мм



gcandis
«Академ. ТимЪ»
Телуш-4-й этаж, Шлясс 6,
75177, Дортмунд (Германия)
Тел: +49 7231 15500-0
www.gcandis.com

REF

01-107064

LOT

201019011

Рекомендуемый диаметр сосуда

От 7,0 мм до 8,0 мм

Составляет:

1 x Устройство для эндолимбного сосуда DERIVO® 2

А: Диаметр сосуда

В: Длина катетера

A	8,0 мм	7,5 мм	7,0 мм
B	30 мм	41 мм	51 мм

Размер пакуемого изделия
Диаметр: 8,2 мм Длина: 24 мм



А: Диаметр сосуда В: Длина катетера в А

Конфигурация пространственного расположения /-фигуры

Рис. D

Рекомендуемый катетер
для доставки:
NeuroBridge® 30
NeuroSlider® 30 D.L.C
Трехфазный катетер
для доставки:
B1 0.039 Awella

MD

Устройство для
эндолимбного
сосуда
DERIVO® 2
8,0 x 30 мм

MD

Устройство для
эндолимбного
сосуда
DERIVO® 2
8,0 x 30 мм

MD

Устройство для
эндолимбного
сосуда
DERIVO® 2
8,0 x 30 мм

MD

Устройство для
эндолимбного
сосуда
DERIVO® 2
8,0 x 30 мм

MD

Устройство для
эндолимбного
сосуда
DERIVO® 2
8,0 x 30 мм

UDI

ОЧОБЕНЕ УИД:
0110426050333615

REF

01-107064

LOT

201019011

UDI

ОЧОБЕНЕ УИД:
0110426050333615

REF

01-107064

LOT

201019011

UDI

ОЧОБЕНЕ УИД:
0110426050333615

REF

01-107064

LOT

201019011



(0110426050333615)(17231022)(10)201019011



STERILE

2023-10-22



Устройство для эндолимбного
сосуда DERIVO® 2
8,0 x 30 мм



Рекомендуемый катетер
NeuroBridge® 30
NeuroSlider® 30 D.L.C

LOT

201019011

REF

2023-10-22



 Устройство для
мобилизации сосуда
DERIVO® 2
с корпоративным покрытием
8,0 x 50 mm

 **acandis**
Акционерное общество
Теоретический отдел
75177, Екатеринбург (Россия)
Тел: +49 7291 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107074 LOT 201028006

Персональный номер сосуда От 7,0 mm до 8,0 mm

Составляет:

1 x Устройство для мобилизации сосуда DERIVO® 2

	A	8,0 mm	7,5 mm	7,0 mm
B	50 mm	70 mm	35 mm	

Размеры упаковочного материала
Диаметр 8,2 mm Длина 38 mm

А: Диаметр сосуда

В: Длина изделия в А

Конфигурация протекторного покрытия: рифленый

Рис. D



STERILE

2023-10-19

2023-10-19

Устройство для мобилизации
сосуда DERIVO® 2
с корпоративным покрытием
8,0 x 50 mm

Персональный
номер
NeuroBridge® 39
NeuroSlide® 39 DLC

LOT 201028006
2023-10-19

 acandis

MD Устройство для
мобилизации
сосуда
DERIVO® 2
с корпоративным
покрытием
8,0 x 50 mm
UD CHODRAE Y94E
010426060333714
REF 01-107074
LOT 201028006

MD Устройство для
мобилизации
сосуда
DERIVO® 2
с корпоративным
покрытием
8,0 x 50 mm
UD CHODRAE Y94E
010426060333714
REF 01-107074
LOT 201028006

MD Устройство для
мобилизации
сосуда
DERIVO® 2
с корпоративным
покрытием
8,0 x 50 mm
UD CHODRAE Y94E
010426060333714
REF 01-107074
LOT 201028006



q̄candis

CE 0297

LOT 210511020

Of 13, you 35

1. Устройством для возбуждения сечения ДНК О³ :1. Устройством для возбуждения сечения ДНК О³ :

Fig. 2

UDC 621.372.6.01
01-10-2001
210511020

U.S. v. 100,000

OCHEMIE Y&S
(01)04262650 333884
01-107001
210511020

2.5 x 10⁶ mm²
 2.5 x 10⁶ mm²
 2.5 x 10⁶ mm²
 2.5 x 10⁶ mm²

Deutscher Musikverlag
Münchener Platz
Neuro-Slider® 17 DLC

25 LOT 2105110209 2021-04-13

acandis


Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm

gacandis®
«Аксоник ГмбХ»
Тельер-Франс-Штрассе 6,
75177, Гиресхайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.gacandis.com

REF 01-107013 **LOT** 200528001

Рекомендуемый диаметр сосуда От 2,5 мм до 3,5 мм

Содержание:
1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

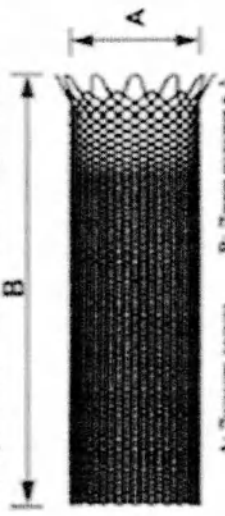

А: Диаметр сосуда В: Длина изделия в А

Конфигурация транскатетерного проволочного J-формы

Pen D

А	3,5 mm	3,0 mm	2,5 mm
В	30 mm	45 mm	60 mm

Размеры расширенного изделия
Диаметр: 3,7 mm Длина: 22 mm

Рекомендуемый мониторатор для доставки
NeuroSlider® 27 (DLC)

Требуемый мониторатор для доставки
RL 0,017 200mm

MO Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm

MO Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm

MO Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm

STERILIZED 2023-06-25

Barcode (01)0426050339103 (17)250528001200528001

UDR OCH-OB-HE YMA (01)0426050339103 REF 01-107013 LOT 200528001

UDR OCH-OB-HE YMA (01)0426050339103 REF 01-107013 LOT 200528001

UDR OCH-OB-HE YMA (01)0426050339103 REF 01-107013 LOT 200528001

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm

Рекомендуемый мониторатор NeuroSlider® 27 (DLC)

LOT 200528001 2023-06-25

gacandis®

Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с кордовым наконечником
4,0 x 40 мм

acandis
AG
Адрес: ТМКО
Техно-4-й этаж, Штрассе 6,
75177, Тюринген (Германия)
Тел: +49 7231 15500-0
www.acandis.com



REF 01.107039 LOT 200722002

Разомкнутый диаметр сосуда

От 3,0 мм до 4,0 мм

Составные:

1. Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

В

A	4,0 мм	3,5 мм	3,0 мм
B	40 мм	60 мм	75 мм

Размеры раскрытого вилочка
Диаметр 4,2 мм Длина 28 мм



A: Диаметр сосуда B: Длина вилочка в A

Конструкция приспособления предназначена

Fig. D

Расомкнутый вилочек
для системы
NeuroSlider® 27 (DLG)
Трибуналь вилочек
для системы
NI 6.07 Jumbo



(01)04250670394501722002200722002

MO
Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с кордовым
наконечником
4,0 x 40 мм
UOC
ОСНОВНЫЕ УММ
01.04250670394501722002
REF
01-107039
LOT
200722002

MO
Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с кордовым
наконечником
4,0 x 40 мм
UOC
ОСНОВНЫЕ УММ
01.04250670394501722002
REF
01-107039
LOT
200722002

Устройство для эмболизации
сосудов DERIVO® 2
с кордовым наконечником
4,0 x 40 мм



Расомкнутый
вилочек
NeuroSlider® 27 (DLG)

LOT 200722002
2013-07-30

acandis



Устройство для
эмболизации сосуда
DERIVO® 2 4,5 x 20 mm




acandis
— KARDIUM TONIX —
Томск-4 (г. Томск, Шиповск б.
75177, Россия) (Т. Россия)
Тел: +49 7221 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107019 LOT 210209010

Размерный диаметр сосуда От 3,5 mm до 4,5 mm

Составные:

1 x Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2

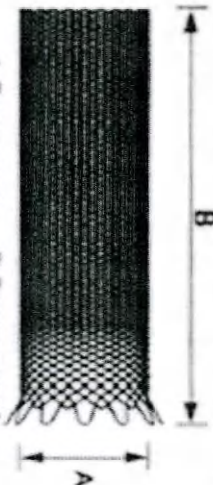

A - Длина сосуда B - Длина фильтра в A
Конфигурация расширительного элемента 1-го поколения

	A	4,5 mm	4,0 mm	3,5 mm
B	20 mm	21 mm	19 mm	


Размер расширительного элемента
Диаметр: 4,7 mm Длина: 18 mm

Размещенный монитор
для контроля
Navi o'Side® 27 (DLG)
Технический мониторинг
для контроля
ELI 0,027 Jumbo

Fig. D



STERILE 2014-02-11



MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	UDI	OOCH094-E Y554 10104262650339165
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	REF	01-107019
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	LOT	210209010
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	UDI	OOCH094-E Y554 10104262650339165
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	REF	01-107019
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	LOT	210209010
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	UDI	OOCH094-E Y554 10104262650339165
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	REF	01-107019
MO	Устройство для эмболизации сосуда DERIVO® 2 4,5 x 20 mm	LOT	210209010

Устройство для эмболизации
сосуда DERIVO® 2
4,5 x 20 mm



Размещенный
монитор
Navi o'Side® 27 (DLG)
LOT 210223022
2014-02-11



Устройство для
заблуждения сосуда
DERIVO® 2
с коротким наконечником
4,5 x 40 мм

acandis
с/а-хемис ГмбХ
Тельер-Фурнур Штраусс &
75177, Рюппельсбах (Германия)
Тел: +49 7231 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107043 **LOT** 200716012

Расширительный диаметр сосуда

От 3,5 мм до 4,5 мм

Составные:

1 x Устройство для заблуждения сосуда DERIVO® 2

A	4,5 мм	4,0 мм	3,5 мм
B	40 мм	41 мм	77 мм

Размер расширенного участка
Диаметр 4,7 мм Длина 29 мм



A: Длина конуса B: Длина изделия A

Конфигурация транскатетерного устройства: прямая

Рис. D

MO Устройство для заблуждения сосуда DERIVO® 2 с коротким наконечником 4,5 x 40 мм
UDI 011042605033400
REF 01-107043
LOT 200716012

MO Устройство для заблуждения сосуда DERIVO® 2 с коротким наконечником 4,5 x 40 мм
UDI 011042605033400
REF 01-107043
LOT 200716012

MO Устройство для заблуждения сосуда DERIVO® 2 с коротким наконечником 4,5 x 40 мм
UDI 011042605033400
REF 01-107043
LOT 200716012



0110426050334001752507309100200716012



Устройство для заблуждения
сосуда DERIVO® 2
с коротким наконечником
4,5 x 40 мм



Расширительный
матрикс
NeoStader® 27 (DE C)

LOT 200716012
2012-07-30

acandis



Устройство для
мобилизации сосудов
DERIVO® 2 5,0 x 20 мм



«Аксоник Трейд»
Телавор-Фармпр. Ул.Ильича 6,
75177, Республика (Г.Самара)
Тел.: +48 723 11500-0
www.acandis.com

REF 01-107023 LOT 210506022

Разовый диаметр сосуда От 4,0 мм до 5,0 мм

Составляет:

1 x Устройство для мобилизации сосудов DERIVO® 2

И x Устройство для мобилизации сосудов DERIVO® 2

	A	5,0 мм	4,5 мм	4,0 мм
B	10 мм	20 мм	37 мм	



A: Диаметр сосуда B: Длина изделия A

Конфигурация после движения приспособления: f-форма

Размерны расширителя
Диаметр: 6,2 мм Длина: 16 мм

Производитель: компания
«Аксоник Трейд»
Телавор-Фармпр. Ул.Ильича 6,
75177, Республика (Г.Самара)
Тел.: +48 723 11500-0
www.acandis.com

Page D



2024-06-10



WO Устройство для мобилизации сосудов DERIVO® 2 5,0 x 20 мм
UDI 010425050338202 REF 01-107023 LOT 210506022

WO Устройство для мобилизации сосудов DERIVO® 2 5,0 x 20 мм
UDI 010425050338202 REF 01-107023 LOT 210506022

WO Устройство для мобилизации сосудов DERIVO® 2 5,0 x 20 мм
UDI 010425050338202 REF 01-107023 LOT 210506022



Устройство для мобилизации
сосудов DERIVO® 2
5,0 x 20 мм



Производитель
компания
«Аксоник Трейд»
Телавор-Фармпр. Ул.Ильича 6,
75177, Республика (Г.Самара)
Тел.: +48 723 11500-0
www.acandis.com



210506022
2024-06-10



**Устройство для
заболеваний сосуда
DERIVO® 2**
с пористой мембраной
5,0 x 40 мм

acandis
«Акандис Тевис»
Тел.: +49 7231 1500-6
75171, Пфальцвайм (Германия)
Tel.: +49 7231 1500-0
www.acandis.com

REF 01.107047 LOT 210312010


Размерный диаметр сосуда От 4,0 мм до 5,0 мм

Составные:

1 x Устройство для забора крови DERIVO® 2

A	5,0 мм	4,5 мм	4,0 мм
B	40 мм	61 мм	75 мм


Размер расширенного элемента
Диаметр 6,3 мм Длина 30 мм

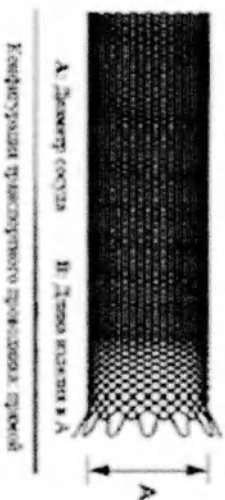


A Диаметр сосуда B Длина элемента
Конструкция пористой мембраны

Разомкнутый мембранный
элемент
NewObder® 27 (DLC)
Трехконтурный мембранный
элемент
R1 0.07 Amide

PIN ID



2014-03-15



(01)042004-00130448(17)2+031543 0010312010

MO Устройство для забора крови DERIVO® 2 с расширенным элементом 5,0 x 40 мм
UDI OCHOB-E 1946 0104200400130448 REF 01.107047 LOT 210312010

MO Устройство для забора крови DERIVO® 2 с расширенным элементом 5,0 x 40 мм
UDI OCHOB-E 1946 0104200400130448 REF 01.107047 LOT 210312010

MO Устройство для забора крови DERIVO® 2 с расширенным элементом 5,0 x 40 мм
UDI OCHOB-E 1946 0104200400130448 REF 01.107047 LOT 210312010

Устройство для забора крови
DERIVO® 2
с пористой мембраной
5,0 x 40 мм



Разомкнутый мембранный элемент
NewObder® 27 (DLC)

LOT 210312010
2014-03-15


acandis



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2 5,5 x 25 mm



«Аксоник Твекс»
Телюв-4 кутер-Штрассе 6,
79177, Еппингхайм (Германия)
Тел.: +49 7331 15500-0
www.axonik.com




REF 01.107028 LOT 201117036

Размерный диаметр сосуда От 4,5 mm до 5,5 mm

Составное:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

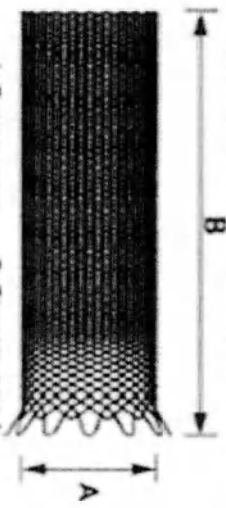

A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в А

Конфигурация привязанного устройства J-формы

A	5,5 mm	6,0 mm	4,5 mm
B	25 mm	37 mm	40 mm

Размеряя привязанного изделия
Диаметр: 5,7 mm Длина: 20 mm

Производительное наименование
для маркировки
NeuroSlider® 27 (DLC)
Телефонный код производителя
для маркировки
HLL 0,017 J-формы

Рис. D

(01)0426060339257(1)7231120610201117036

MO

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 5,5 x 25 mm

MO

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 5,5 x 25 mm

MO

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 5,5 x 25 mm

UO

OCHOBLE Y44

010426060339257

REF

01.107028

LOT

201117036

UO

OCHOBLE Y44

010426060339257

REF

01.107028

LOT

201117036

UO

OCHOBLE Y44

010426060339257

REF

01.107028

LOT

201117036

Устройство для эмболизации
сосудов DERIVO® 2
5,5 x 25 mm



Производительное
наименование
NeuroSlider® 27 (DLC)



201117036
2023-11-30



2. Вторичная упаковка – Картонная коробка белого цвета



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с короткими ниточечником
2,5 x 10 мм



«Аксонид» ГмбХ
Текстор-Финтер Штрассе 6,
75177, Пфорцхайм (Г.ФРГ)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.axonid.com

REF 01-107001

LOT 210511020

Рекомендуемый диаметр сосуда

От 1,5 мм до 2,5 мм

Составляющее:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

A	2,5 мм	2,0 мм	1,5 мм
B	10 мм	16 мм	19 мм

Размеры раскрытого ниточечника
Диаметр 2,7 мм Длина 8 мм



A: Диаметр сосуда B: Длина ниточечника в А

Конфигурация стандартного проводника прямой

Реконструктивный микрокатетер

для доступа

NeuroSlider® 1" DLS

Трехручный микрокатетер

для доступа

B1 0,0165 0,017 дюйма

Раз D

MD Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
ниточечником
2,5 x 10 мм



UDI ОЧИСЛИТЕ УМК
(01)04260650338984
REF 01-107001
LOT 210511020

MD Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
ниточечником
2,5 x 10 мм



UDI ОЧИСЛИТЕ УМК
(01)04260650338984
REF 01-107001
LOT 210511020

MD Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
ниточечником
2,5 x 10 мм



UDI ОЧИСЛИТЕ УМК
(01)04260650338984
REF 01-107001
LOT 210511020



(01)04260650338984(17)240512X101210511020



STERILE

2024-06-12



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2 3,5 x 30 mm



acandis
a/k/a/kas: GmbH
Теледор-Фармер-Штрассе 6,
75177, Иффордхайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107013

LOT 200528001

Раскомбинированный диаметр сосуда


От 2,5 mm до 3,5 mm

Сопоставление:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

	A	3,5 mm	3,0 mm	2,5 mm
B	30 mm	48 mm	60 mm	

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 1,1 mm Длина: 22 mm

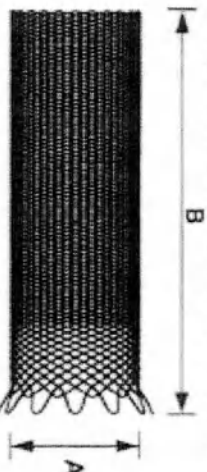

A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в A

Конфигурация трапециевидного проволочного каркаса

Раскомбинированный микрокатетер

для доставки


NeuroSlider® 17 (DLC)

Травматический микрокатетер


для доставки

BI 0,077 mm/0,03 mm

Ред. D




(01)04260650339103(17)305280(10)200528001



2013-07-23

MO	Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УИИ
REF	01-107013	REF	01-107013
LOT	200528001	LOT	200528001
MO	Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УИИ
REF	01-107013	REF	01-107013
LOT	200528001	LOT	200528001
MO	Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 3,5 x 30 mm	UDI	ОСНОВНЫЕ УИИ
REF	01-107013	REF	01-107013
LOT	200528001	LOT	200528001



«Академик ТМО»
Телефон: +7 495 931 11 00
75177, Подольск (Территория)
Тел.: +49 7231 1500-0
www.aacadin.com




210223022

OT 3.0 MM TO 4.0 MM

Copyright:

ИХЪ СЪПРОТИВО ДЪА ЗАБОЛЪВАЩИ СЪСЪЗВОДЪ ДЕРИВО?

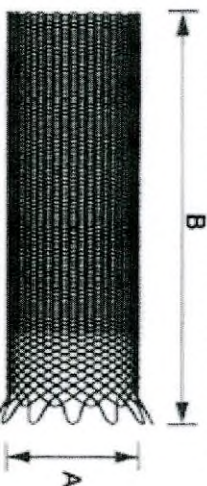

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness and health-related quality of life (HRQL) of elderly people. The study was conducted in a community center in a city in the north of Iran. The study population consisted of 30 elderly people (15 men and 15 women) aged 65-75 years. The study was a randomized controlled trial. The control group received no intervention, and the intervention group received a 12-week training program. The training program consisted of aerobic, strength, and flexibility exercises. The physical fitness and HRQL were measured at the beginning and end of the study. The results showed that the intervention group had significant improvements in physical fitness and HRQL compared to the control group. The findings of this study suggest that a 12-week training program can improve the physical fitness and HRQL of elderly people.

Значительная транзитная торговля. В 1969 г.

Flowmeters and multiphotors
for doctors:
NeuroSlider® 27 (DLC)

NeuroSlider® 27 (DLC)

Трёхомный мультипликатор

NOT NOTED:
BI 0,027 and 0.028

1543



STERILE EO



2024-02-28



(01) 94260650399110(17)240225(10) 210223022



MD	UCI	OCHOBHIE YML
Устройство для		(010)4-606060339110
автоматизации	REF	01-107014
серии VO-2	LOT	210223022
4,0 x 15 мм		
MD	UCI	OCHOBHIE YML
Устройство для		(010)4-606060339110
автоматизации	REF	01-107014
серии VO-2	LOT	210223022
4,0 x 15 мм		
MD	UCI	OCHOBHIE YML
Устройство для		(010)4-606060339110
автоматизации	REF	01-107014
серии VO-2	LOT	210223022
4,0 x 15 мм		



OCHOBHBE YNA:
(01)04260850339110
REF 01-107014
LOT 210223022



ОЧОБНННННННННН
(01)04260650339110
REF 01-107014
LOT 210223022



OCHOBHBE YMH
01704260650339110
REF 01-107014
LOT 210223022



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2 4,5 x 20 мм



xcandis®

«Аксандис ГмбХ»
Теодор-Фарнер-Штрассе 6,
75177, Пфорштайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.xcandis.com

REF 01-107019


LOT 210209010

Рекомендуемый диаметр сосуда

От 3,5 мм до 4,5 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

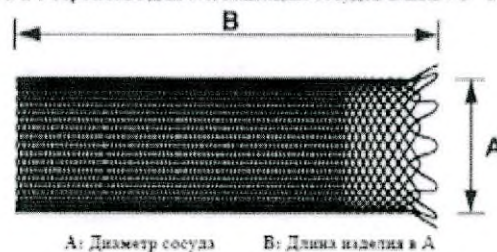

A: Диаметр сосуда

B: Длина изделия в A

Конфигурация транспортного проводника: J-форма

A	4,5 мм	4,0 мм	3,5 мм
B	20 мм	31 мм	39 мм

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 4,7 мм Длина: 15 мм

Рекомендуемый микрокатетер
для доставки
NeuroSlider® 27 (DLC)

Требуемый микрокатетер
для доставки
B.I 0,01" дюйма

Ред D



STERILE EO



2024-02-11



(01)04260650339165(17)240211(10) 210209010

xcandis

xcandis

xcandis

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
4,5 x 20 мм

UDI



ОСНОВНЫЕ УИИ:

(01)04260650339165

REF 01-107019

LOT 210209010

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
4,5 x 20 мм

UDI



ОСНОВНЫЕ УИИ:

(01)04260650339165

REF 01-107019

LOT 210209010

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
4,5 x 20 мм

UDI



ОСНОВНЫЕ УИИ:

(01)04260650339165

REF 01-107019

LOT 210209010

Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с коротким наконечником
4,0 x 40 мм


acandis
«Аксандис Твек»
Теодор-Фармер-Штрассе 6,
75177, Лёффоршайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107039 **LOT** 200722002

Рекомендуемый диаметр сосуда От 3,0 мм до 4,0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

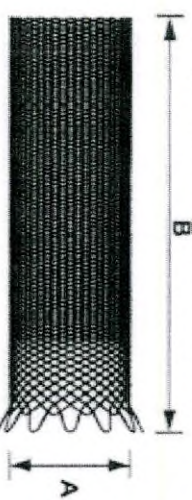

A: Диаметр сосуда B: Длина вставки в A

Конфигурация транспортного проводника: прямой

	A	4,0 mm	3,5 mm	3,0 mm
B	40 mm	63 mm	78 mm	

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 4,2 мм Длина: 29 мм

Рекомендуемый микрокатетер
для доставки:
NeuroSlider® 2* (DLC)
Требуемый микрокатетер
для доставки:
BA 0,027 дюйма

Рис D

STERILE

2011-07-30

(0104260650339365)(17230730610)200722002

MD (0104260650339365) Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником 4,0 x 40 мм

UDI (0104260650339365) (01-107039) (LOT) 200722002

REF (01-107039) (LOT) 200722002

MD (0104260650339365) Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником 4,0 x 40 мм

UDI (0104260650339365) (01-107039) (LOT) 200722002

REF (01-107039) (LOT) 200722002

MD (0104260650339365) Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником 4,0 x 40 мм

UDI (0104260650339365) (01-107039) (LOT) 200722002

REF (01-107039) (LOT) 200722002

**Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2 5,0 x 20 мм**

acandis
"Акандис ГмбХ"
Изолю-Фарм-Штрассе 6,
75177, Фюртхайд (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.acandis.com

CE 0287

REF 01-107023 LOT 210506022

Рекомендуемый диаметр сосуда От 4,0 мм до 5,0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

A	5,0 mm	4,5 mm	4,0 mm
B	20 mm	30 mm	37 mm

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 5,2 mm Длина: 15 mm



A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в А

Конфигурация транспортного проводника: J-форма

Рабочий диаметр микрокатетера

для доставки

NeuroSlider® 27 (DLC)

Требуются микрокатетер

для доставки

BI 0,027 дюйма

Рез D

UDI

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 5,0 x 20 мм

ОСНОВНЫЕ УИИ

REF 01-107023

LOT 210506022

UDI

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 5,0 x 20 мм

ОСНОВНЫЕ УИИ

REF 01-107023

LOT 210506022

UDI

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 5,0 x 20 мм

ОСНОВНЫЕ УИИ

REF 01-107023

LOT 210506022

UDI

Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 5,0 x 20 мм

ОСНОВНЫЕ УИИ

REF 01-107023

LOT 210506022

STERILEEO

20-4-05-10



(01)04260650339202(17)240510(30)210506022

84

Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с коротким наконечником
5,0 x 40 мм



acandis
«Акандис ГмбХ»
Готтор-Фарнер-Штрассе 6,
75177, Тübingen (Германия)
Тел.: +49 7531 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107047 **LOT** 210312010


Рекомендуемый диаметр сосуда От 4,0 мм до 5,0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

	A	4,0 mm	4,5 mm	4,0 mm
B	40 mm	61 mm	72 mm	

Размеры раскрытого плетения
Диаметр 6,2 мм Длина 30 мм

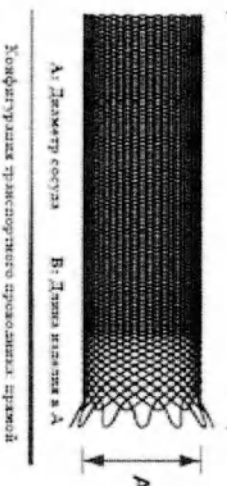

A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в А

Конфигурация практического применения: прямой

Рекомендуемый микроклаттер
для доставки
NeuroSlider® 27 (DLC)
Трёхмерный микроклаттер
для доставки
B1 0,027 дюйма

Рис D

 MD Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником 5,0 x 40 мм	 UDI ОЧИСЛЕНИЕ УММ (01)04260650339446 REF 01-107047 LOT 210312010
 MD Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником 5,0 x 40 мм	 UDI ОЧИСЛЕНИЕ УММ (01)04260650339446 REF 01-107047 LOT 210312010
 MD Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником 5,0 x 40 мм	 UDI ОЧИСЛЕНИЕ УММ (01)04260650339446 REF 01-107047 LOT 210312010

**Устройство для
обобщения сосудов
DERIVO® 2 5,5 x 25 мм**

acandis
«Аксандис Текс»
Телавив-Финтер-Штрассе 6,
75117, Илдорфшлаг (Германия)
Тел. +49 7231 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107028 **LOT** 201117036

Рекомендуемый диаметр сосуда От 4,5 мм до 5,5 мм

Содержимое:

1 x Устройство для обобщения сосудов DERIVO® 2

A	5,5 мм	5,0 мм	4,5 мм
B	25 мм	37 мм	46 мм

Размер подходящего изделия
Диаметр 5,5 мм Длина 20 мм



A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в A

Конфигурация радиального протеза J-форма

Результативный материал
для доставки
NeuroShield® 2 (DLC)
Требуемый маркер
для доставки
B1 0,07 дюйма

Per D



STERILE 2023.11.20



(01)04260650339257(17)201117036(10)201117036

MD Устройство для обобщения сосудов DERIVO® 2 5,5 x 25 мм	UDI ОСНОВНЫЕ УИИ REF (01)04260650339257 01-107028 LOT 201117036
MD Устройство для обобщения сосудов DERIVO® 2 5,5 x 25 мм	UDI ОСНОВНЫЕ УИИ REF (01)04260650339257 01-107028 LOT 201117036
MD Устройство для обобщения сосудов DERIVO® 2 5,5 x 25 мм	UDI ОСНОВНЫЕ УИИ REF (01)04260650339257 01-107028 LOT 201117036

Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с коротким наконечником
5,5 x 40 мм


acandis
«Аксандис ГмбХ»
Тоссер-Фриер-Штрассе 6,
75177, Иффордхам (Германия)
Тел. +49 7251 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107052 LOT 201104014

Рекомендуемый диаметр сосуда От 4,5 мм до 5,5 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

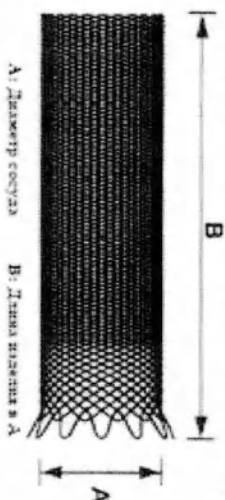

Конфигурация транспортного предохранителя закрыта

A	6,5 mm	8,0 mm	4,8 mm
B	40 mm	60 mm	73 mm

Размеры раскрытого изделия
Диаметр 6,7 мм Длина 31 мм

Рекомендуемый микрокатетер
для доставки
NeuroSider® 27 (DC)
Требуемый микрокатетер
для доставки
ВЛ 0,027 дюйма

Рег. D

STERILE 2023-11-06

(01)04260650339493(17231106(10)201104014

MD Устройство для эмболизации с коротким наконечником 5,5 x 40 мм

UDI (01)04260650339493 REF 01-107052 LOT 201104014

MD Устройство для эмболизации с коротким наконечником 5,5 x 40 мм

UDI (01)04260650339493 REF 01-107052 LOT 201104014

MD Устройство для эмболизации с коротким наконечником 5,5 x 40 мм

UDI (01)04260650339493 REF 01-107052 LOT 201104014

MD Устройство для эмболизации с коротким наконечником 5,5 x 40 мм

UDI (01)04260650339493 REF 01-107052 LOT 201104014



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2 6,0 x 25 мм



acandis
«Аксандис ТМН»
Телеграф-Фармер-Штрассе 6,
75177, Пфорцхайм (Г. Фрэнкх)
Тел. +49 7131 15500-0
www.acandis.com

REF 01-107032 LOT 200709043

Раскладываемый диаметр сосуда

От 5,0 мм до 6,0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

В



А: Диаметр сосуда В: Длина изделия в А

Конфигурация трапециевидного проводника J-форма

A	6,0 мм	5,5 мм	5,0 мм
B	25 мм	37 мм	45 мм

Размеры раскрытого изделия
Диаметр 6,2 мм Длина 20 мм

Раскладываемый микрокатетер
для доставки
NeuroSlider® 27 (ДСС)
Требуемый микрокатетер
для доставки
R1 0,07 дюйма

Ref D



2023-07-30



(01)04260650139295(17)230730(10)200709043

MD	Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 6,0 x 25 мм	UDI	ОСНОВНЫЕ УИИ (01)04260650139295	REF	01-107032	LOT	200709043
MD	Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 6,0 x 25 мм	UDI	ОСНОВНЫЕ УИИ (01)04260650139295	REF	01-107032	LOT	200709043
MD	Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 6,0 x 25 мм	UDI	ОСНОВНЫЕ УИИ (01)04260650139295	REF	01-107032	LOT	200709043

xcandis



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с коротким наконечником
6,0 x 40 мм

xcandis

«Аксандис ГмбХ»
Тейлор-Фармер-Штрассе 6,
75177, Пфорцхайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.xcandis.com

CE 0297

REF 01-107057 LOT 210331011

Рекомендуемый диаметр сосуда От 5,0 мм до 6,0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2



Конфигурация транспортного проводника: прямой

A	6,0 мм	5,5 мм	5,0 мм
B	40 мм	59 мм	72 мм

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 6,2 мм Длина: 31 мм

Рекомендуемый микрокатетер
для доставки:
NeuroSlider® 27 (DLC)

Требуемый микрокатетер
для доставки:
В.И 0,017 дюйма

Рез. D



STERILE EO 2024-04-06



(01)04260650339547(17)240406(10)210331011

MD
Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
6,0 x 40 мм

UDI
ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339547
REF 01-107057
LOT 210331011

MD
Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
6,0 x 40 мм

UDI
ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339547
REF 01-107057
LOT 210331011

MD
Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
6,0 x 40 мм

UDI
ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339547
REF 01-107057
LOT 210331011



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2 7,0 x 20 мм



xcandis®

«Аксидис ГмбХ»
Теодор-Фарнер-Штрассе 6,
75177, Перфшайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.xcandis.com

REF 01-107059

LOT 200803006

Рекомендуемый диаметр сосуда

От 6,0 мм до 7,0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2



A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в A

Конфигурация транспортного проводника: J-форма

A	7,0 мм	6,5 мм	6,0 мм
B	20 мм	18 мм	16 мм

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 7,2 мм Длина: 16 мм

Рекомендуемый катетер
для доставки:
NeuroBridge® 39
NeuroSlider® 39 DLC

Требуемый катетер
для доставки:
ВД 0,039 дюйма

Рез. D



STERILE EO

2023-09-09



(01)04260650339561(17)230909(10)200803006

xcandis

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
7,0 x 20 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339561
REF 01-107059
LOT 200803006

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
7,0 x 20 мм

UDI



ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339561
REF 01-107059
LOT 200803006

MD


Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
7,0 x 20 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339561
REF 01-107059
LOT 200803006



«Академические ГМБХ»
Теодор-Фарнер-Штрассе 6,
75177, Пфорцхайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.acandis.com



REF 01-107064


LOT 201019011

Рекомендуемый диаметр сосуда

От 7.0 мм до 8.0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

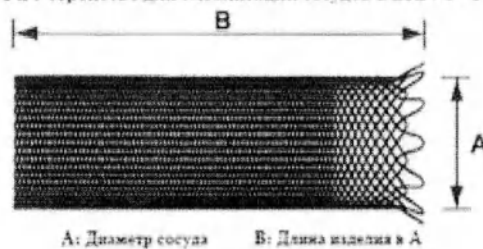

А: Диаметр сосуда В: Длина изделия в А

Конфигурация транспортного проводника: J-форма

A	8,0 mm	7,5 mm	7,0 mm
B	30 mm	42 mm	51 mm

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 8,2 мм Длина: 24 мм

Рекомендуемый катетер
для доставки:
NeuroBridge® 39
NeuroSlider® 39 DLC

Требуемый катетер
для доставки
ВЛ 0,039 дюйма

Res. D



STERILE EO 2023-10-22



(01)04260650339615(17)231022(10)201019011



Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
8,0 x 30 мм



ОСНОВНЫЕ УИМ:
(01)04260650339615
[REP] 01-107064
[LOT] 201019011



Устройство для
амблитизации
содержит
DERIVO® 2
8,0 x 30 mm



ОСНОВНЫЕ УИИ:
(Q1)04260650339615
REF 01-107064
LOT 201019011



Устройство для
защиты от взрыва
серии
DERIVO® 2
8.0 x 30 мм



ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339615
REF 01-107064
LOT 201019011

acandis
Neurovascular Technology GmbH



Устройство для
эмболизации сосудов
DERIVO® 2
с коротким наконечником
8,0 x 50 мм

acandis

«Аксандис ГмбХ»
Теодор-Фарнер-Штрассе 6,
75177, Пфорцхайм (Германия)
Тел.: +49 7231 15500-0
www.acandis.com

CE 0297

REF 01-107074


LOT 201028006

Рекомендуемый диаметр сосуда

От 7,0 мм до 8,0 мм

Содержимое:

1 x Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2

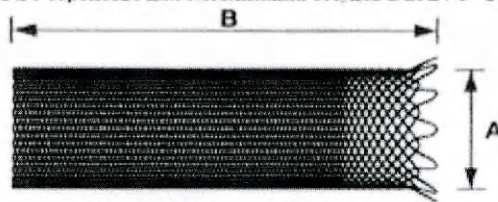

A: Диаметр сосуда B: Длина изделия в A

Конфигурация транспортного проводника: прямой

A	8,0 mm	7,5 mm	7,0 mm
B	50 mm	70 mm	85 mm

Размеры раскрытого изделия
Диаметр: 8,2 mm Длина: 38 mm

Рекомендуемый катетер
для доставки:
NeuroBridge® 39
NeuroSlider® 39 DLC

Требуемый катетер
для доставки:
ВЛ 0,039 дюйма

Ред. D



STERILE EO

2013-10-29



(01)04260650339714(17)231029(10)201028006

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
8,0 x 50 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339714
REF 01-107074
LOT 201028006

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
8,0 x 50 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339714
REF 01-107074
LOT 201028006

MD

Устройство для
эмболизации
сосудов
DERIVO® 2
с коротким
наконечником
8,0 x 50 мм

UDI

ОСНОВНЫЕ УИИ:
(01)04260650339714
REF 01-107074
LOT 201028006

Наименование: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2, в составе:

1. Стент нитиноловый саморасширяющийся, размеры (мм): ____ x ____ - 1 шт.
2. Транспортный проводник J-формы, диаметр: ____ F (____ мм); длина – 2000 мм - 1 шт.
3. Интродьюсер, размеры: ____ F (____ мм) – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Этикетка – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ», Россия

123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com



Апирогенно.

Нетоксично.

Наименование: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Устройство для эмболизации сосудов DERIVO® 2 с коротким наконечником

1. Стент нитиноловый саморасширяющийся, размеры (мм): ____ x ____ - 1 шт.
2. Транспортный проводник с коротким наконечником прямой формы, диаметр: ____ F (____ мм); длина – 2000 мм - 1 шт.
3. Интродьюсер, размеры: ____ F (____ мм) – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Этикетка – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ», Россия

123290, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 39, корп. 2, оф. 10

Тел.: +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

~~XX~~

Апирогенно.

Нетоксично.

Прошито и пронумеровано
58 листов

Генеральный директор
И. Козлов

