



«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации
медицинских изделий Бизнес-
юнита «Радиология»

АО «БАЙЕР»



Алисевич Е.А.

« » 2018 г.

////
АО «БАЙЕР»


107113, Россия, Москва
ул. 3-я Рыбинская д.18, стр.2


Тел.: (495) 234 20 00

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Трубка соединительная высокого давления стерильная

www.bayer.ru

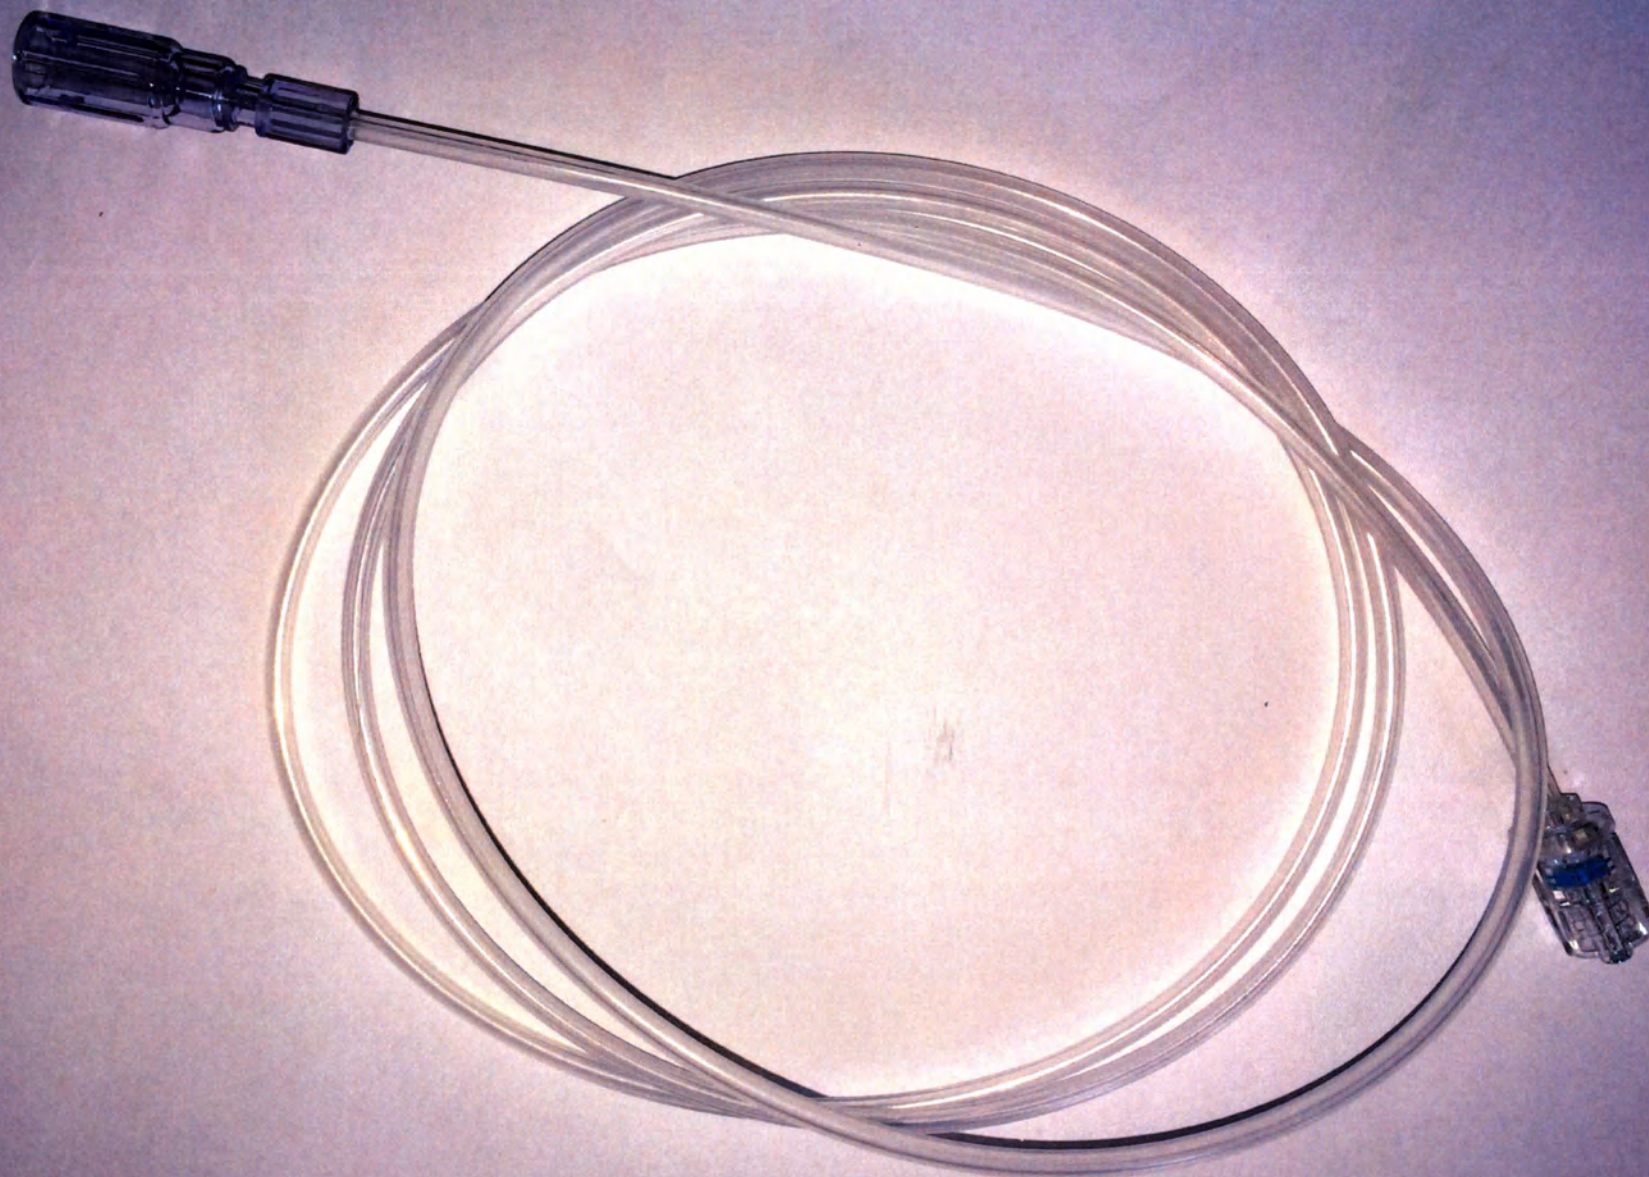

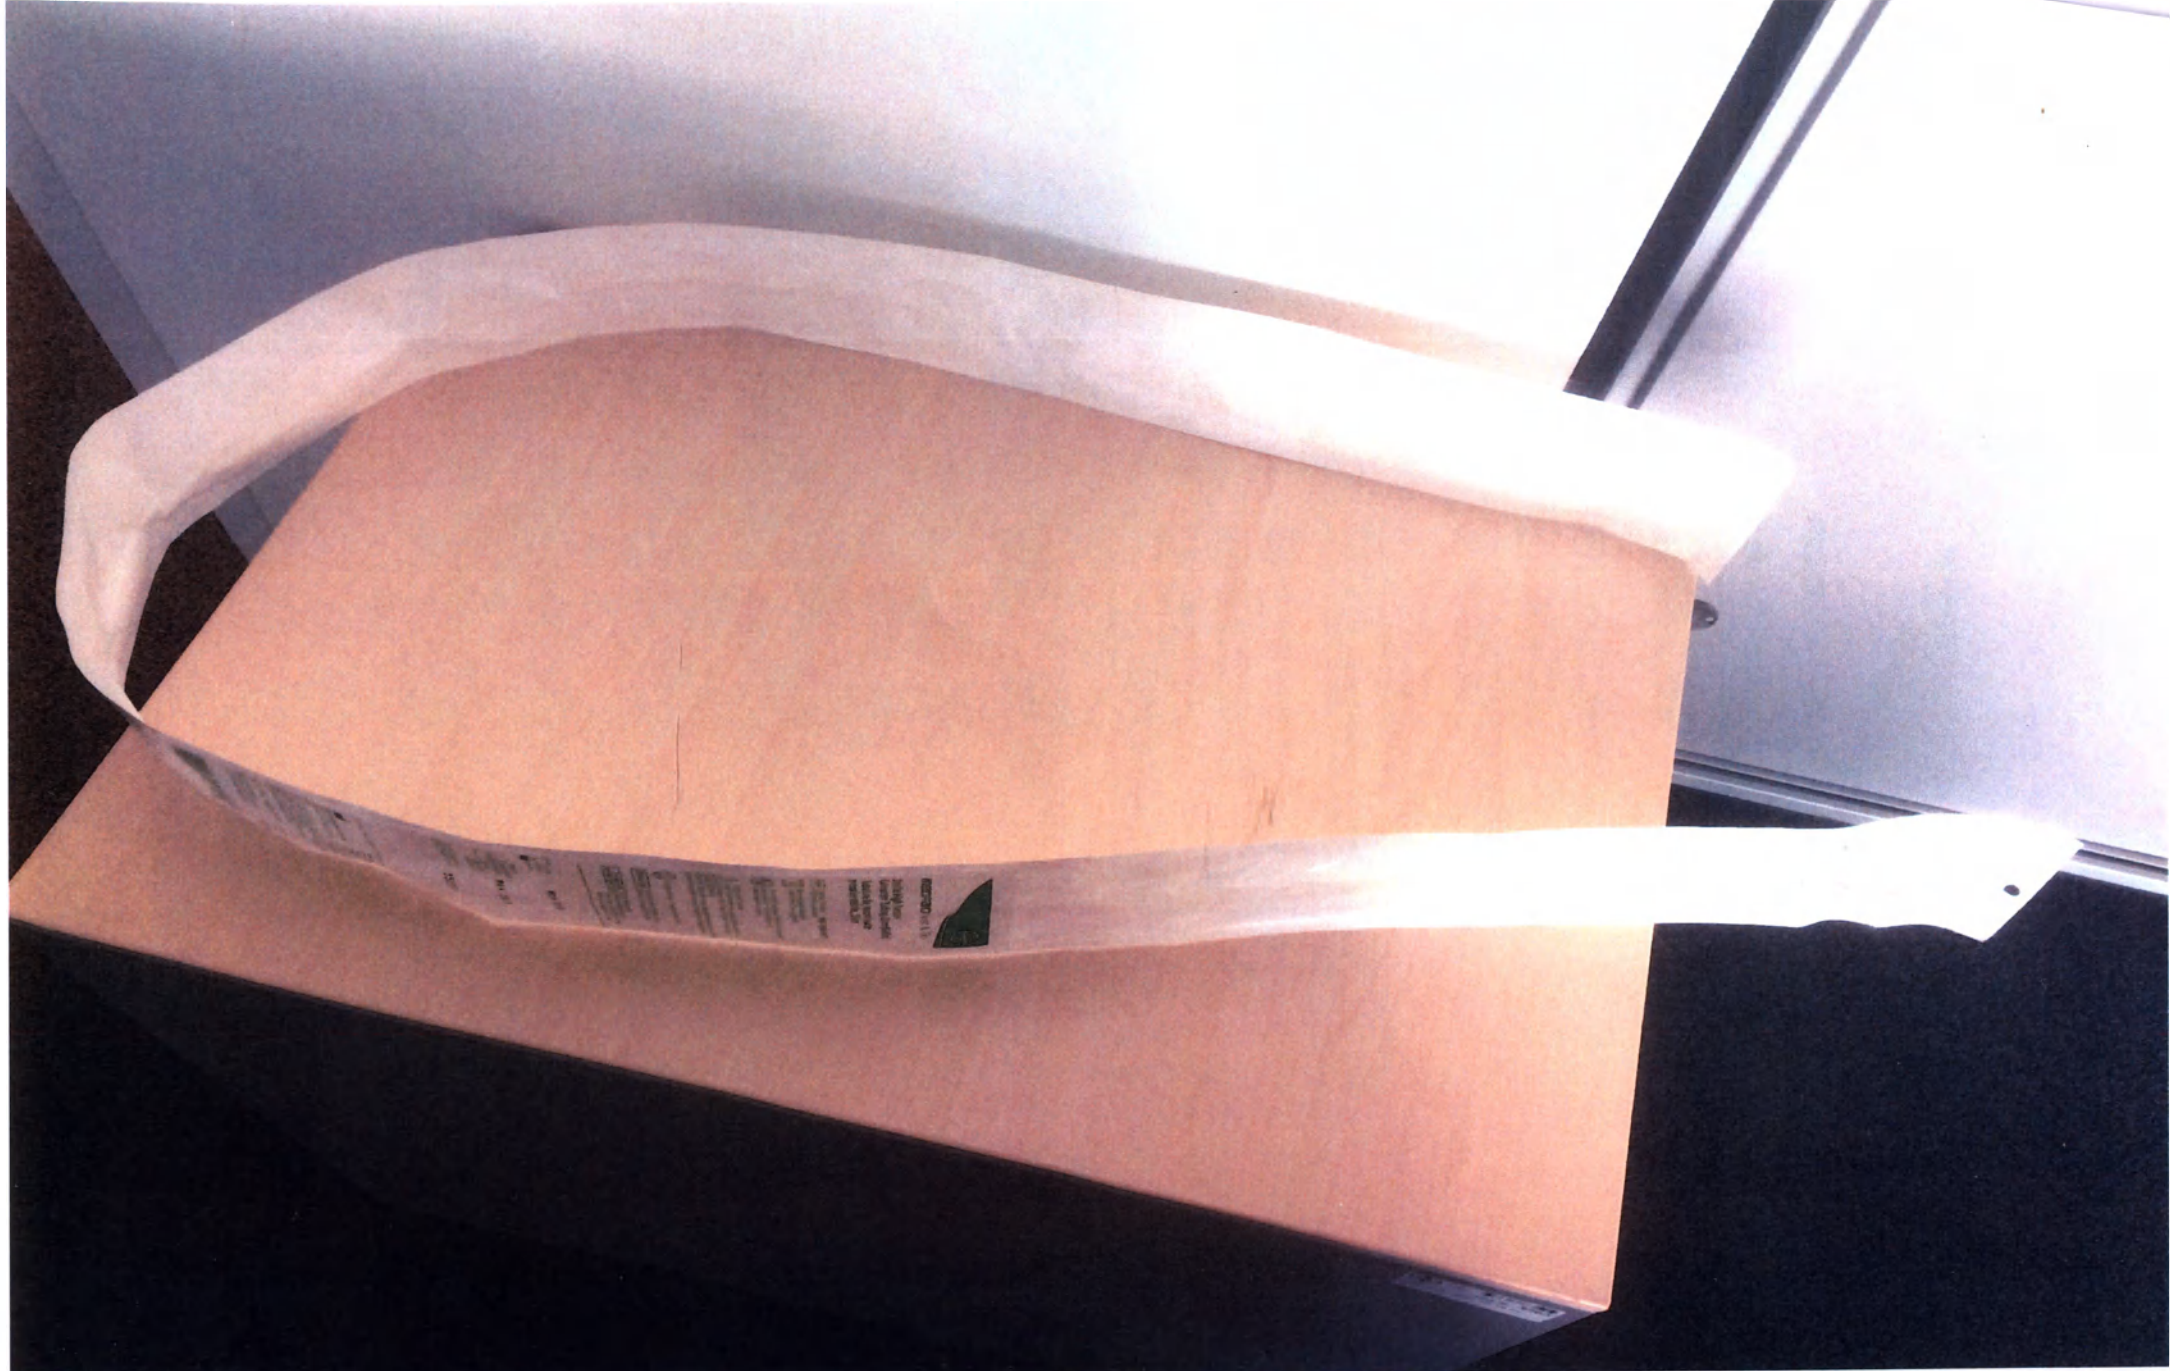



medRAD® Twist & Go

**Sterile High Pressure
Connector Tubing, 150cm (60in)**

**Tubulure de raccord haute
pression stérile, 150cm**

REF Catalog Number: **TAG C150 HPCT**
Référence catalogue:



Non-pyrogenic fluid path.
Ligne d'injection apyrogène.



Do not use if package is opened or damaged.
Ne pas utiliser si l'emballage est
endommagé ou ouvert.



1200psi (8273kPa)
Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use packaged in each carton.
1200psi (8273kPa)
Attention: Reportez-vous aux avertissements et aux mises
en garde du mode d'emploi fourni dans chaque boîte.



Single use only. Usage unique strict



STERILE EO Sterilized with Ethylene Oxide.
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX Not made with
Natural Rubber Latex.
N'est pas fabriqué à partir de
latex de caoutchouc naturel



Use By
Utiliser
avant le

MAY 2018



Date of
Manufacture/
Sterilization
Date de
fabrication/
stérilisation

MAY 2015



Lot Number
Numéro de lot

152203



Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Rx Only. Refer to warnings and cautions on instruction sheet.
Uniquement sur ordonnance.
Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde
figurant dans le mode d'emploi.

Made in China / Fabriqué en Chine

Patent Information:
Information sur les brevets:
www.ripatents.bayer.com

CE 0086

Bayer



(01) 0 0616258 00695 6

DN-227691 Rev. A

Маркировка стерильной упаковки изделия «Трубка соединительная высокого давления стерильная»

Специальное
предназначение не
имеет. И.И.И.
И.И.И.

