

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

медицинского изделия

Система видеозендоскопическая HD-550 в составе

Генеральный директор

ООО «СОНОСКЕЙП МЕДИЦИНА РУС»

«02» МАРТА 2024 г.



Гао Чэн

2024 год

I. Устройство обработки изображений в составе:


Устройство обработки изображений, в вариантах исполнения: HD-550S; HD-550Pro; HD-550; HD-550Exp; HD-510; HD-500Plus









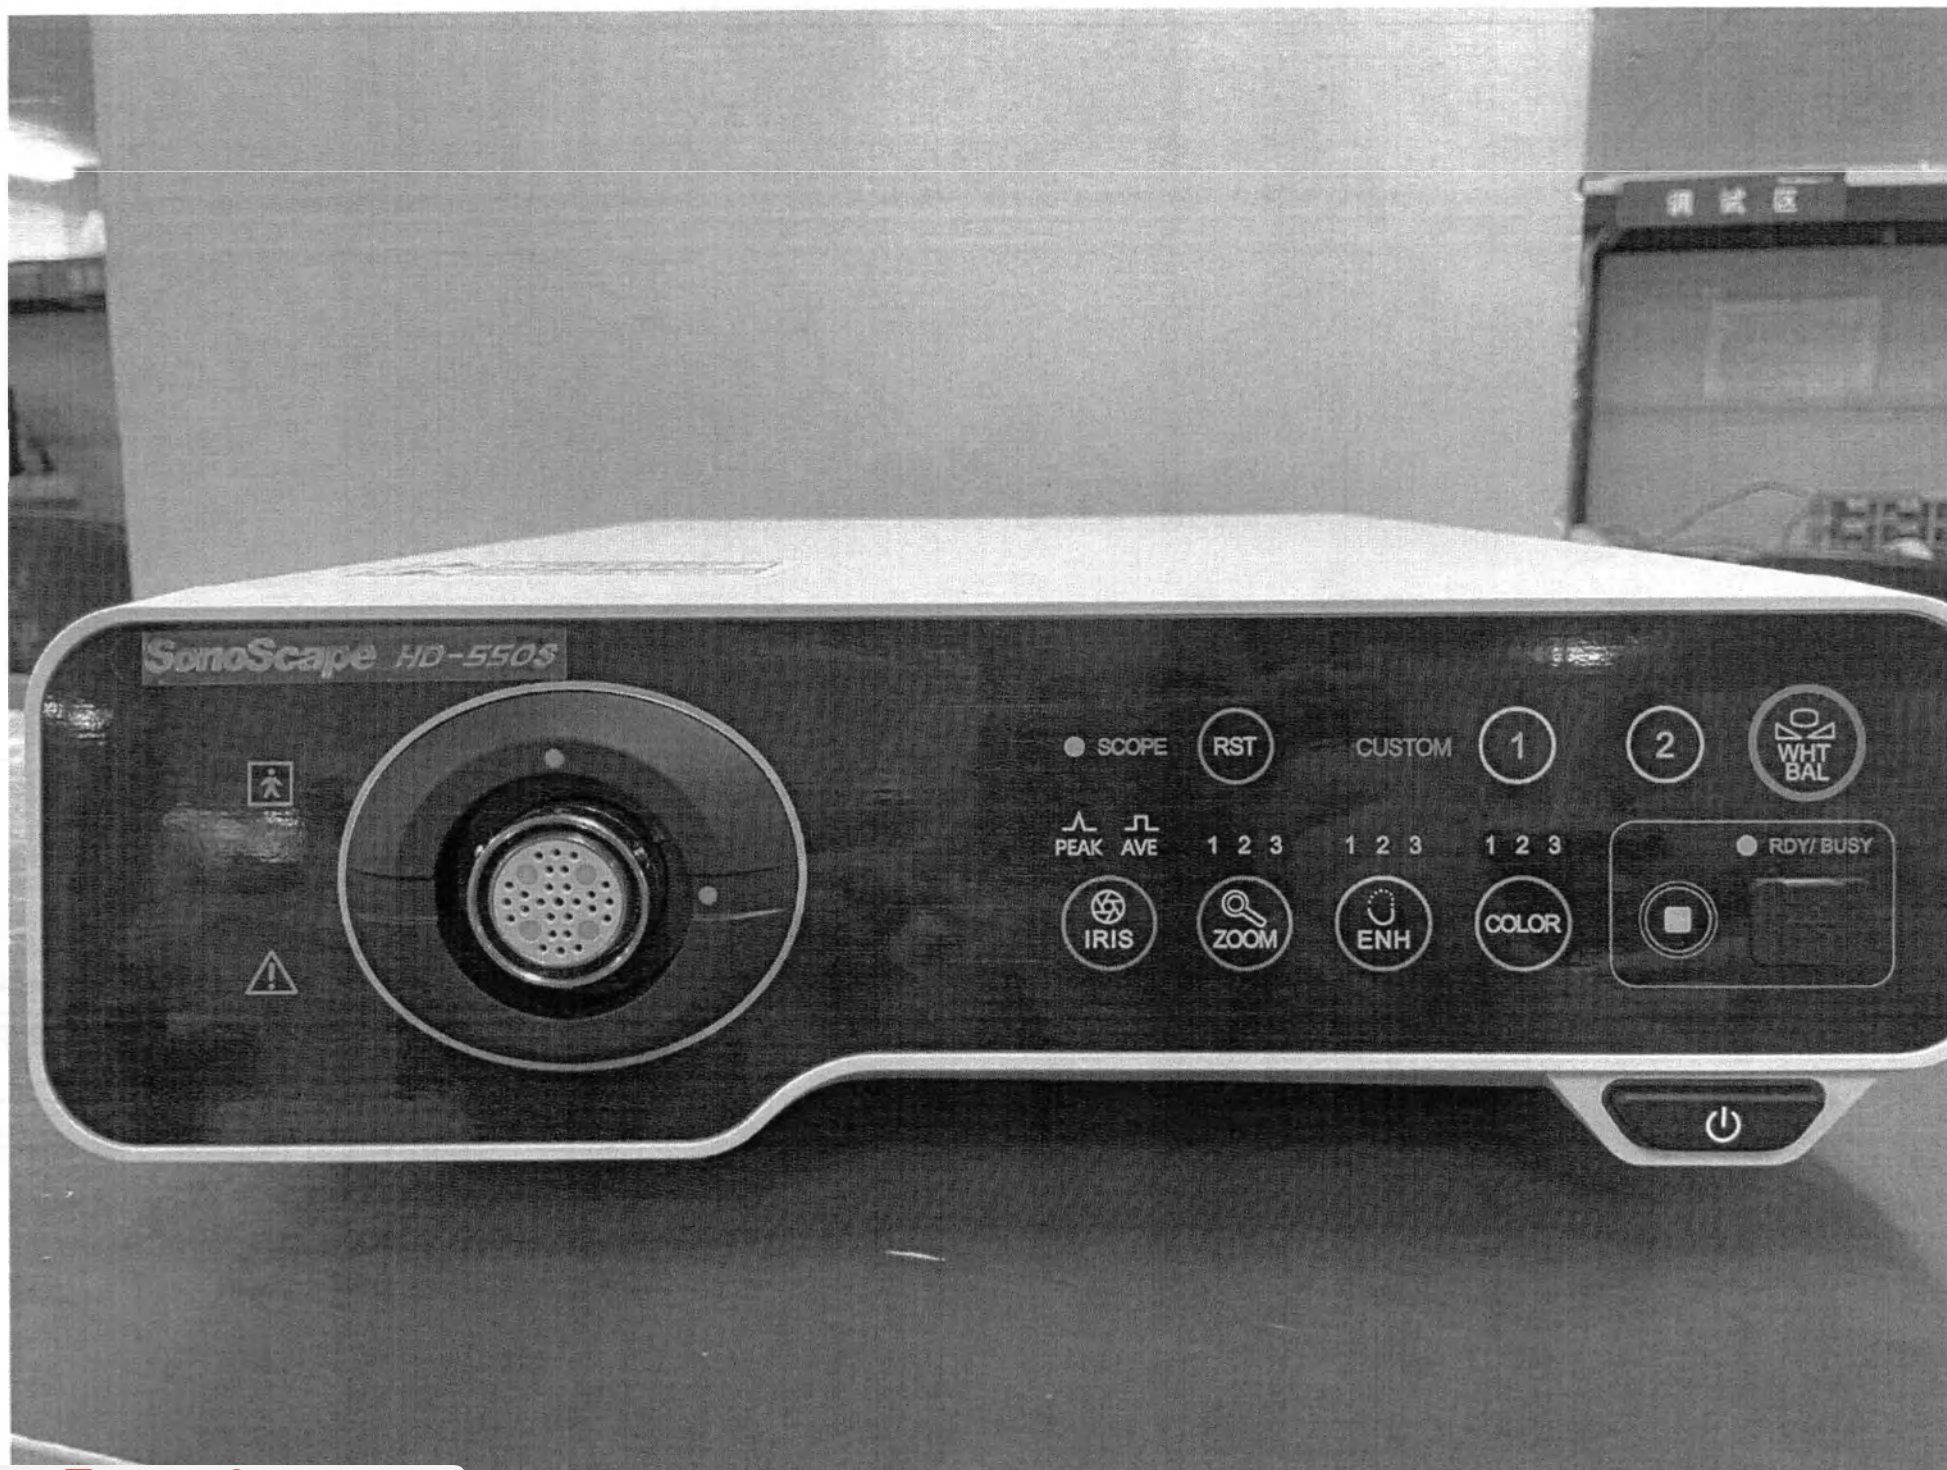

SonoScapeHD-550Exp



● SCOPE

RST

CUSTOM

1

2

PEAK AVE

1 2 3

1 2 3

1 2 3



IRIS



ZOOM



ENH



COLOR


● RO




Силовой шнур




Держатель витого видеокабеля (при необходимости)

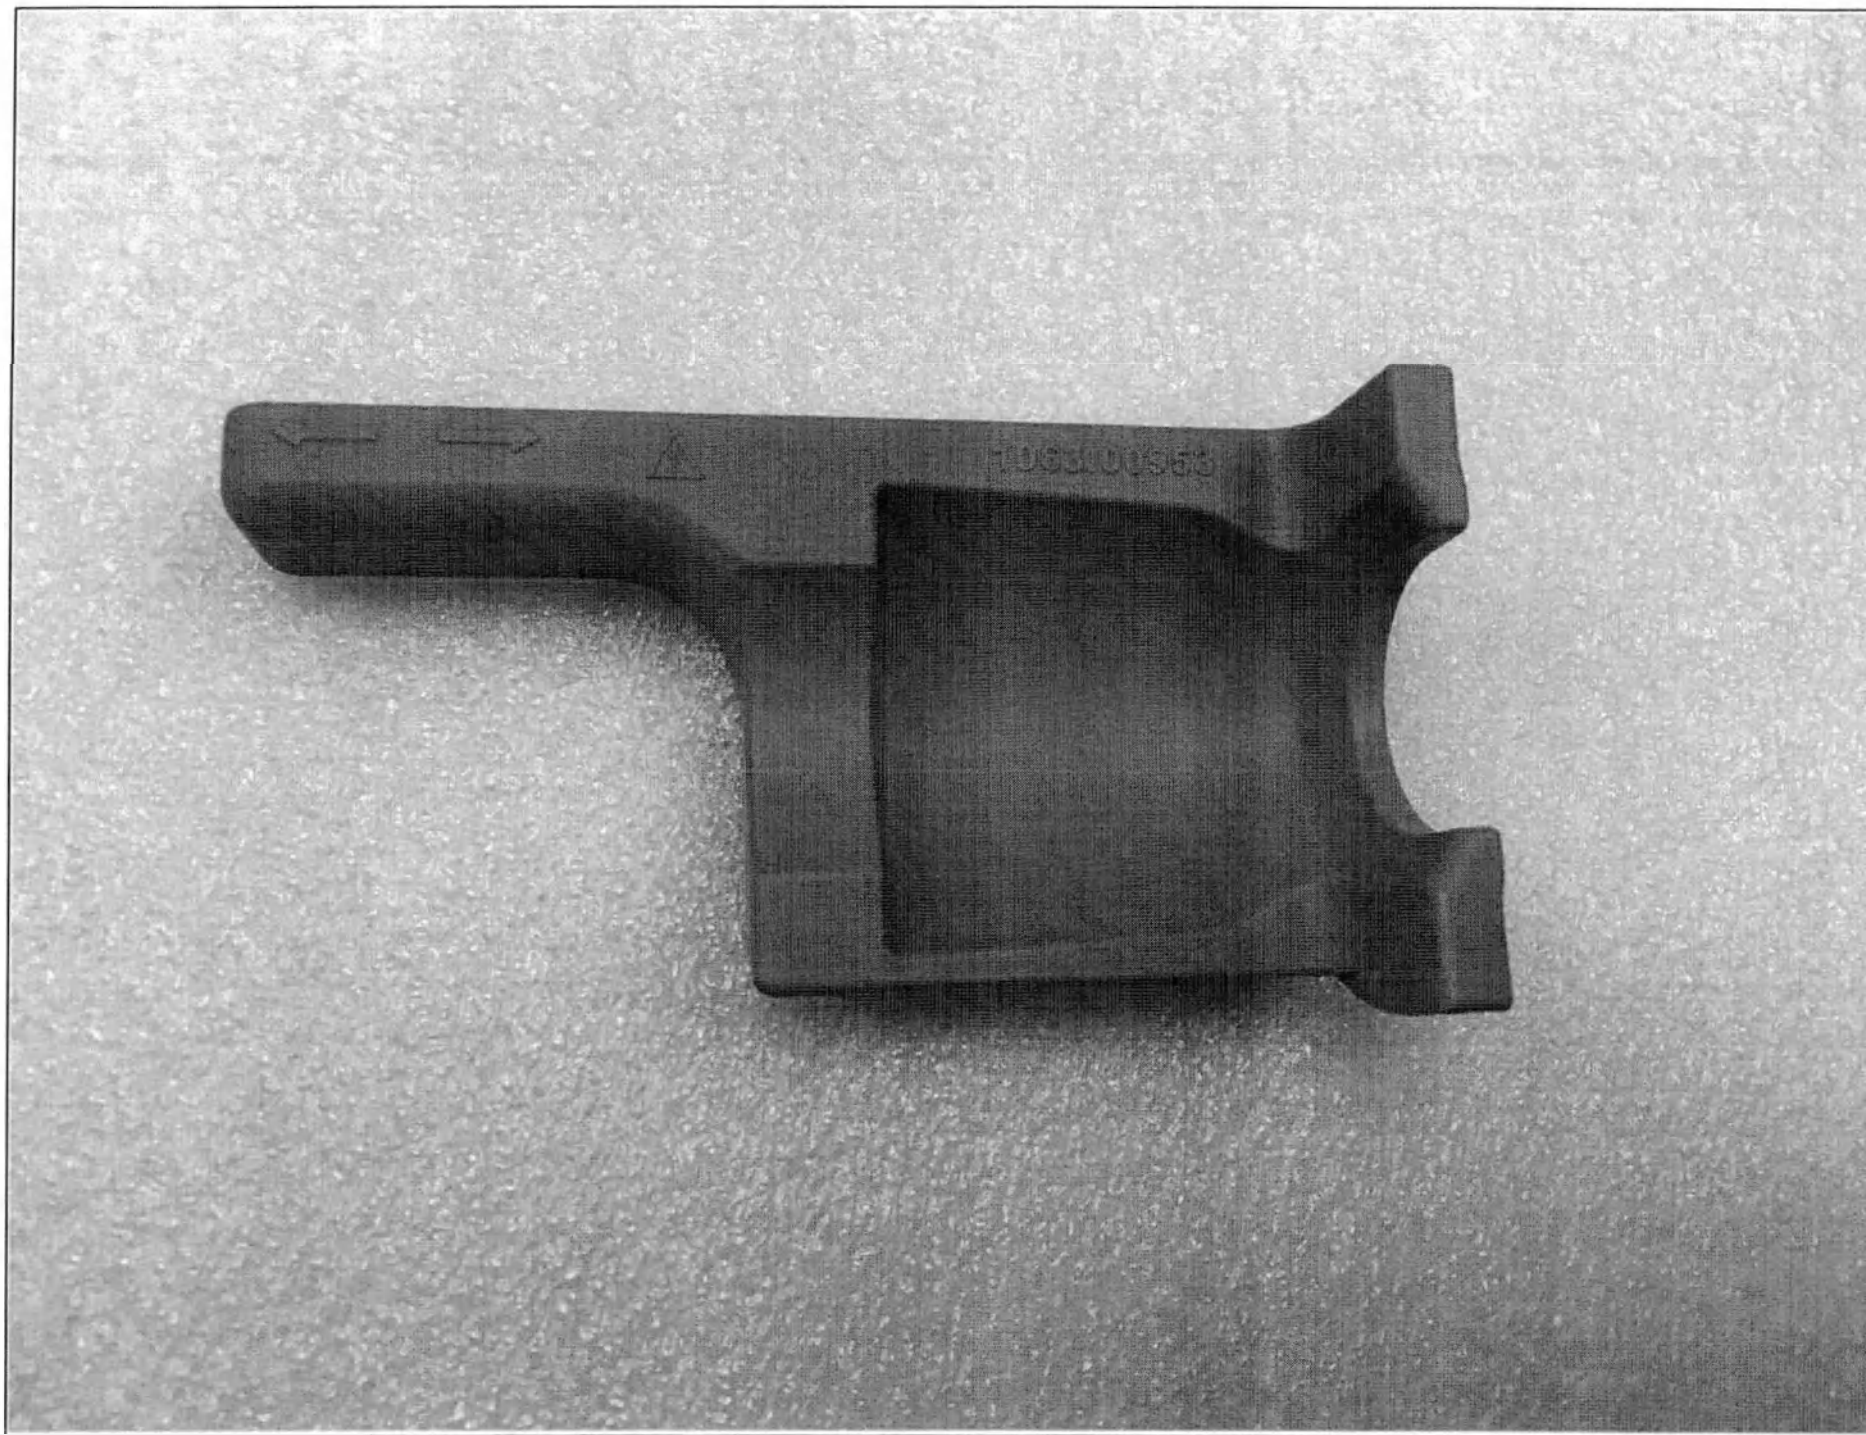

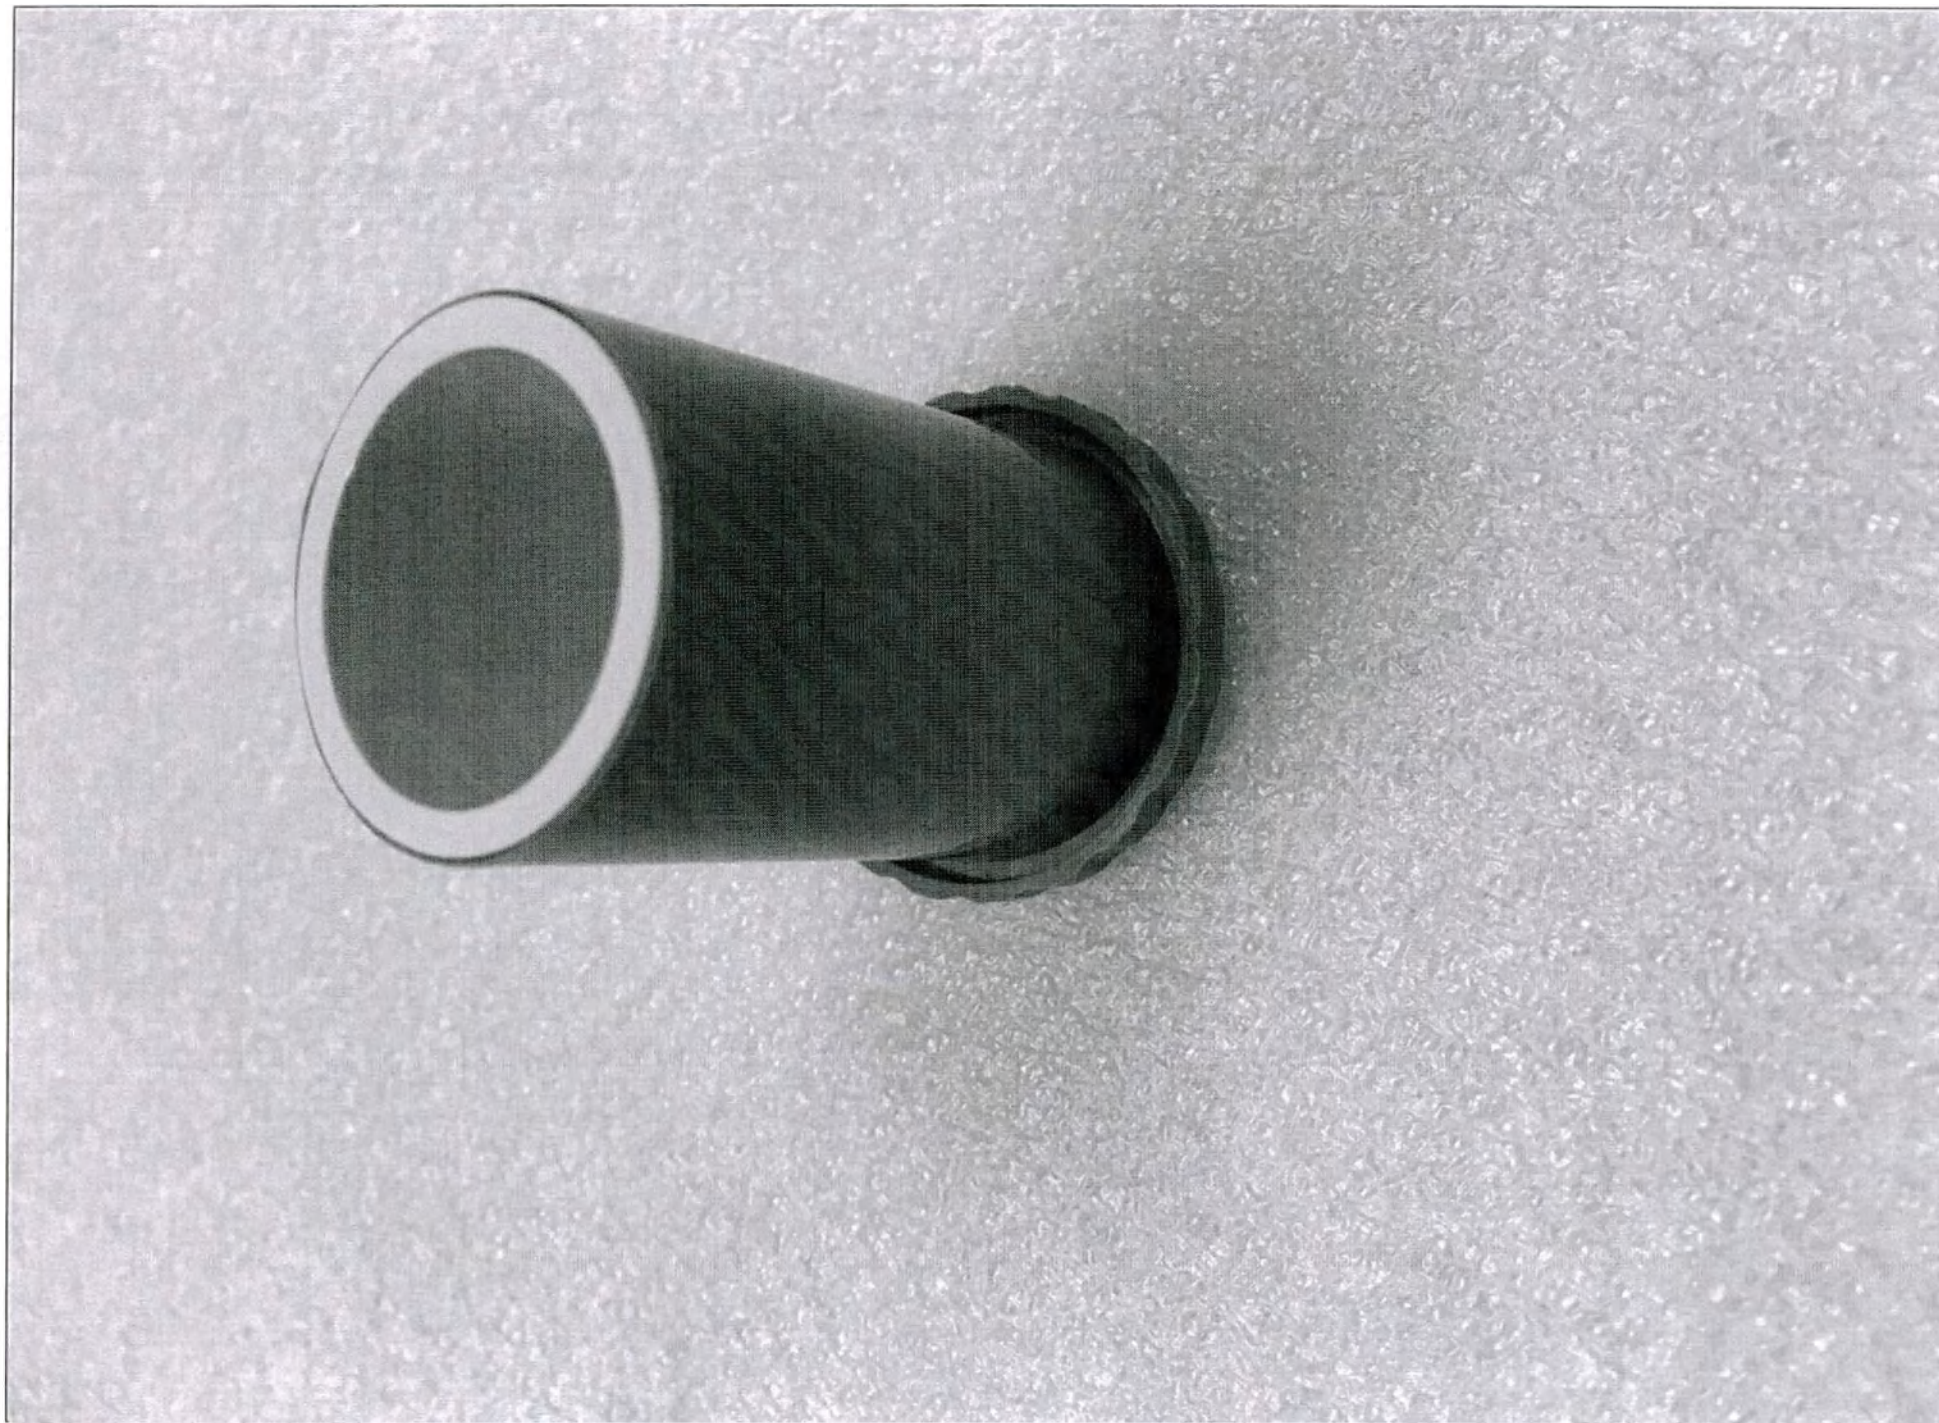


Держатель колпачка баланса белого

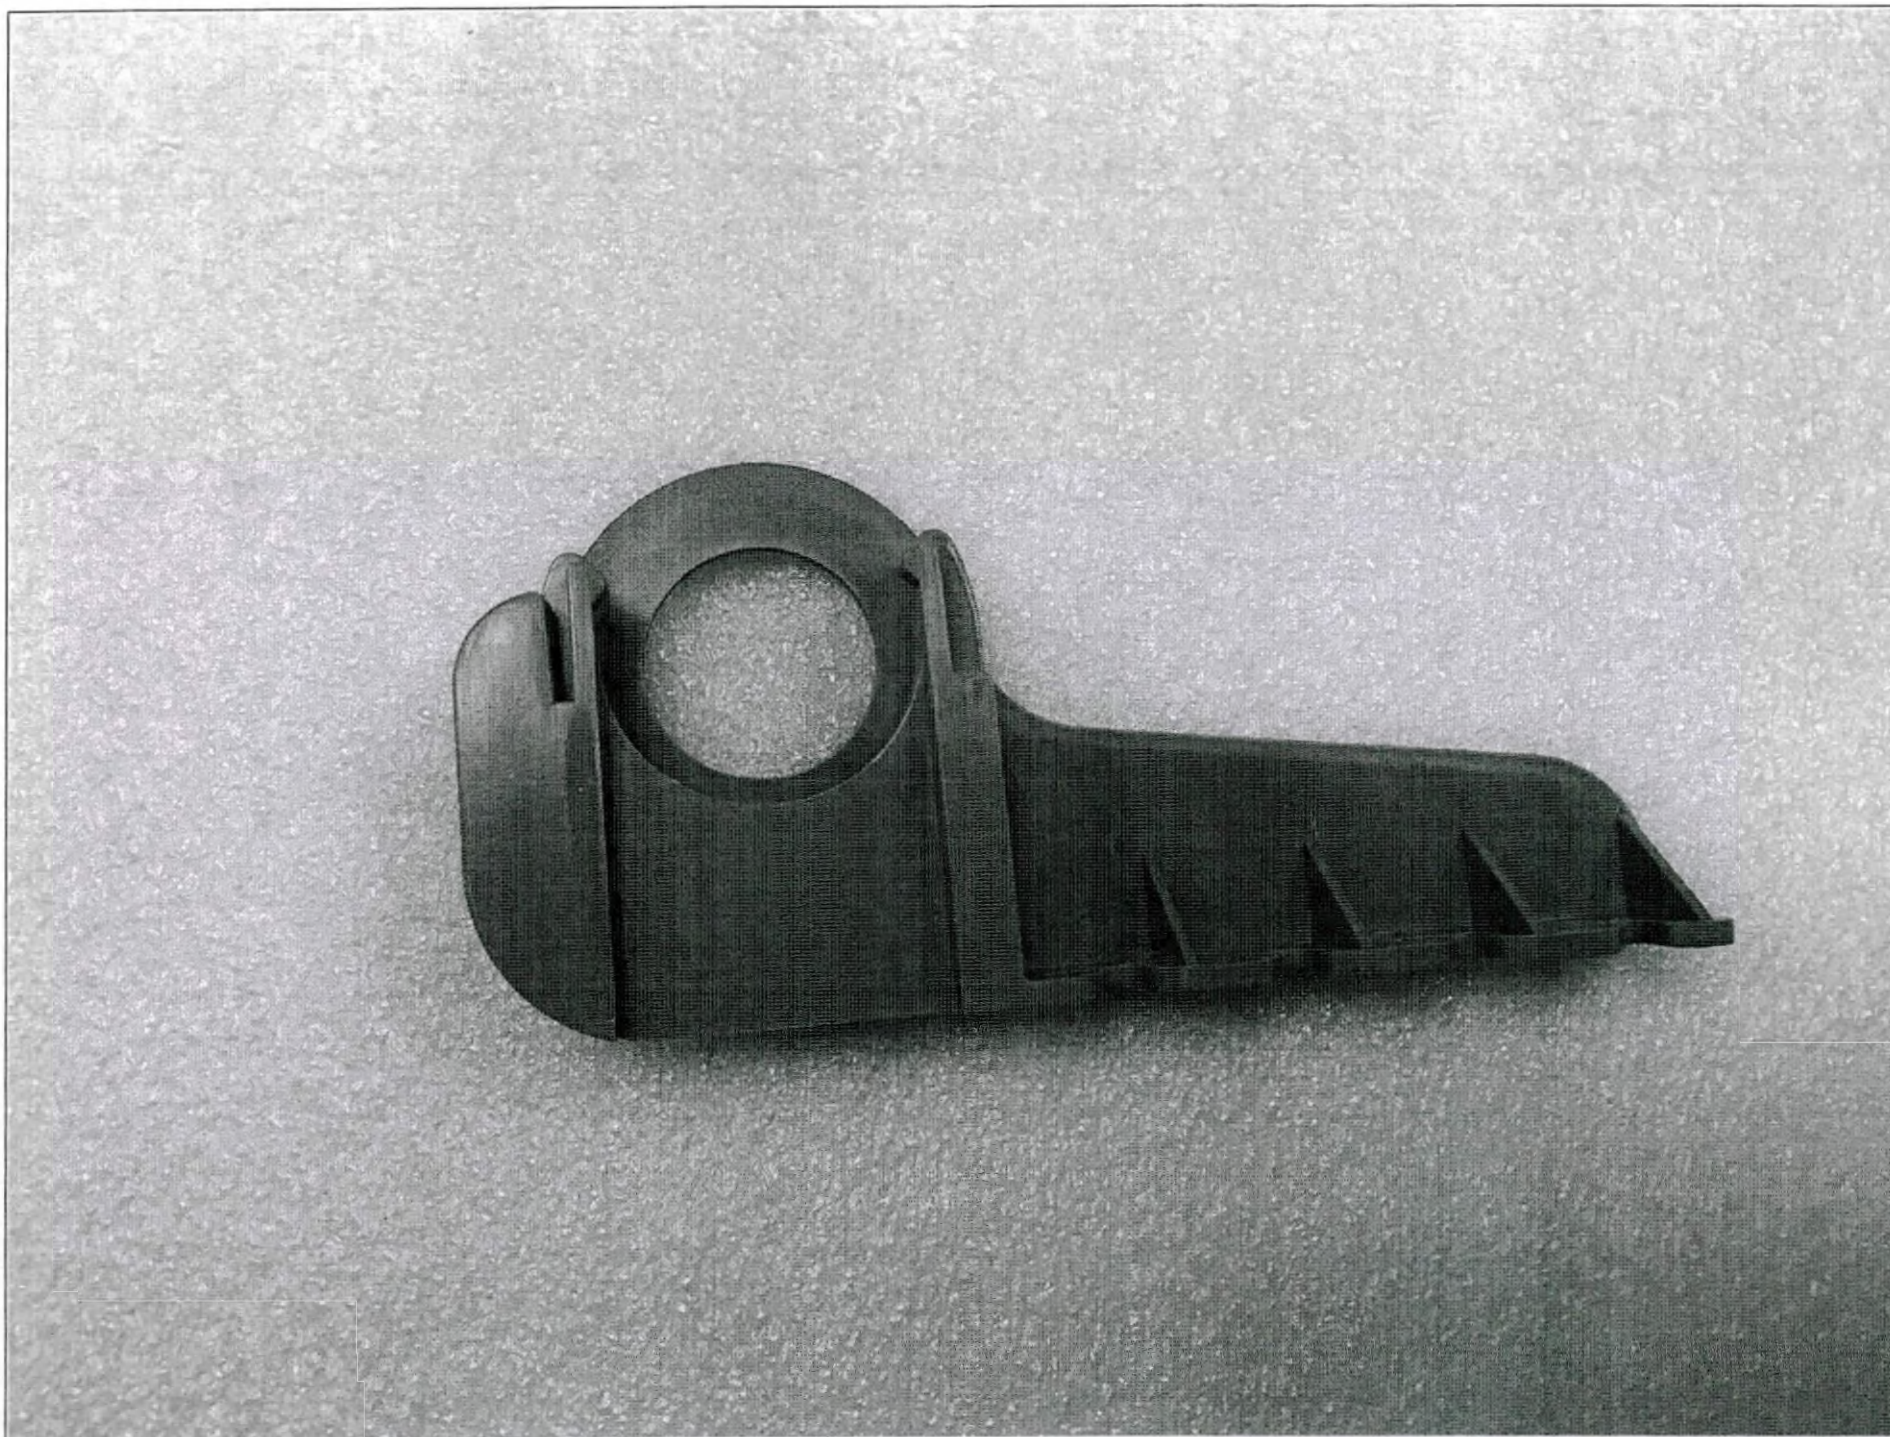

Клавиатура



Плавкий предохранитель

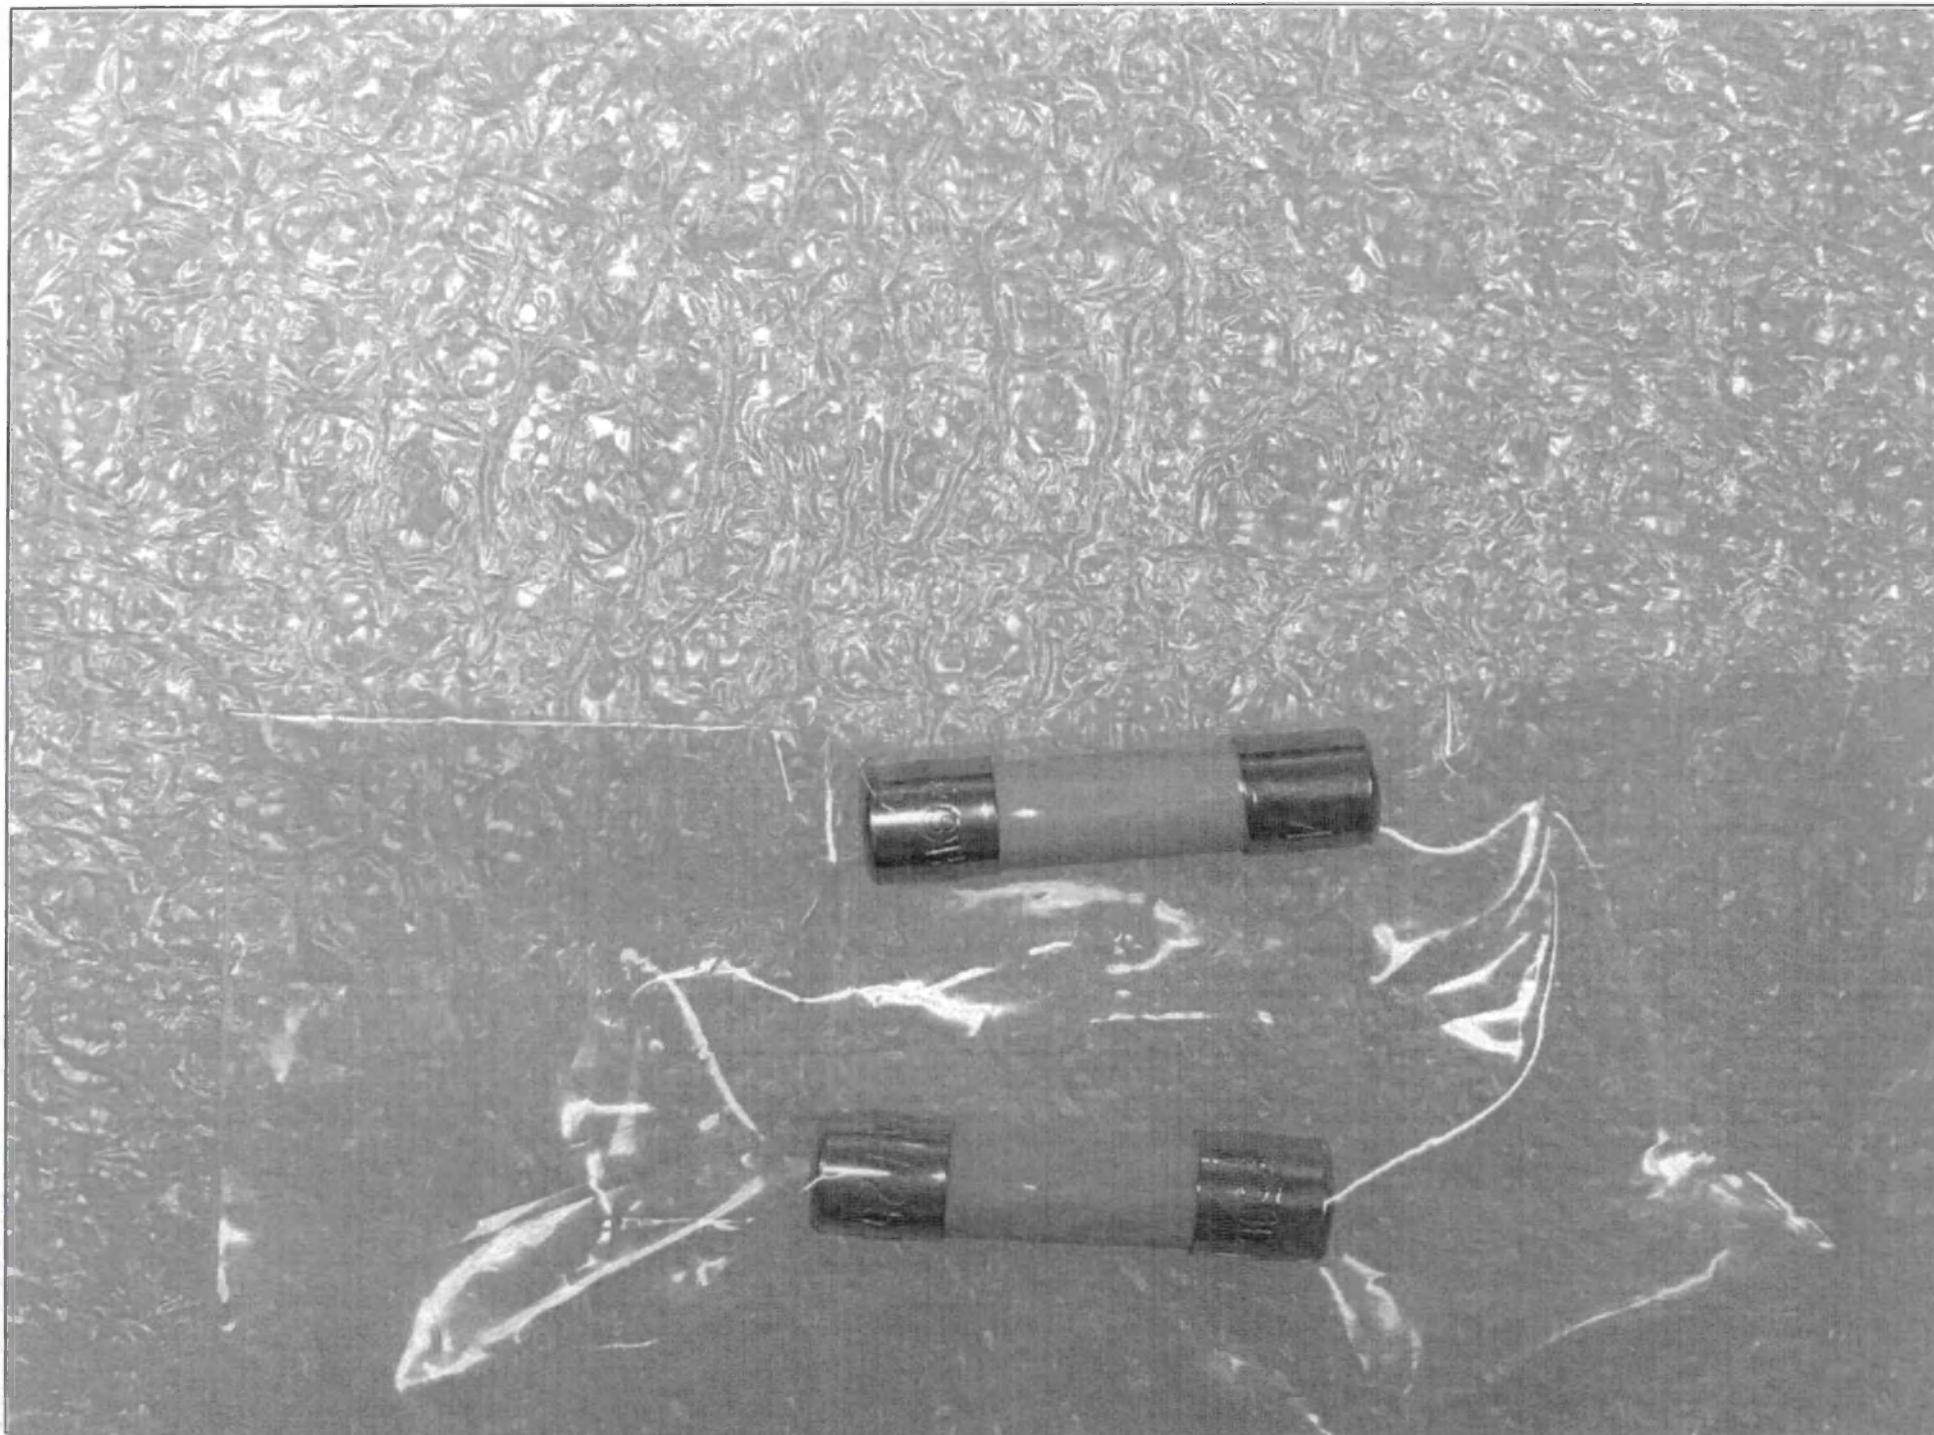

Витой видеокабель (при необходимости)



Оптоволоконный кабель (при необходимости)




SonoScape
HD-550Exp/HD-550/
HD 550Pro/HD-550S/
HD-510/HD-500Plus


Устройство обработки изображений

Руководство пользователя


Ножной переключатель (при необходимости)

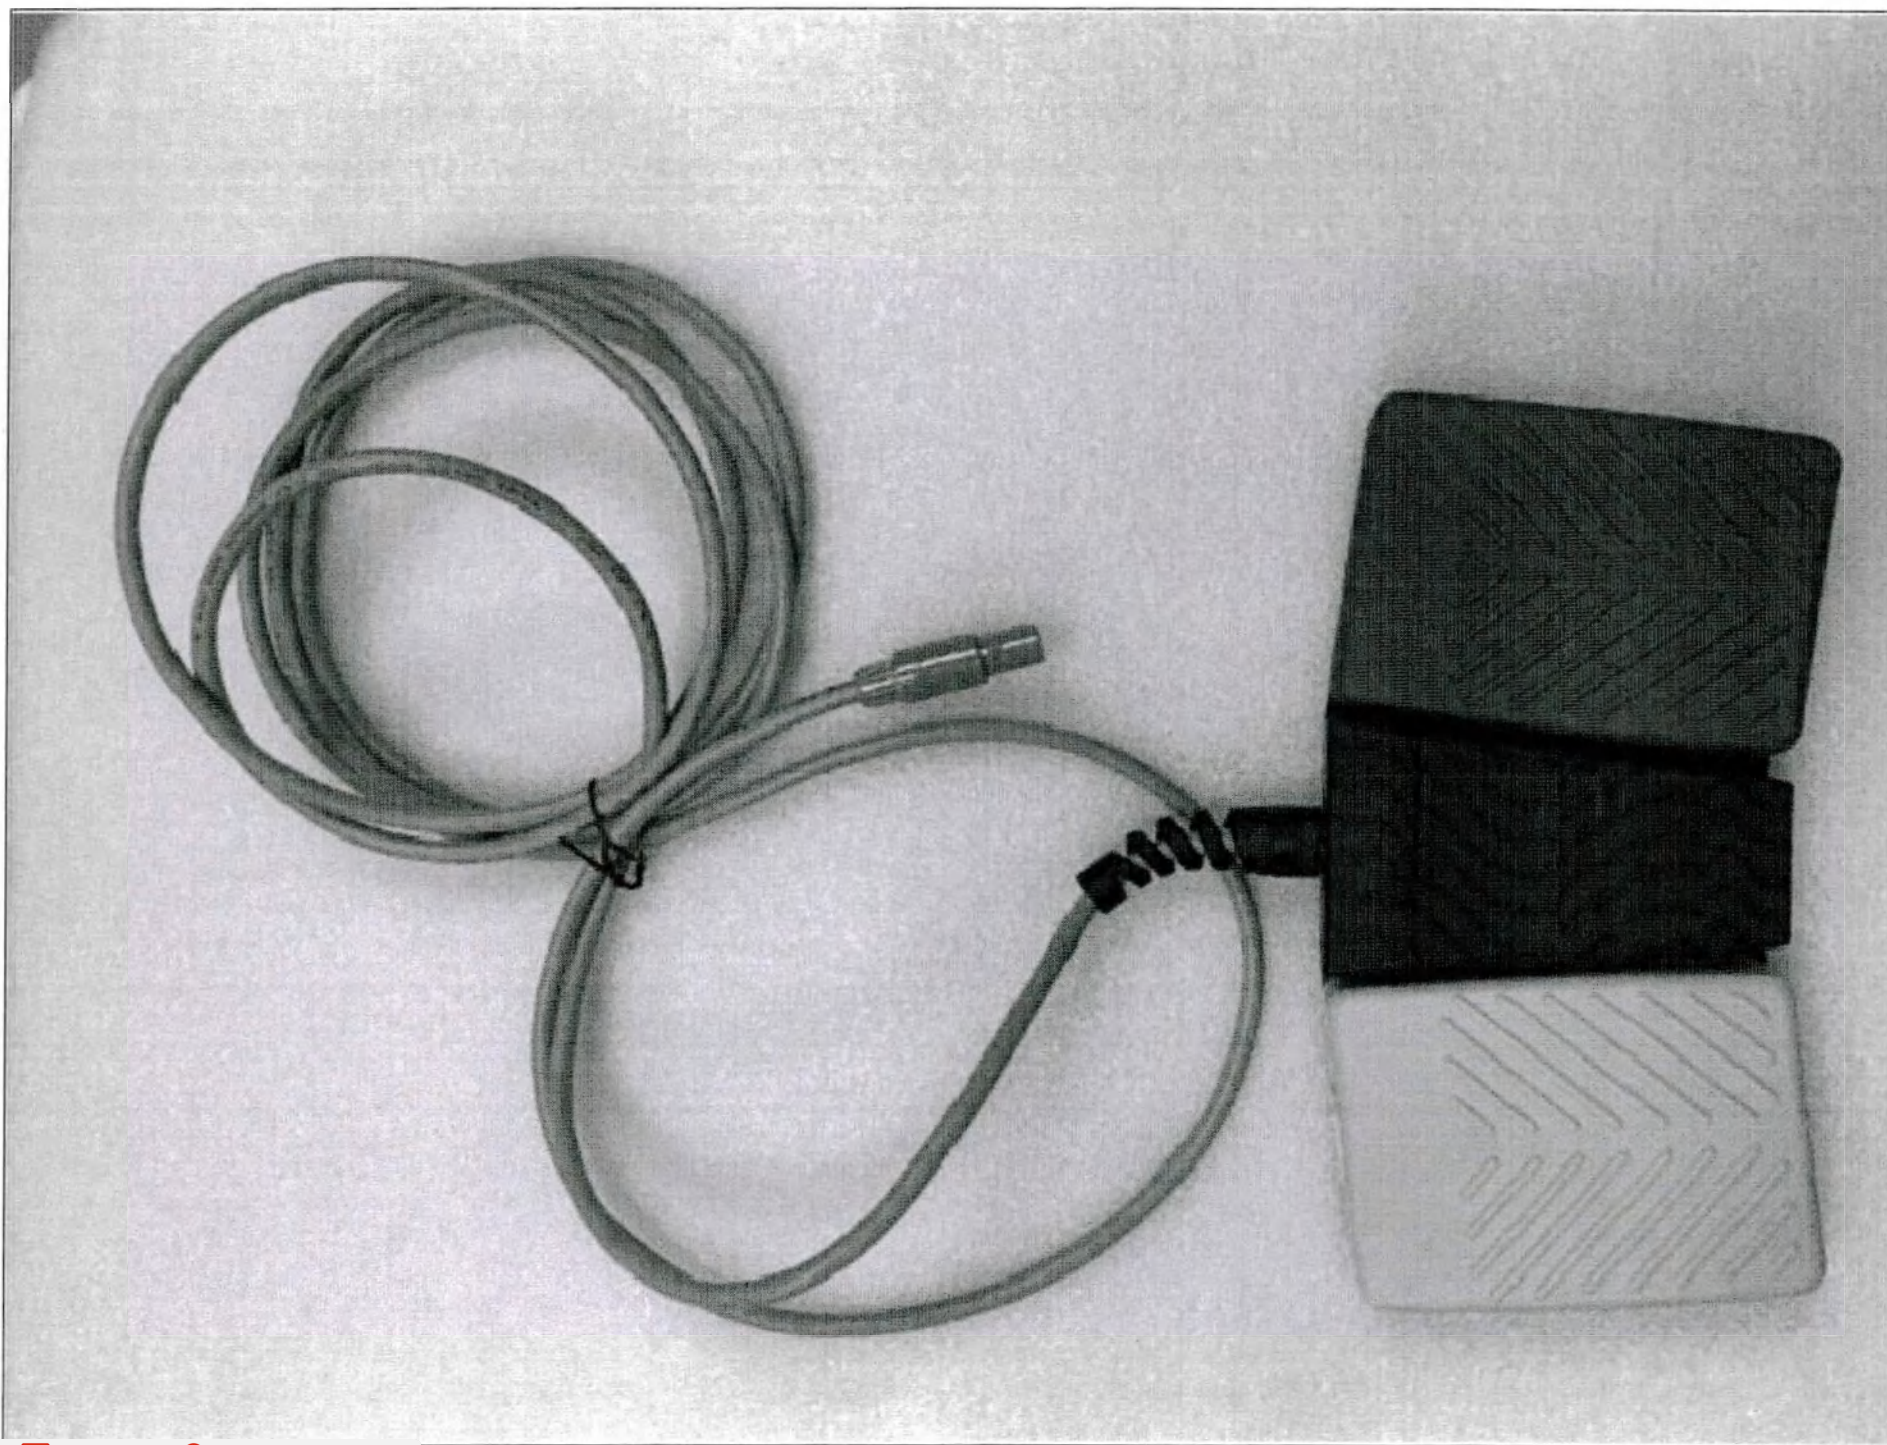


Видеокабель BNC (при необходимости)

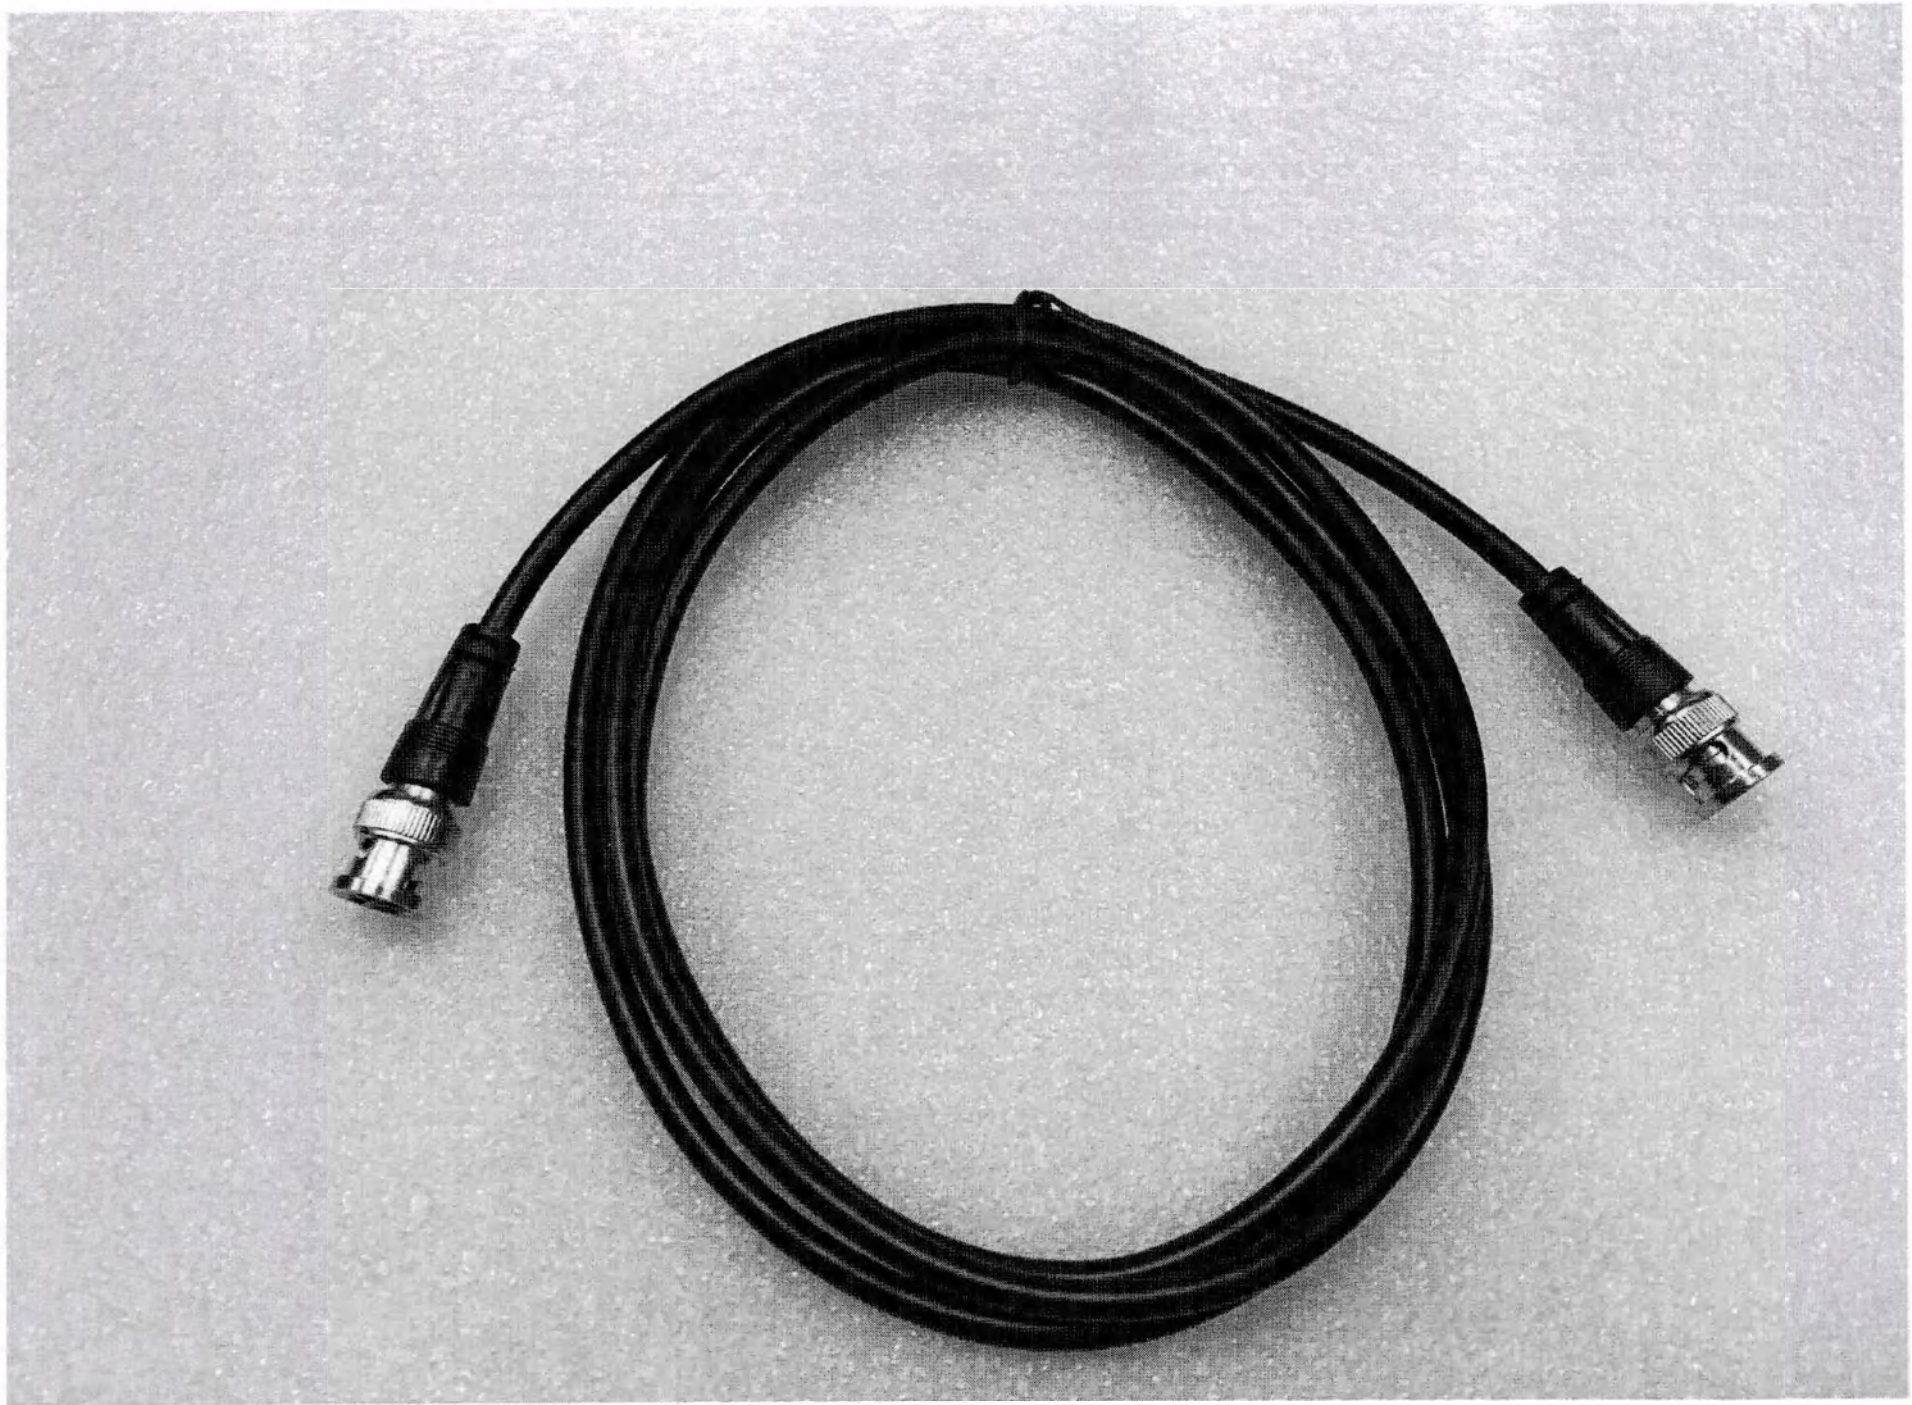


Видеокабель Y/C (при необходимости)

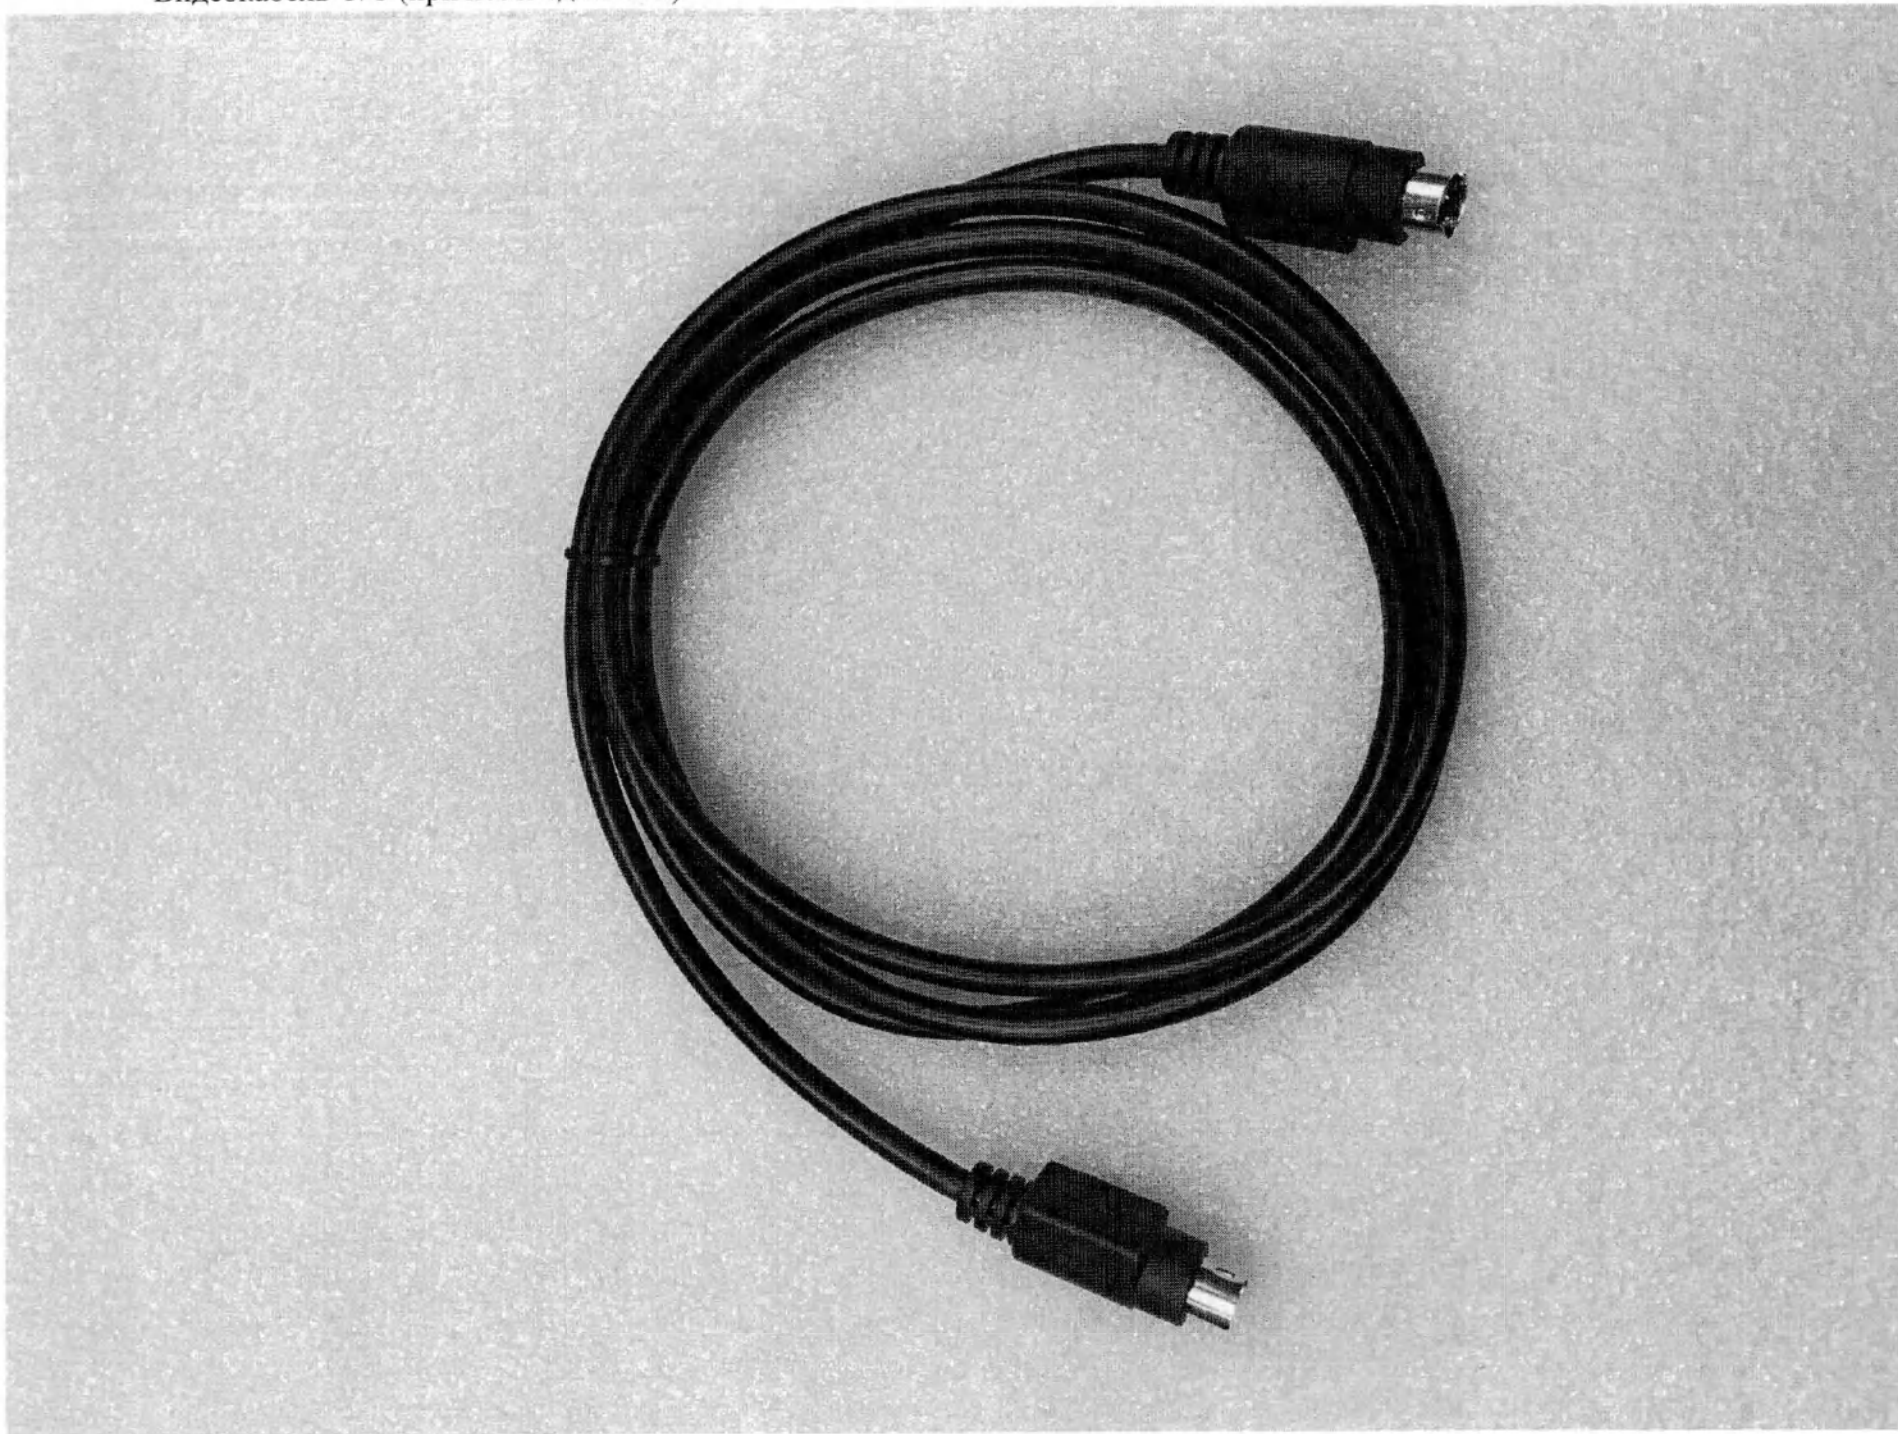


Видеокабель VGA (при необходимости)

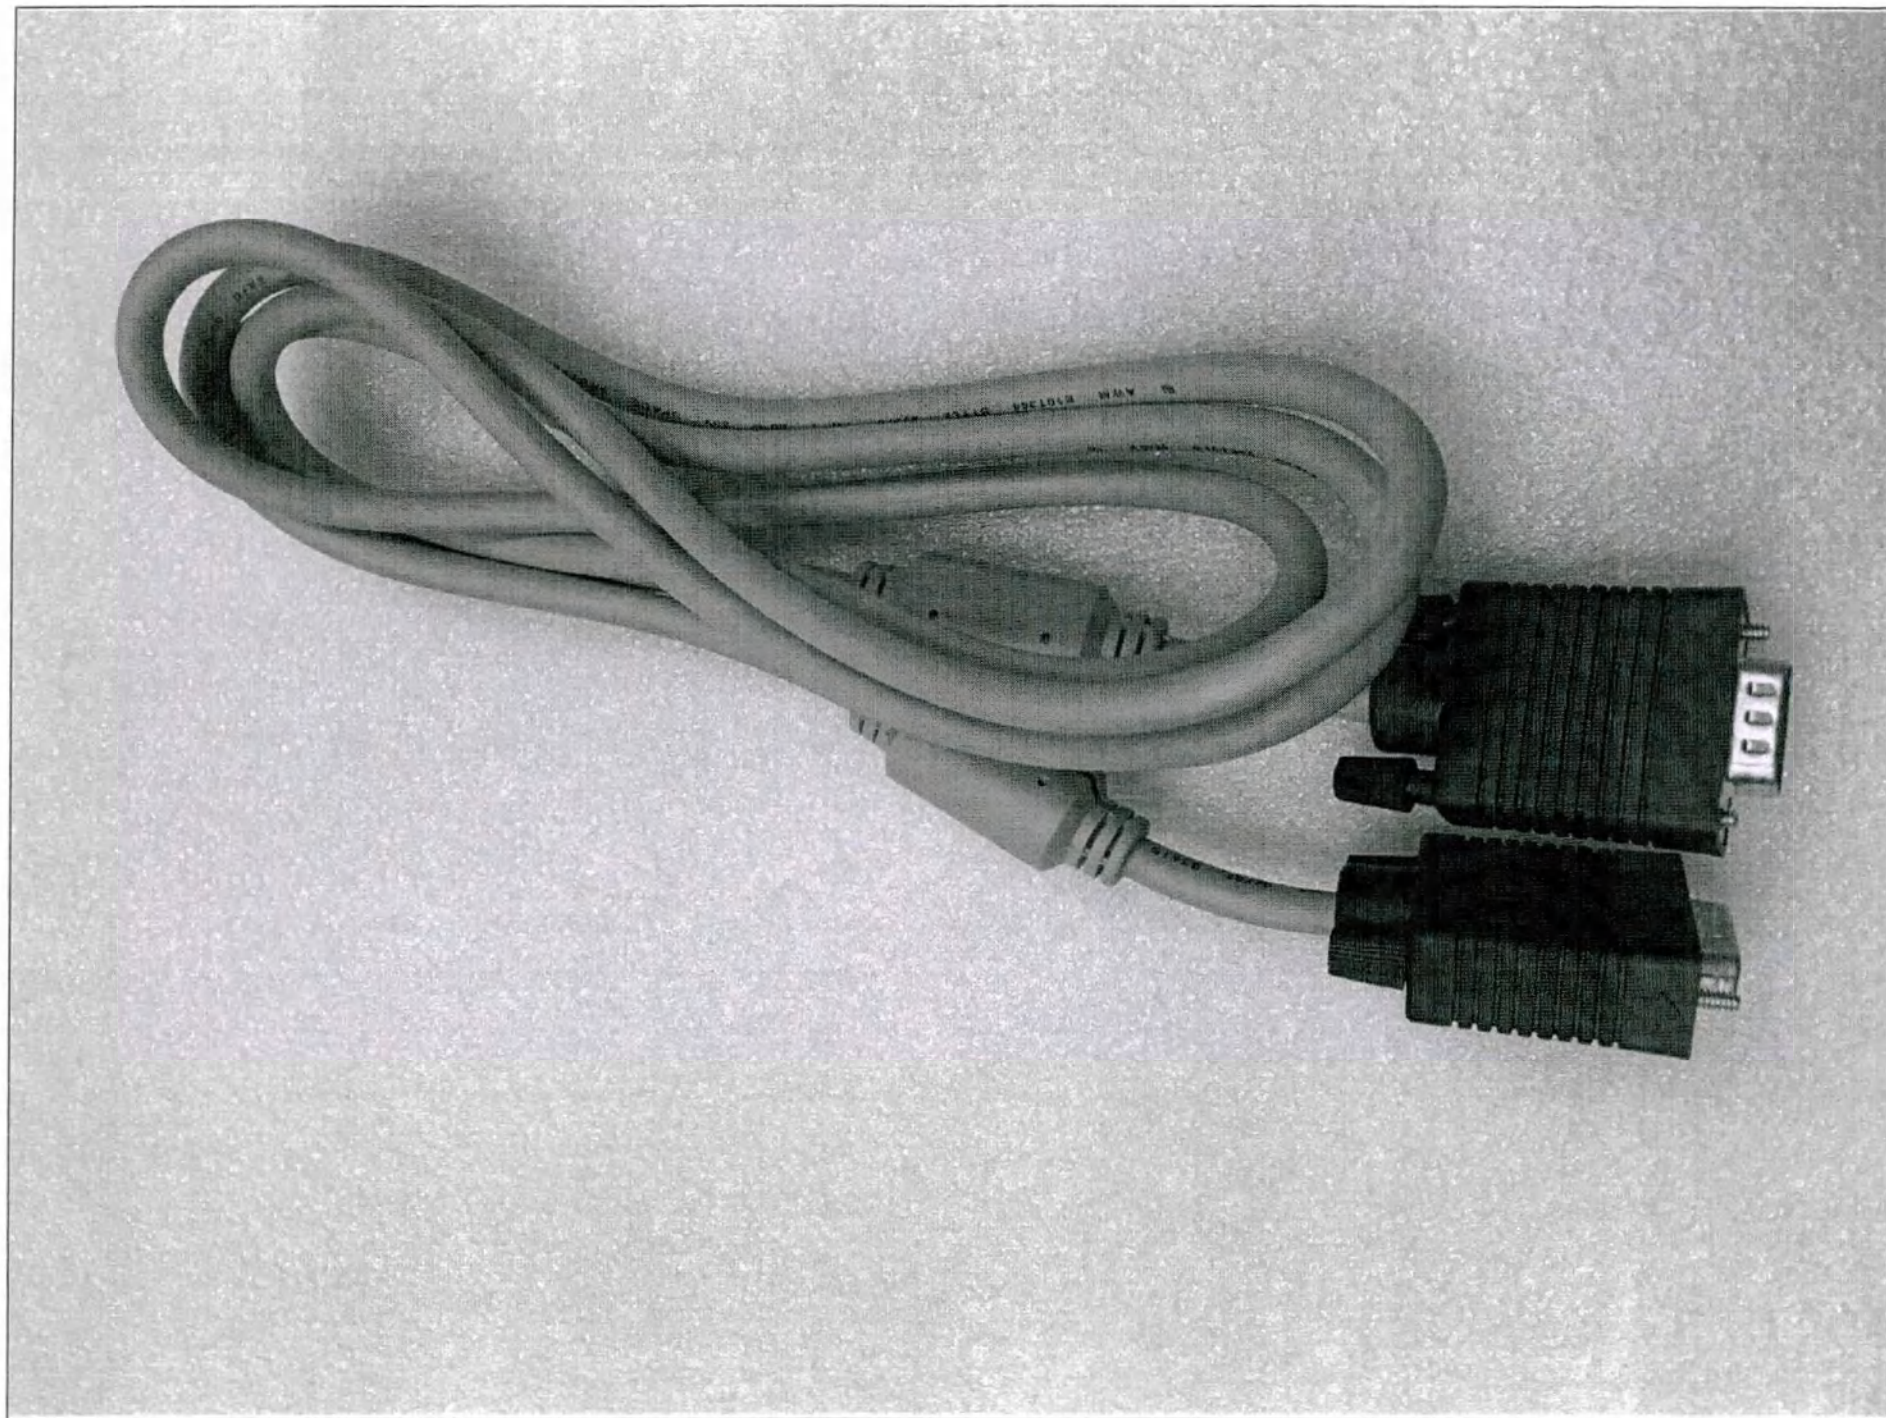


Аудио кабель (при необходимости)

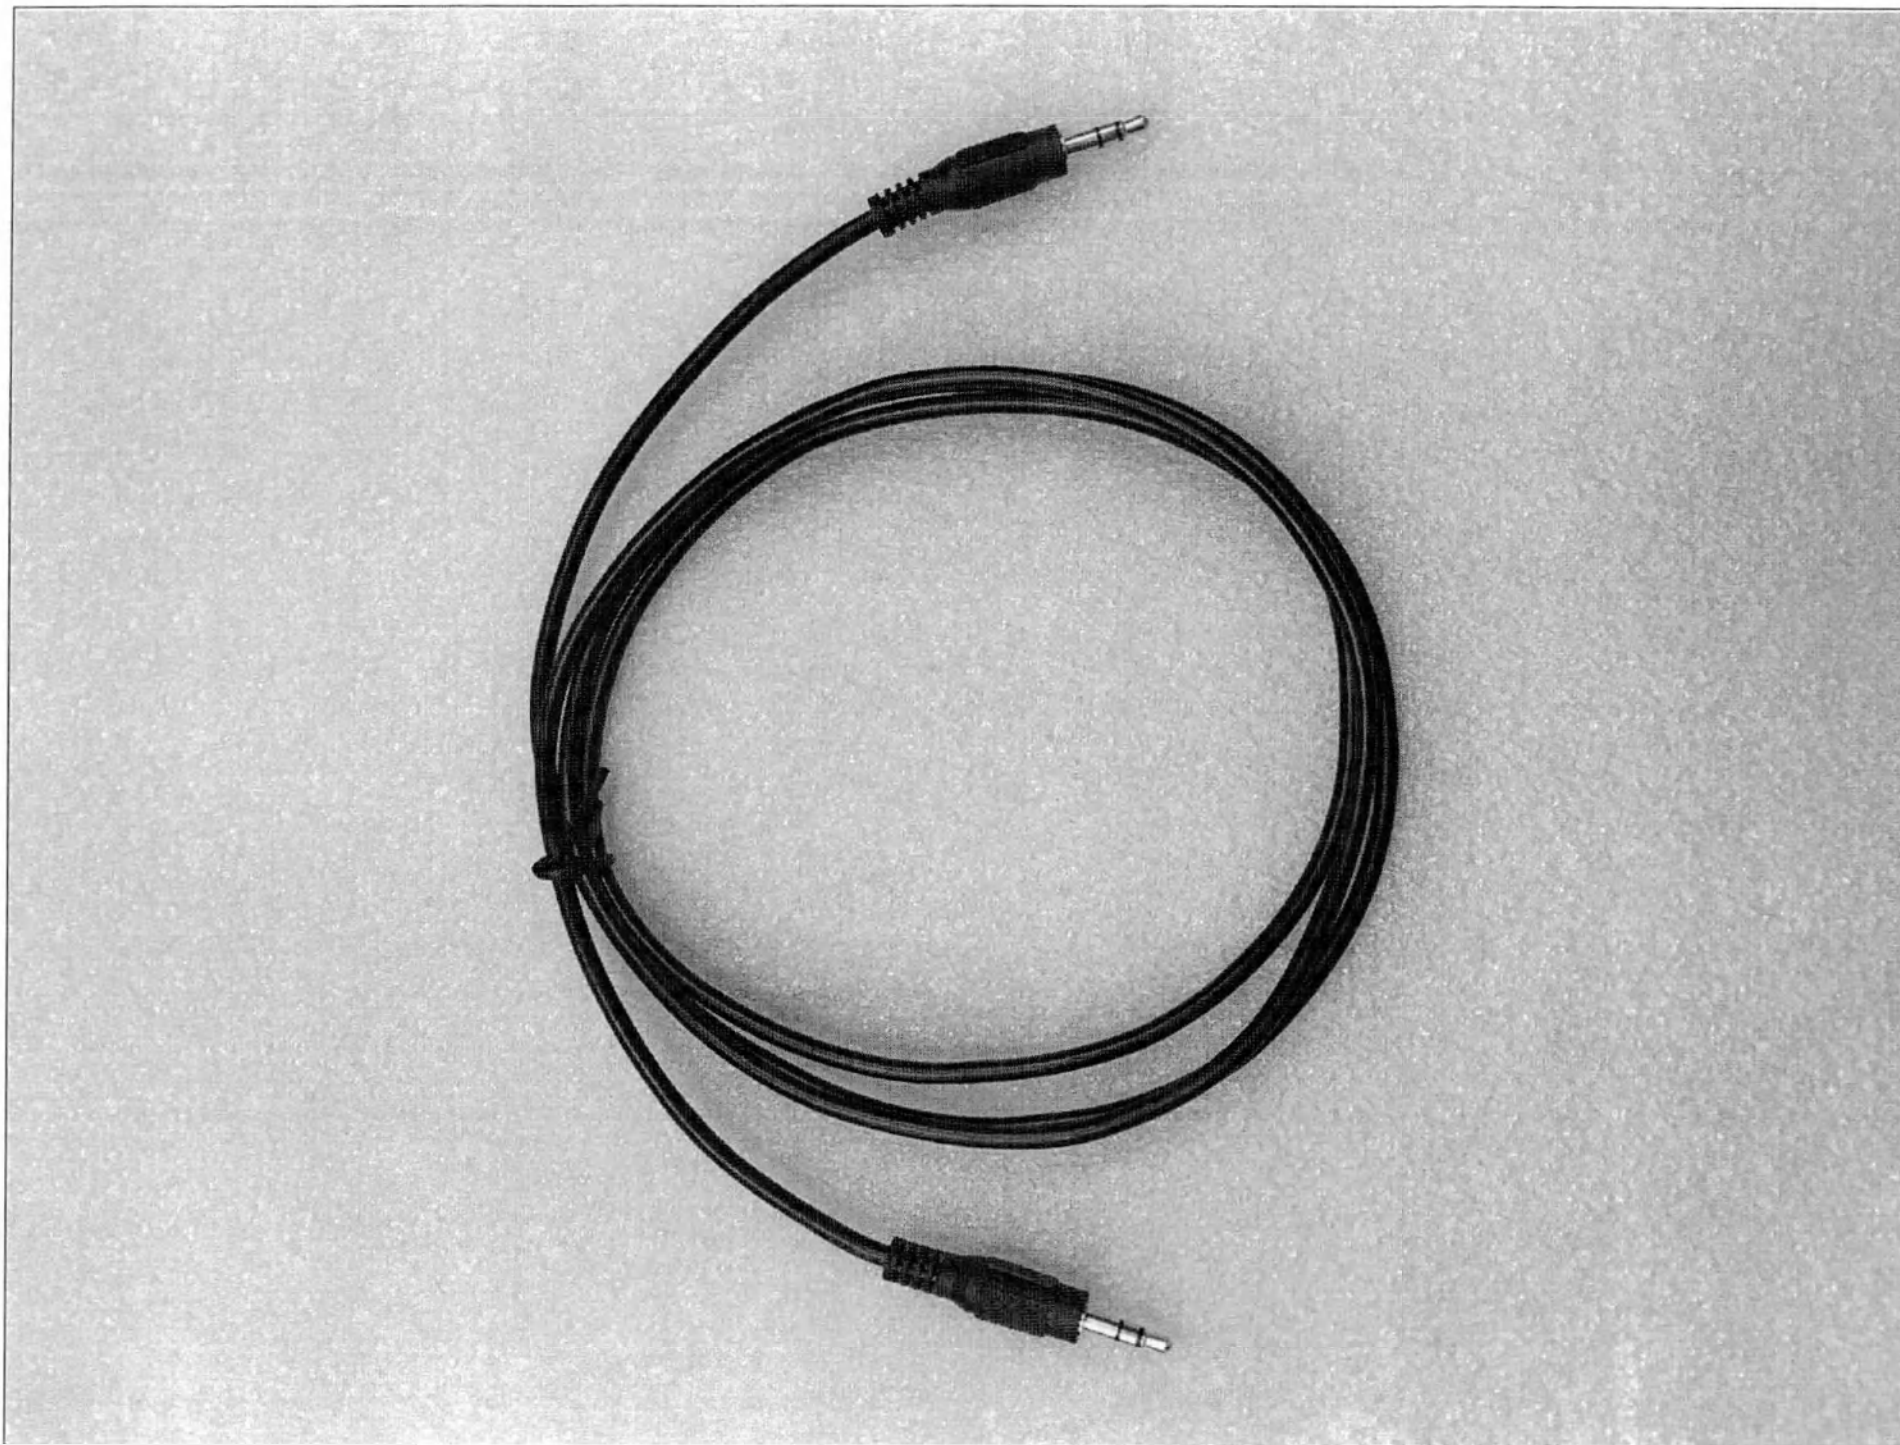


Подставка (при необходимости)

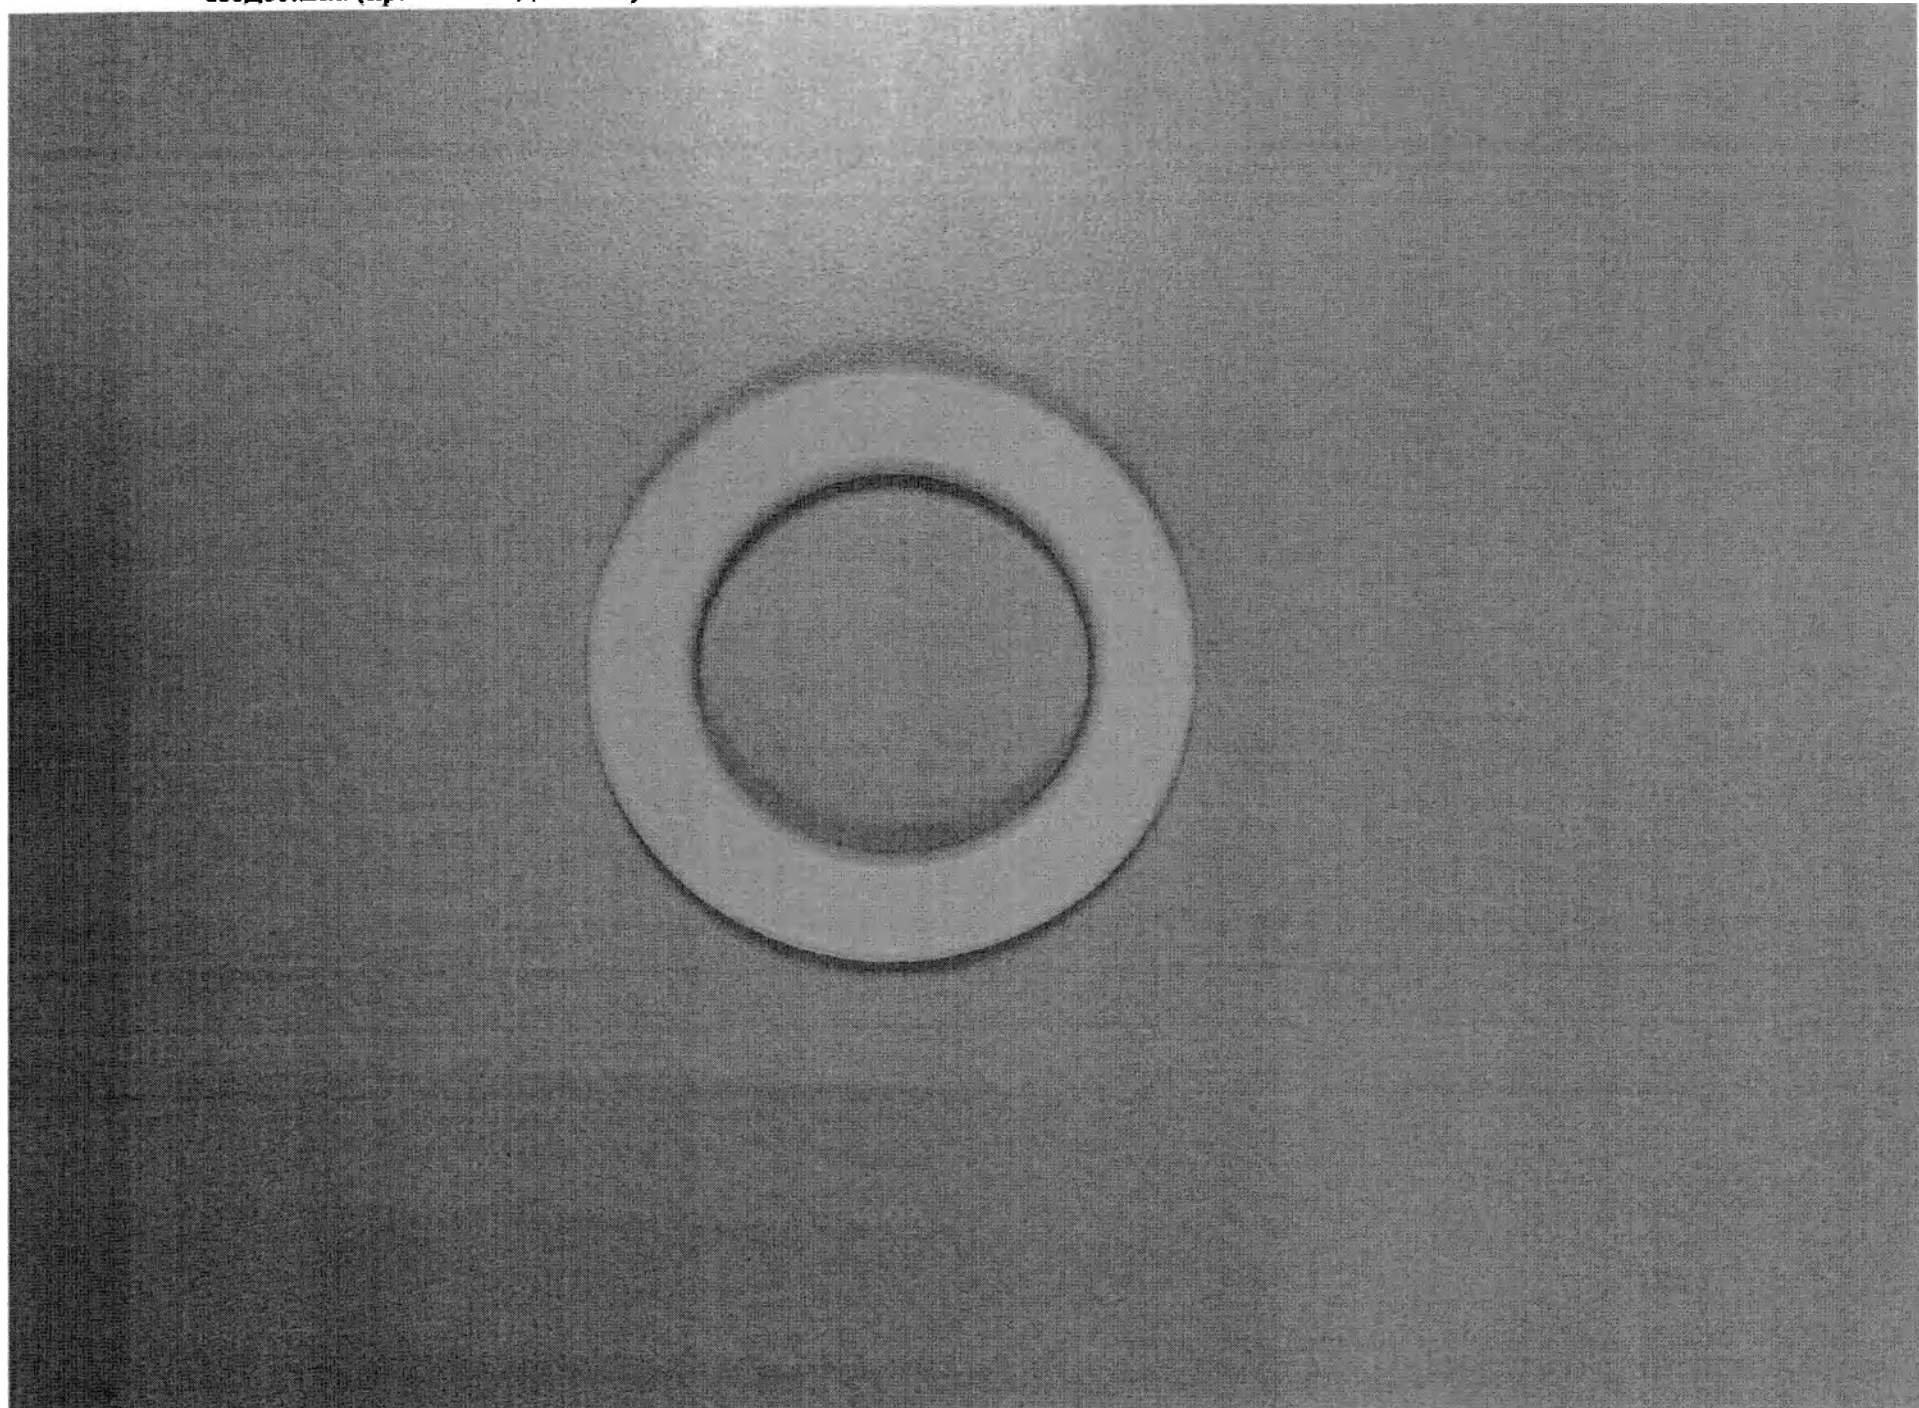


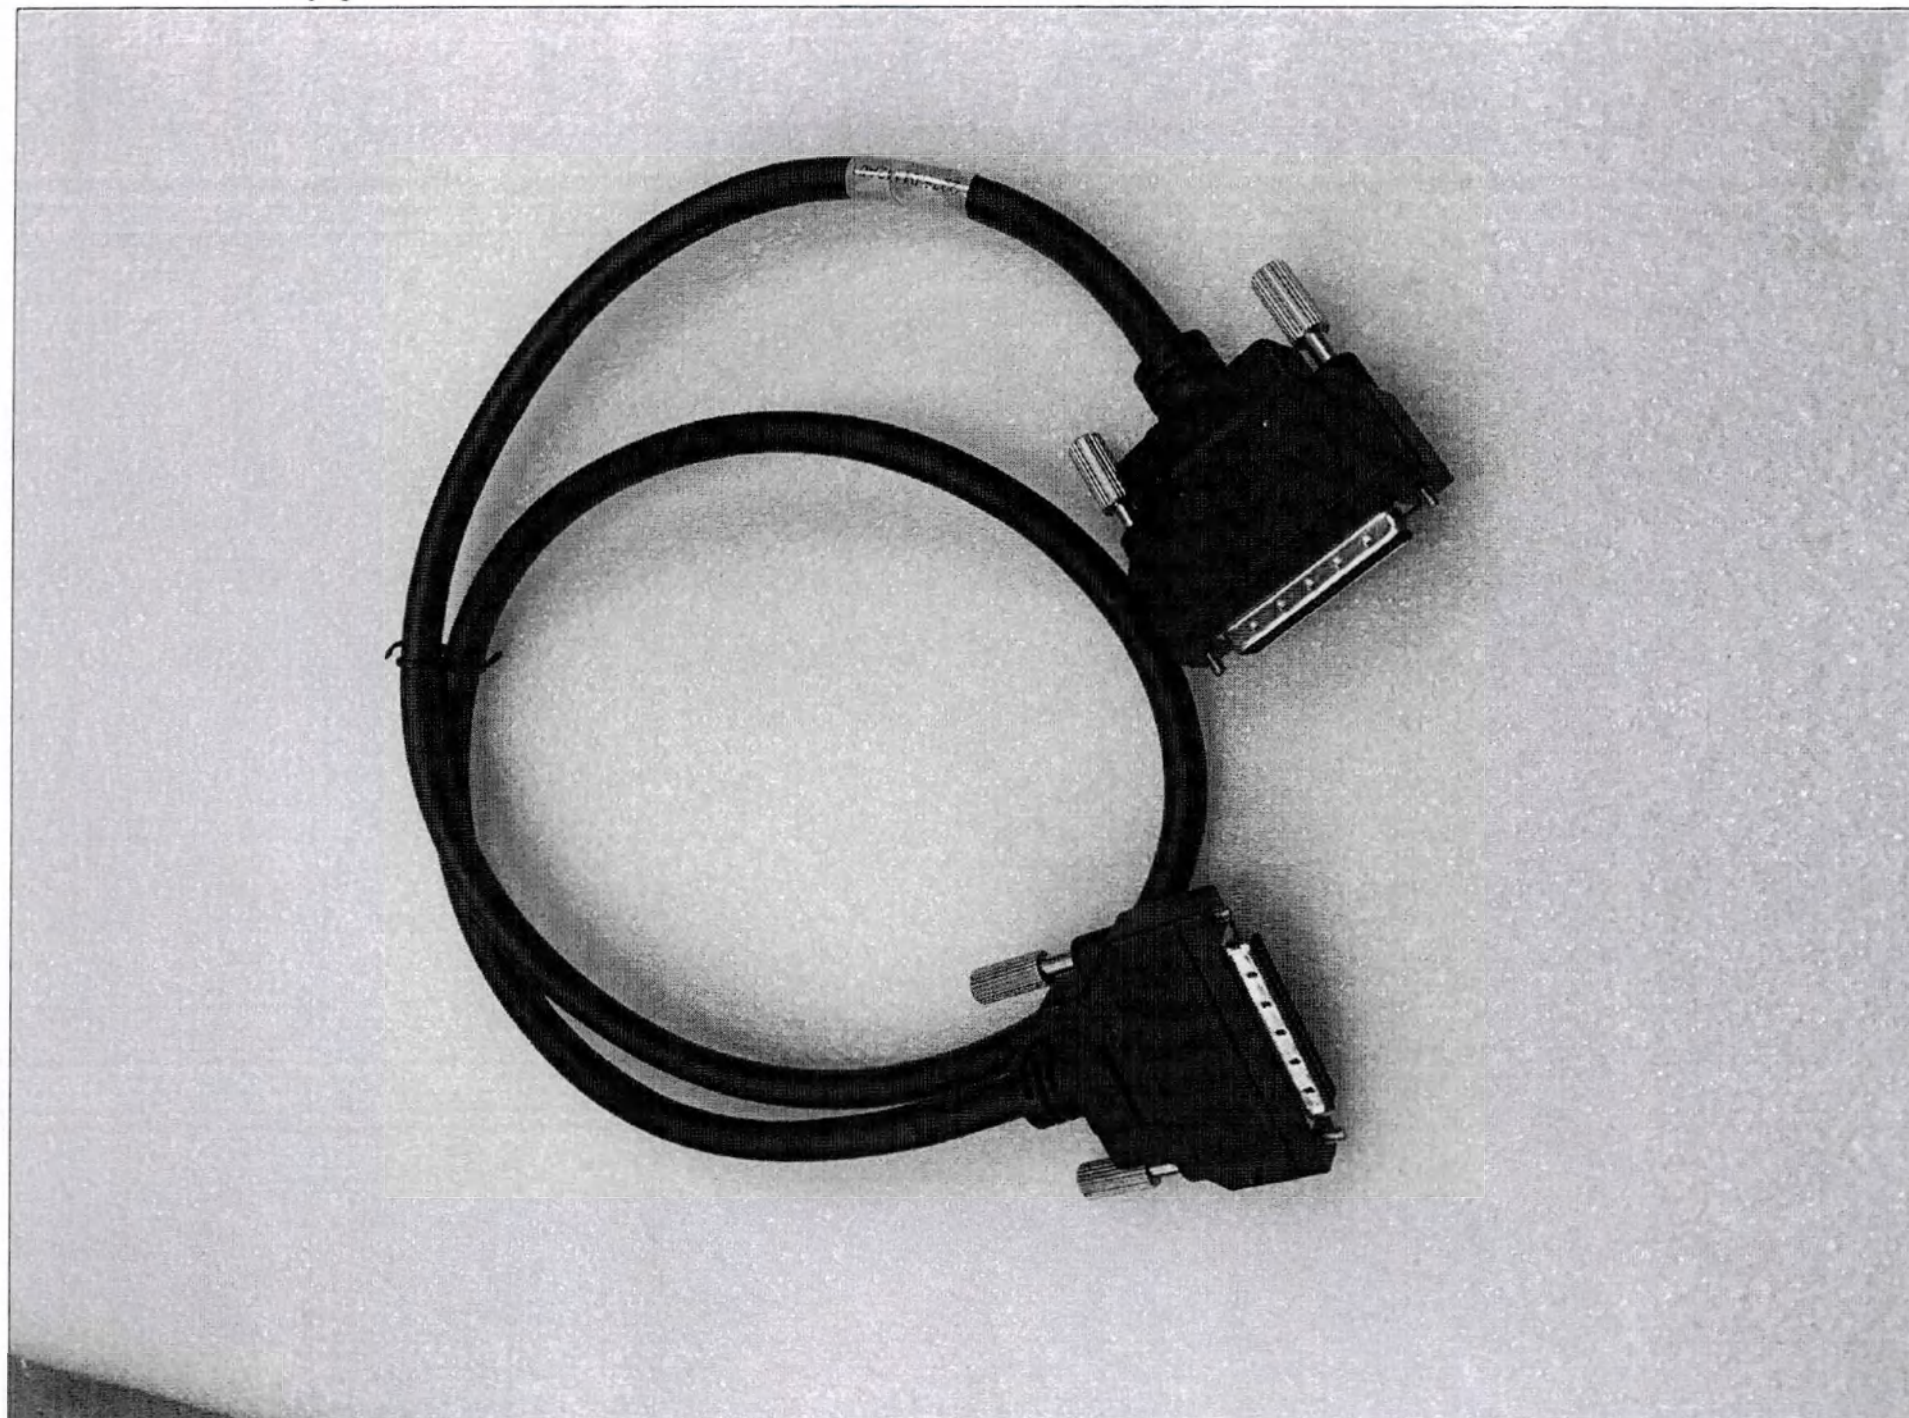

II. Видеогастроскоп

Видеогастроскоп: EG-550; EG-550L

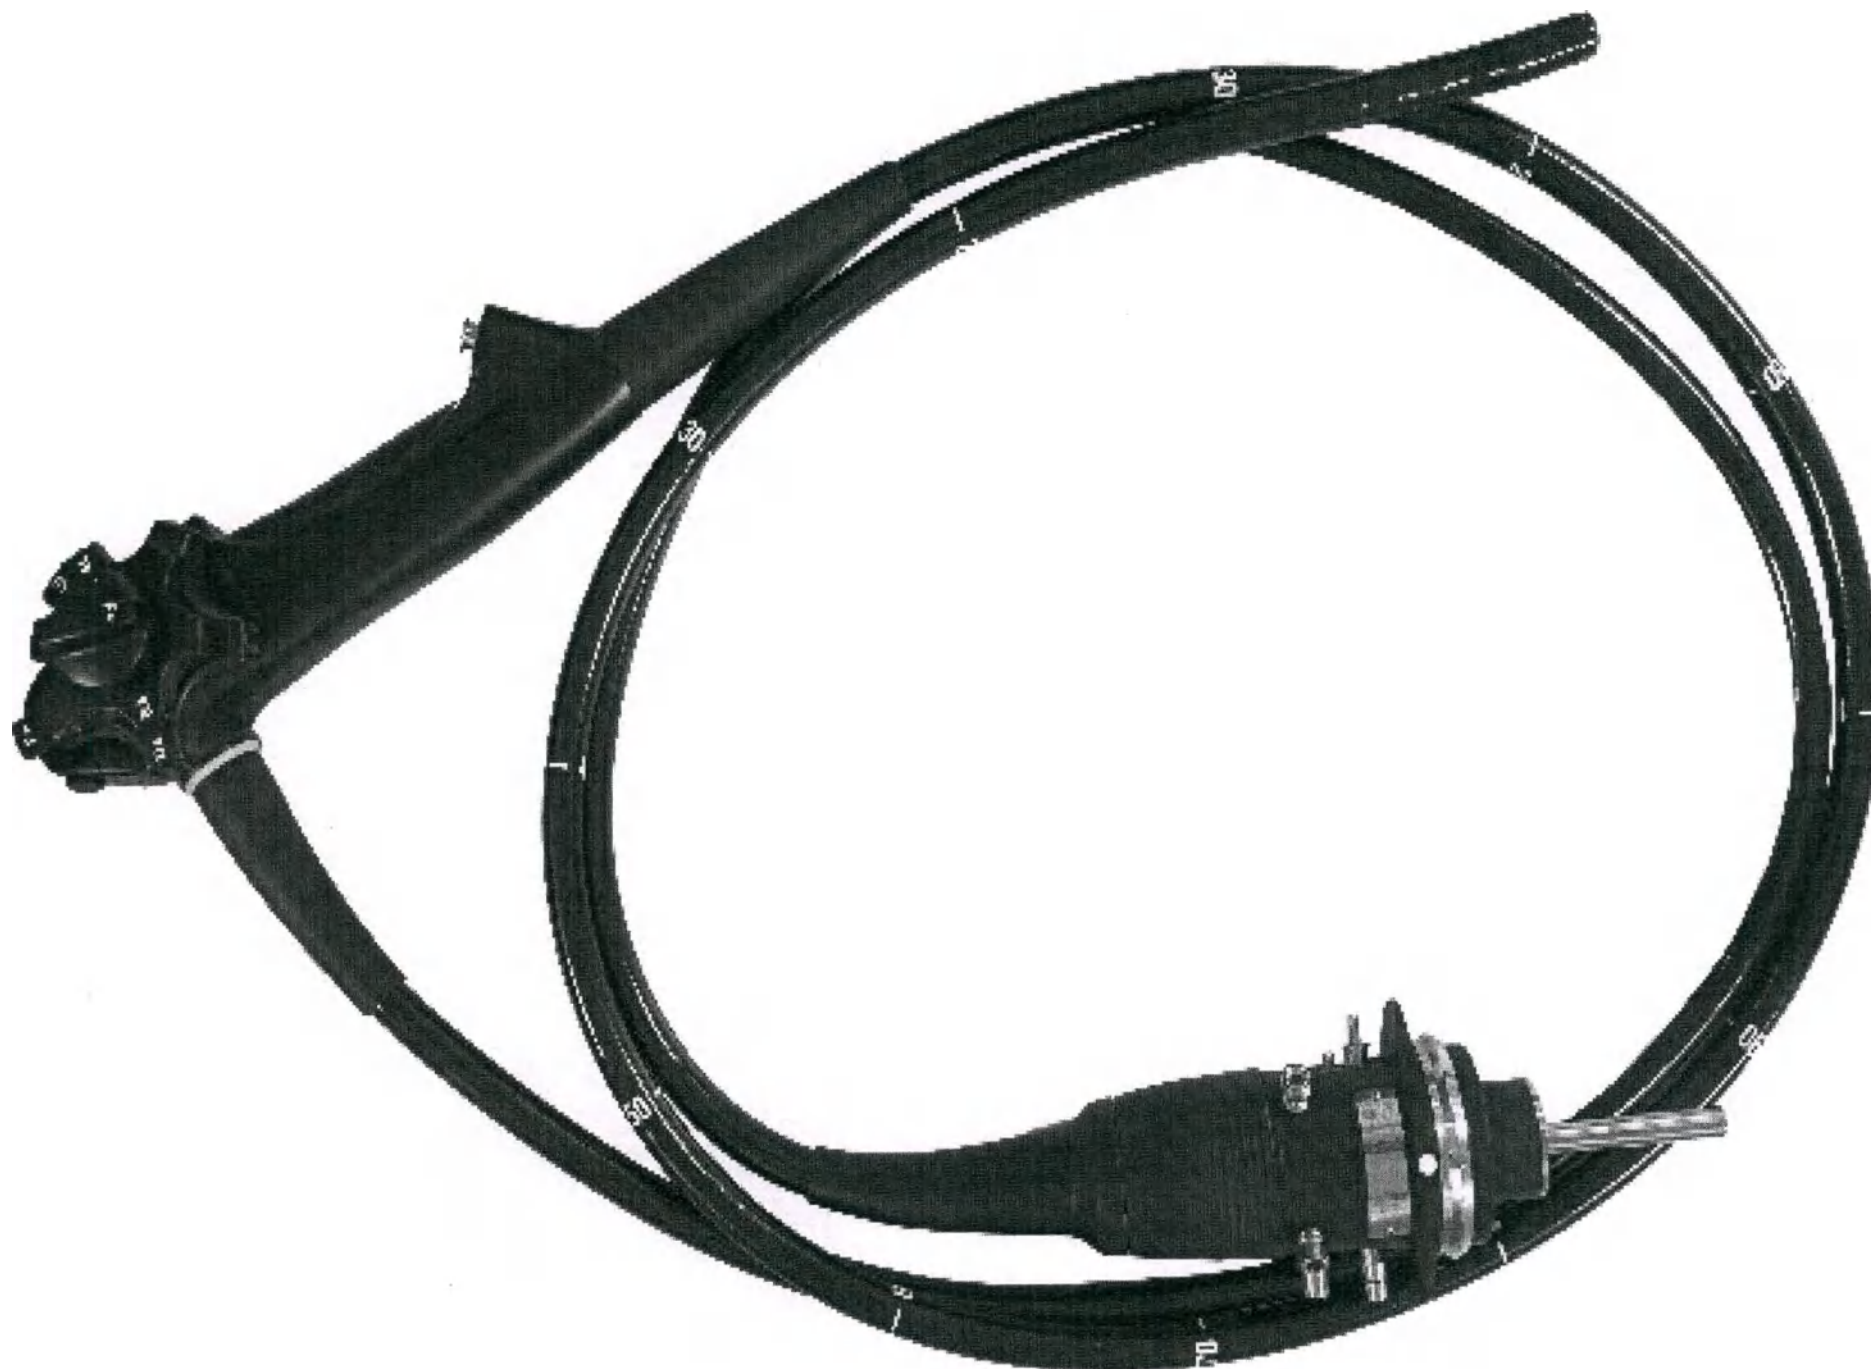


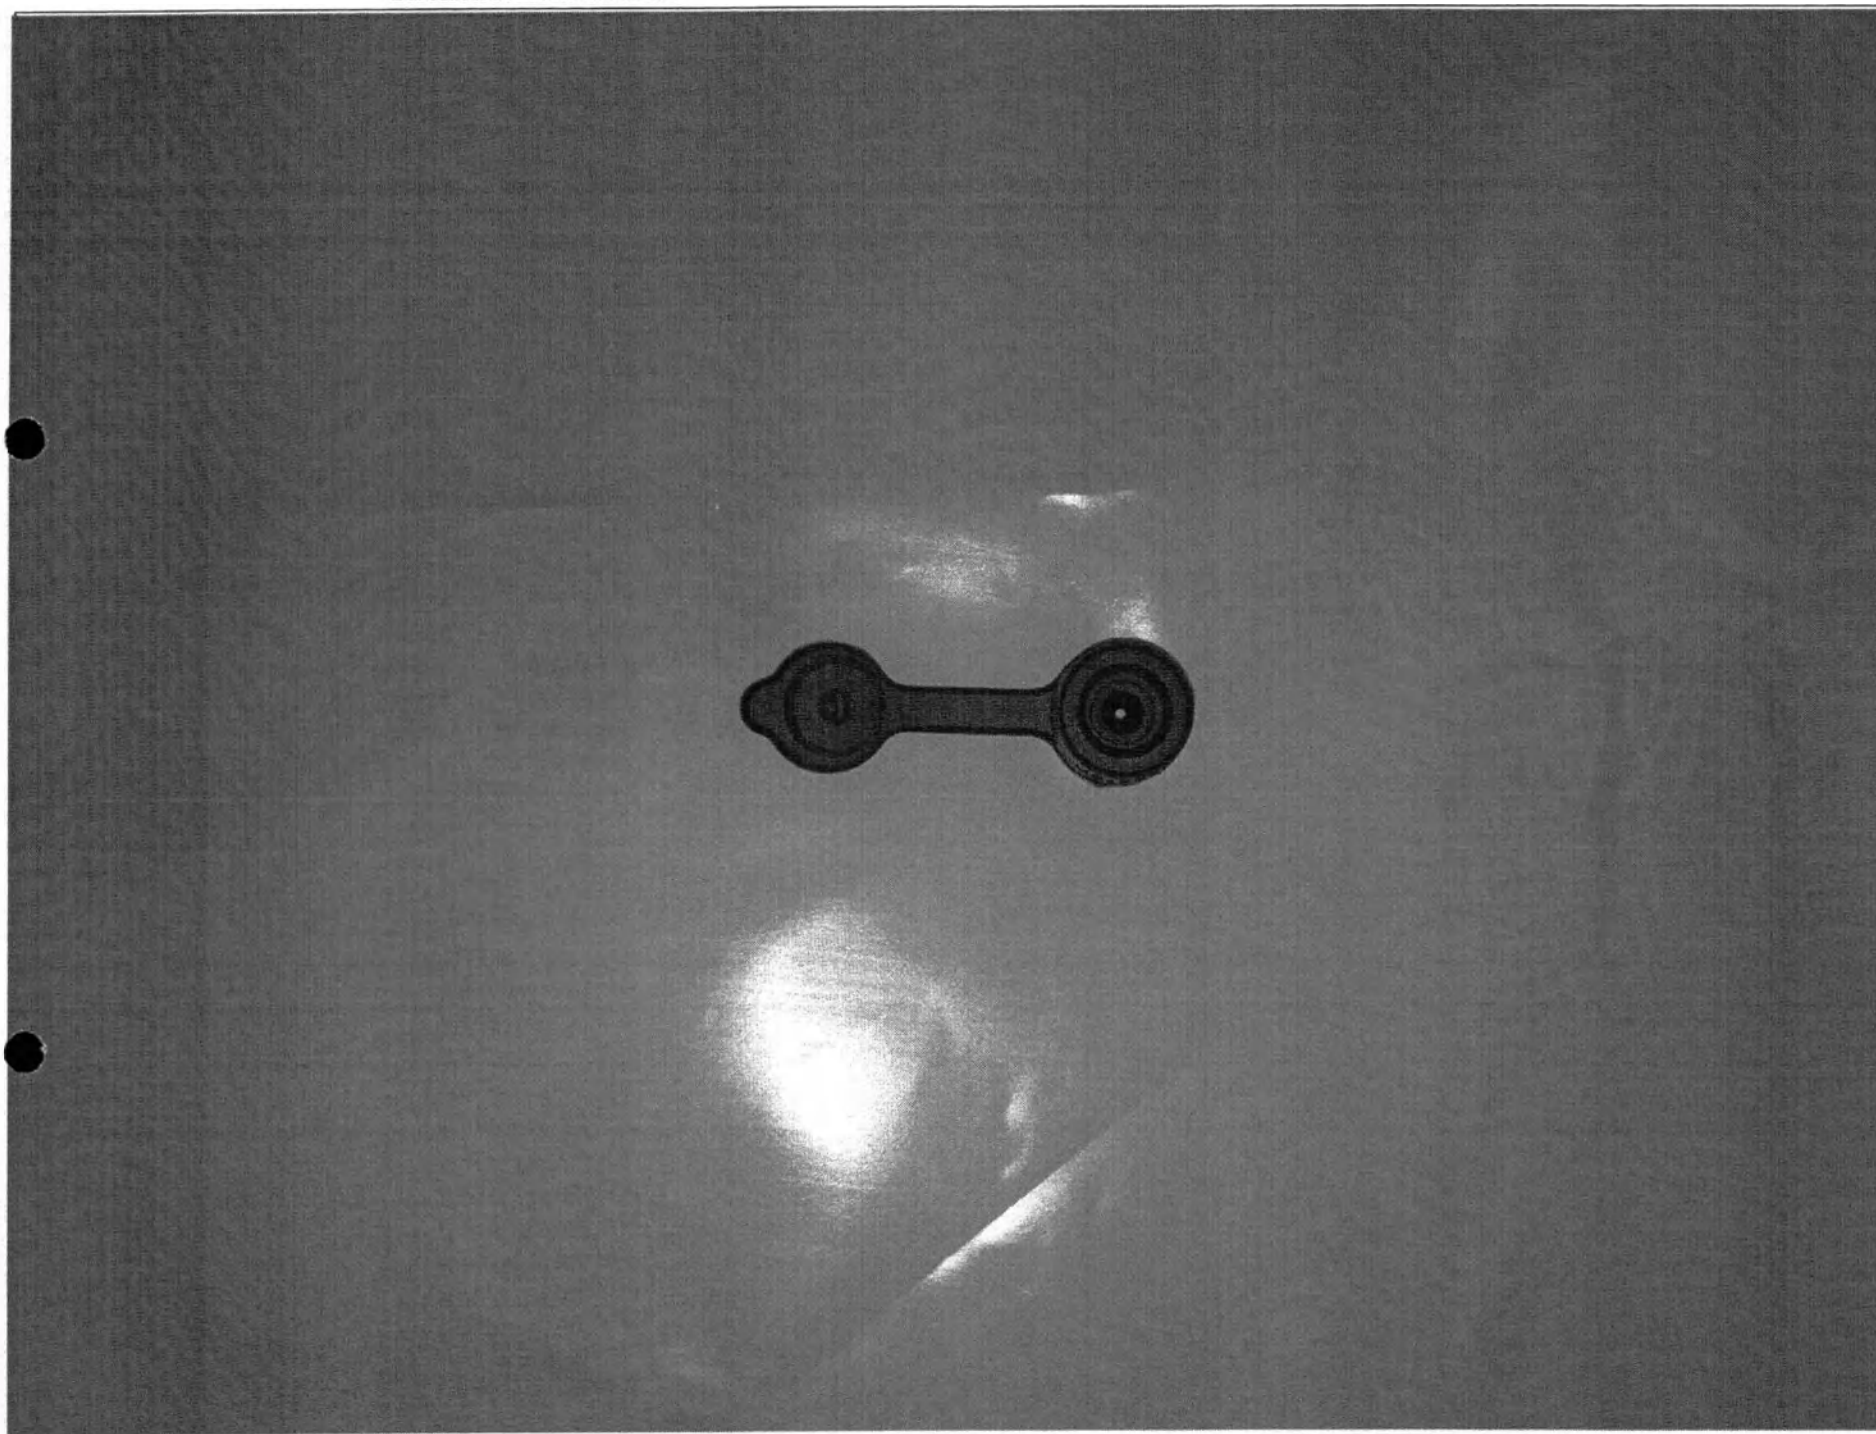


Щетка для очистки




Щетка для очистки гнезда клапана: вода-воздух, аспирационного и биопсийного

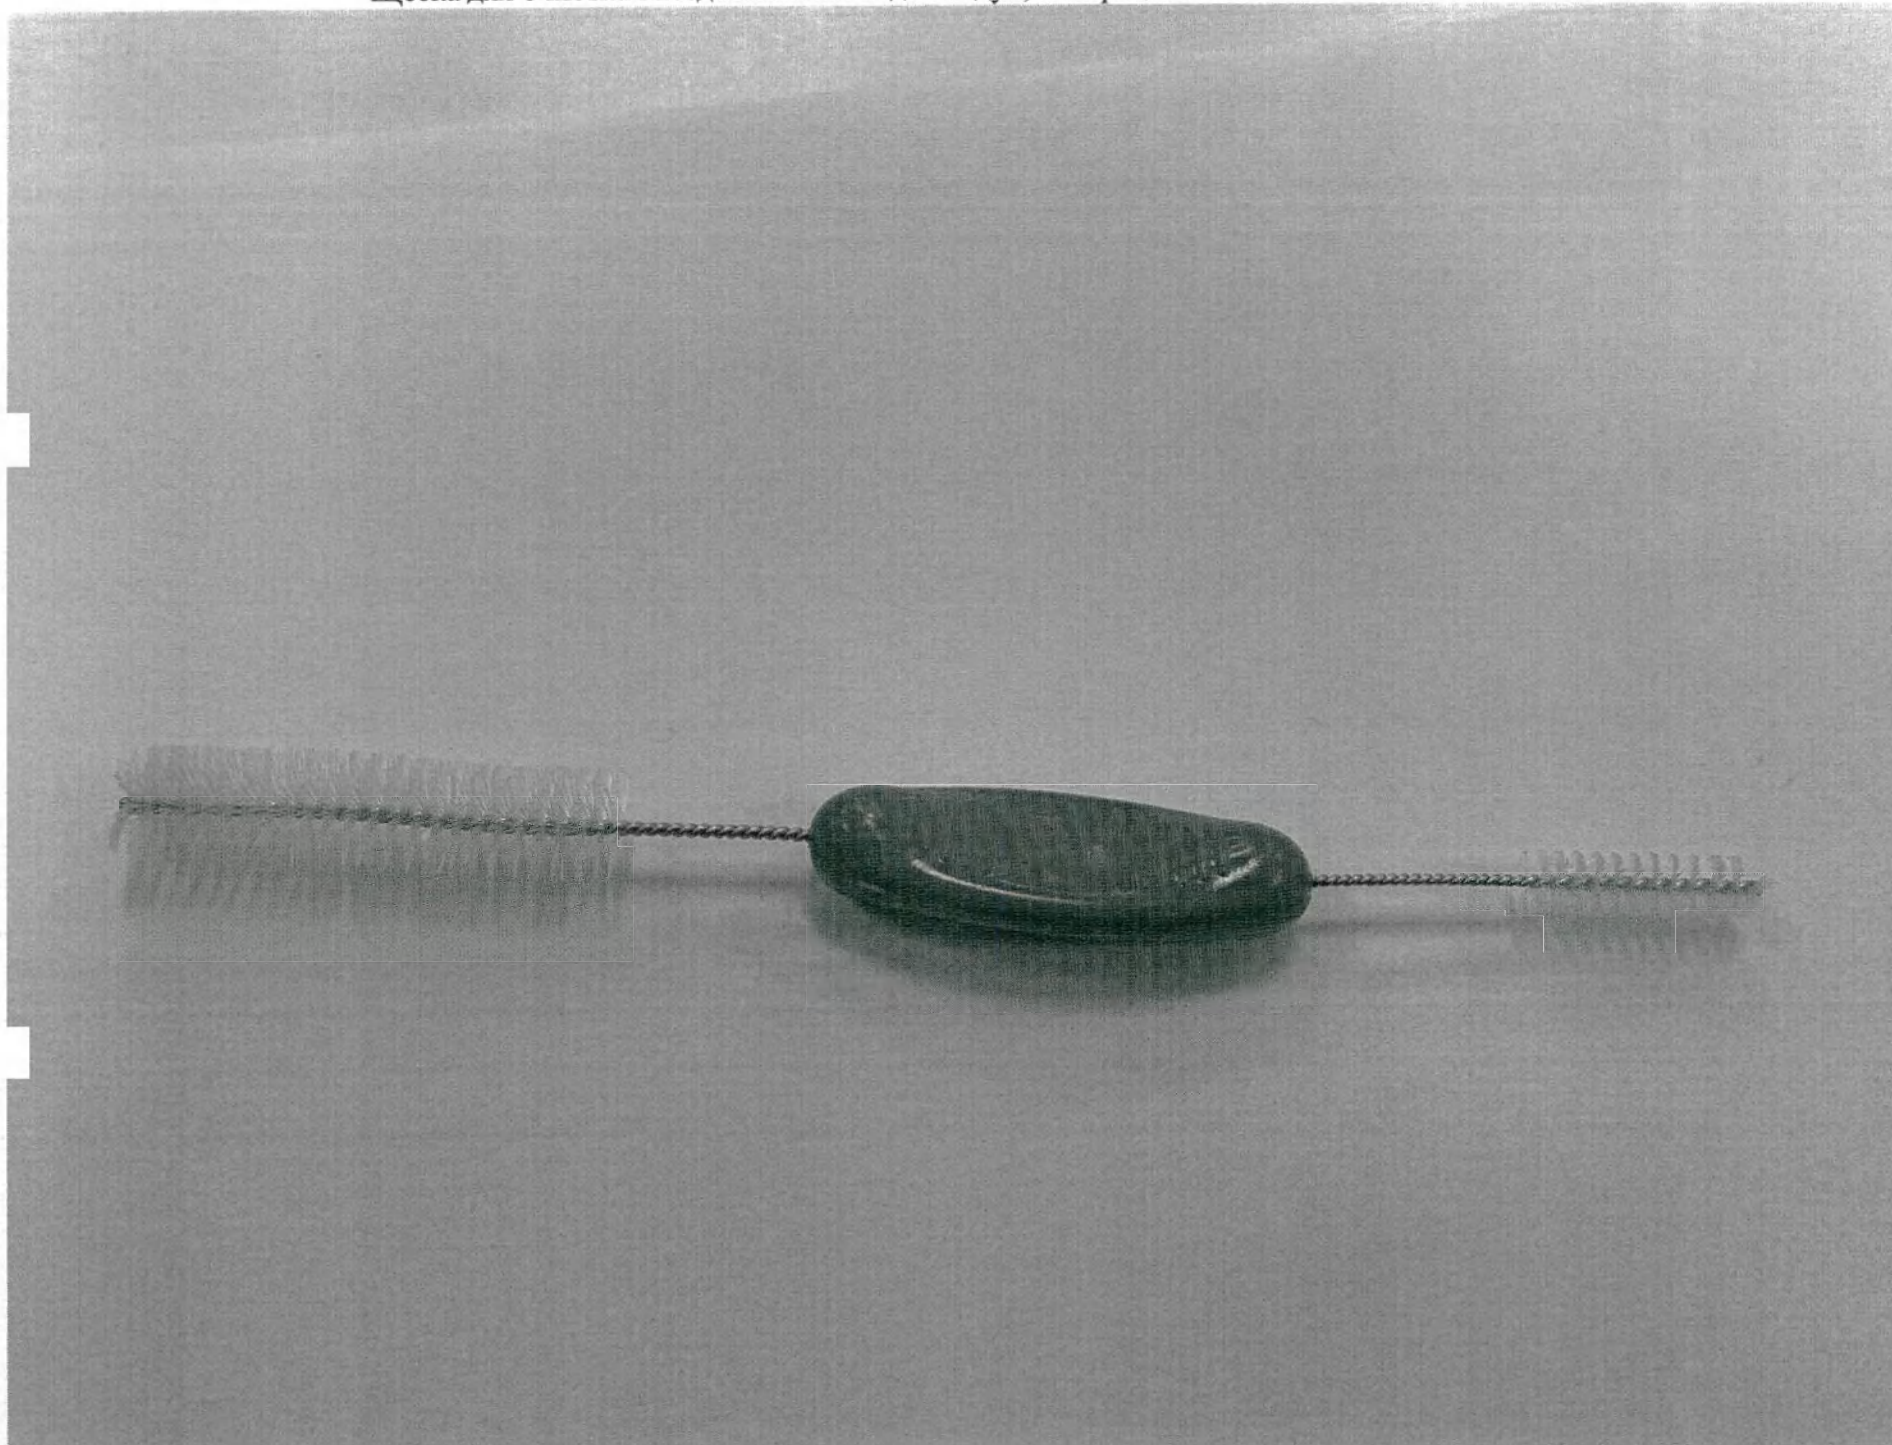

Теченскатель

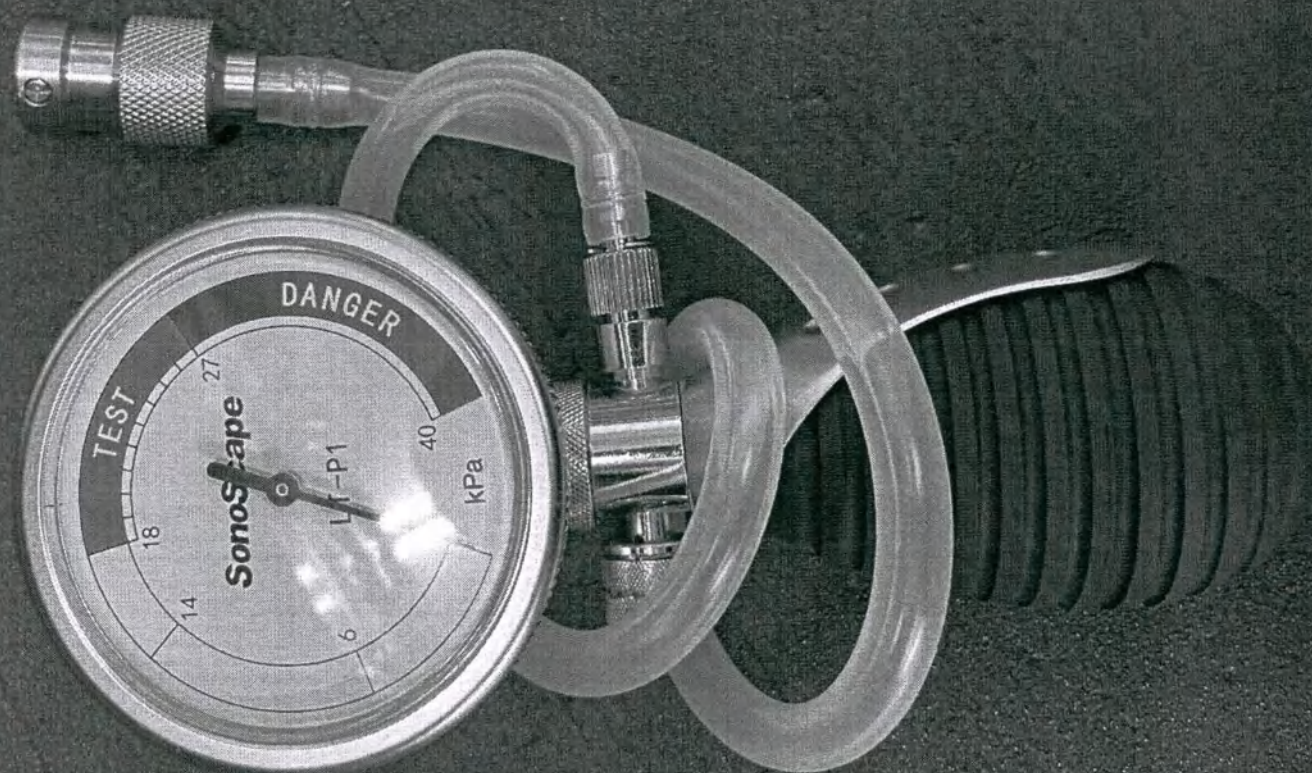


Шприц, 30 мл (при необходимости)

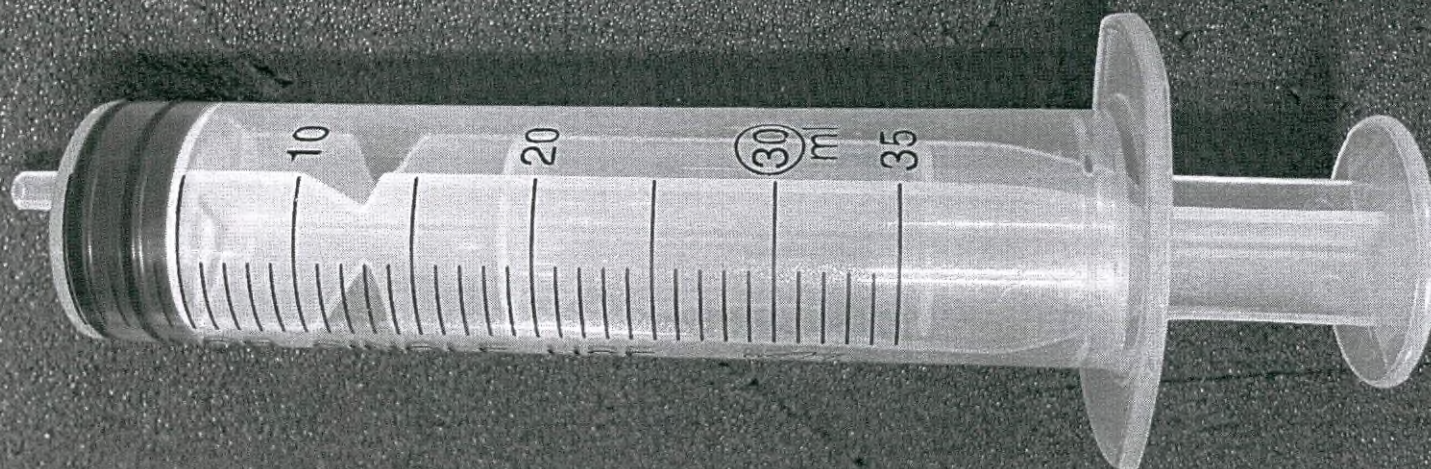

Заглушка ирригационного канала



Резиновый колпачок дистального конца

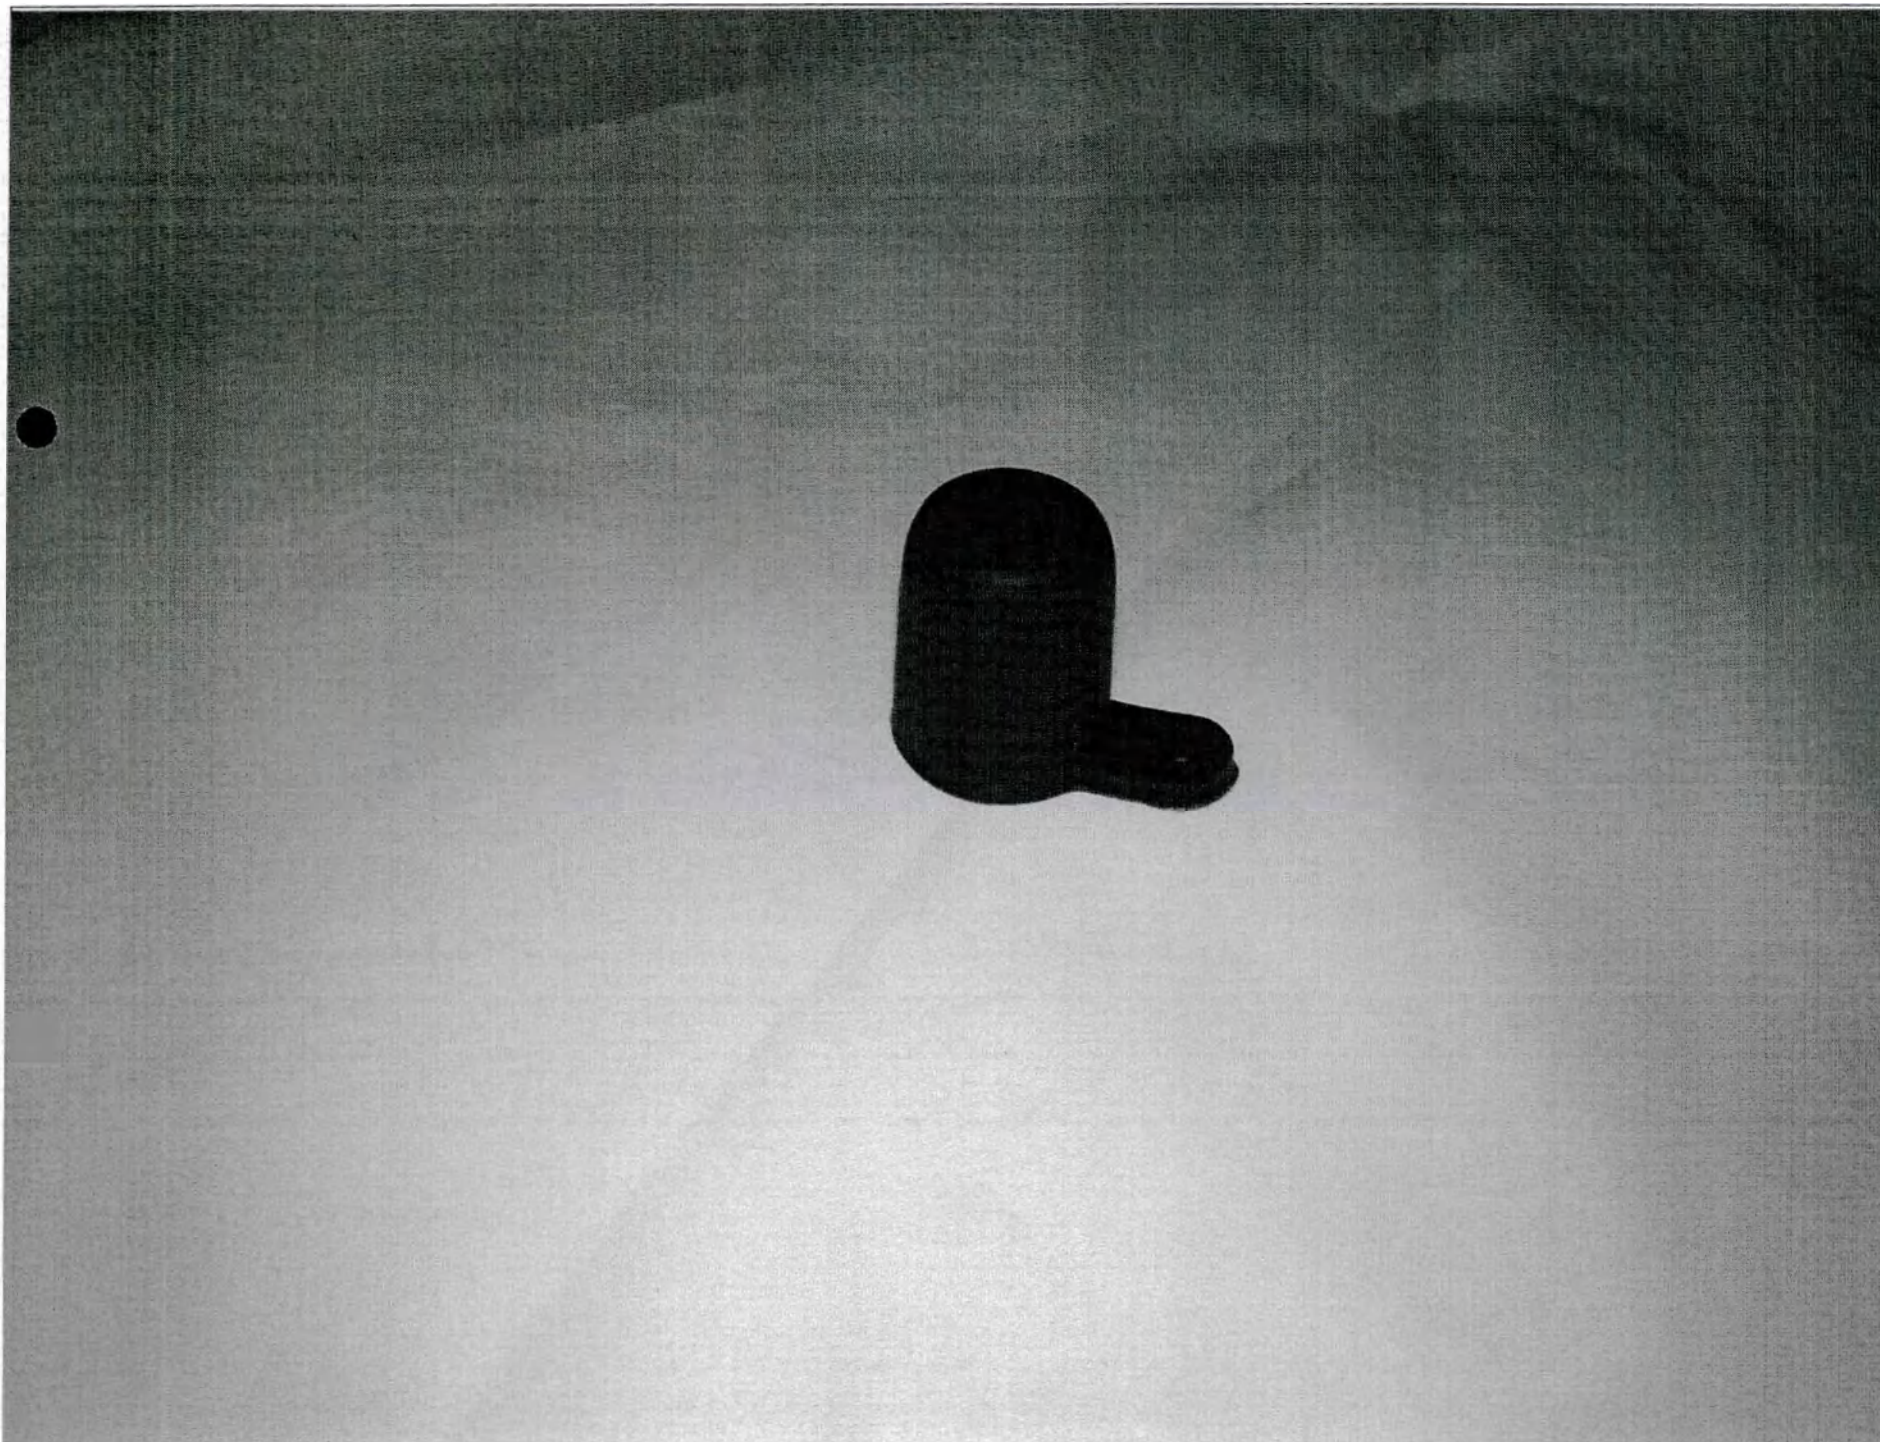

Воздушный/водяной клапан



Клапан аспирации




Бутыль для воды




Комплект для ручной обработки эндоскопа:


- комплект заглушек для промывки

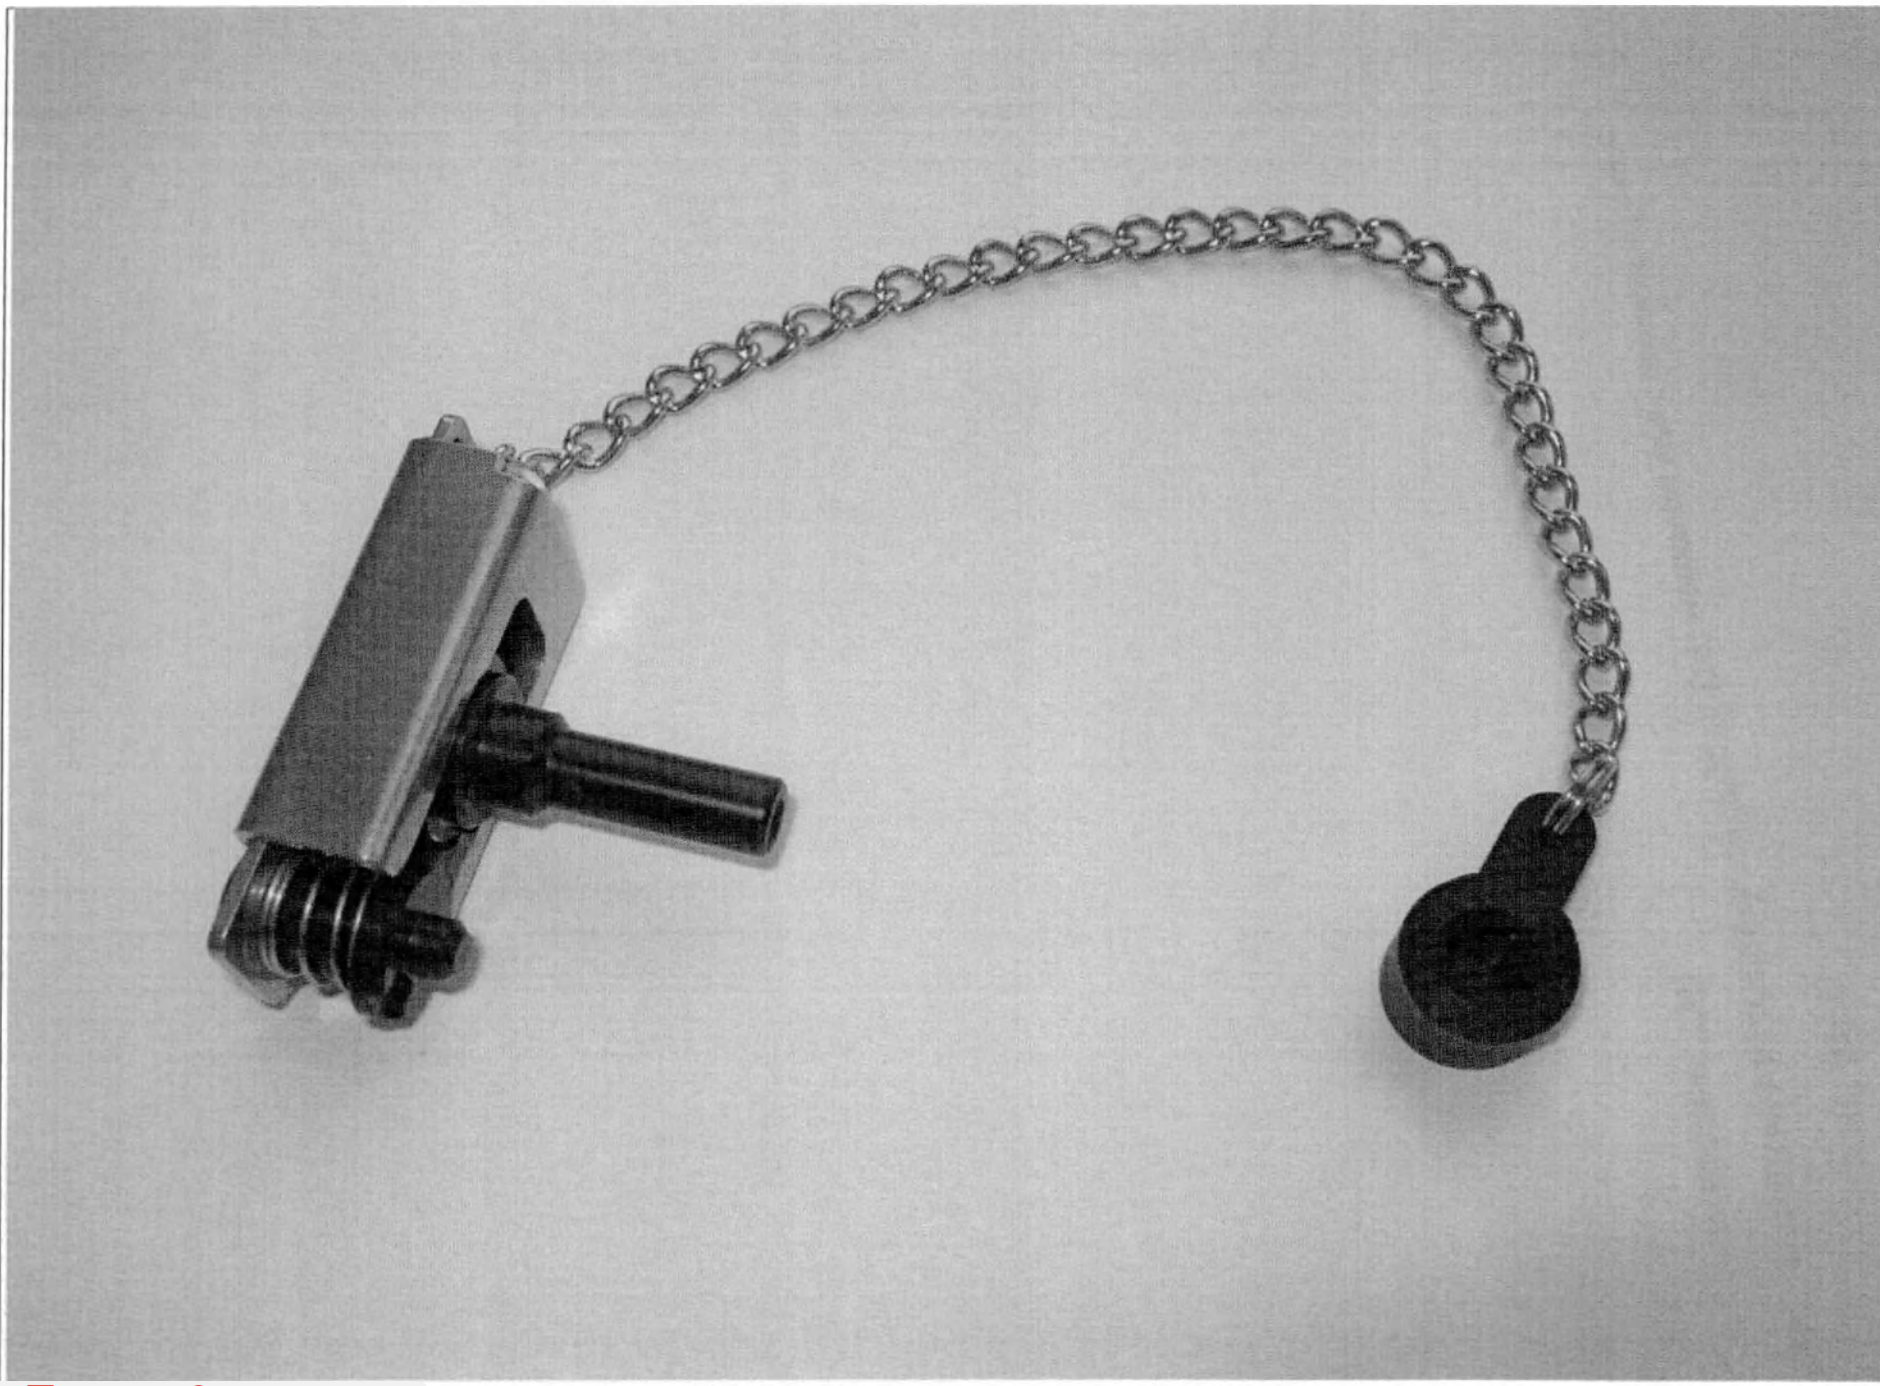


- система для промывки каналов

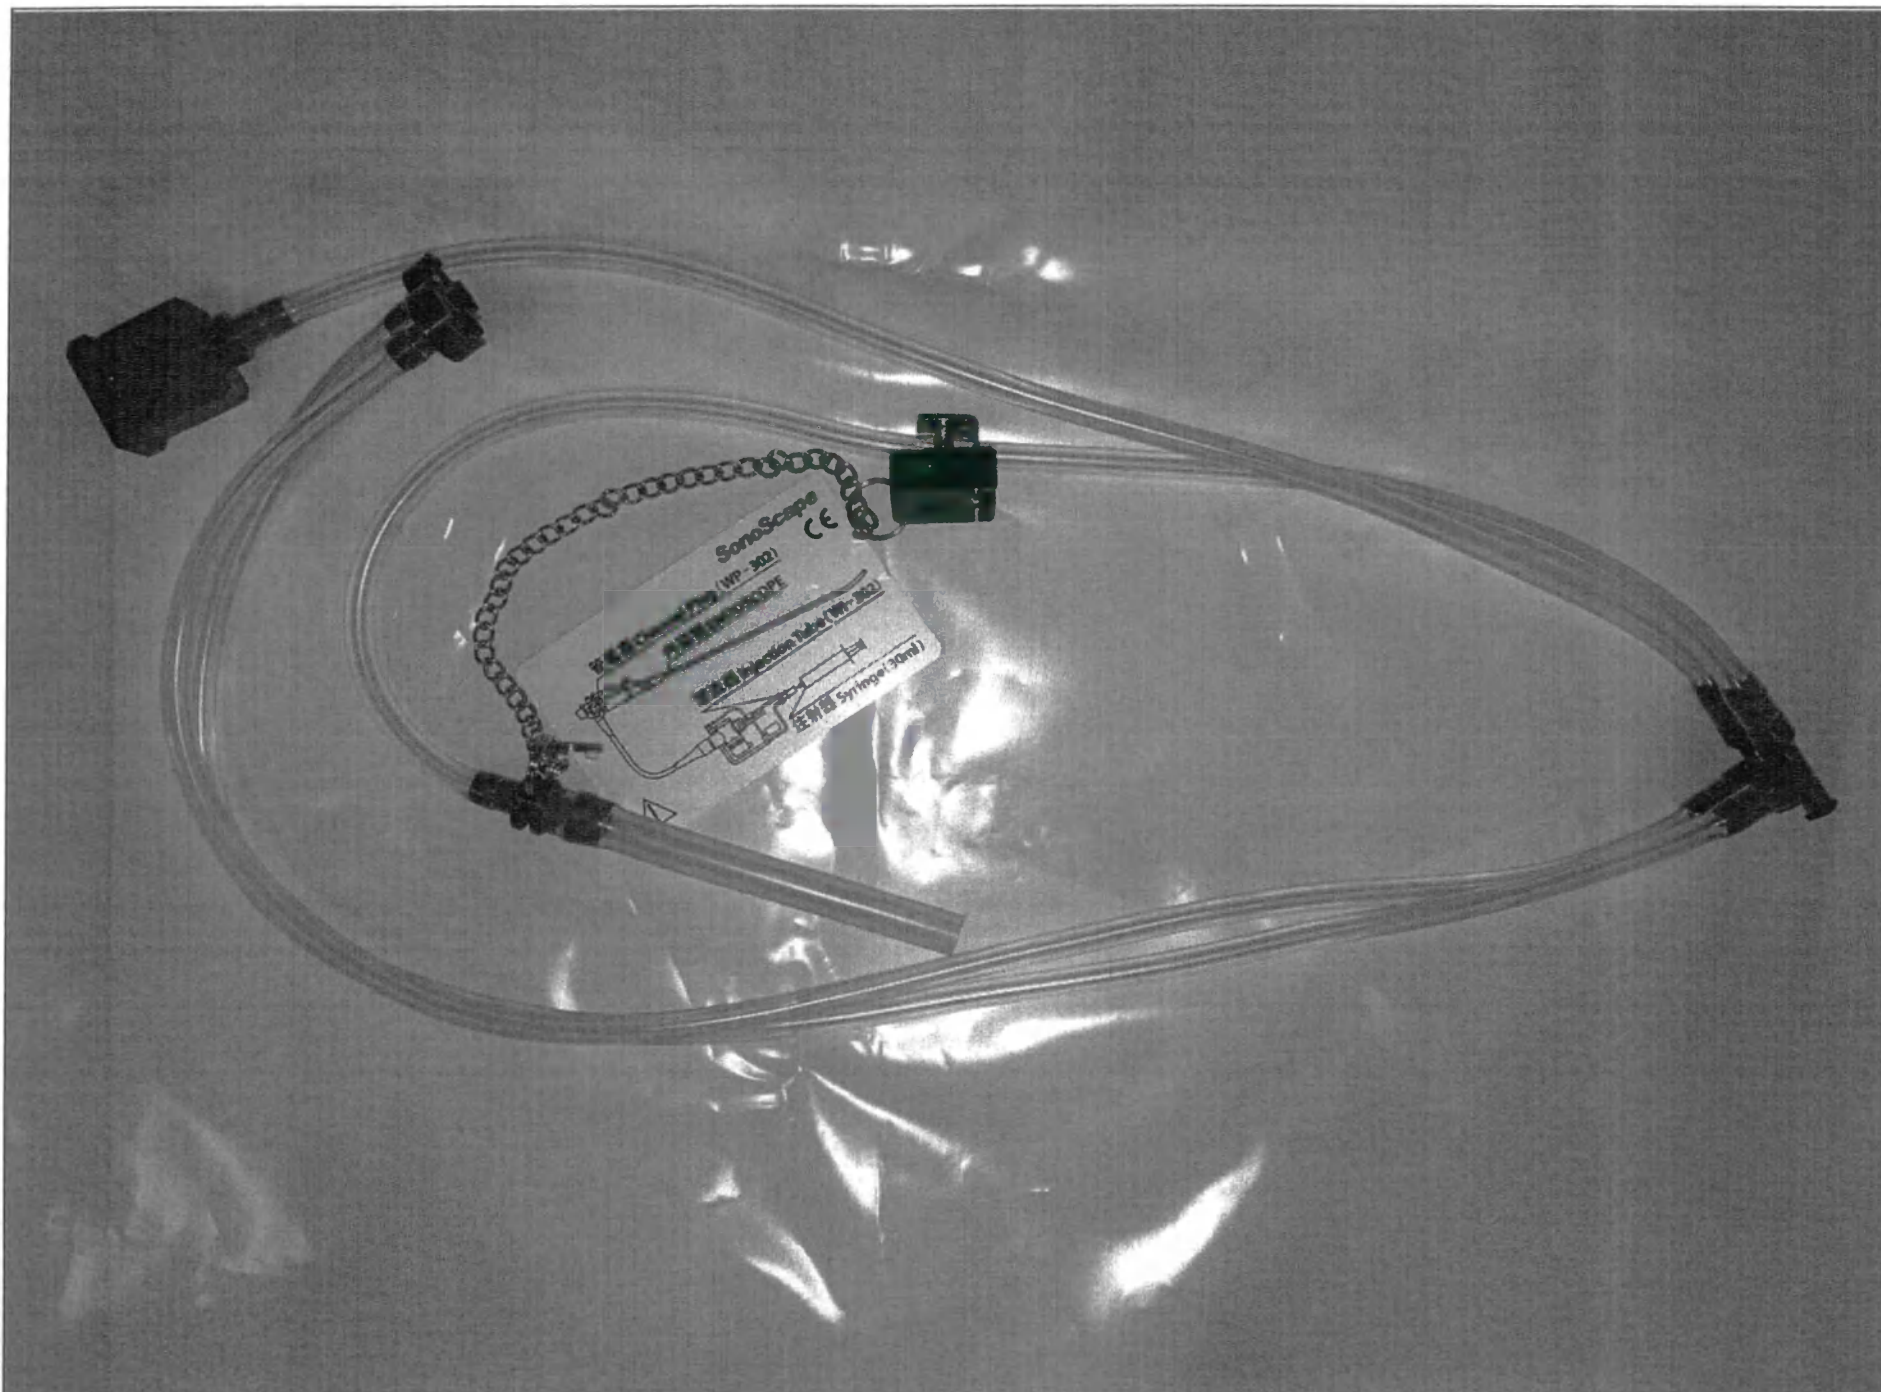


- трубка-адаптер для ирригационного канала (длинная)

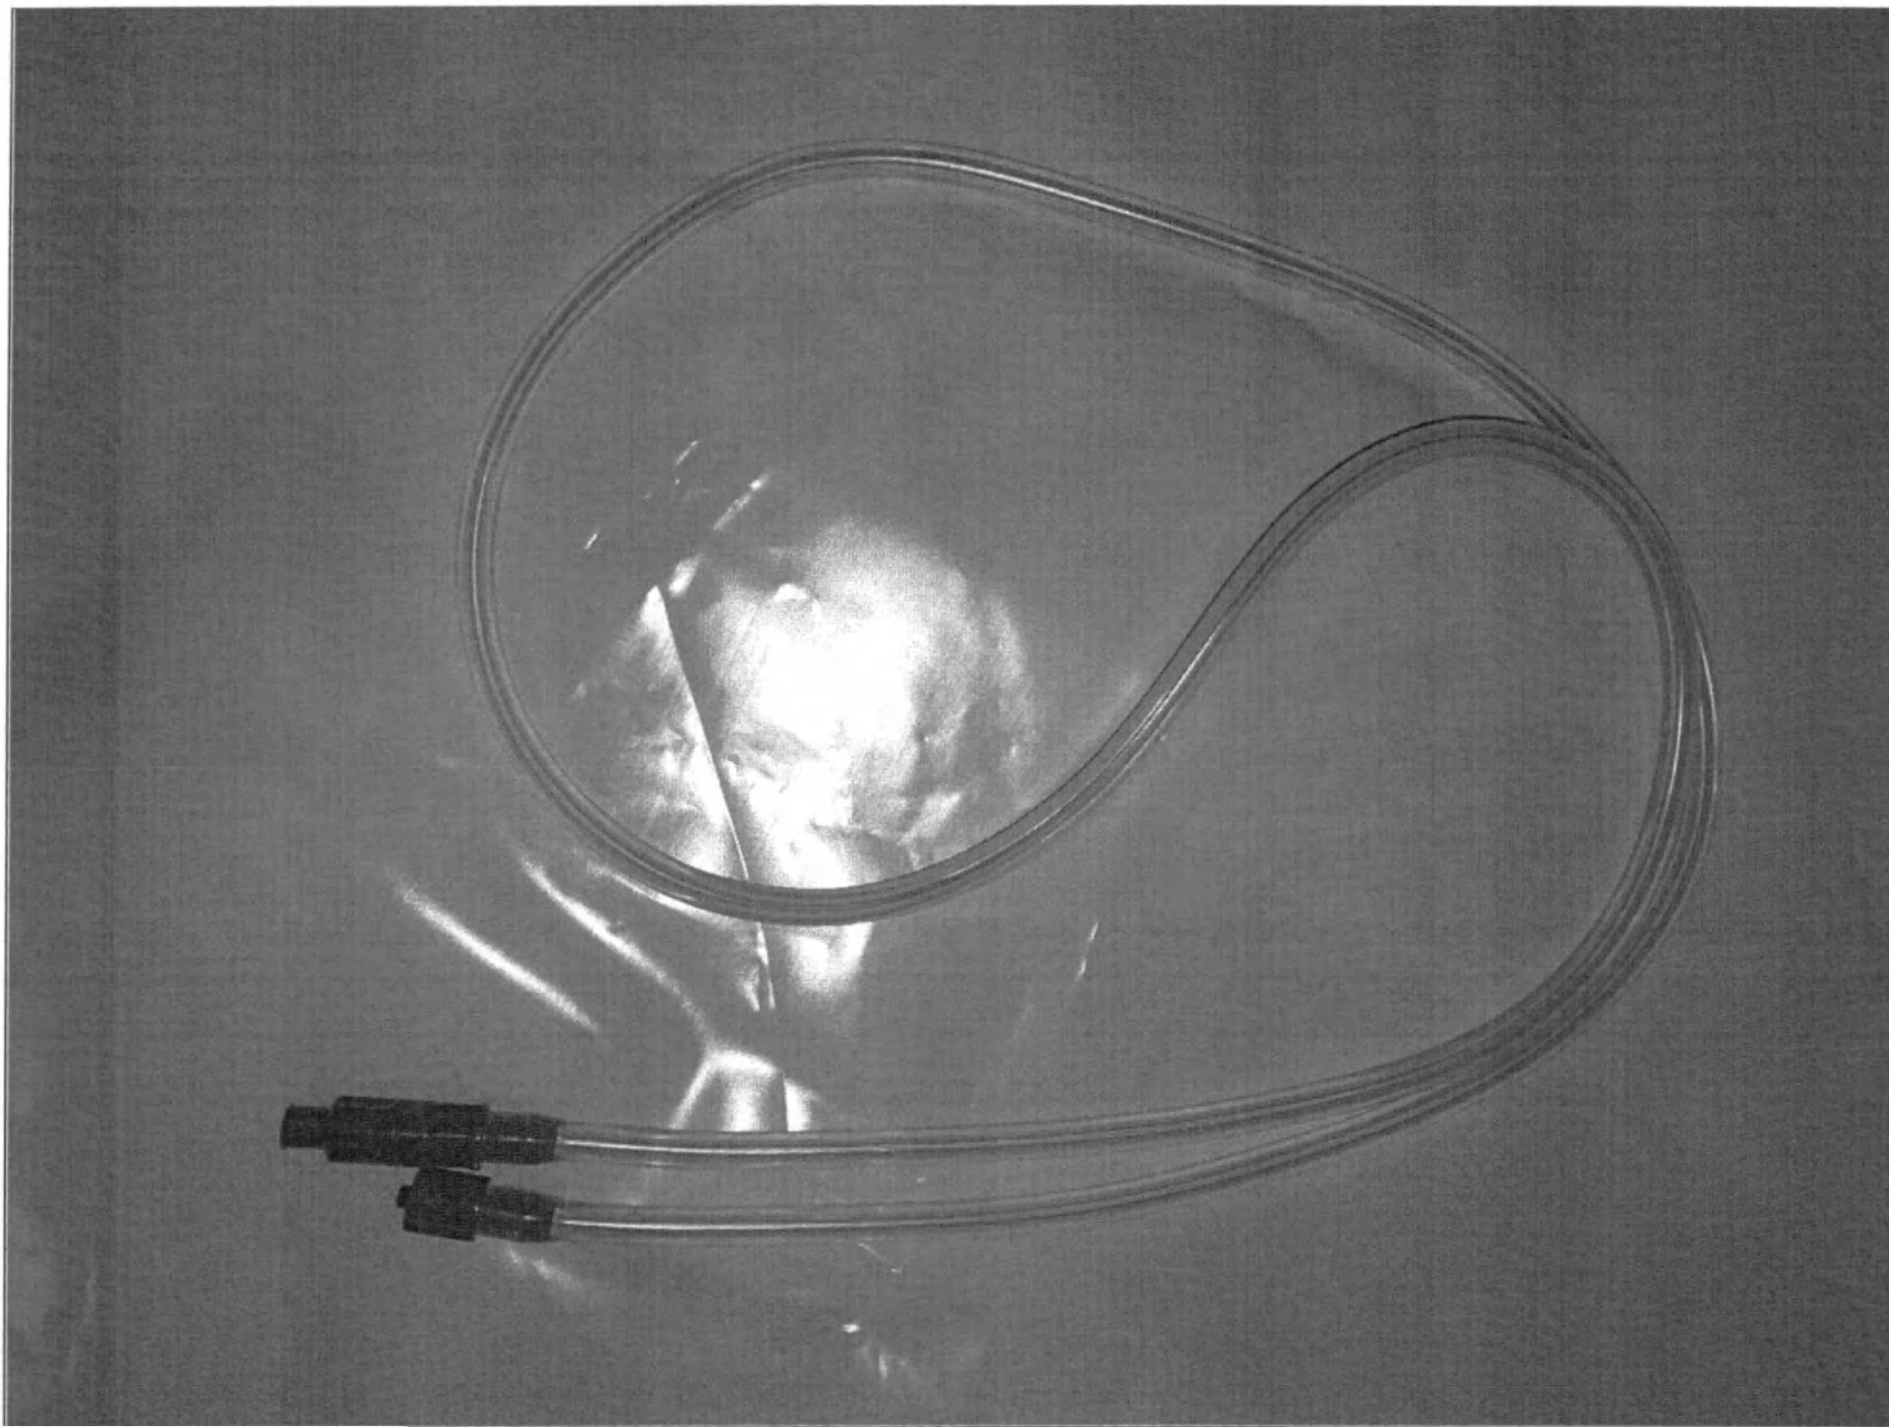


- трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая)

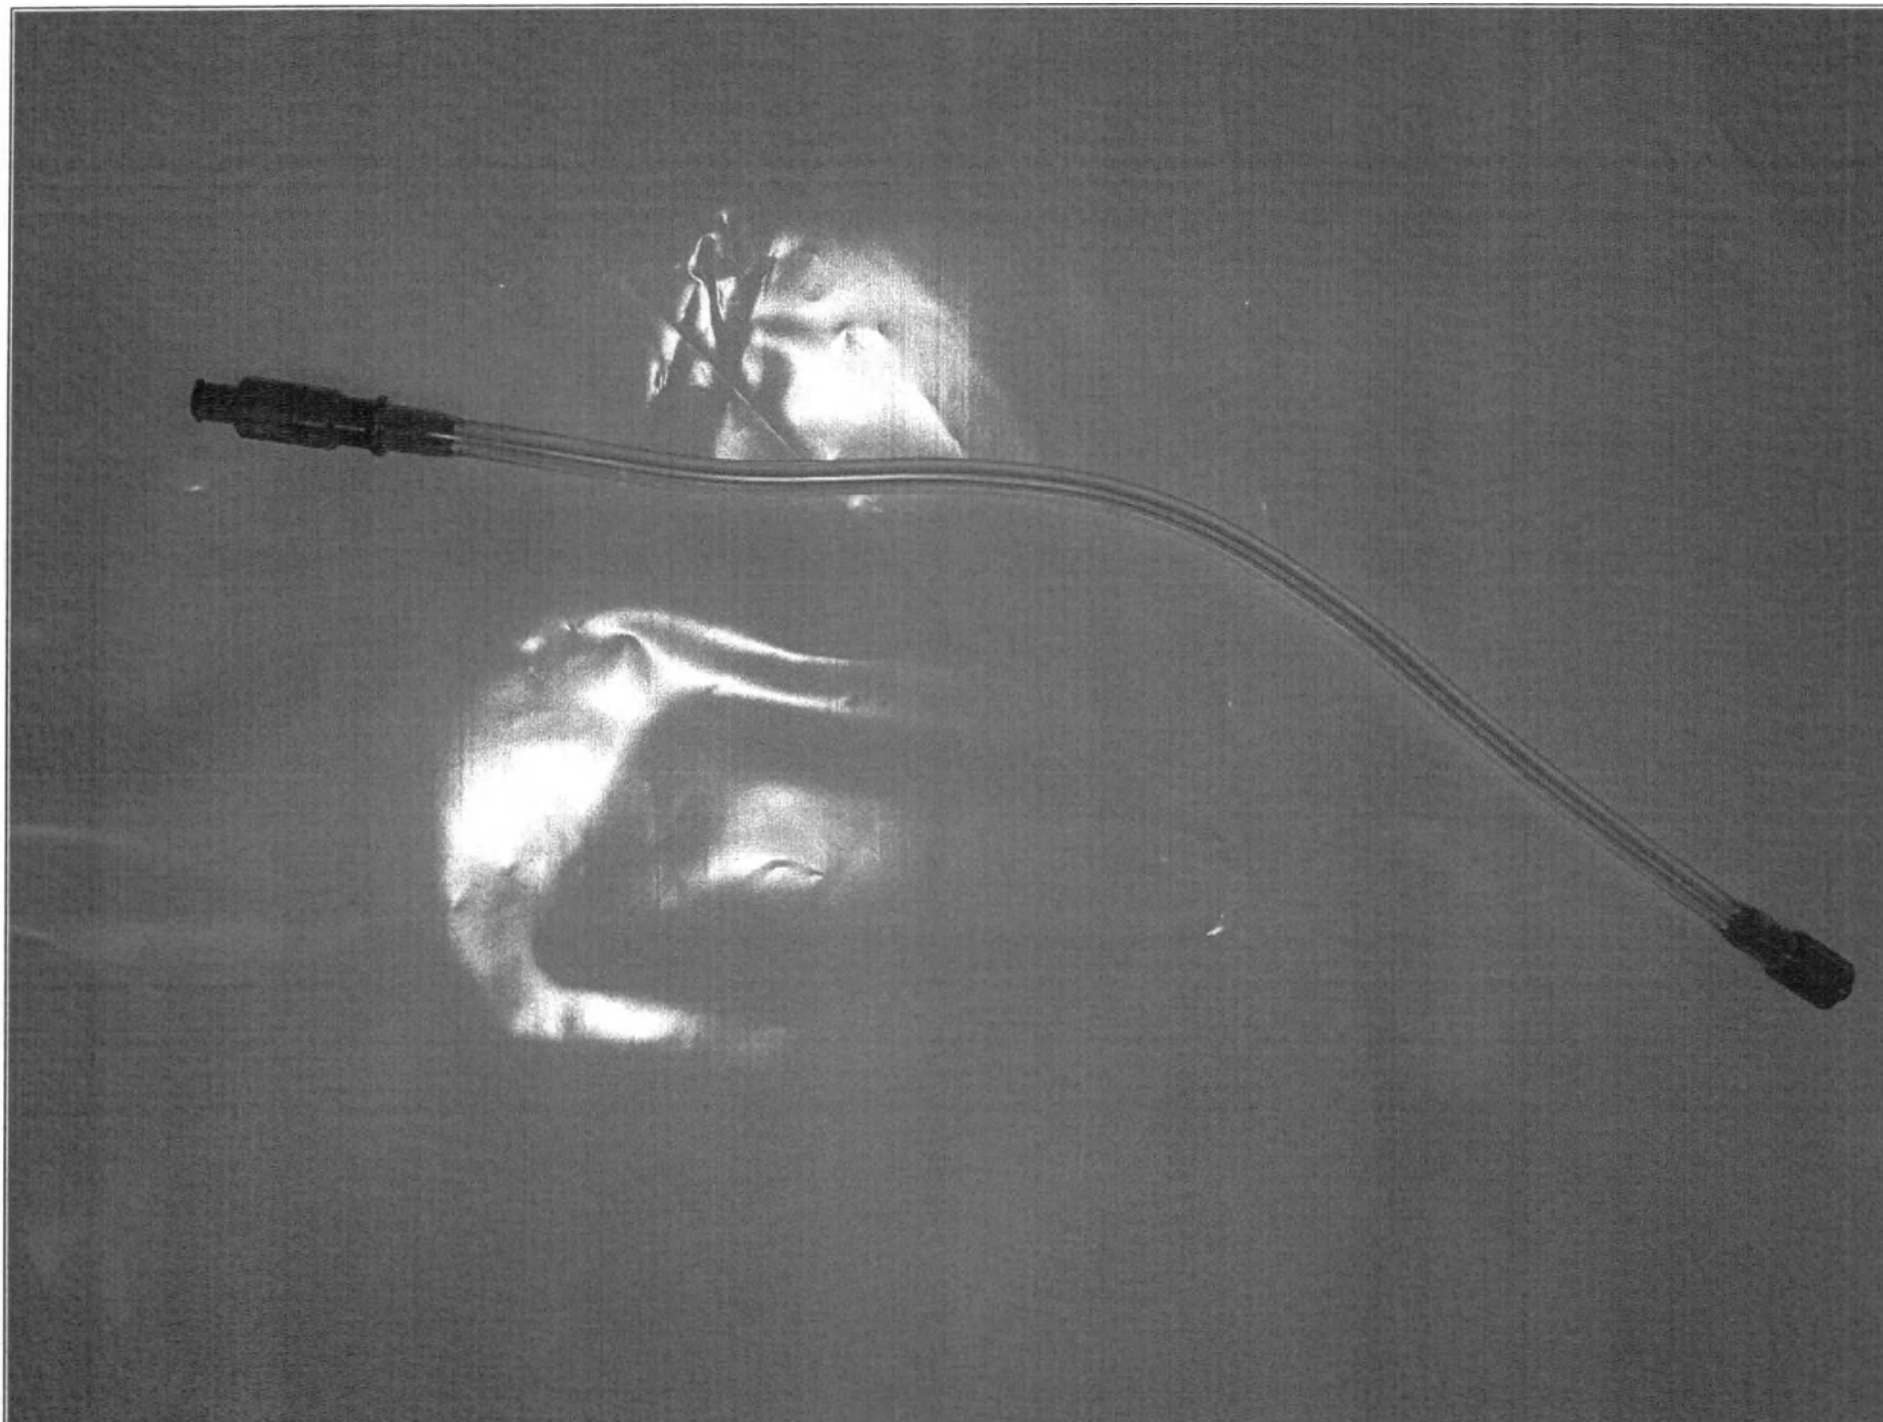

Коннектор для течеискателя (при необходимости)

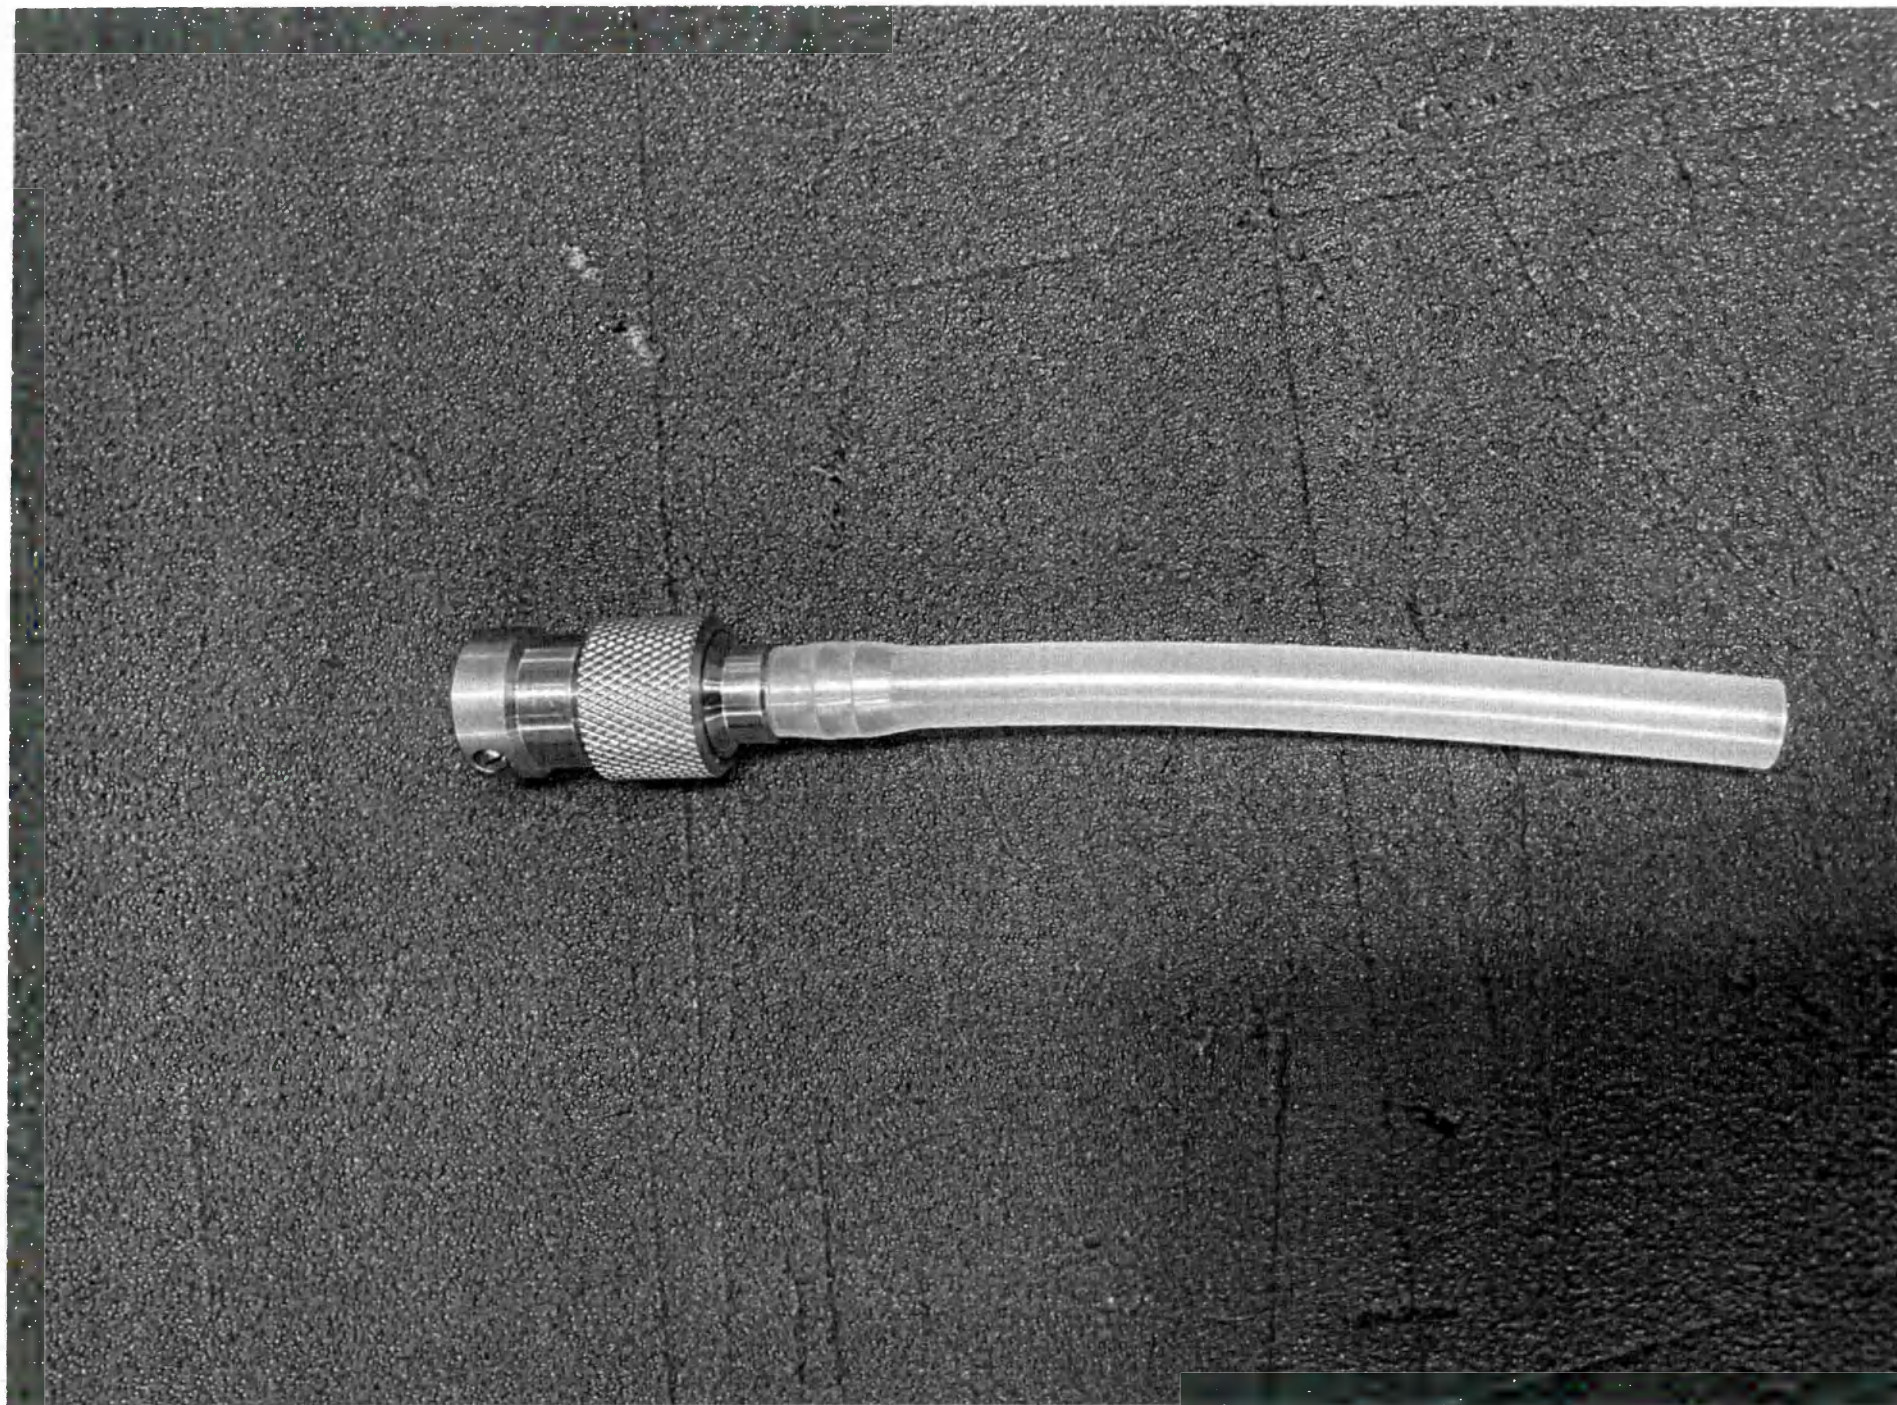

Бутыл для воды с адаптером CO₂ (при необходимости)

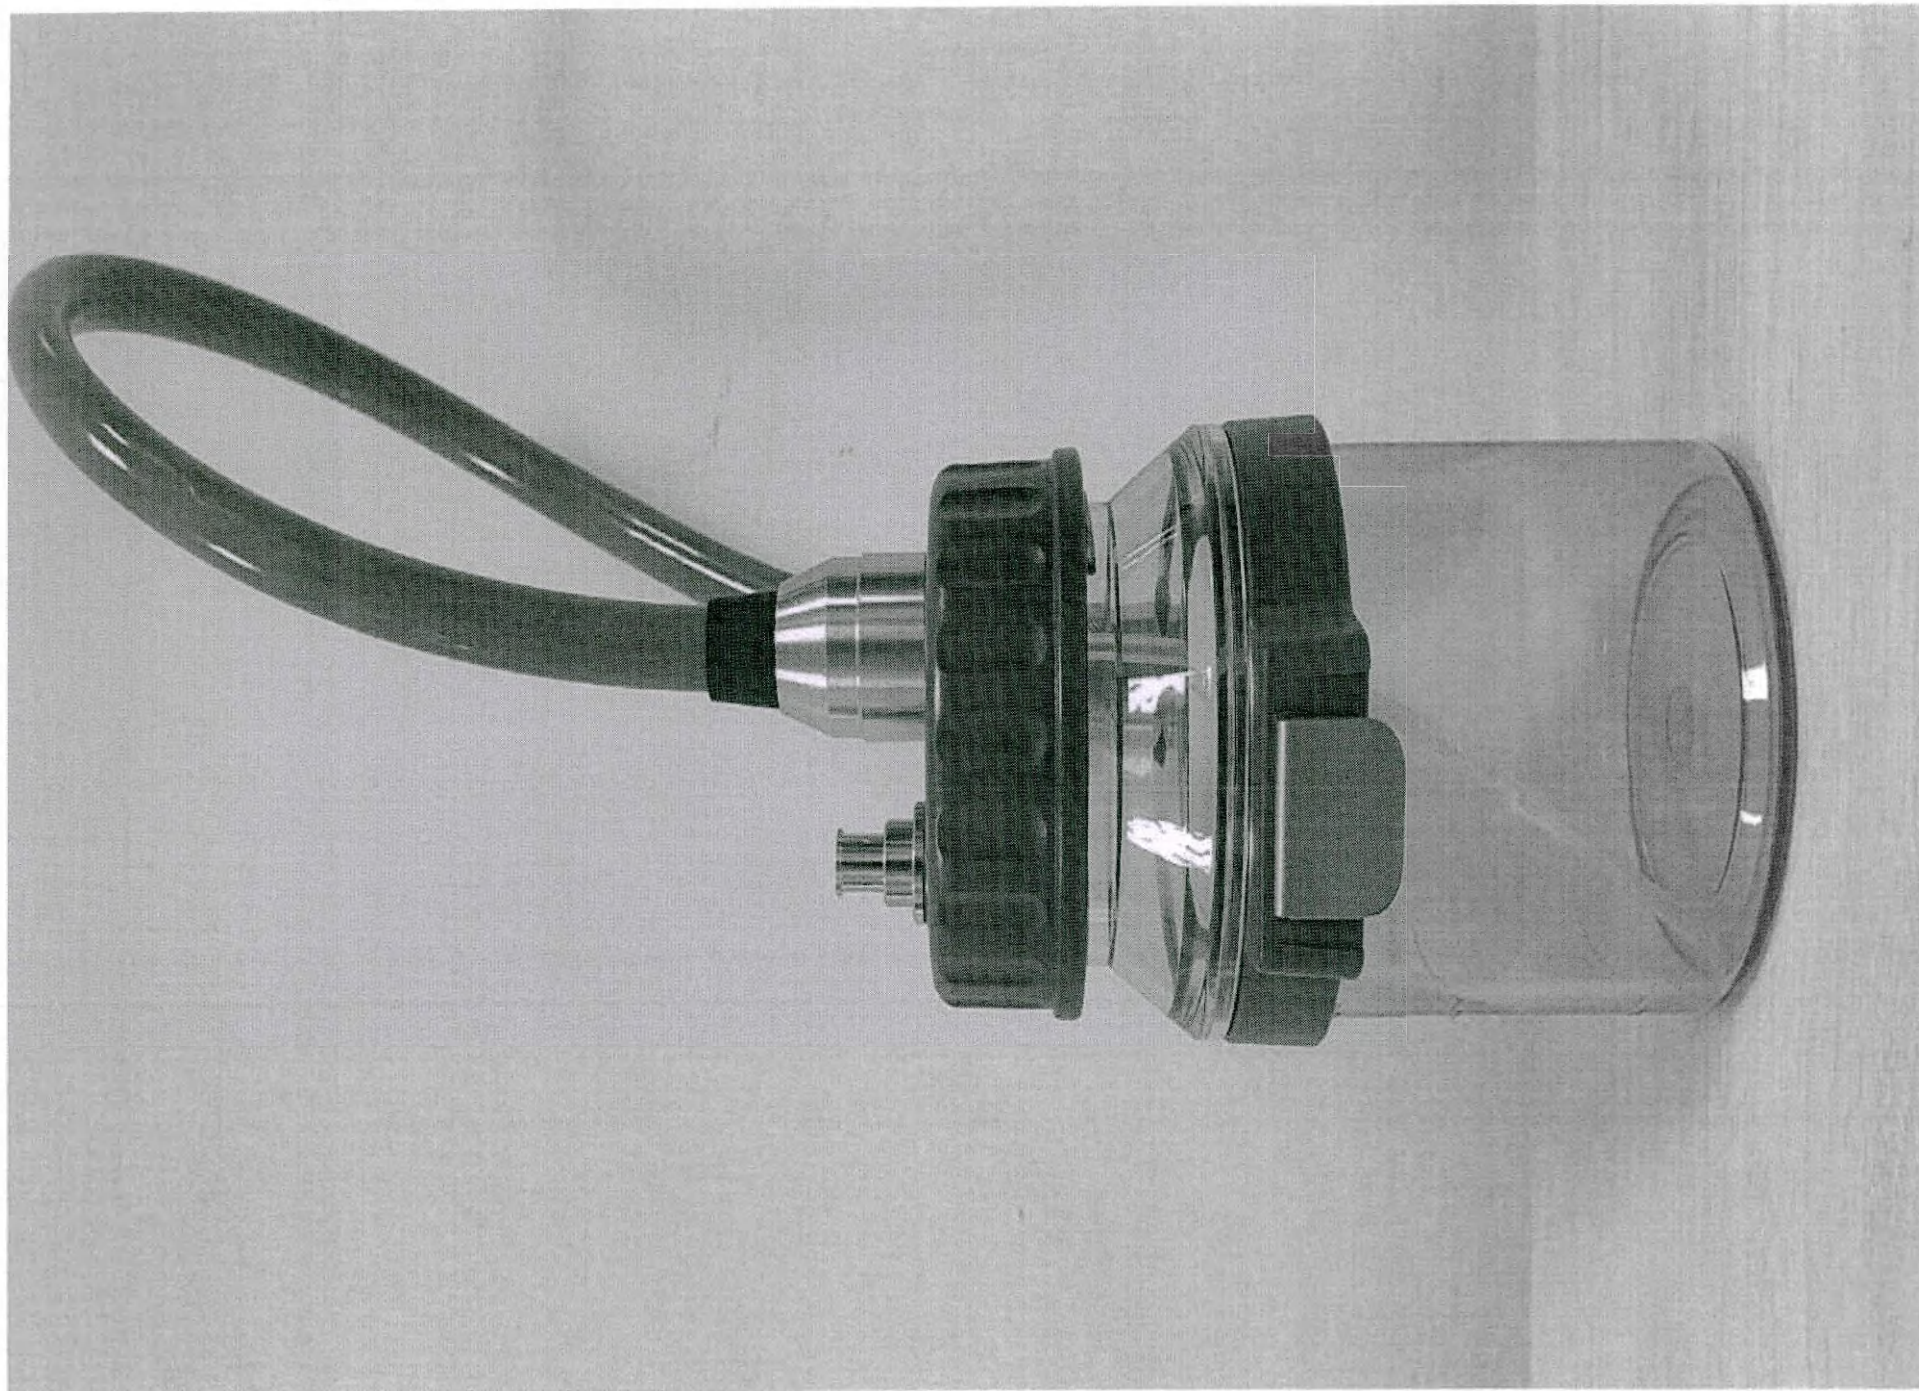


SonoScape

EG-550/EG-550L


Видеогастроскоп

**Руководство
пользователя**

III. Видеоколоноскоп
Видеоколоноскоп, в вариантах исполнения: EC-550; EC-550T; EC-550L; EC-550L/T

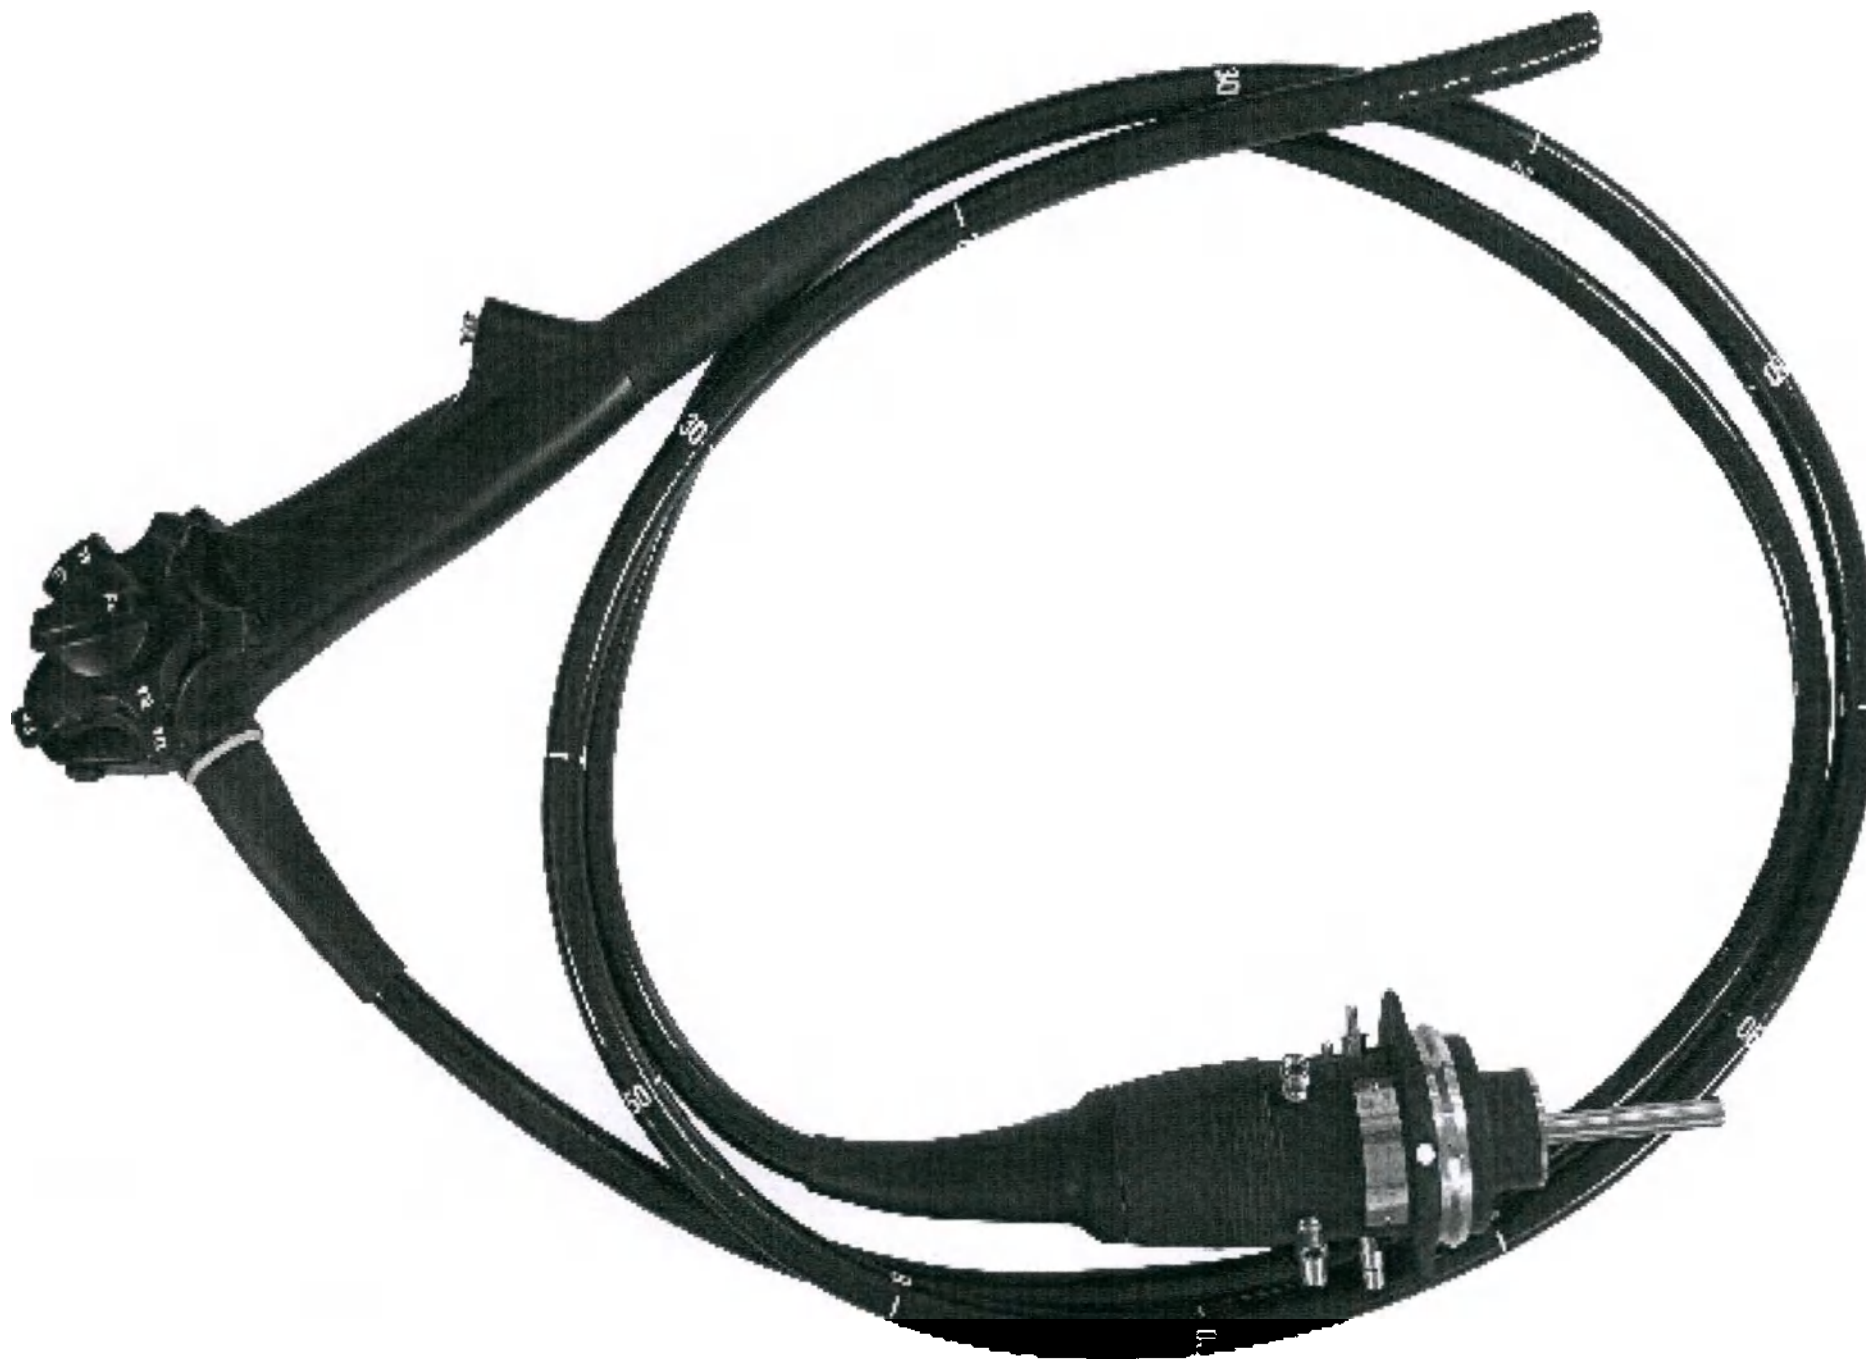


Биопсийный клапан

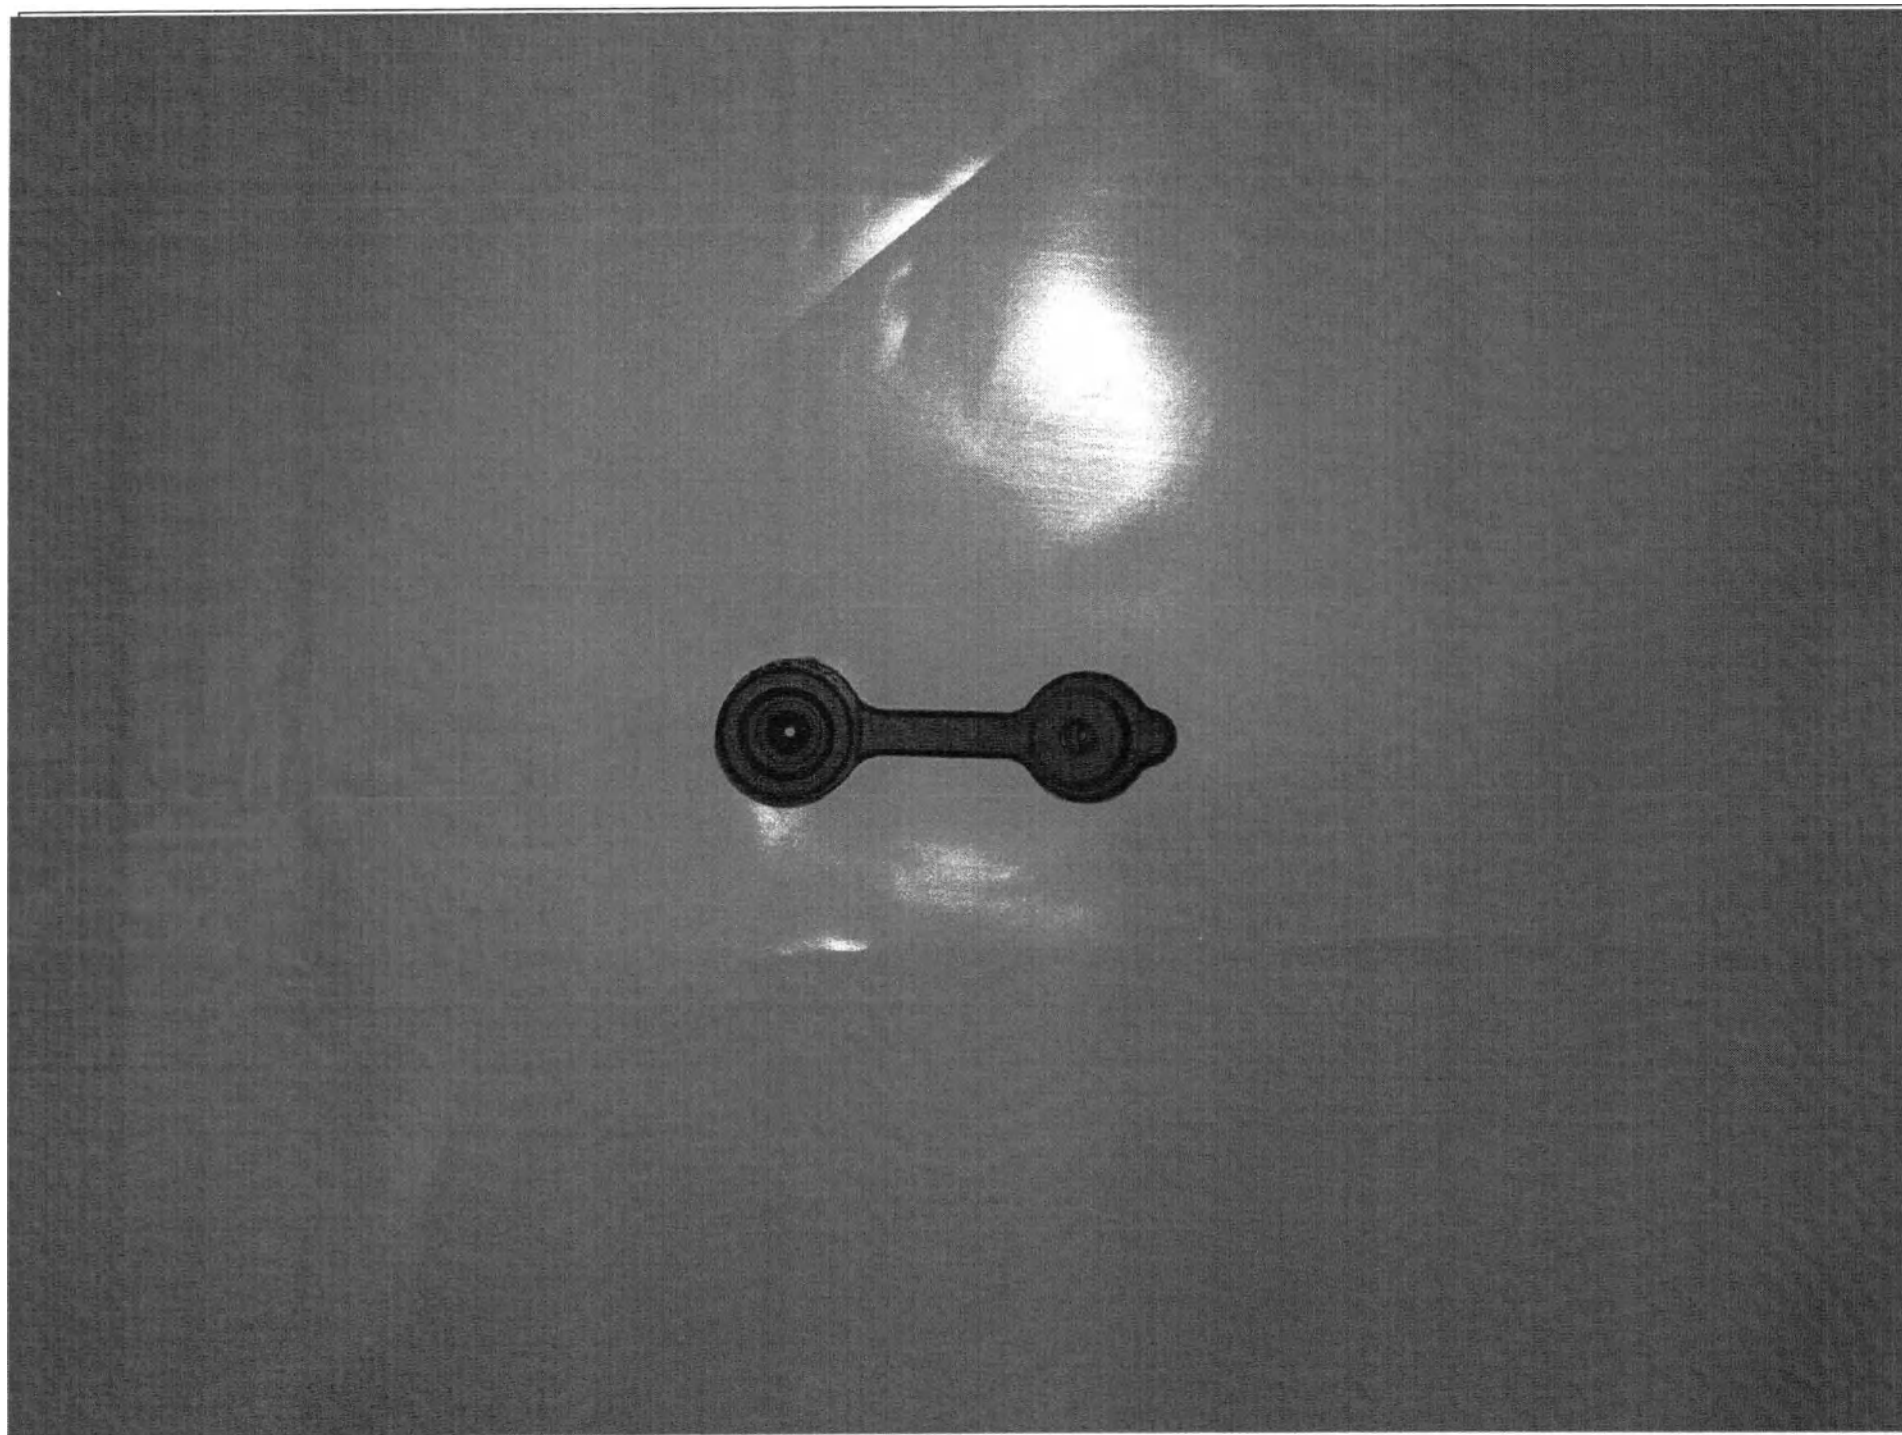


Щетка для очистки




Щетка для очистки гнезда клапана: вода-воздух, аспирационного и биопсийного

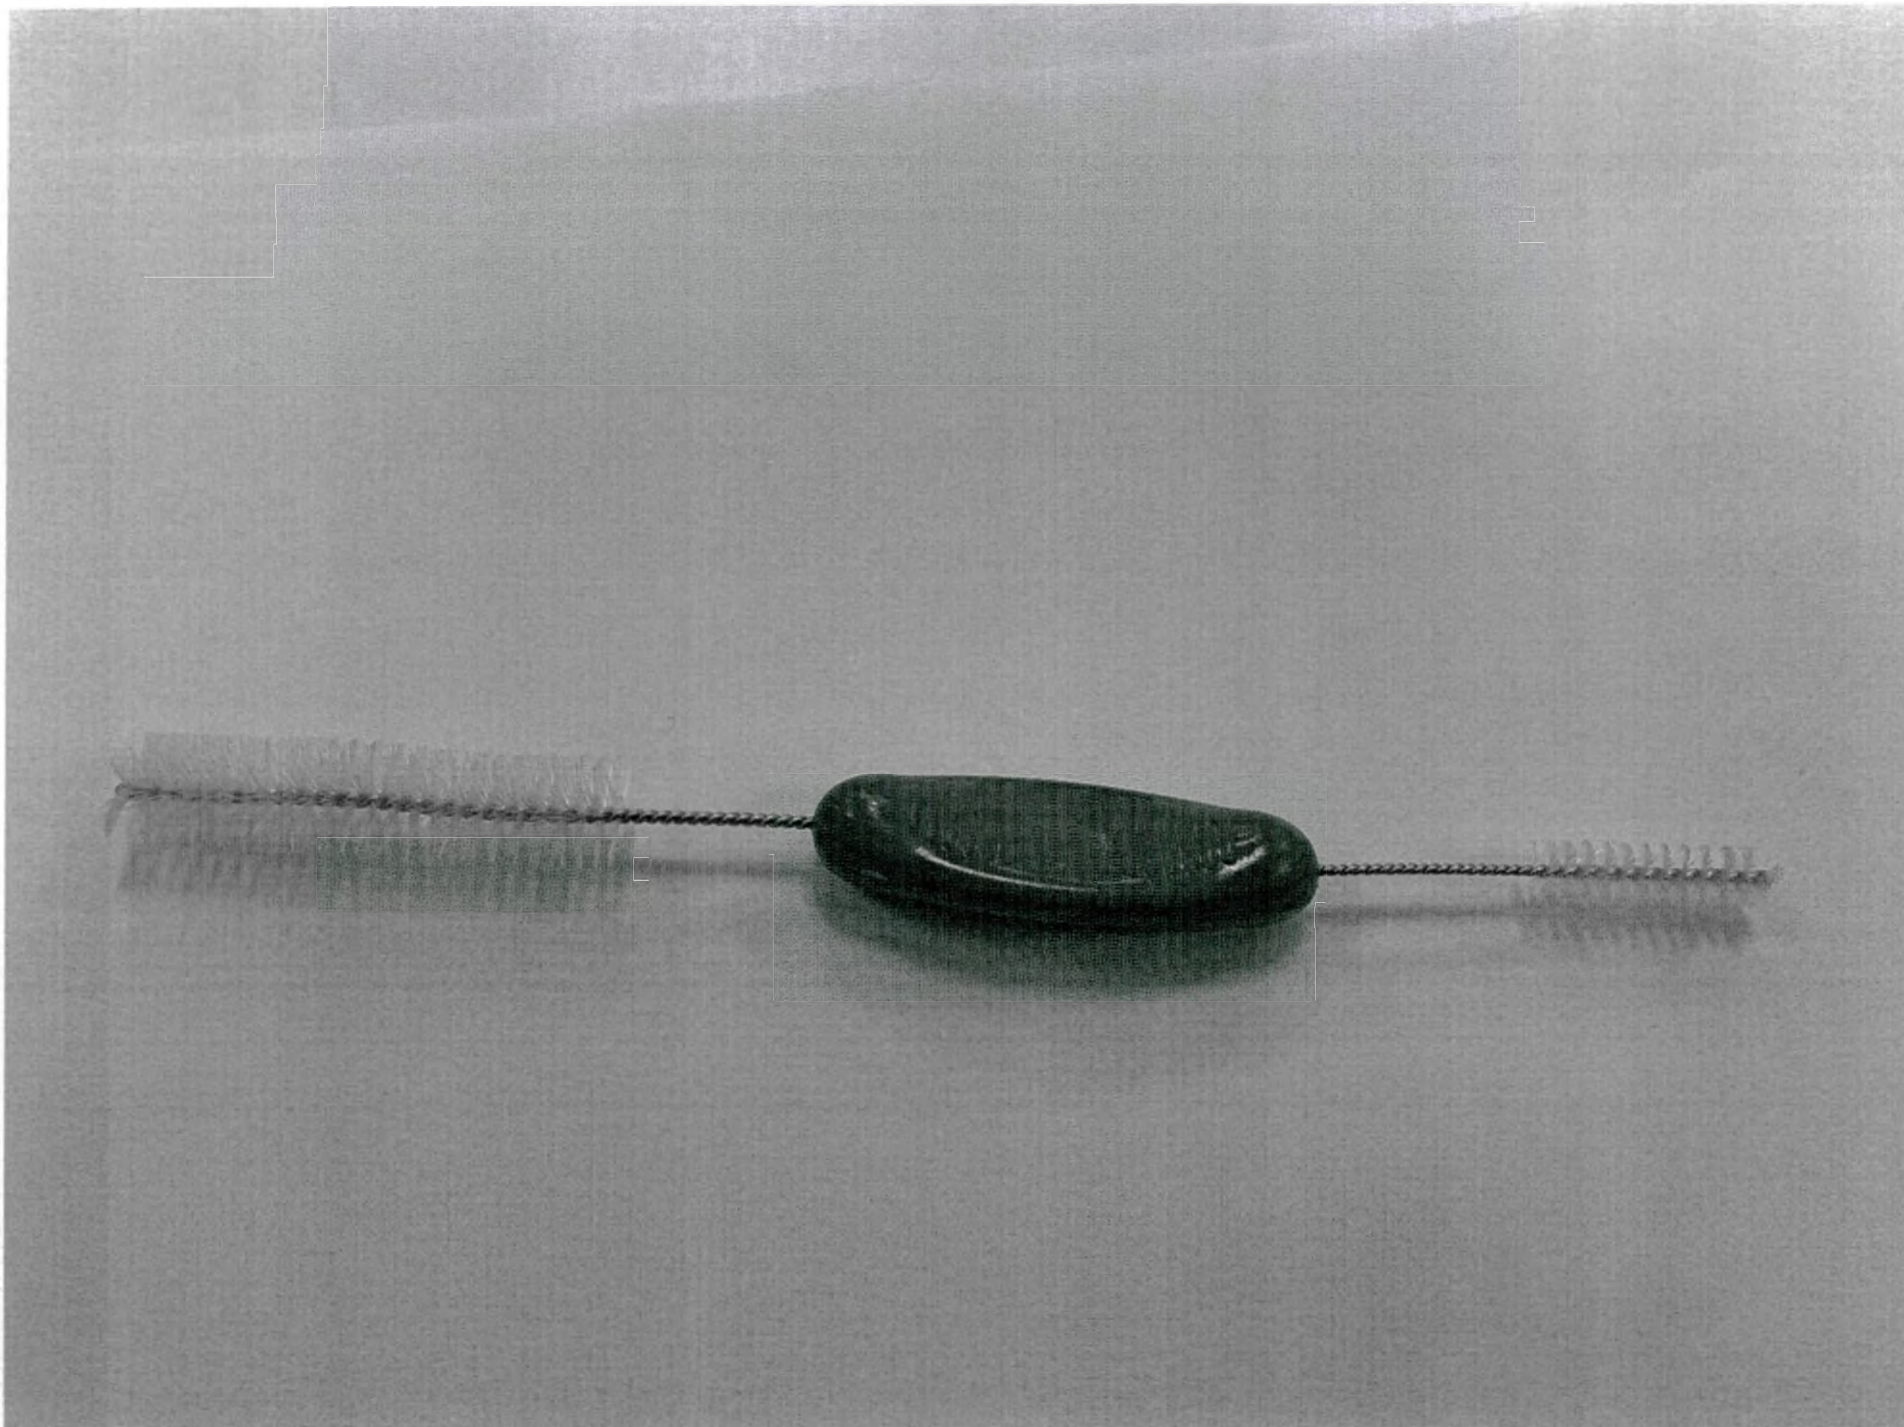

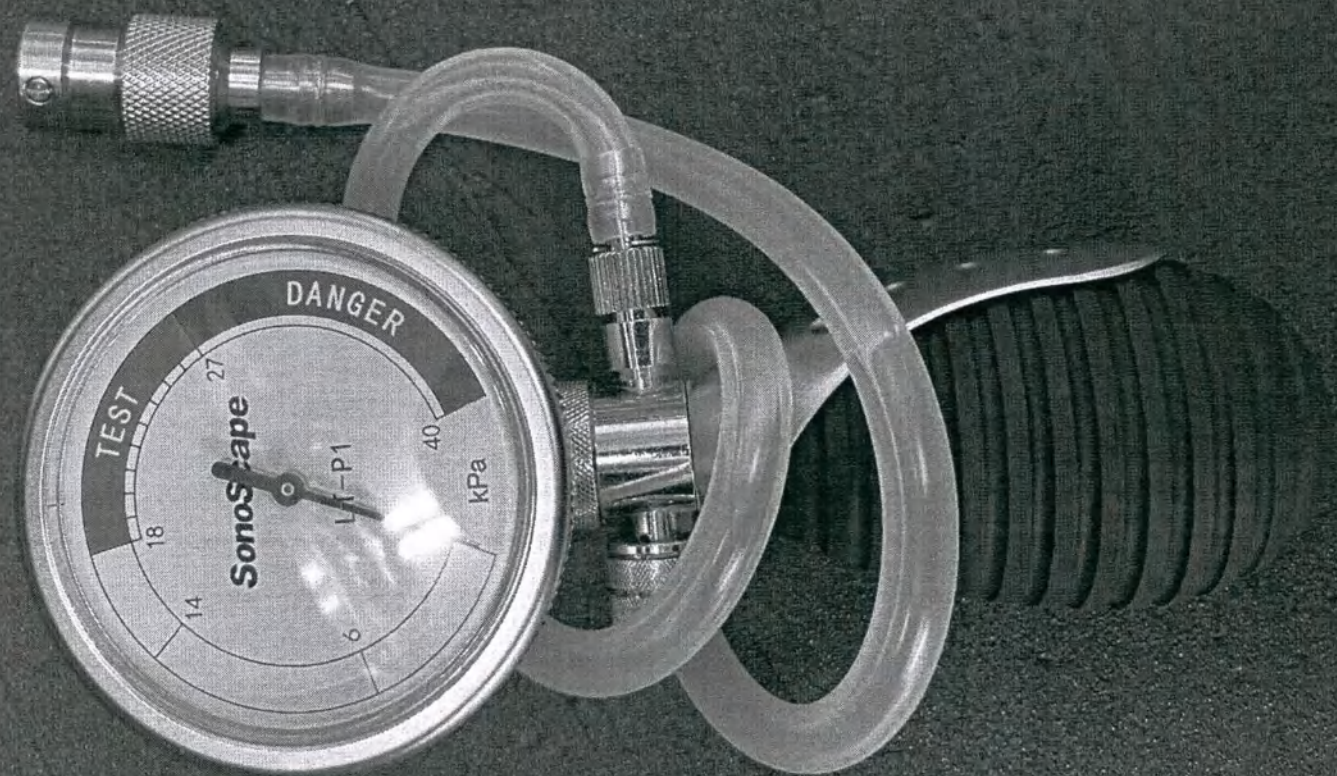


Шприц, 30 мл (при необходимости)

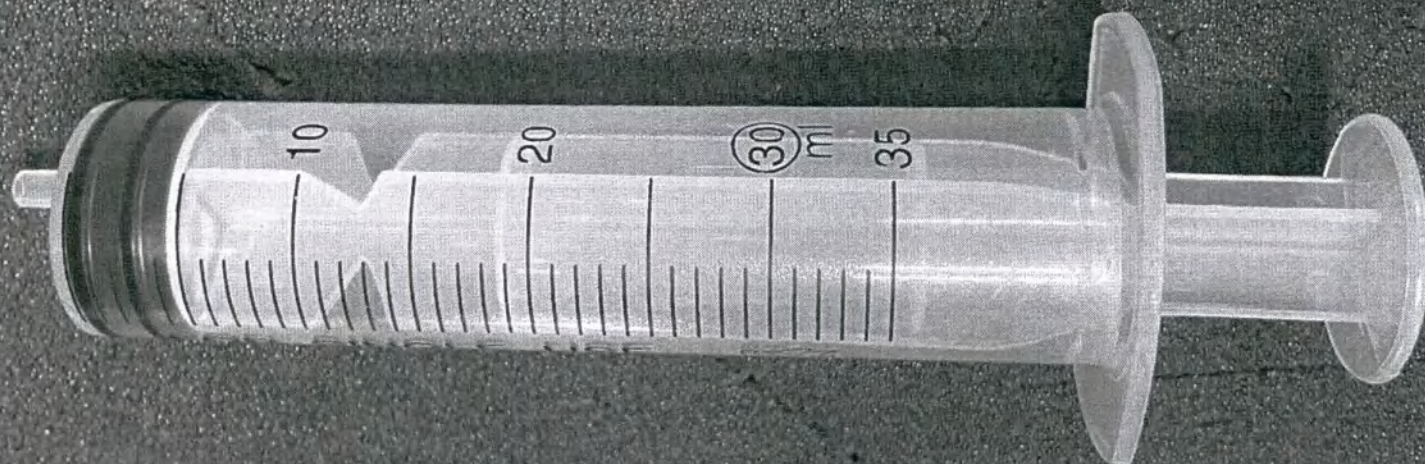

Заглушка ирригационного канала




Резиновый колпачок дистального конца

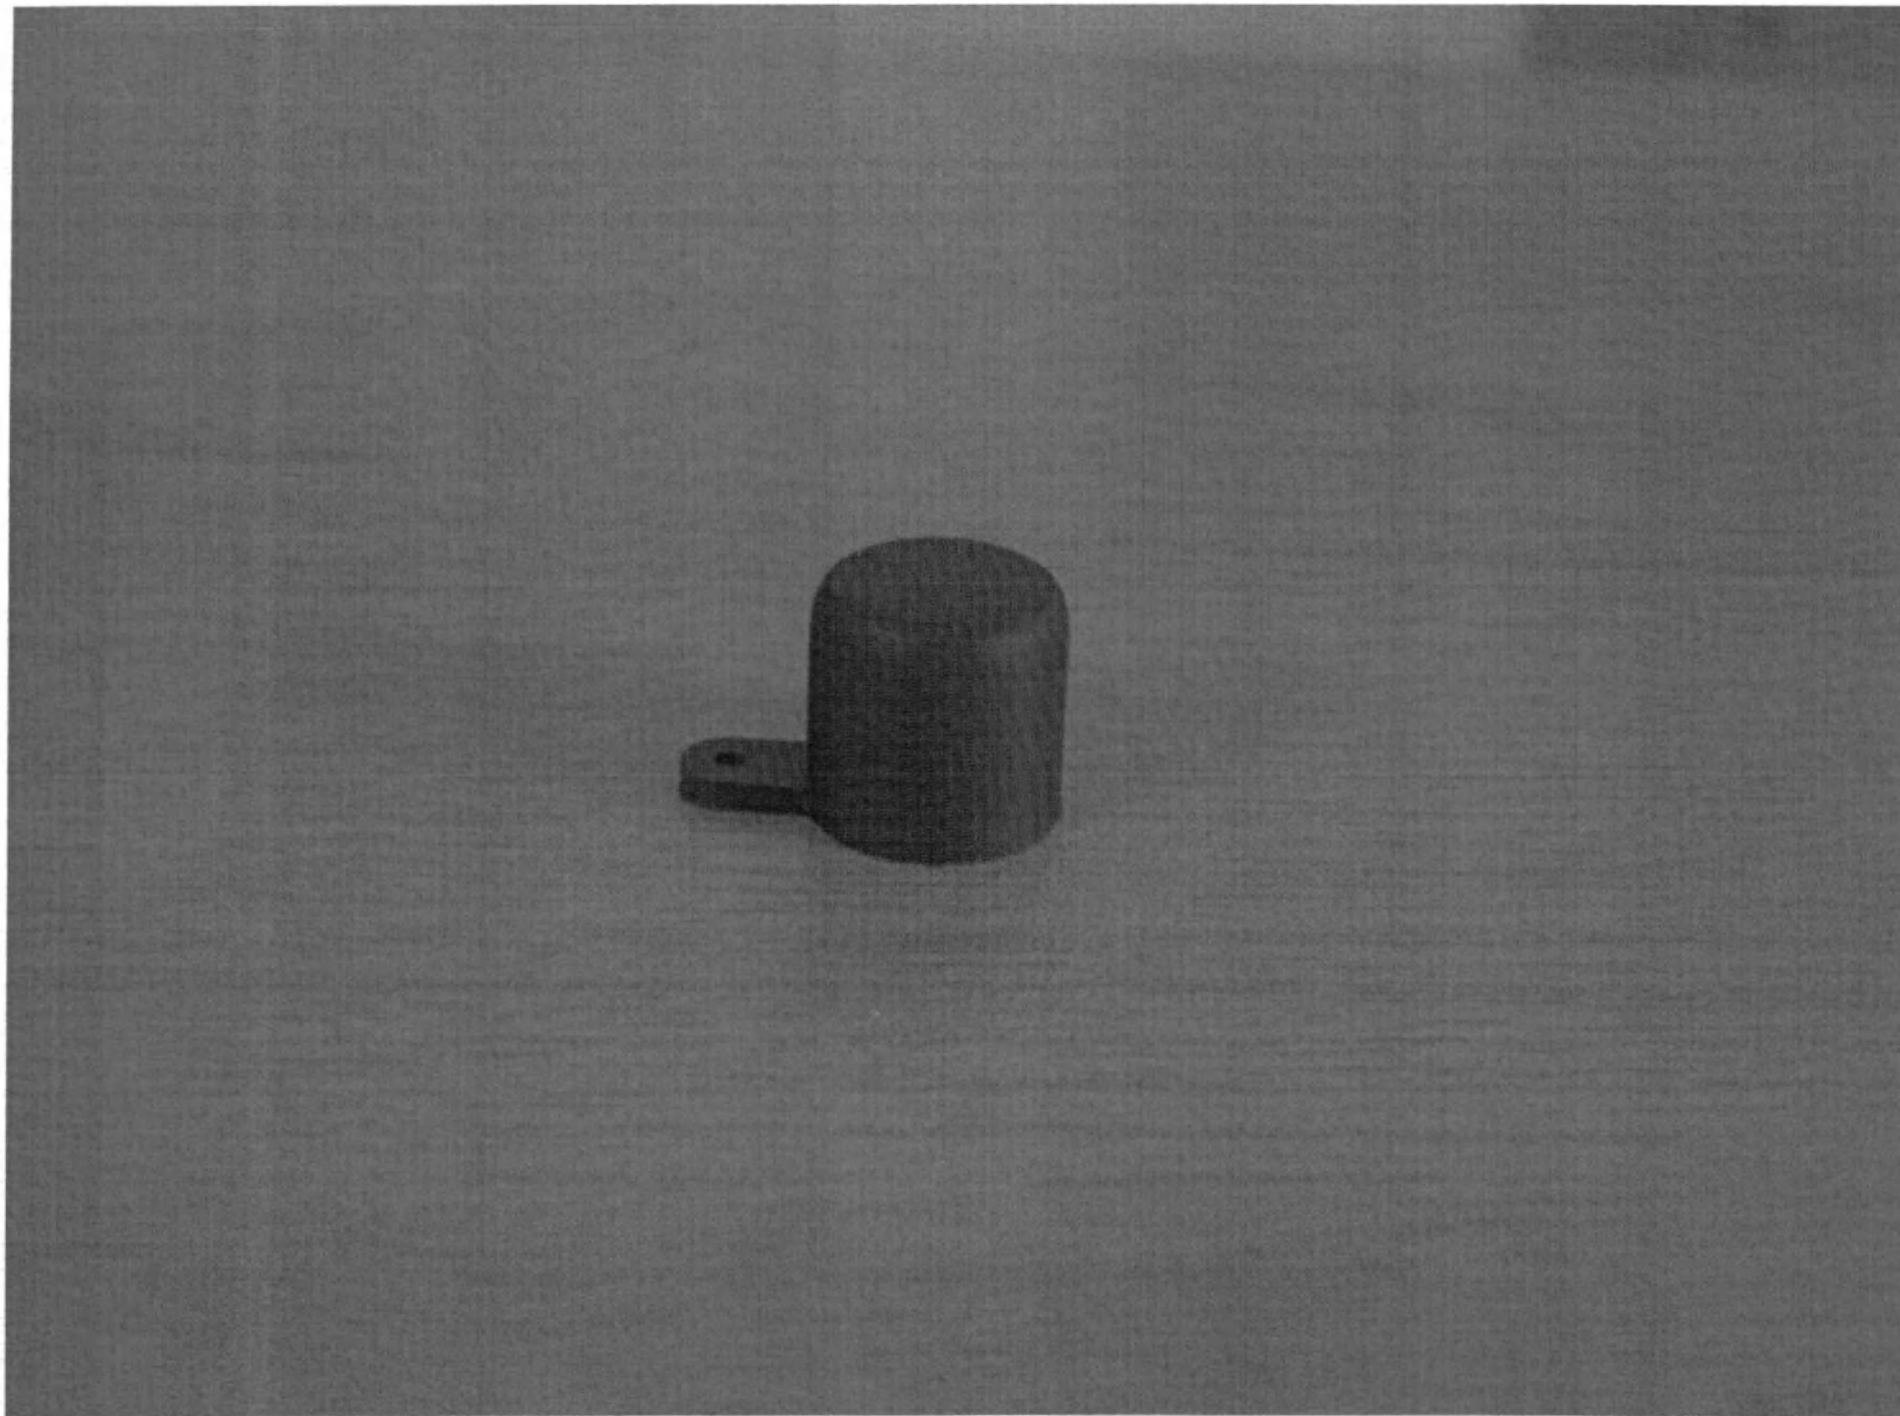


Воздушный/водяной клапан



Клапан аспирации

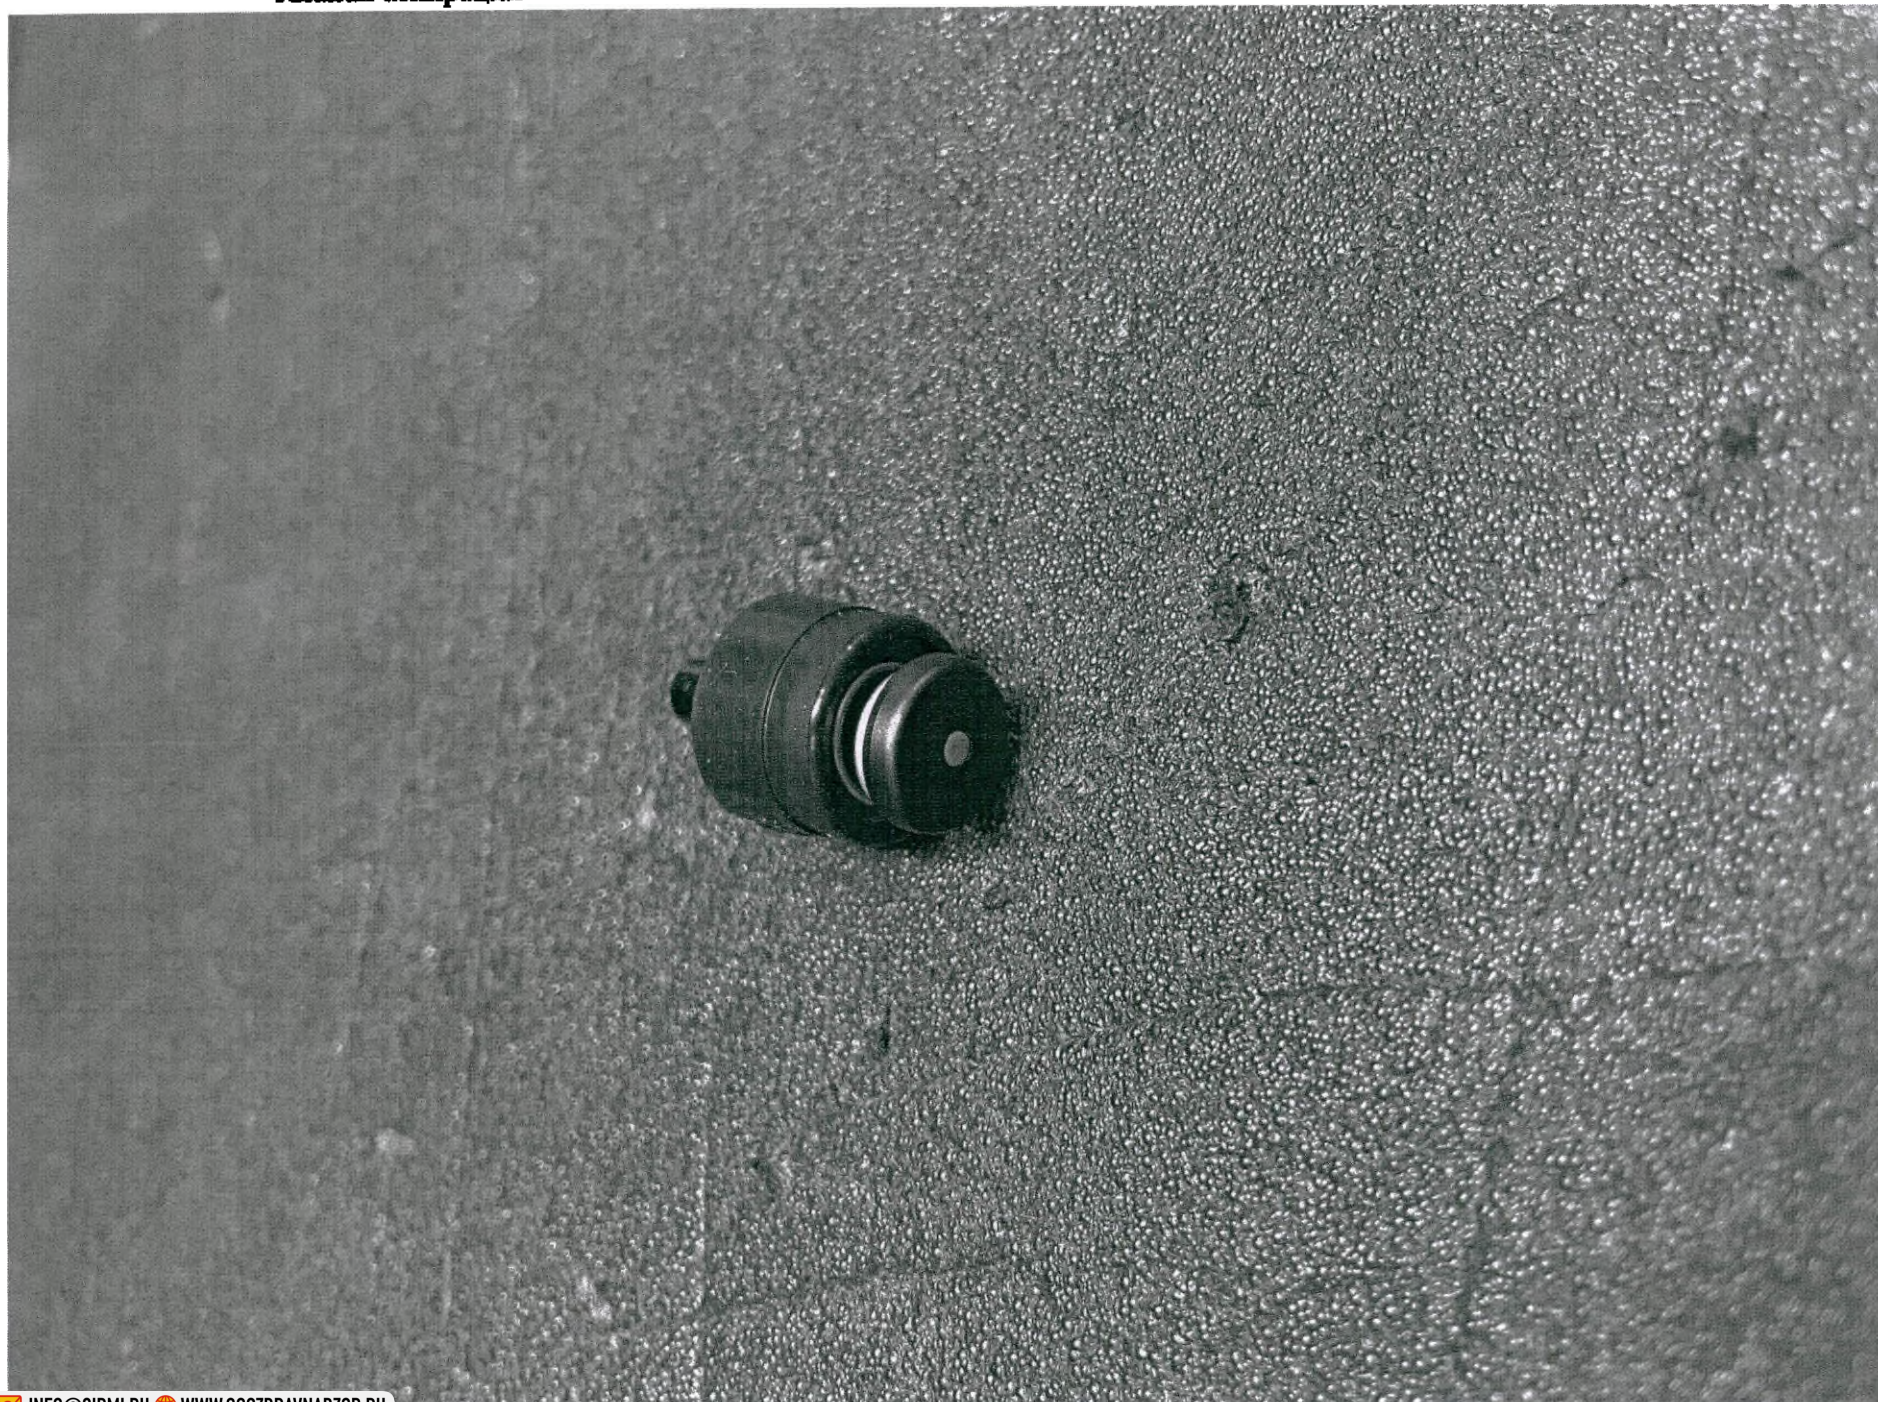

Бутыль для воды

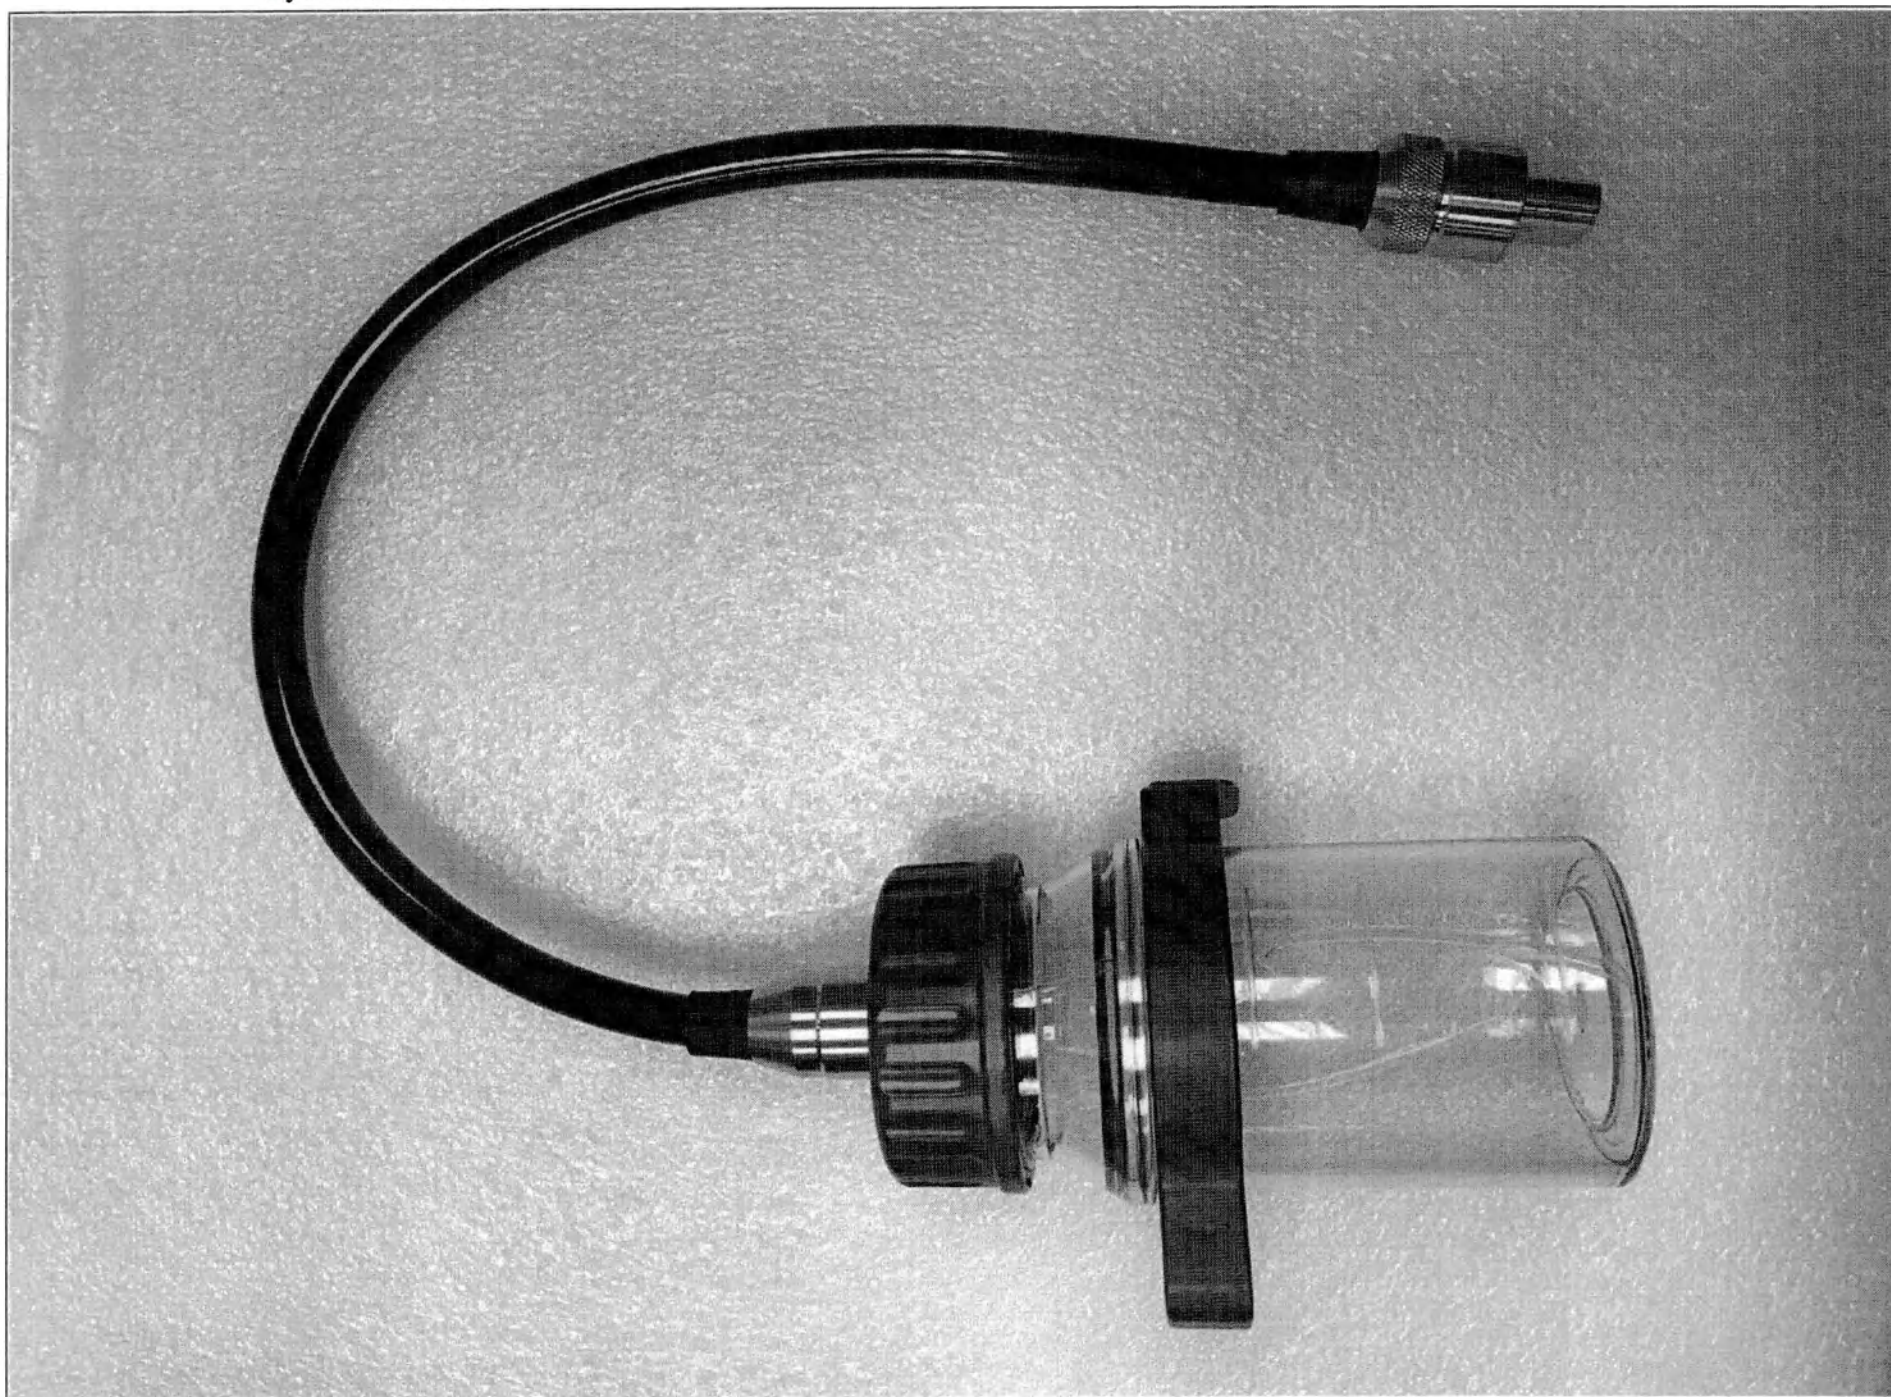


Комплект для ручной обработки эндоскопа

- комплект заглушек для промывки




- система для промывки каналов

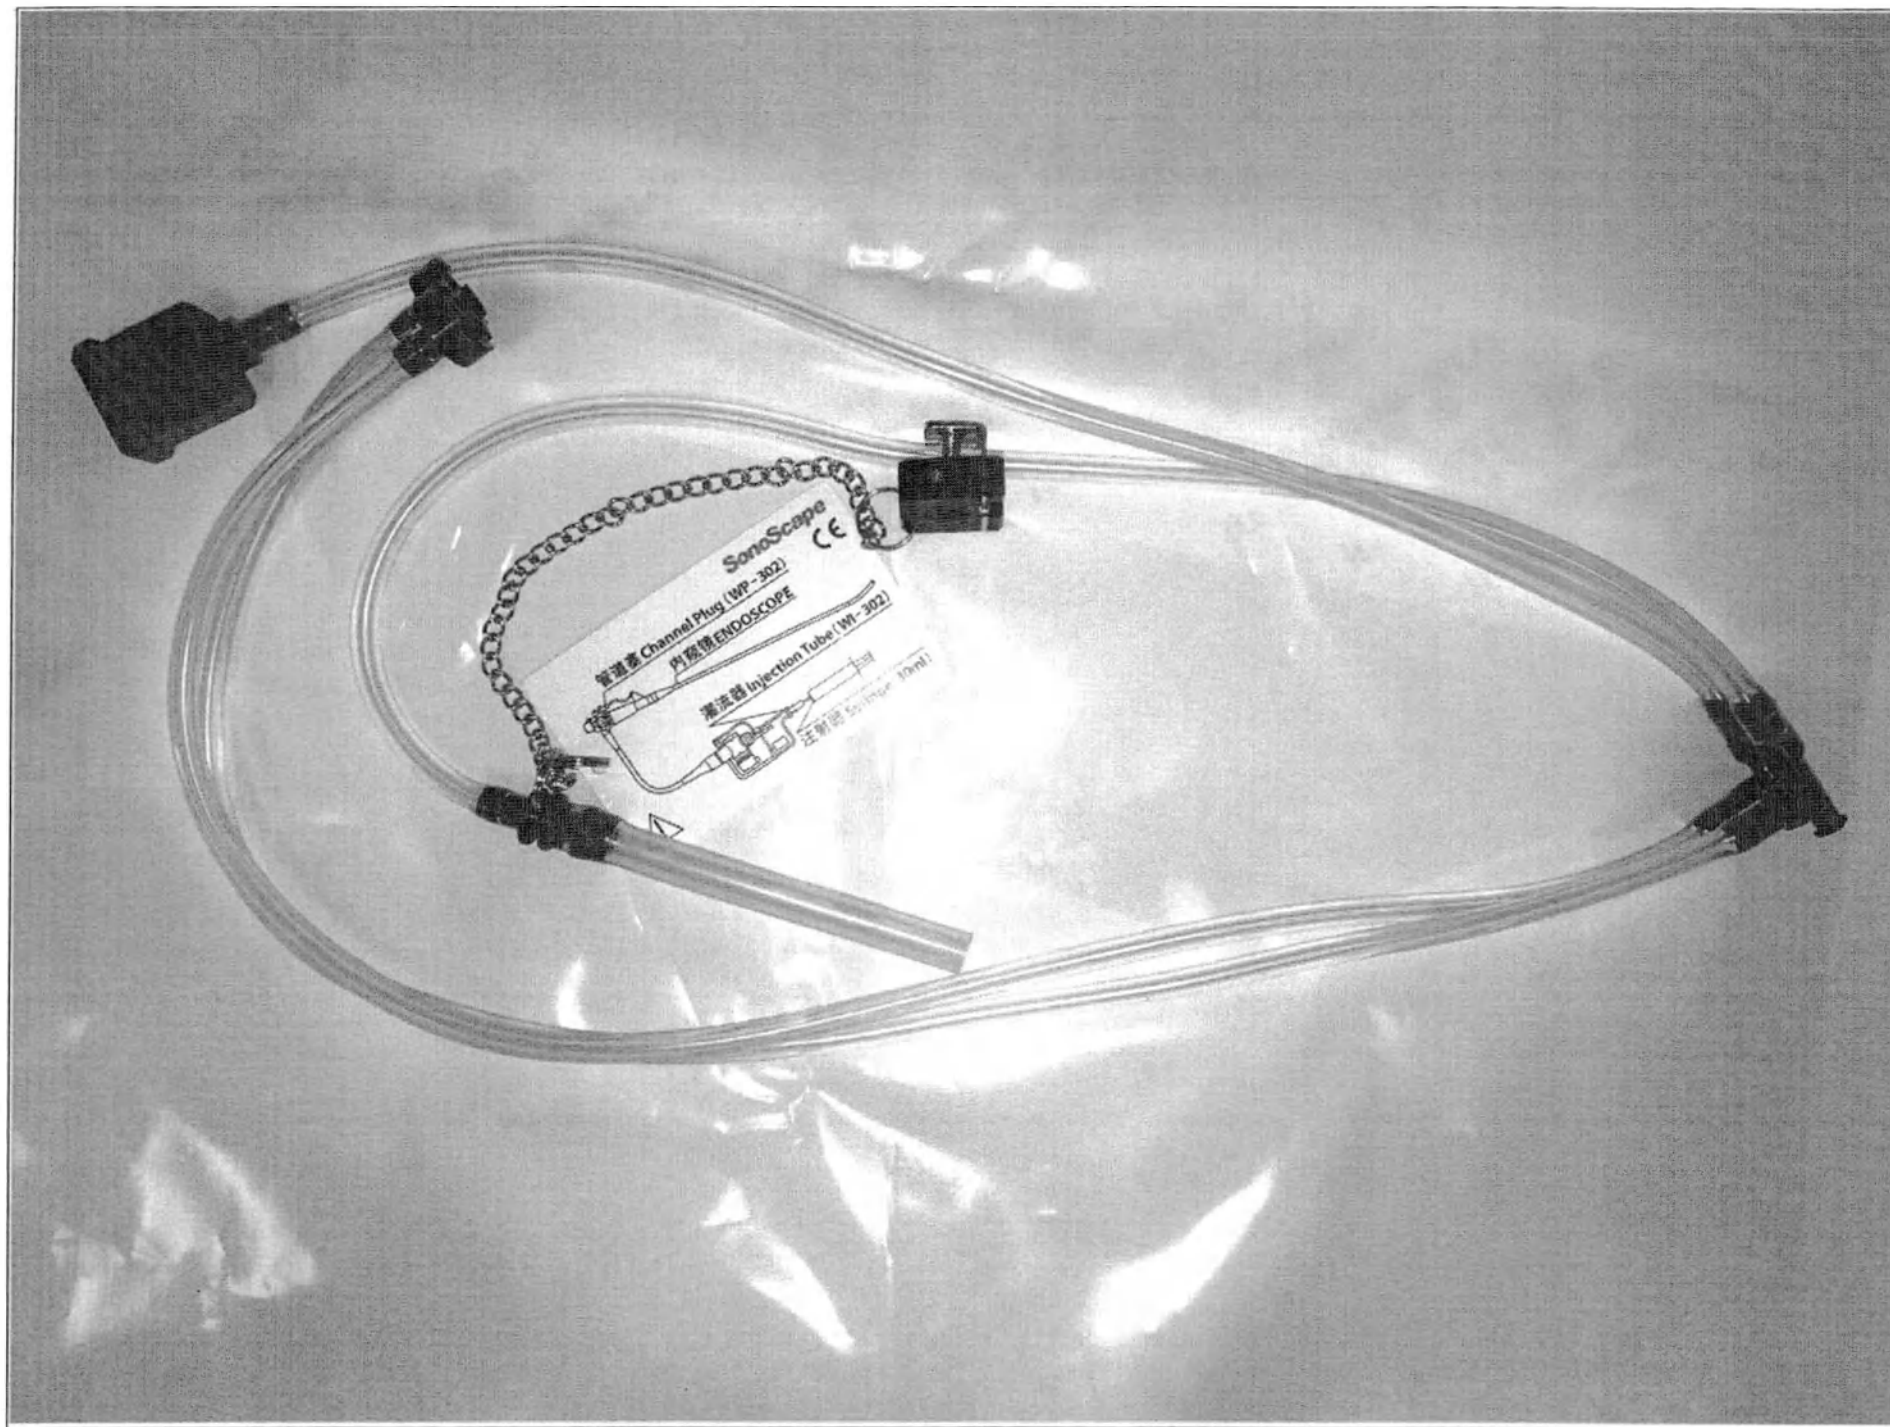


- трубка-адаптер для ирригационного канала (длинная),




- трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая),

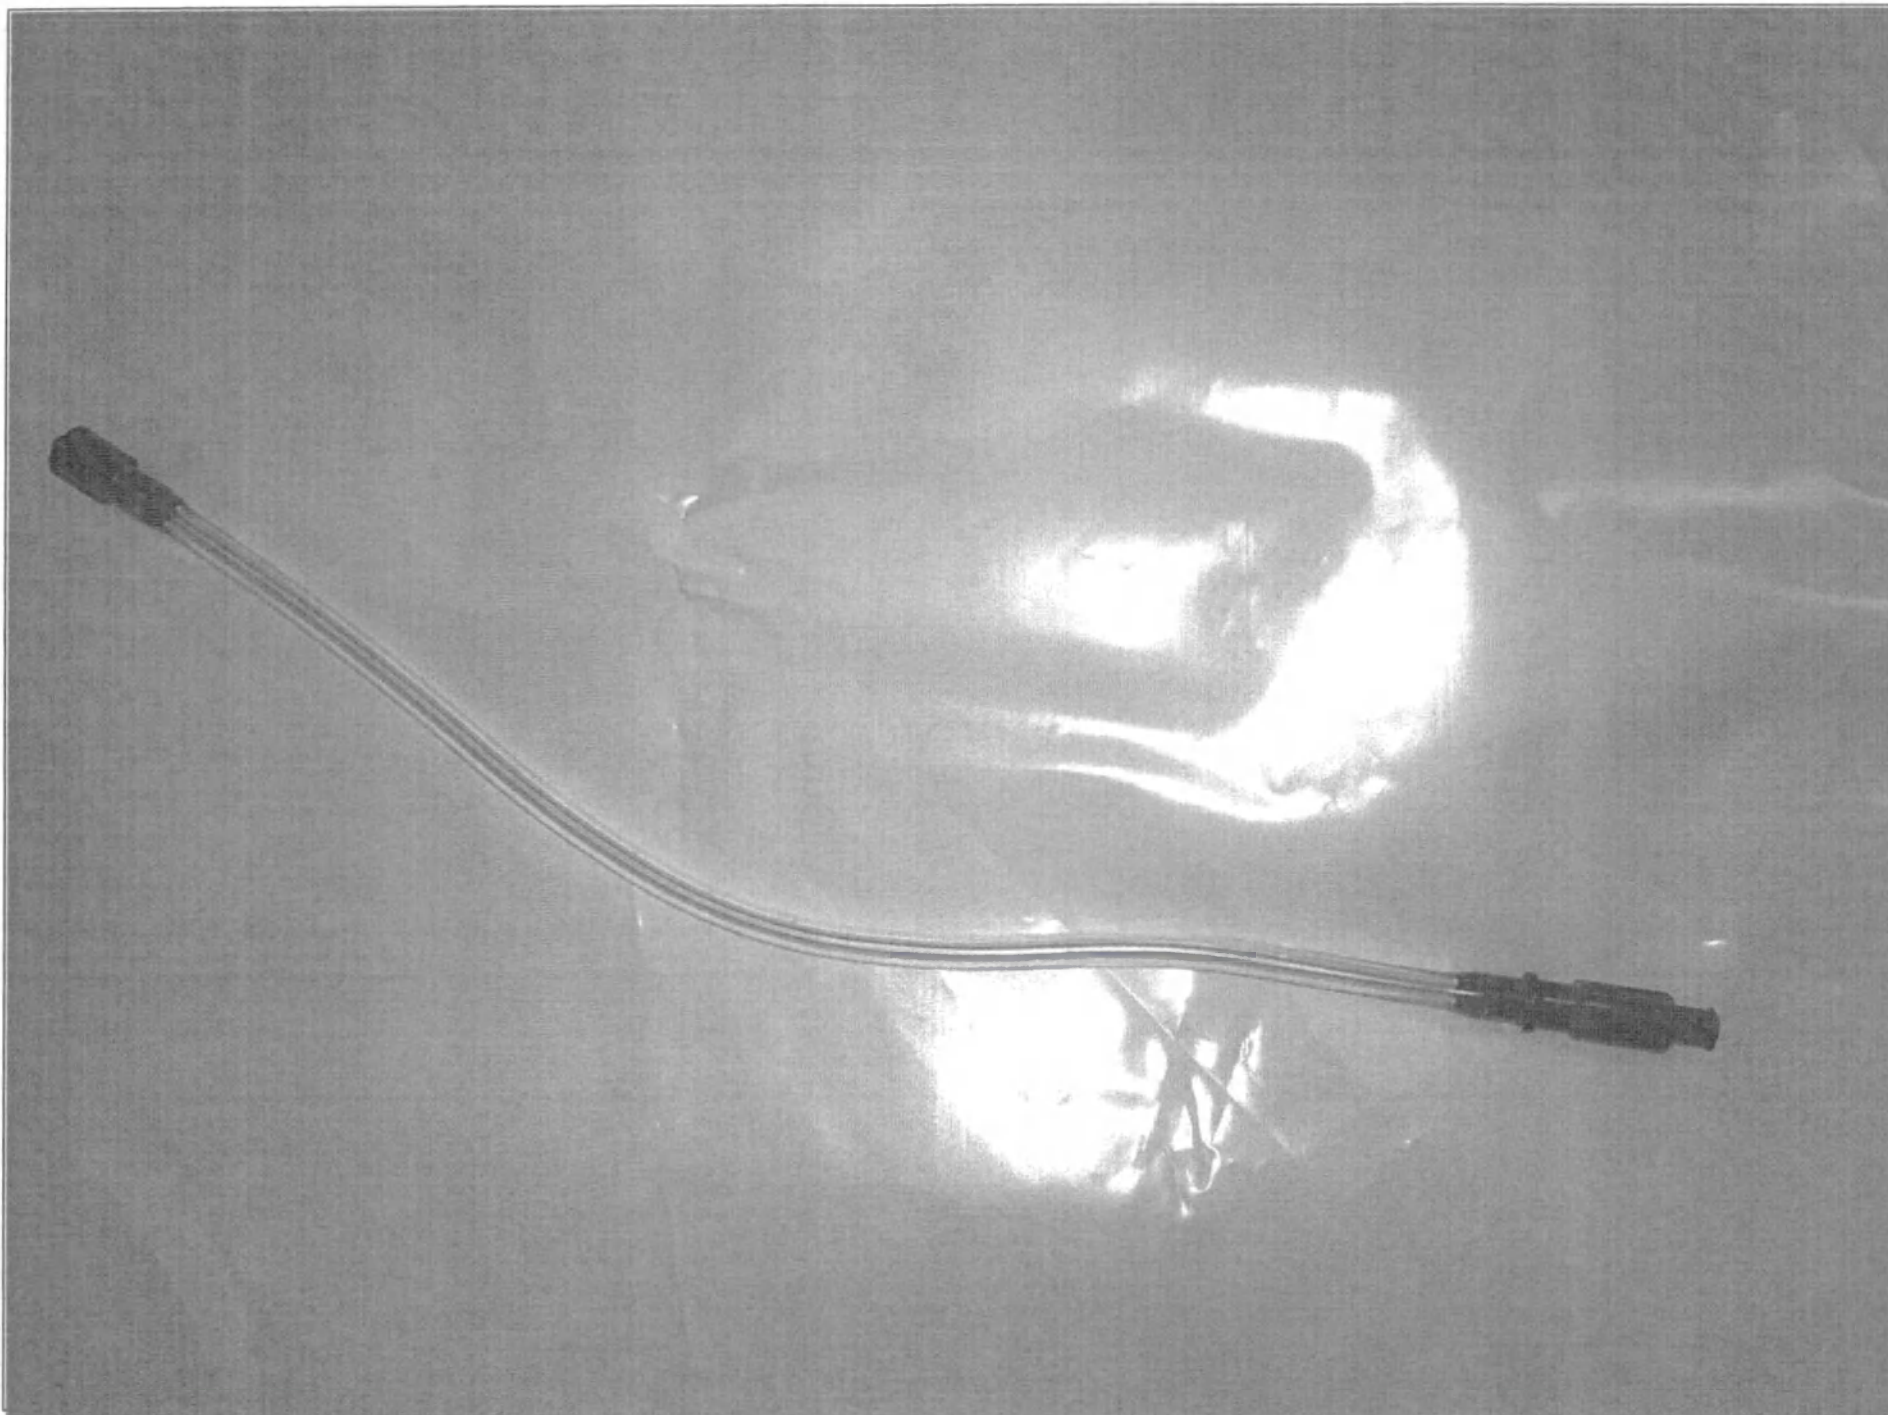

Коннектор для течеискателя (при необходимости)

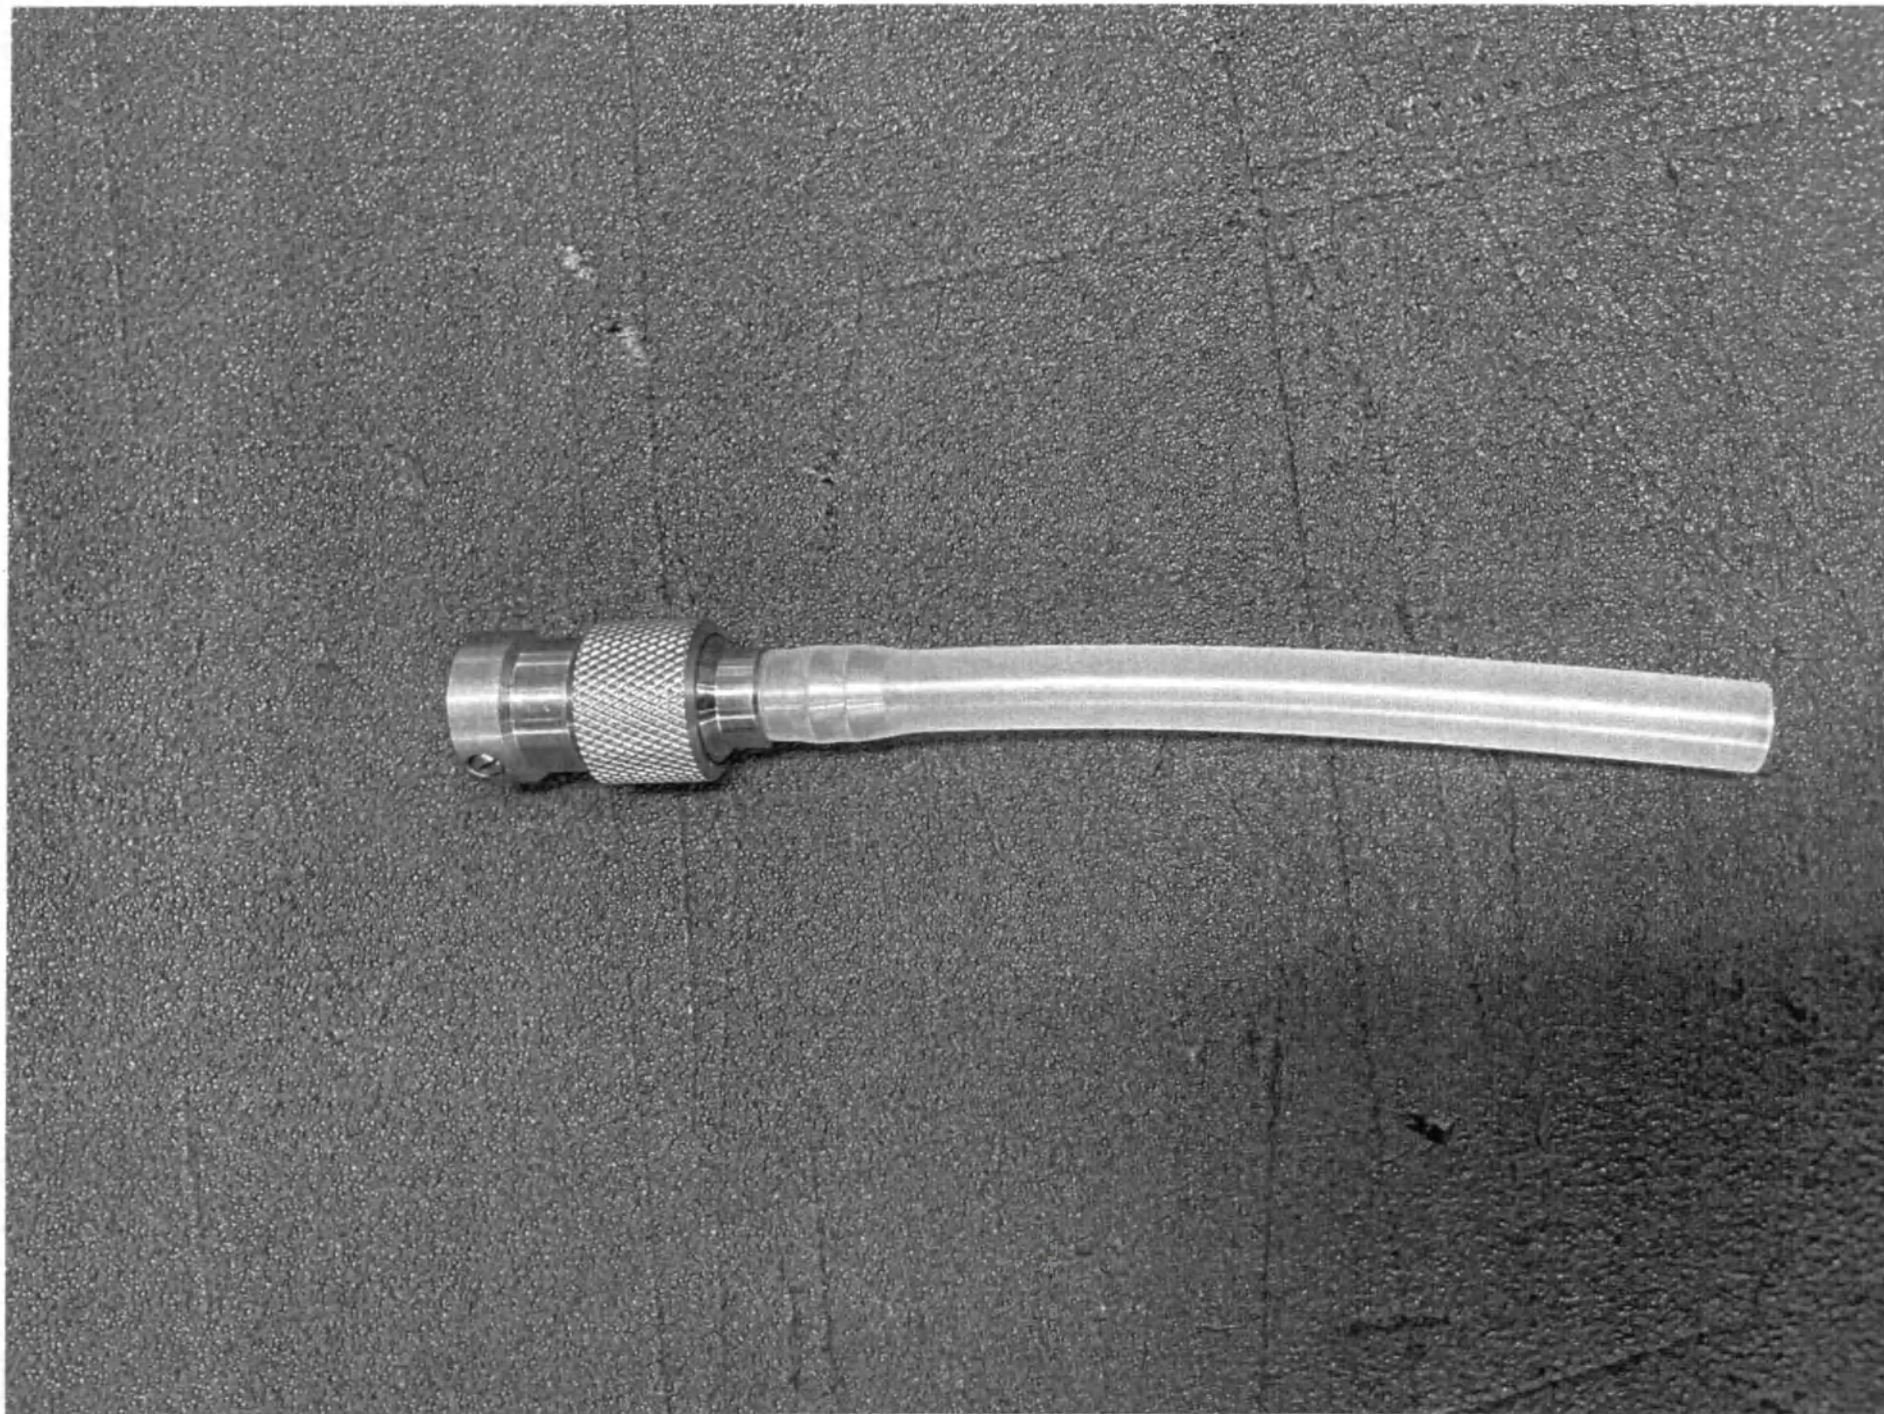

Бутыл для воды с адаптером CO₂

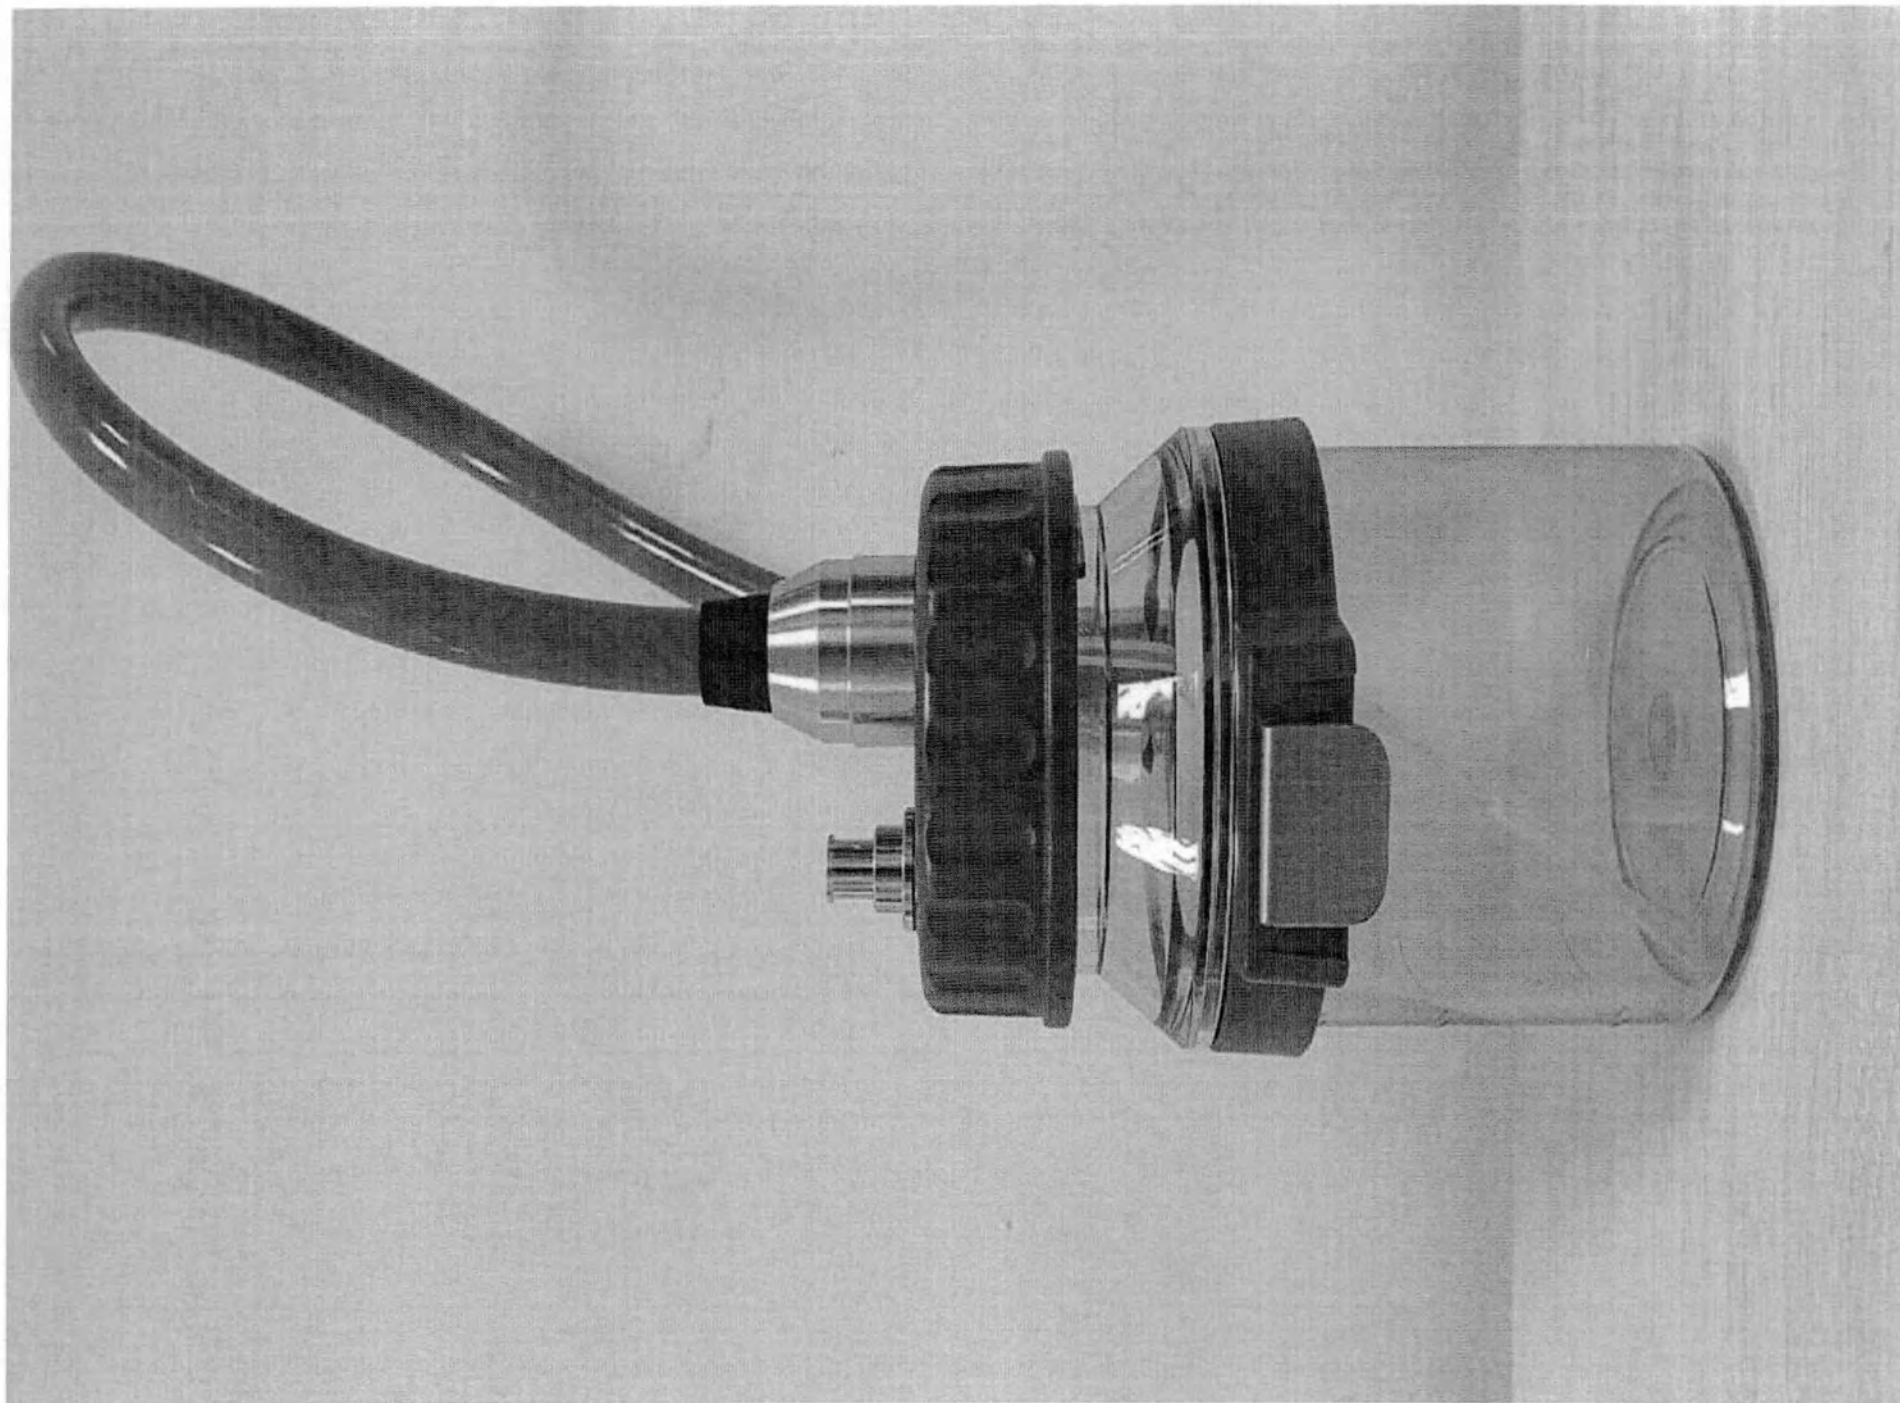


SonoScape
EC-550/ EC-550T/ EC-550L/ EC-
550L/T

Видеоколоноскоп

Руководство пользователя

IV. Источник света

Источник света, в вариантах исполнения: VLS-50T; VLS-50

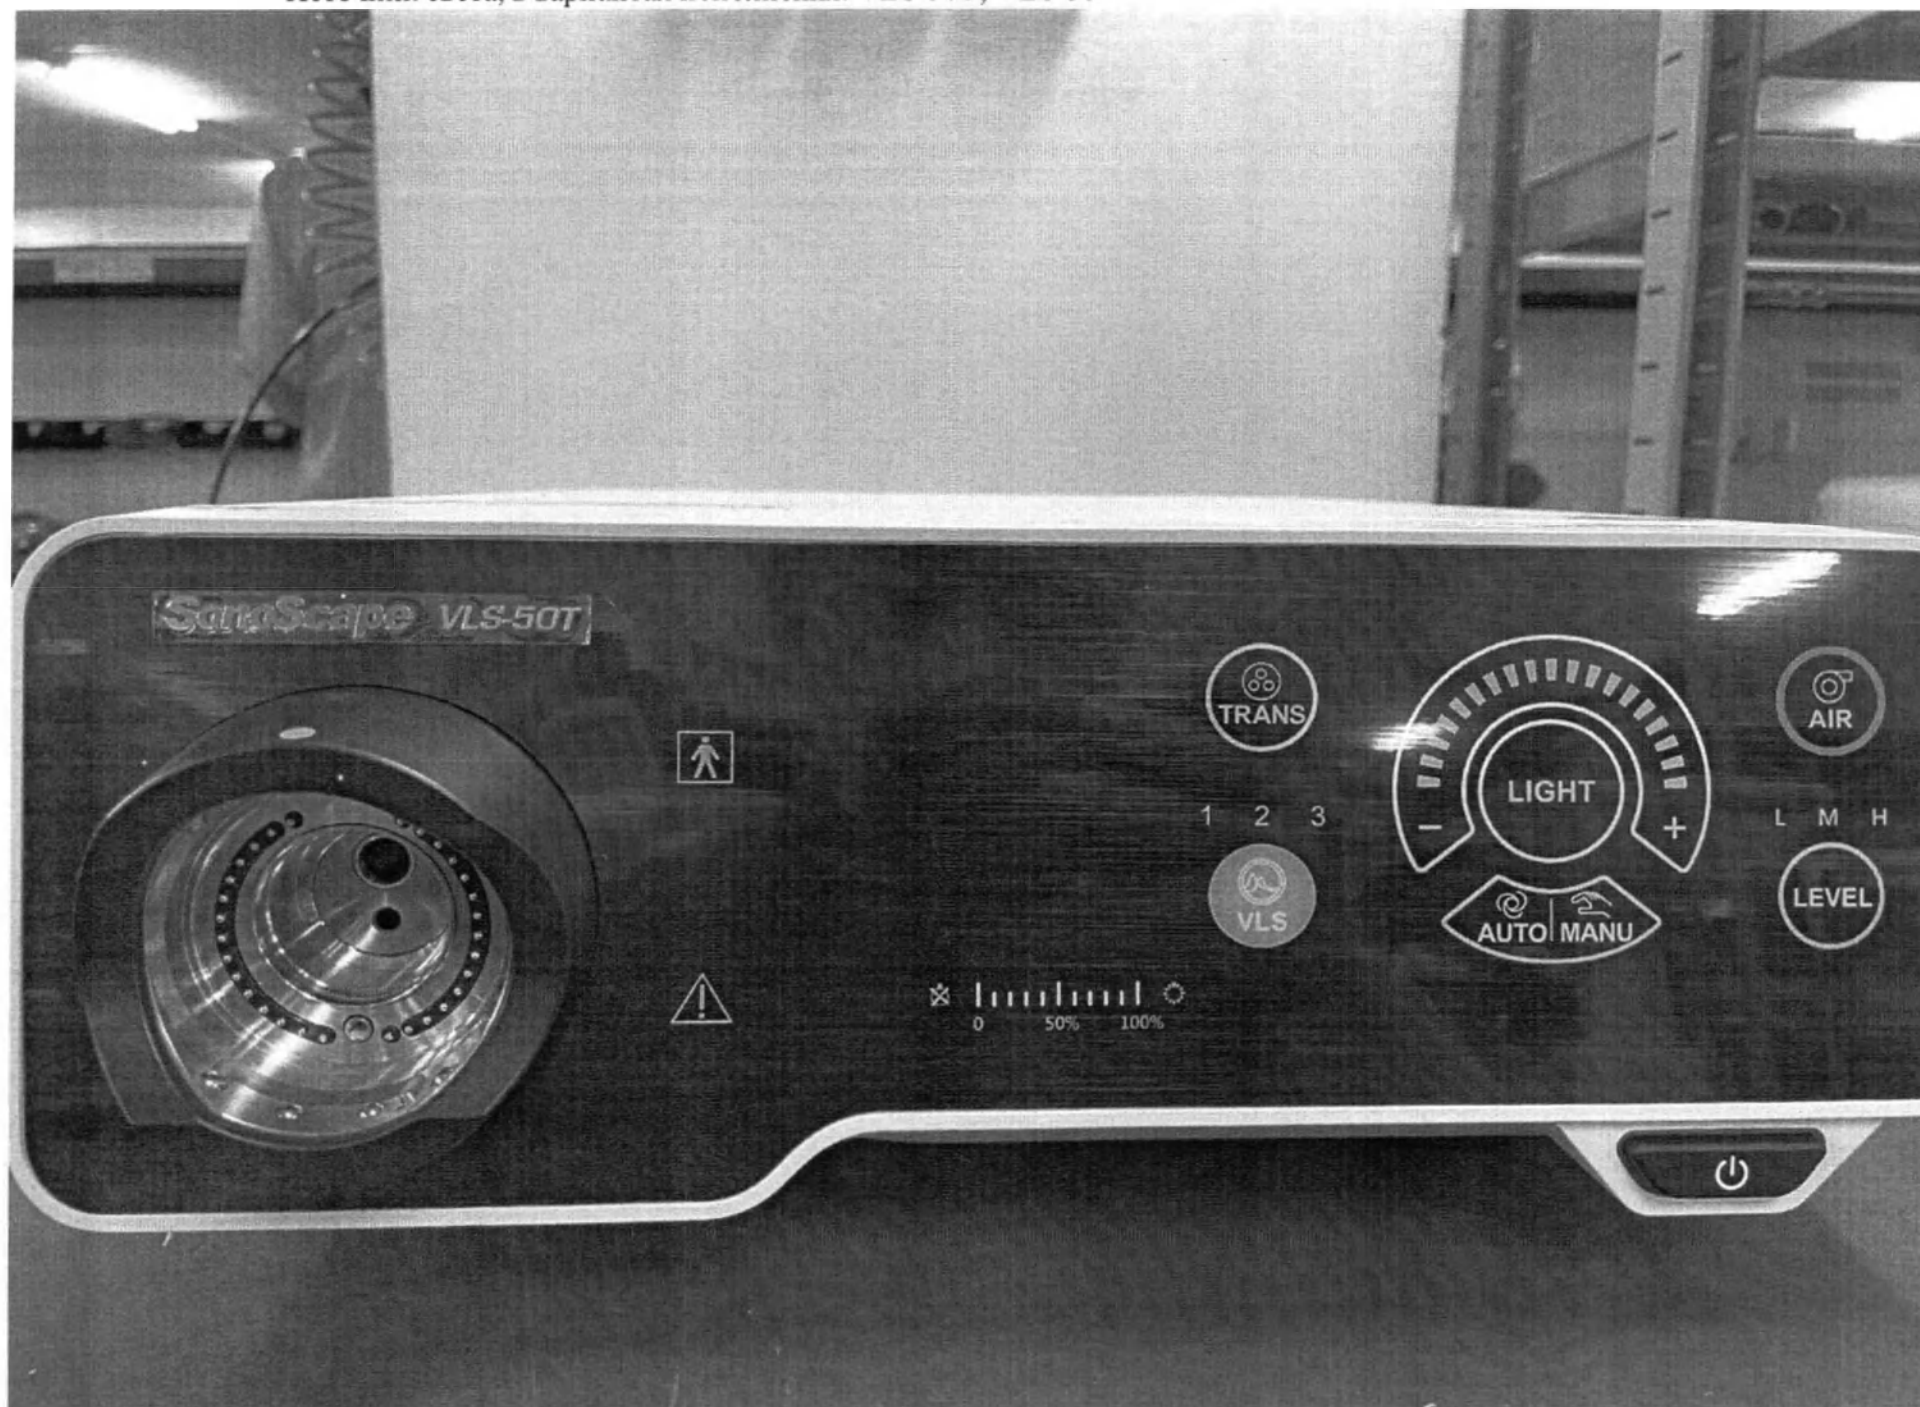





Источник света, в вариантах исполнения: VLS-55Q; VLS-55T, VLS-51T; VLS-51D






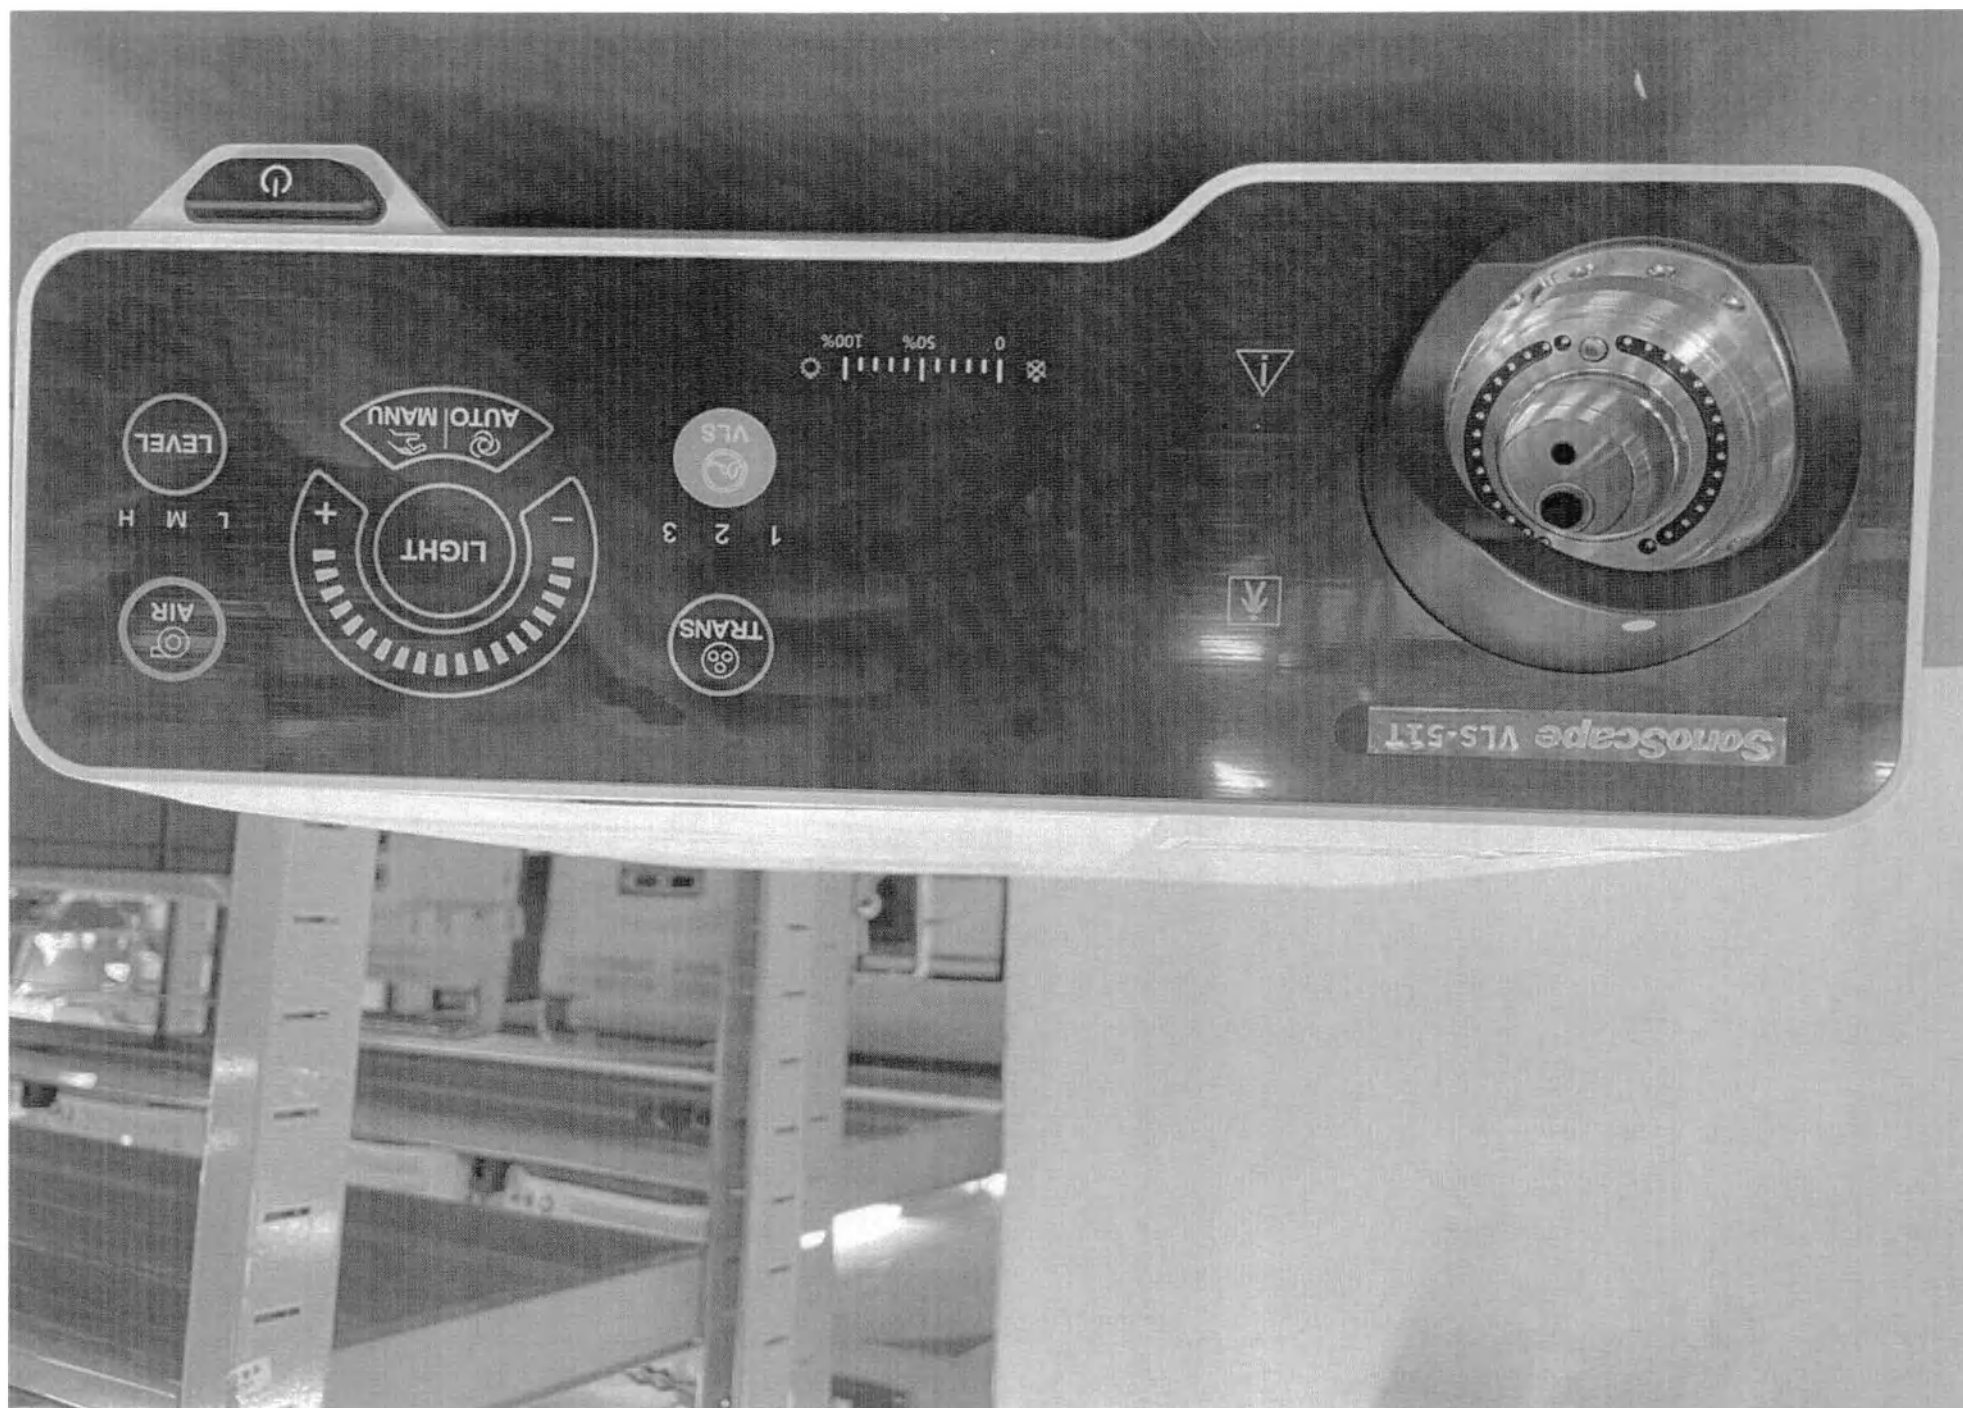


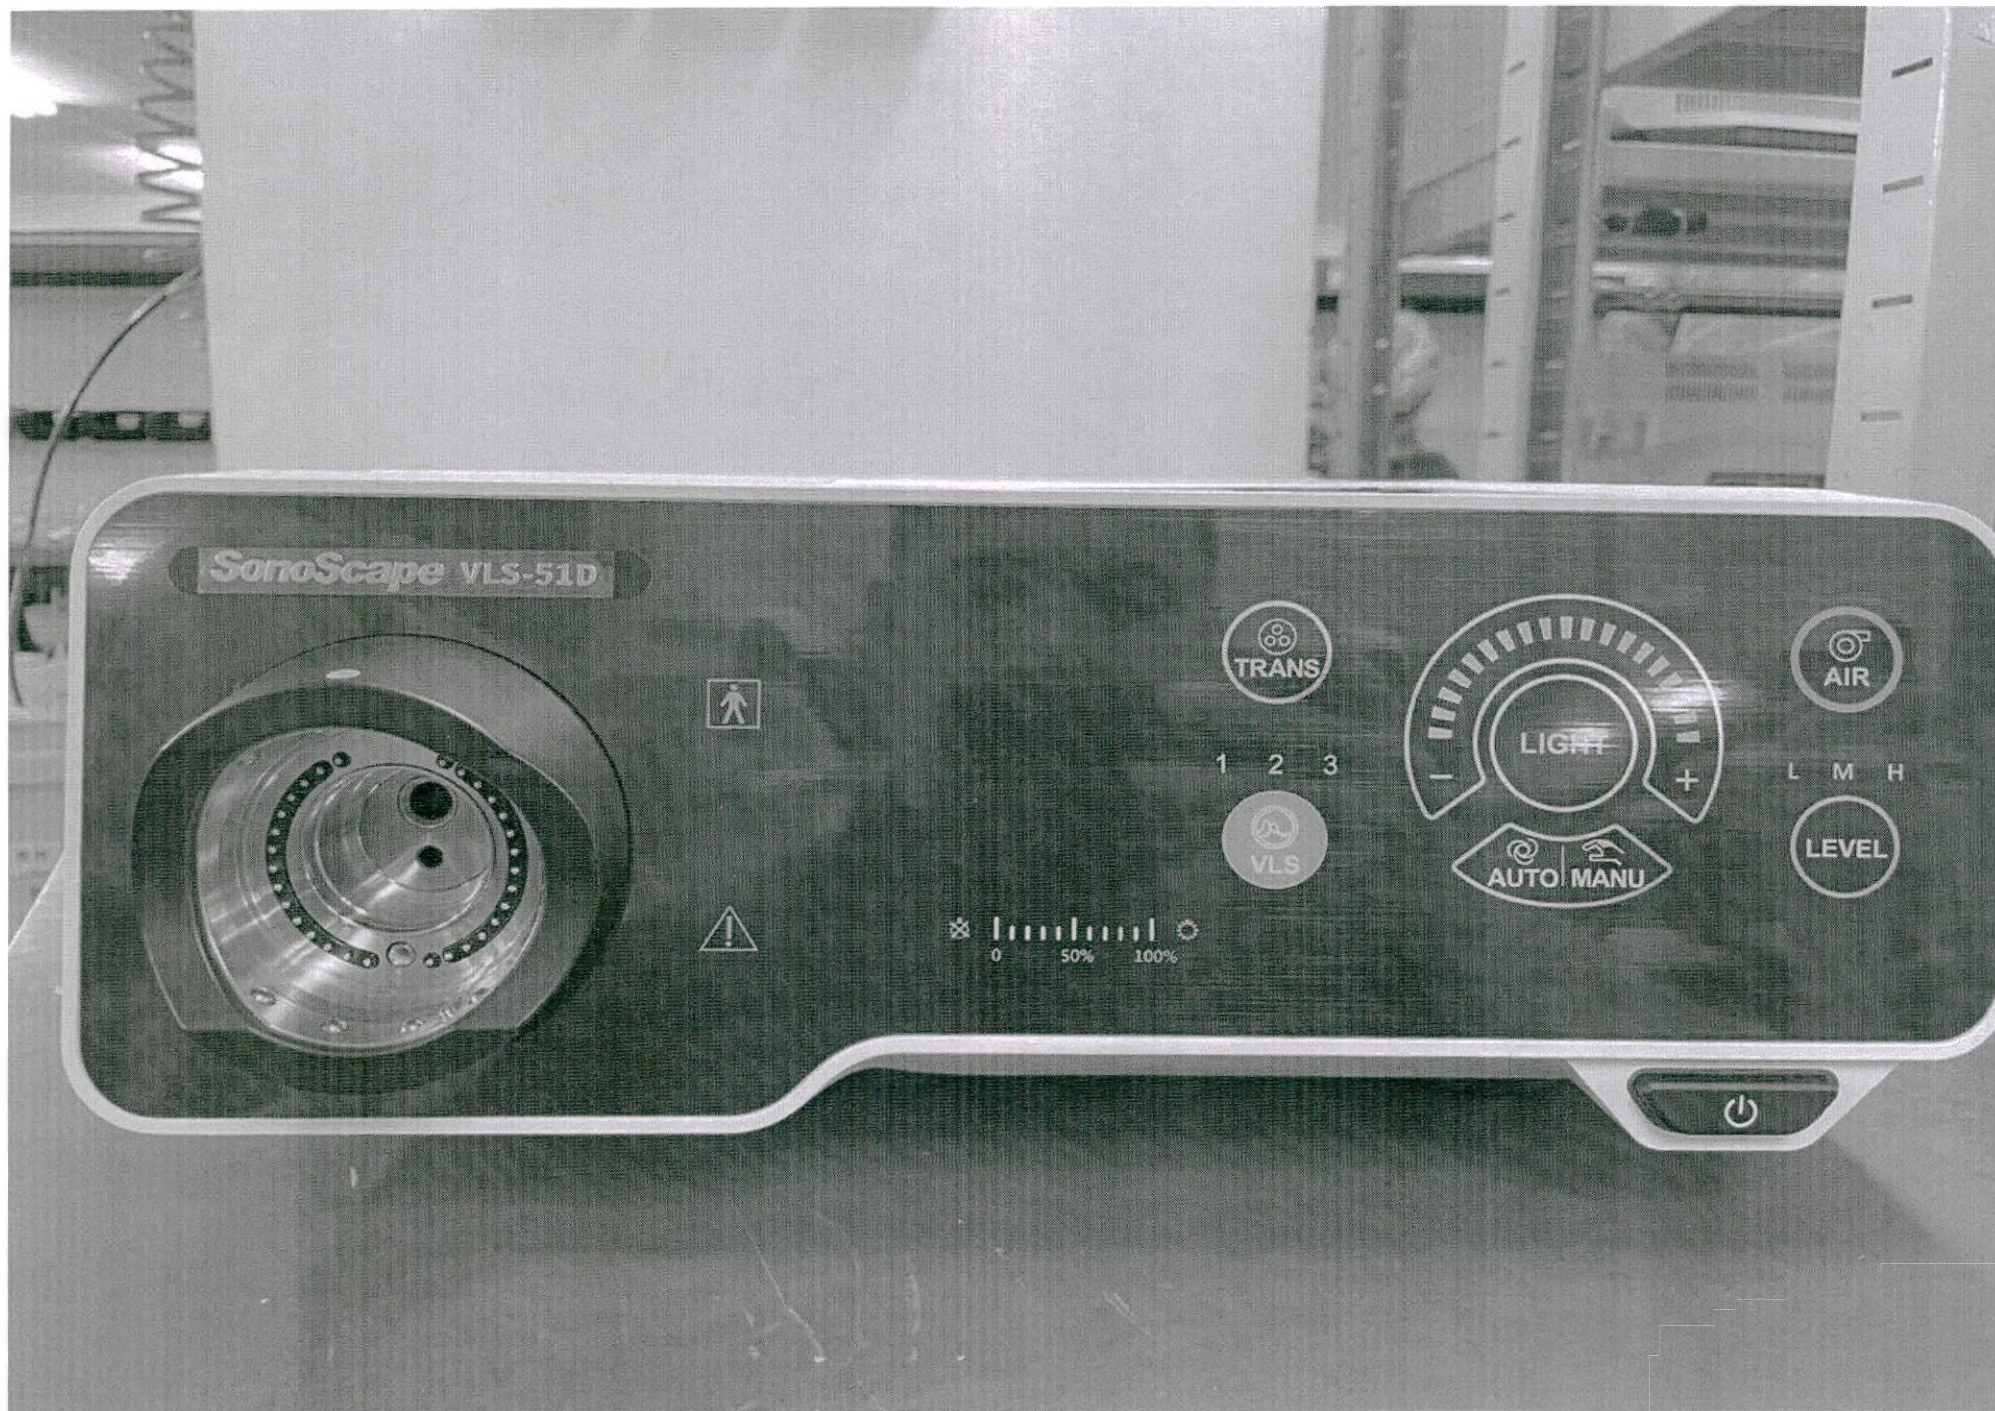


Плавкий предохранитель

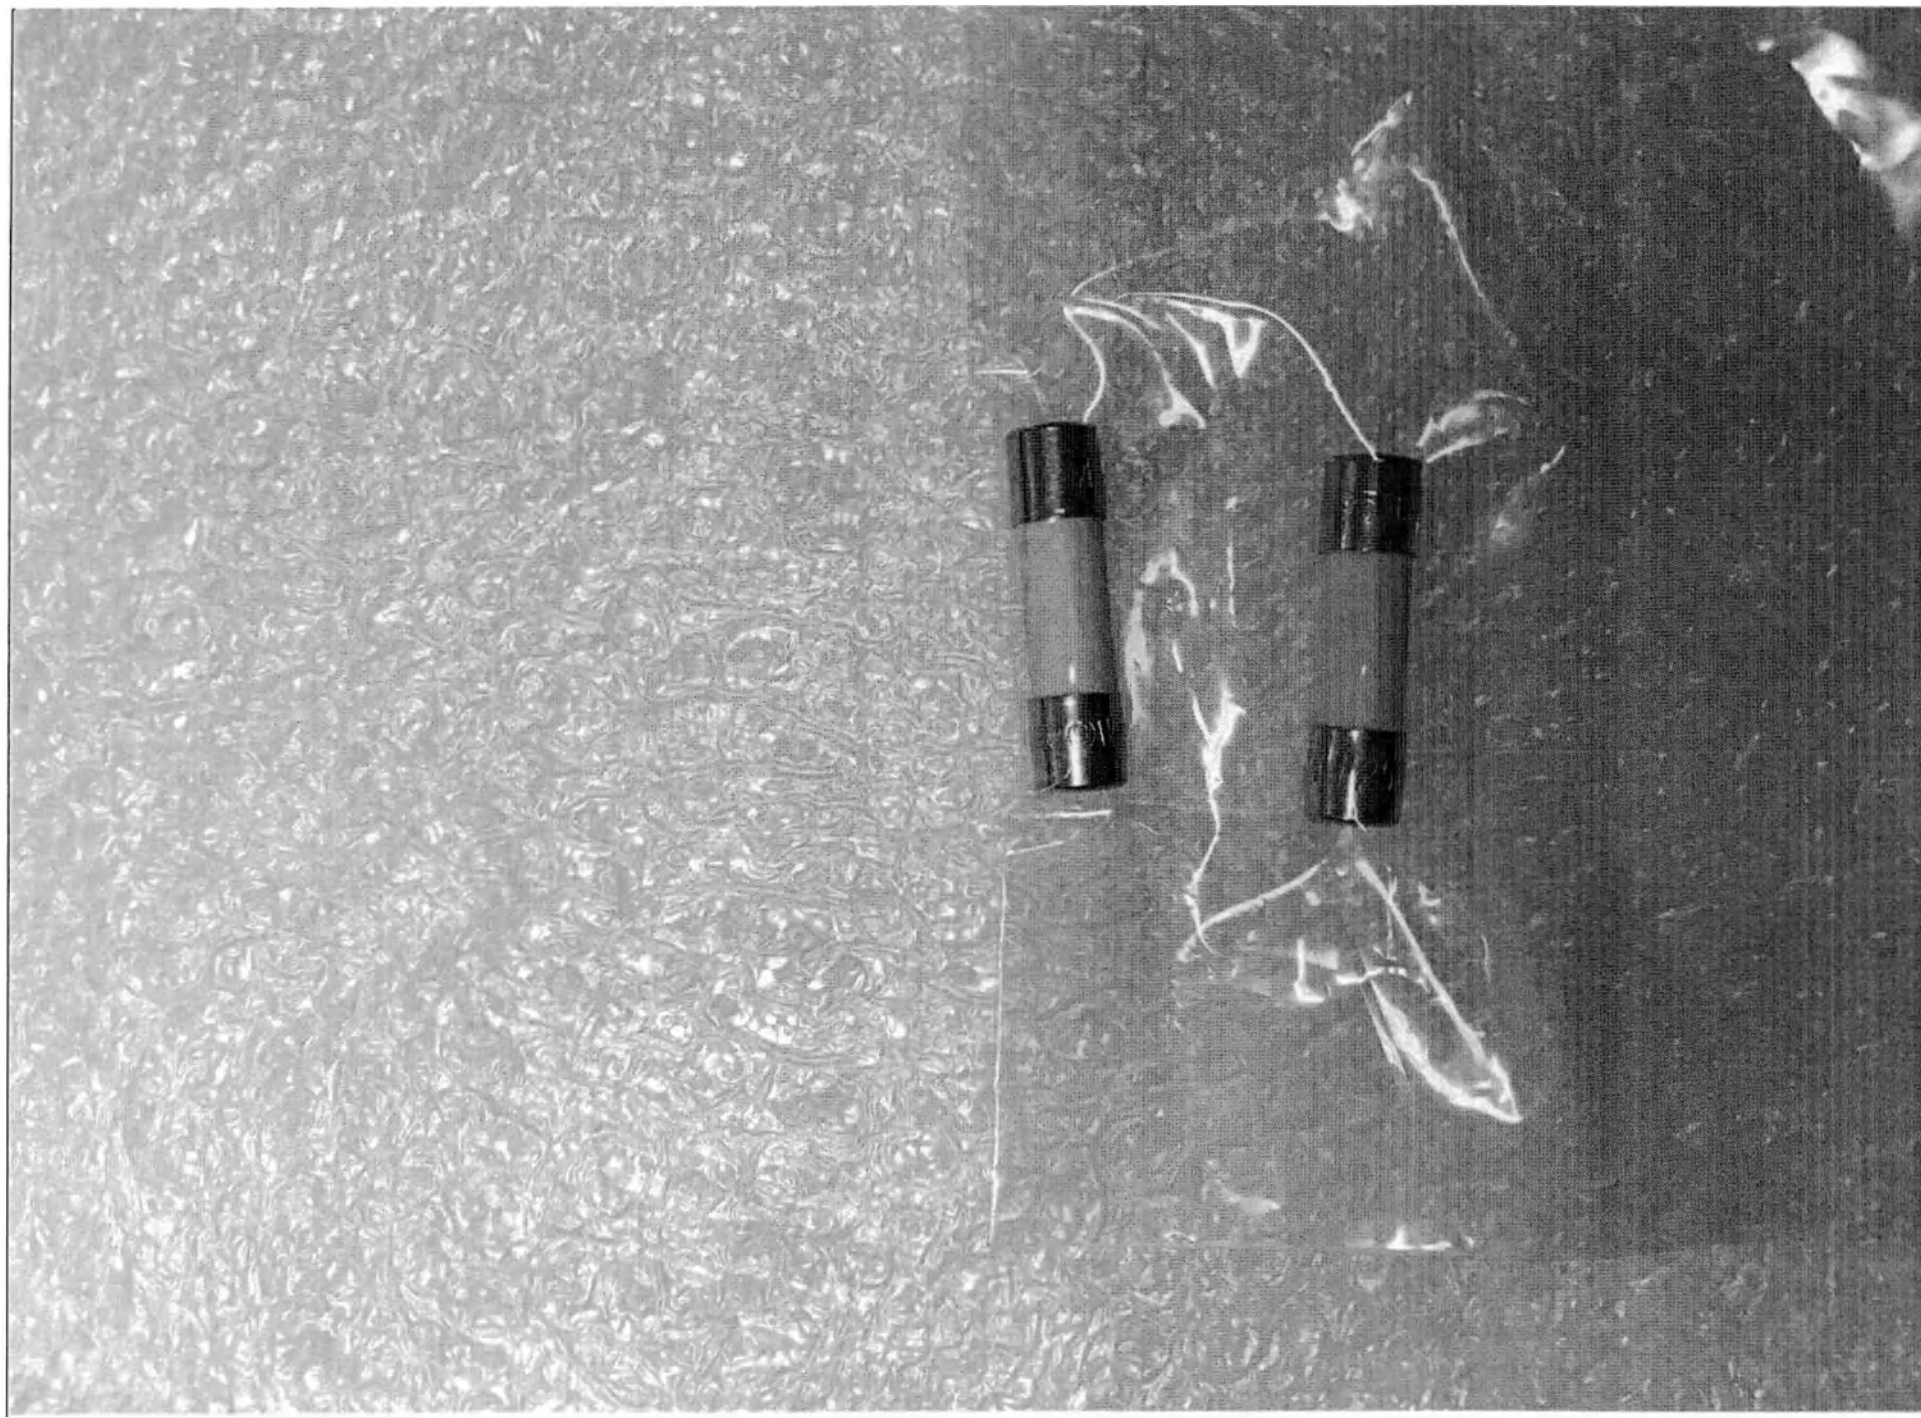

Кабель подключения к сети (при необходимости)

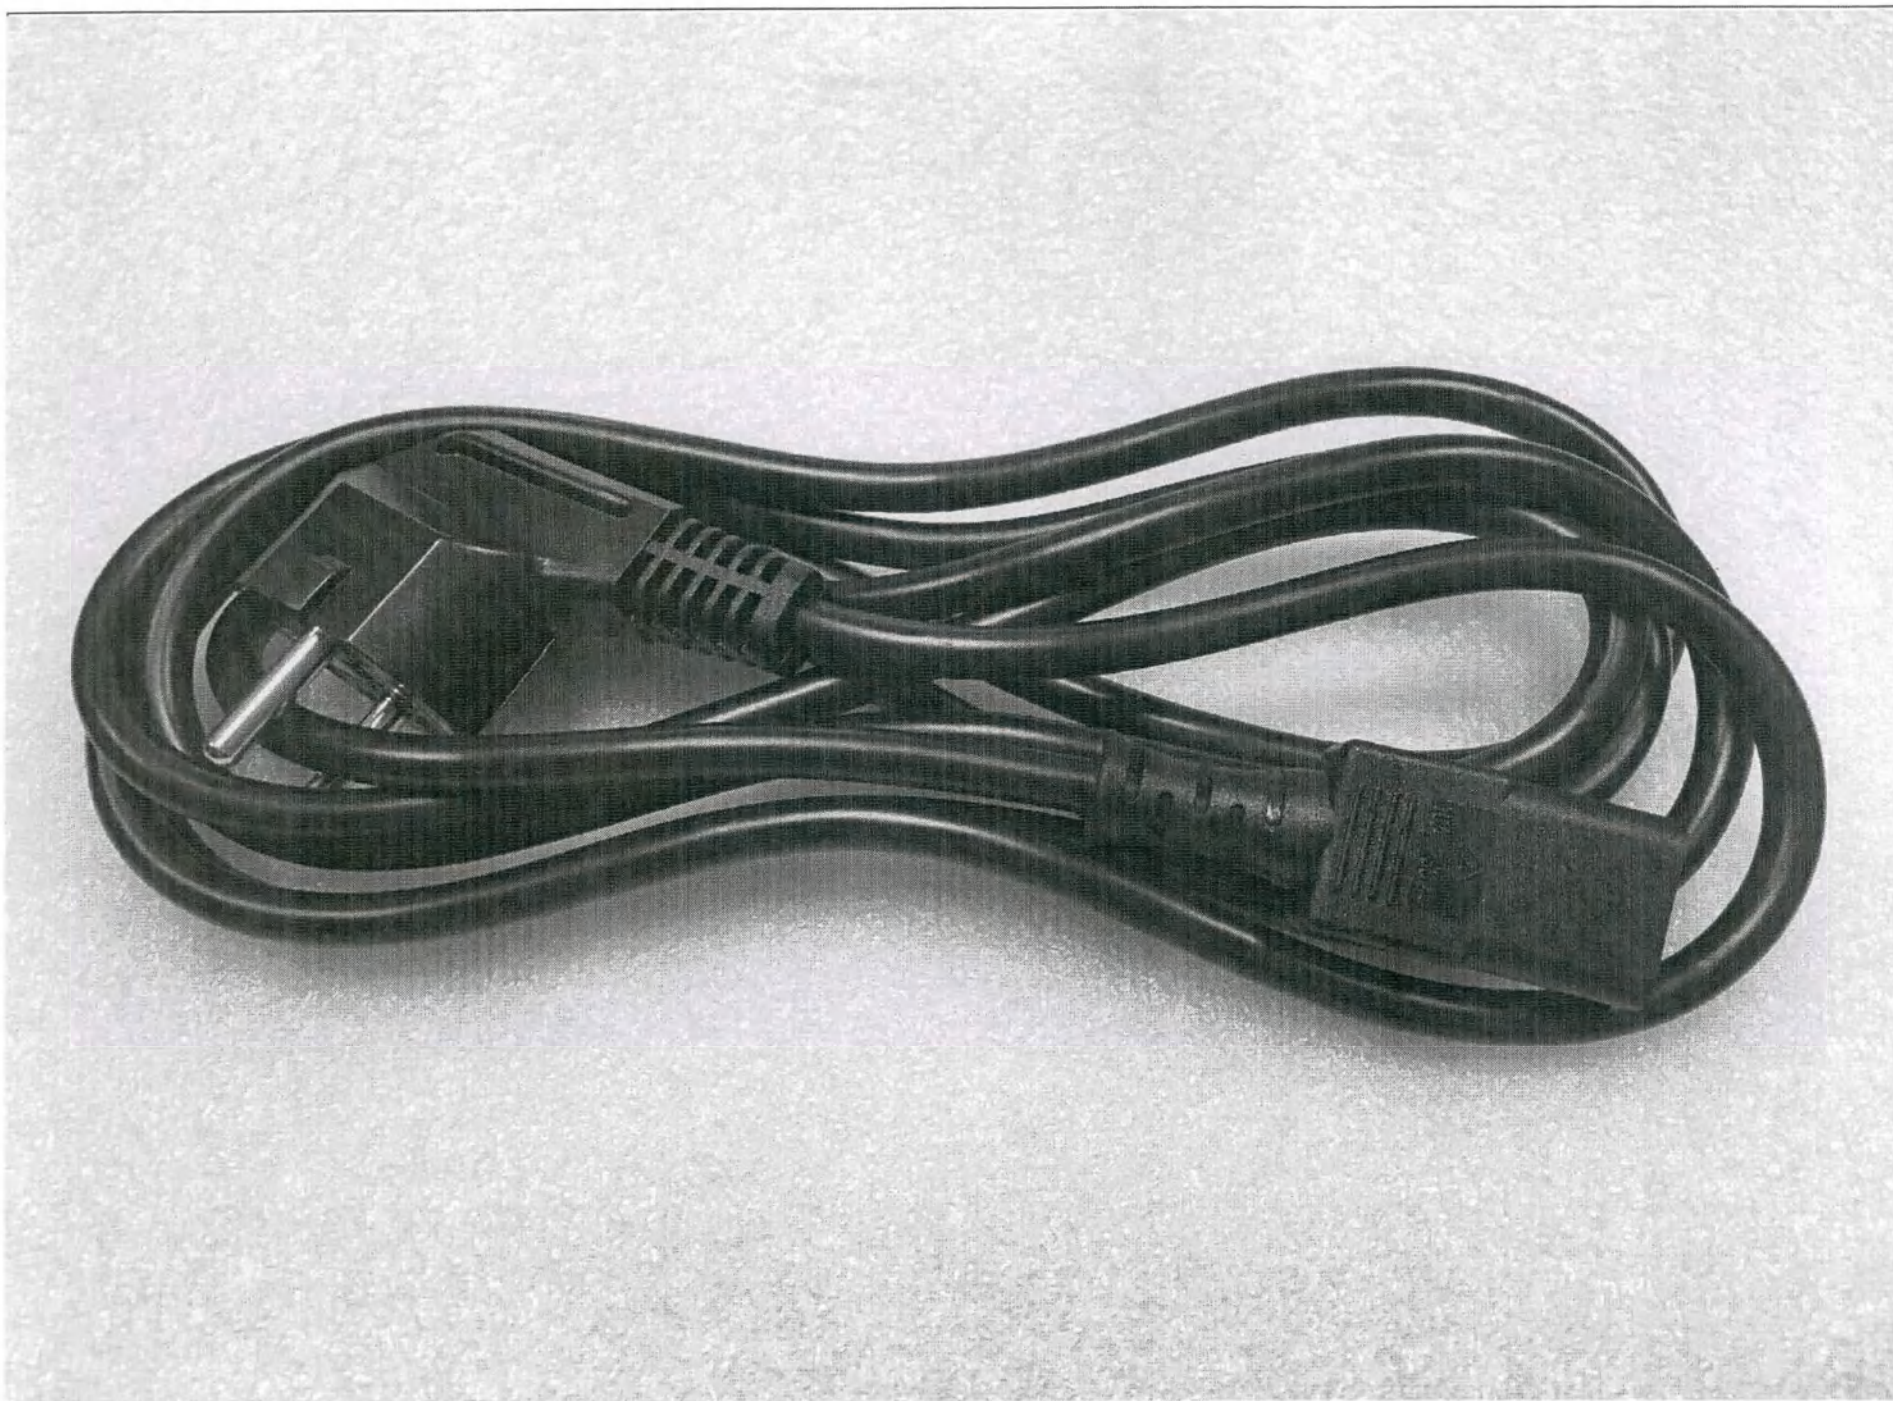

Подставка (при необходимости)

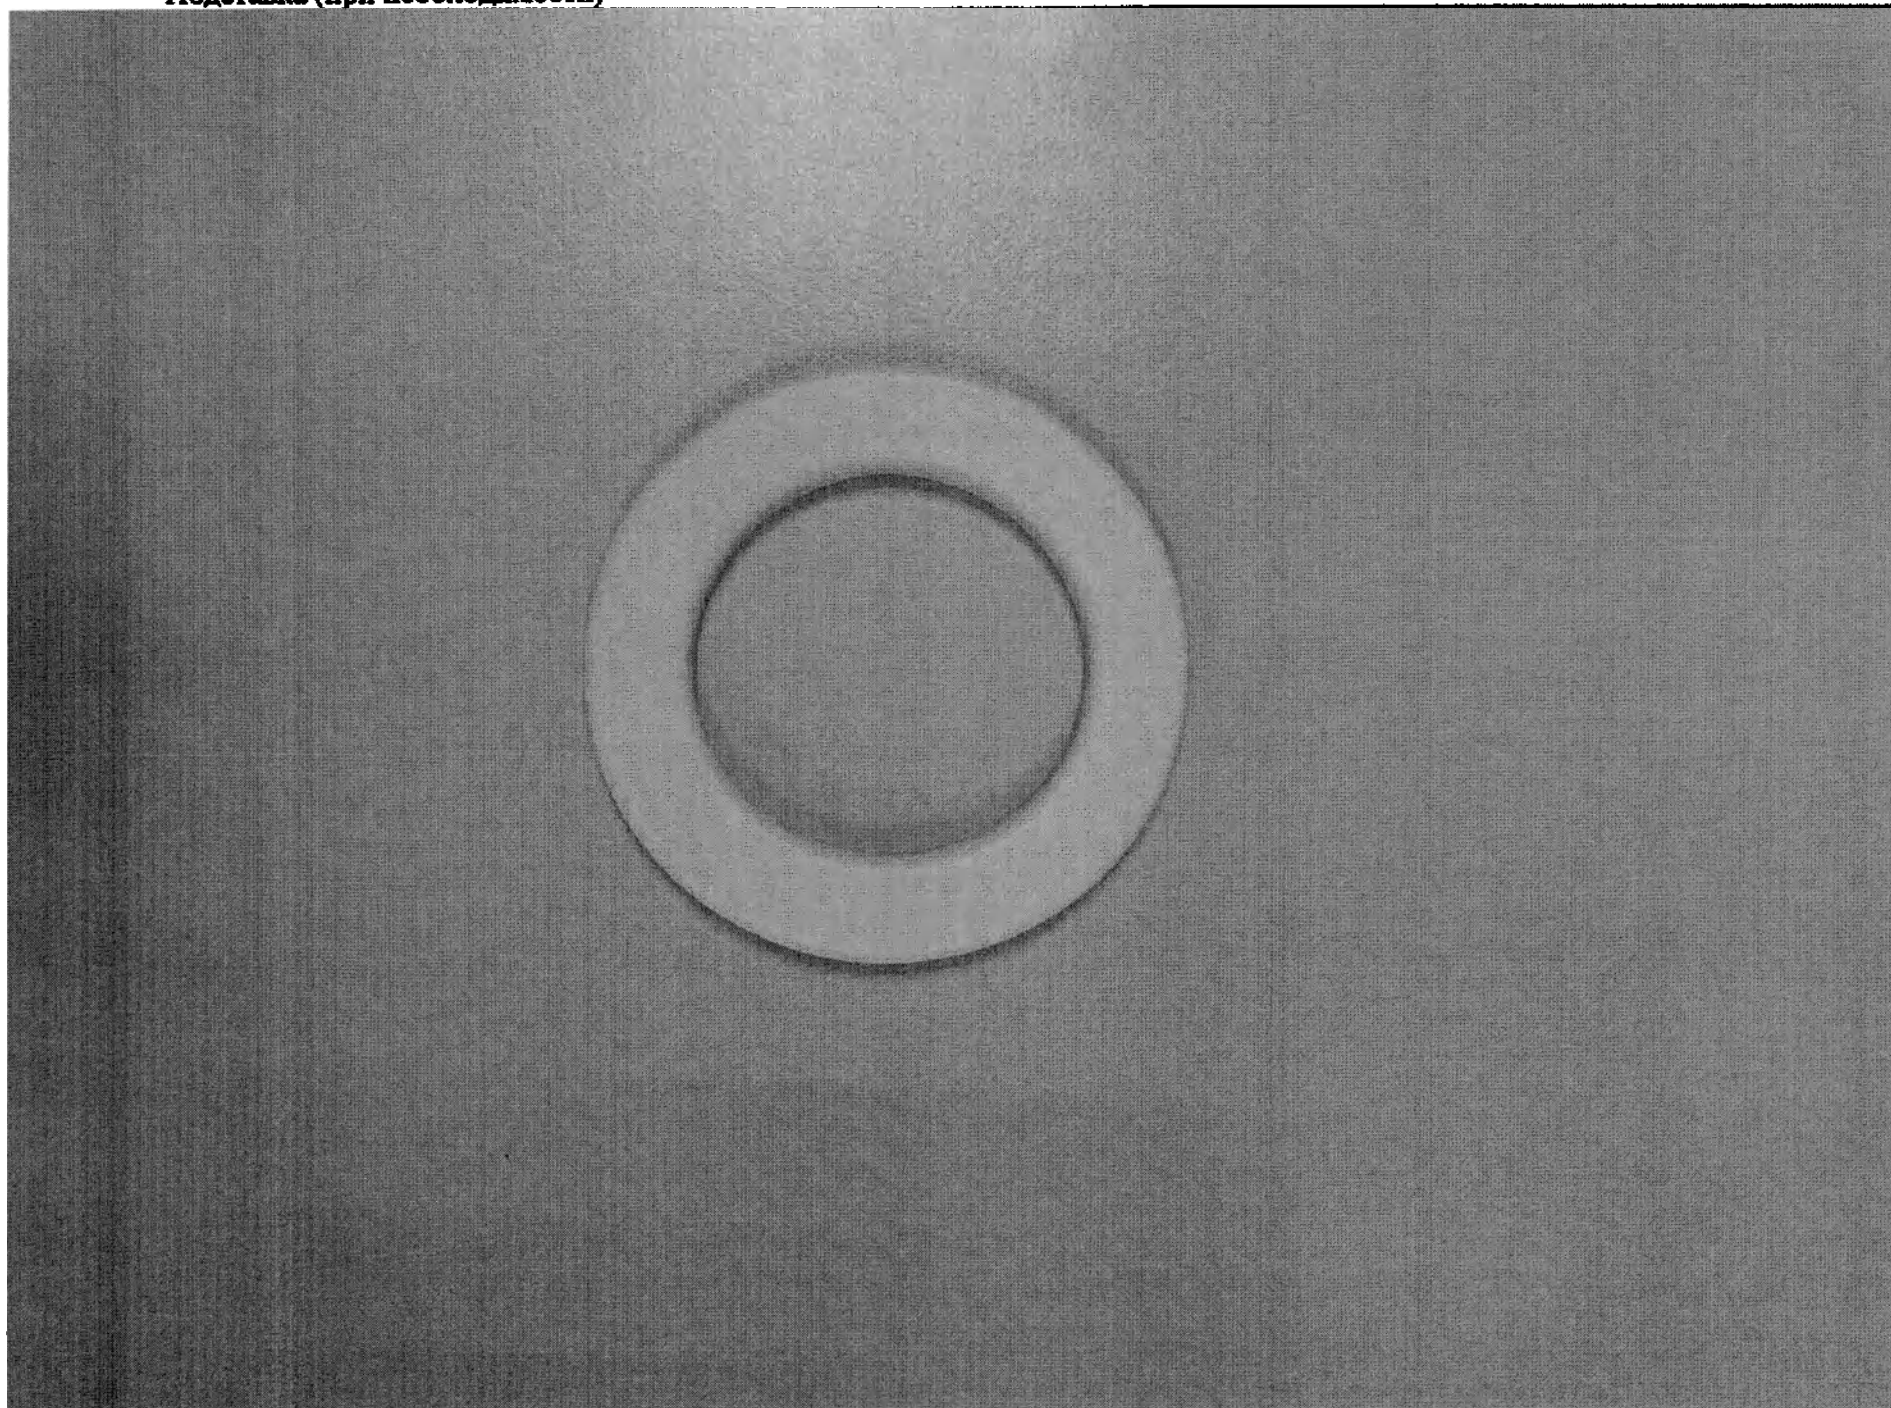


SonoScape

VLS-55Q/VLS-55T/VLS-51T/VLS-51D

Источник света

Руководство пользователя

V. Тележка эндоскопическая HDT-500

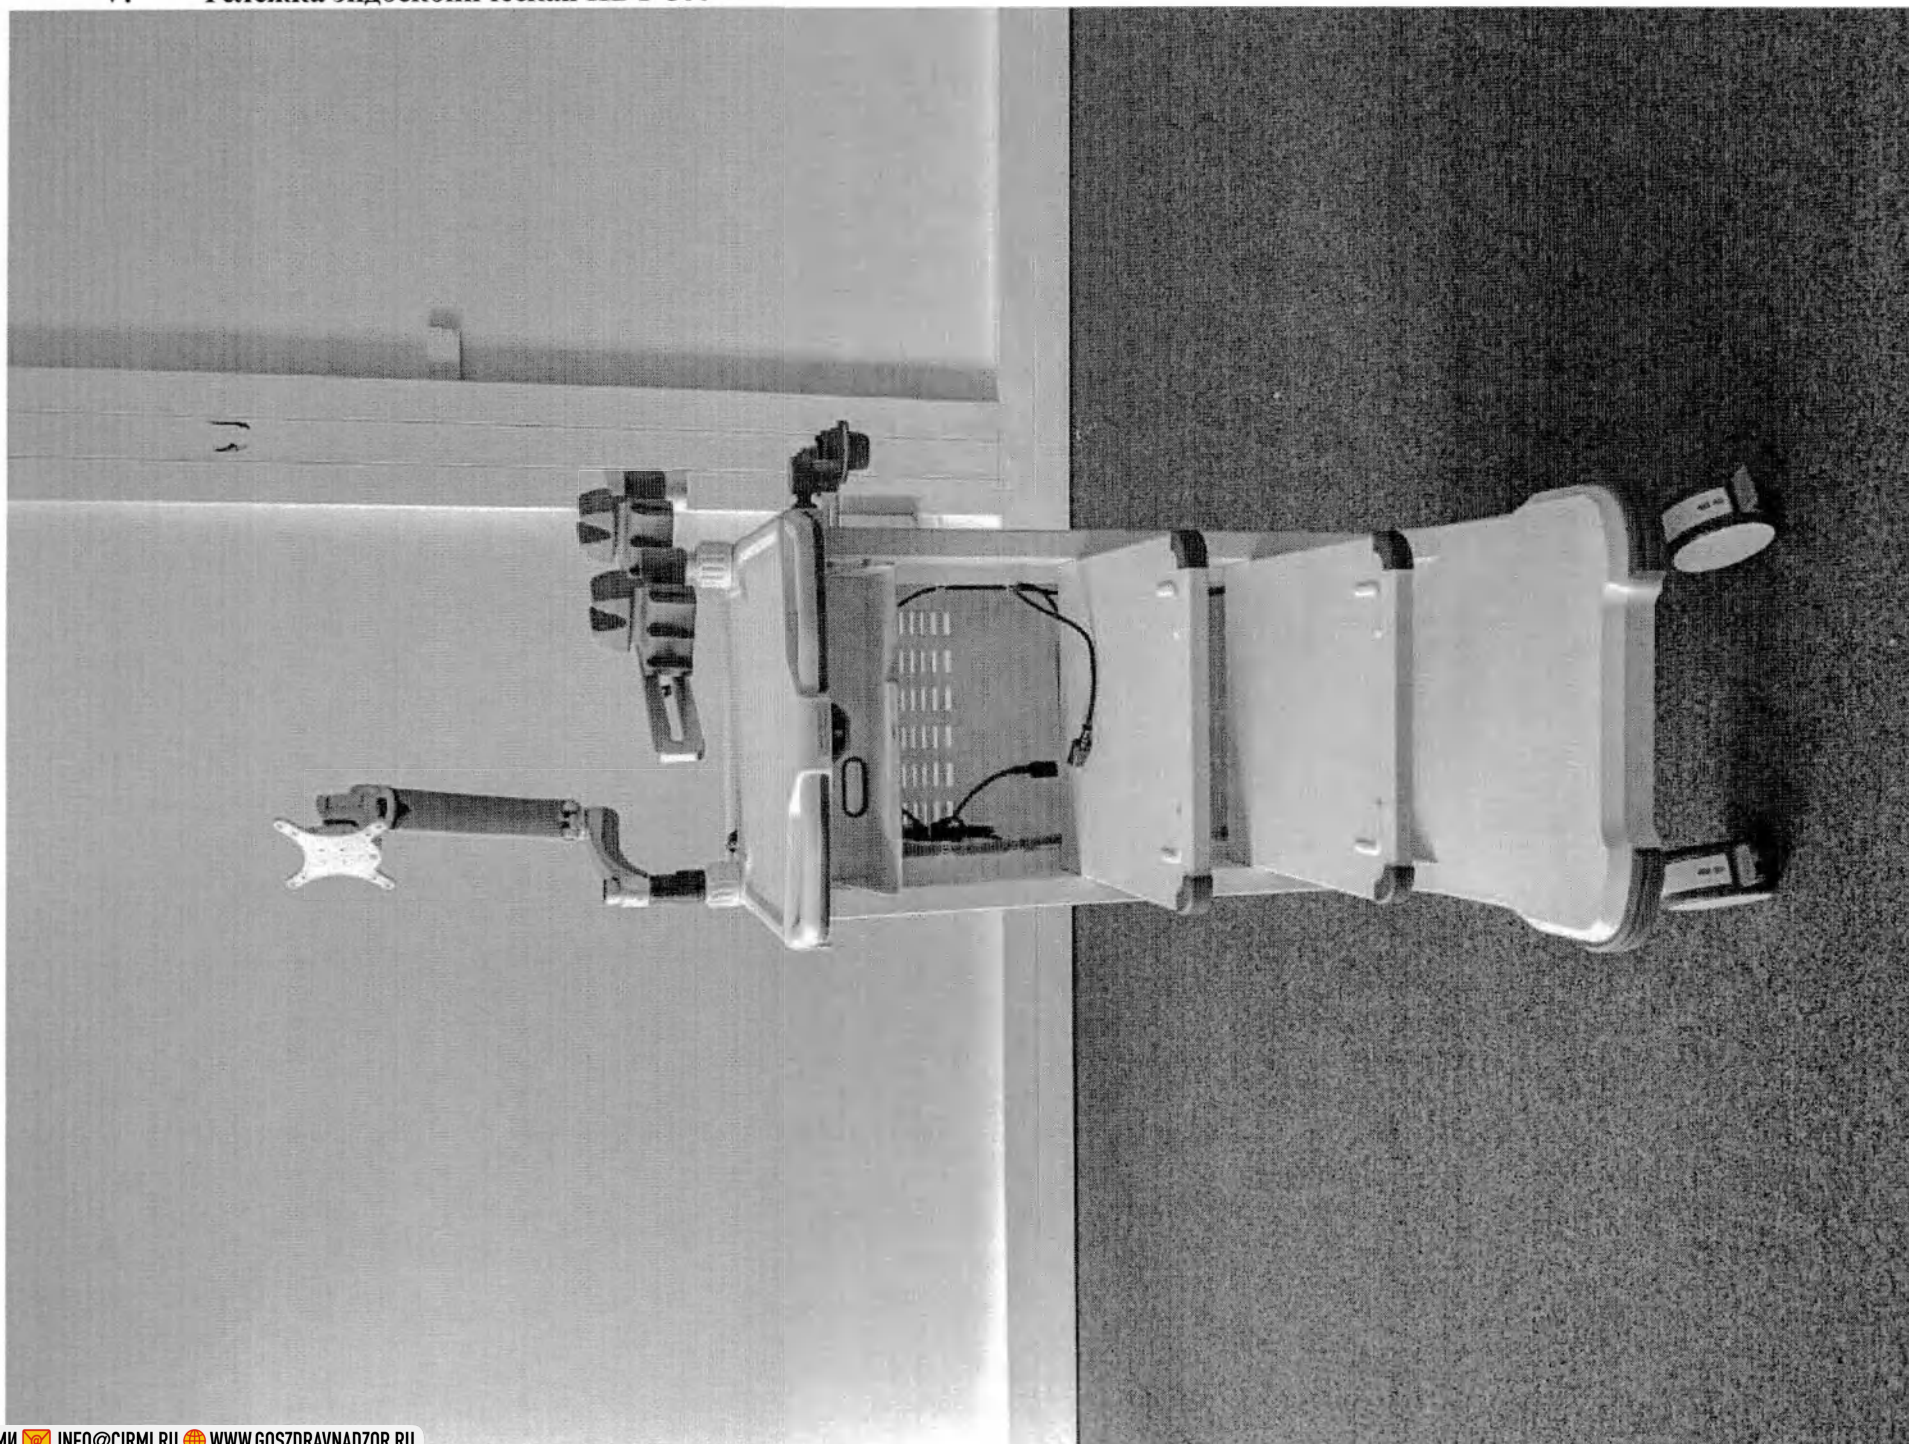

SonoScape

HDT-500

Тележка эндоскопическая


Руководство пользователя

www.sonoscape.com

VI. Монитор медицинский высокой четкости




Шнур сетевой

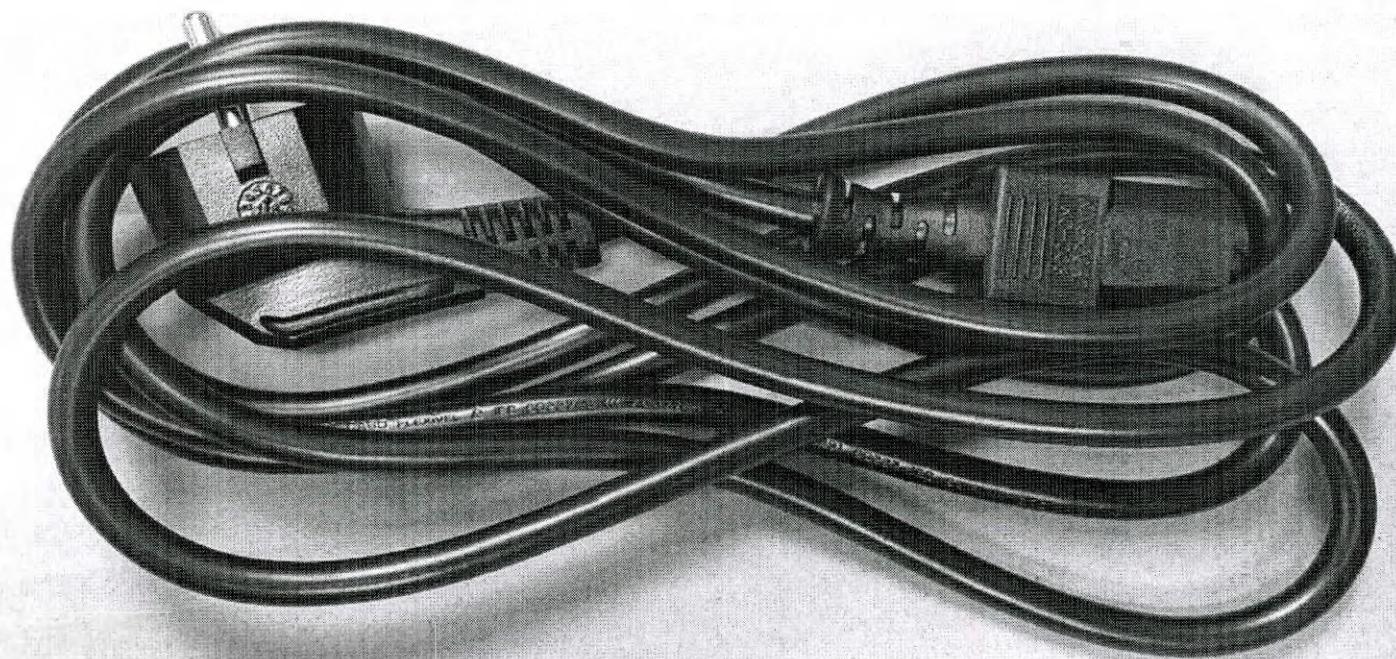


Сетевой адаптер



Кабель DVI

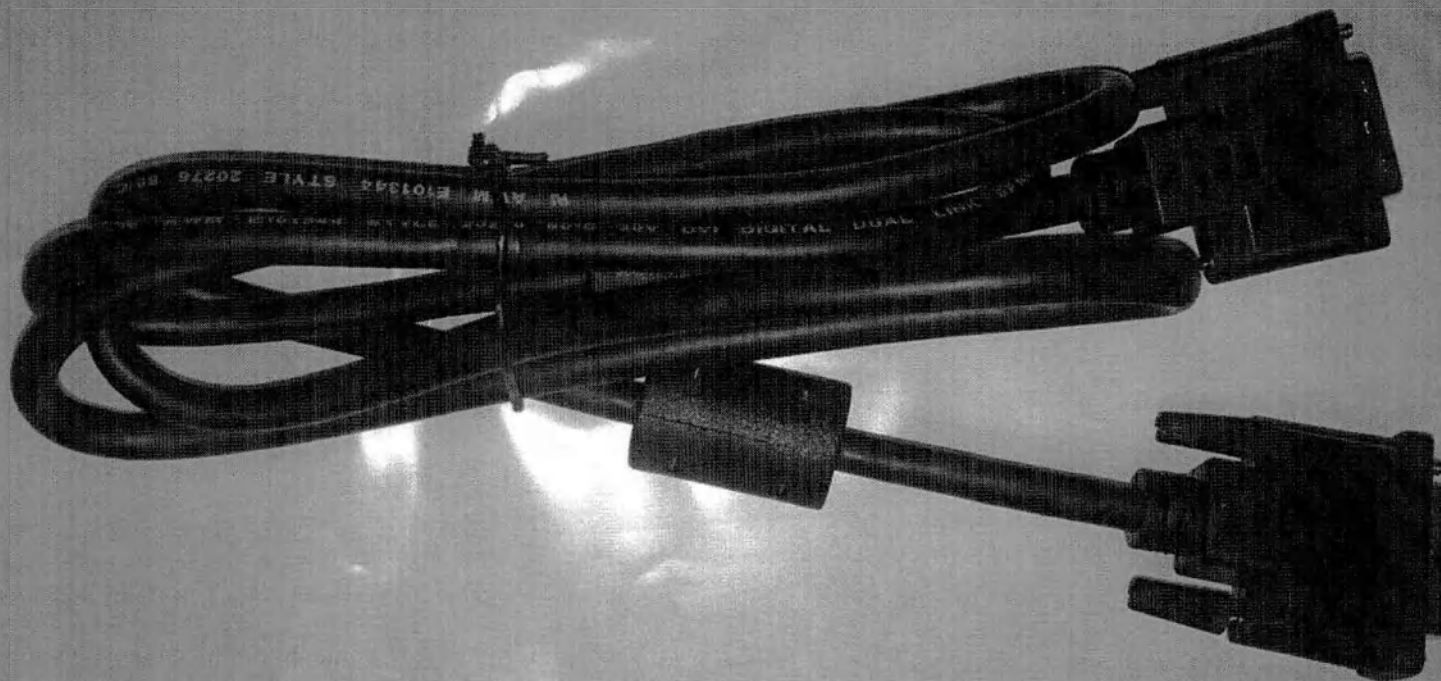

Кабель заземления

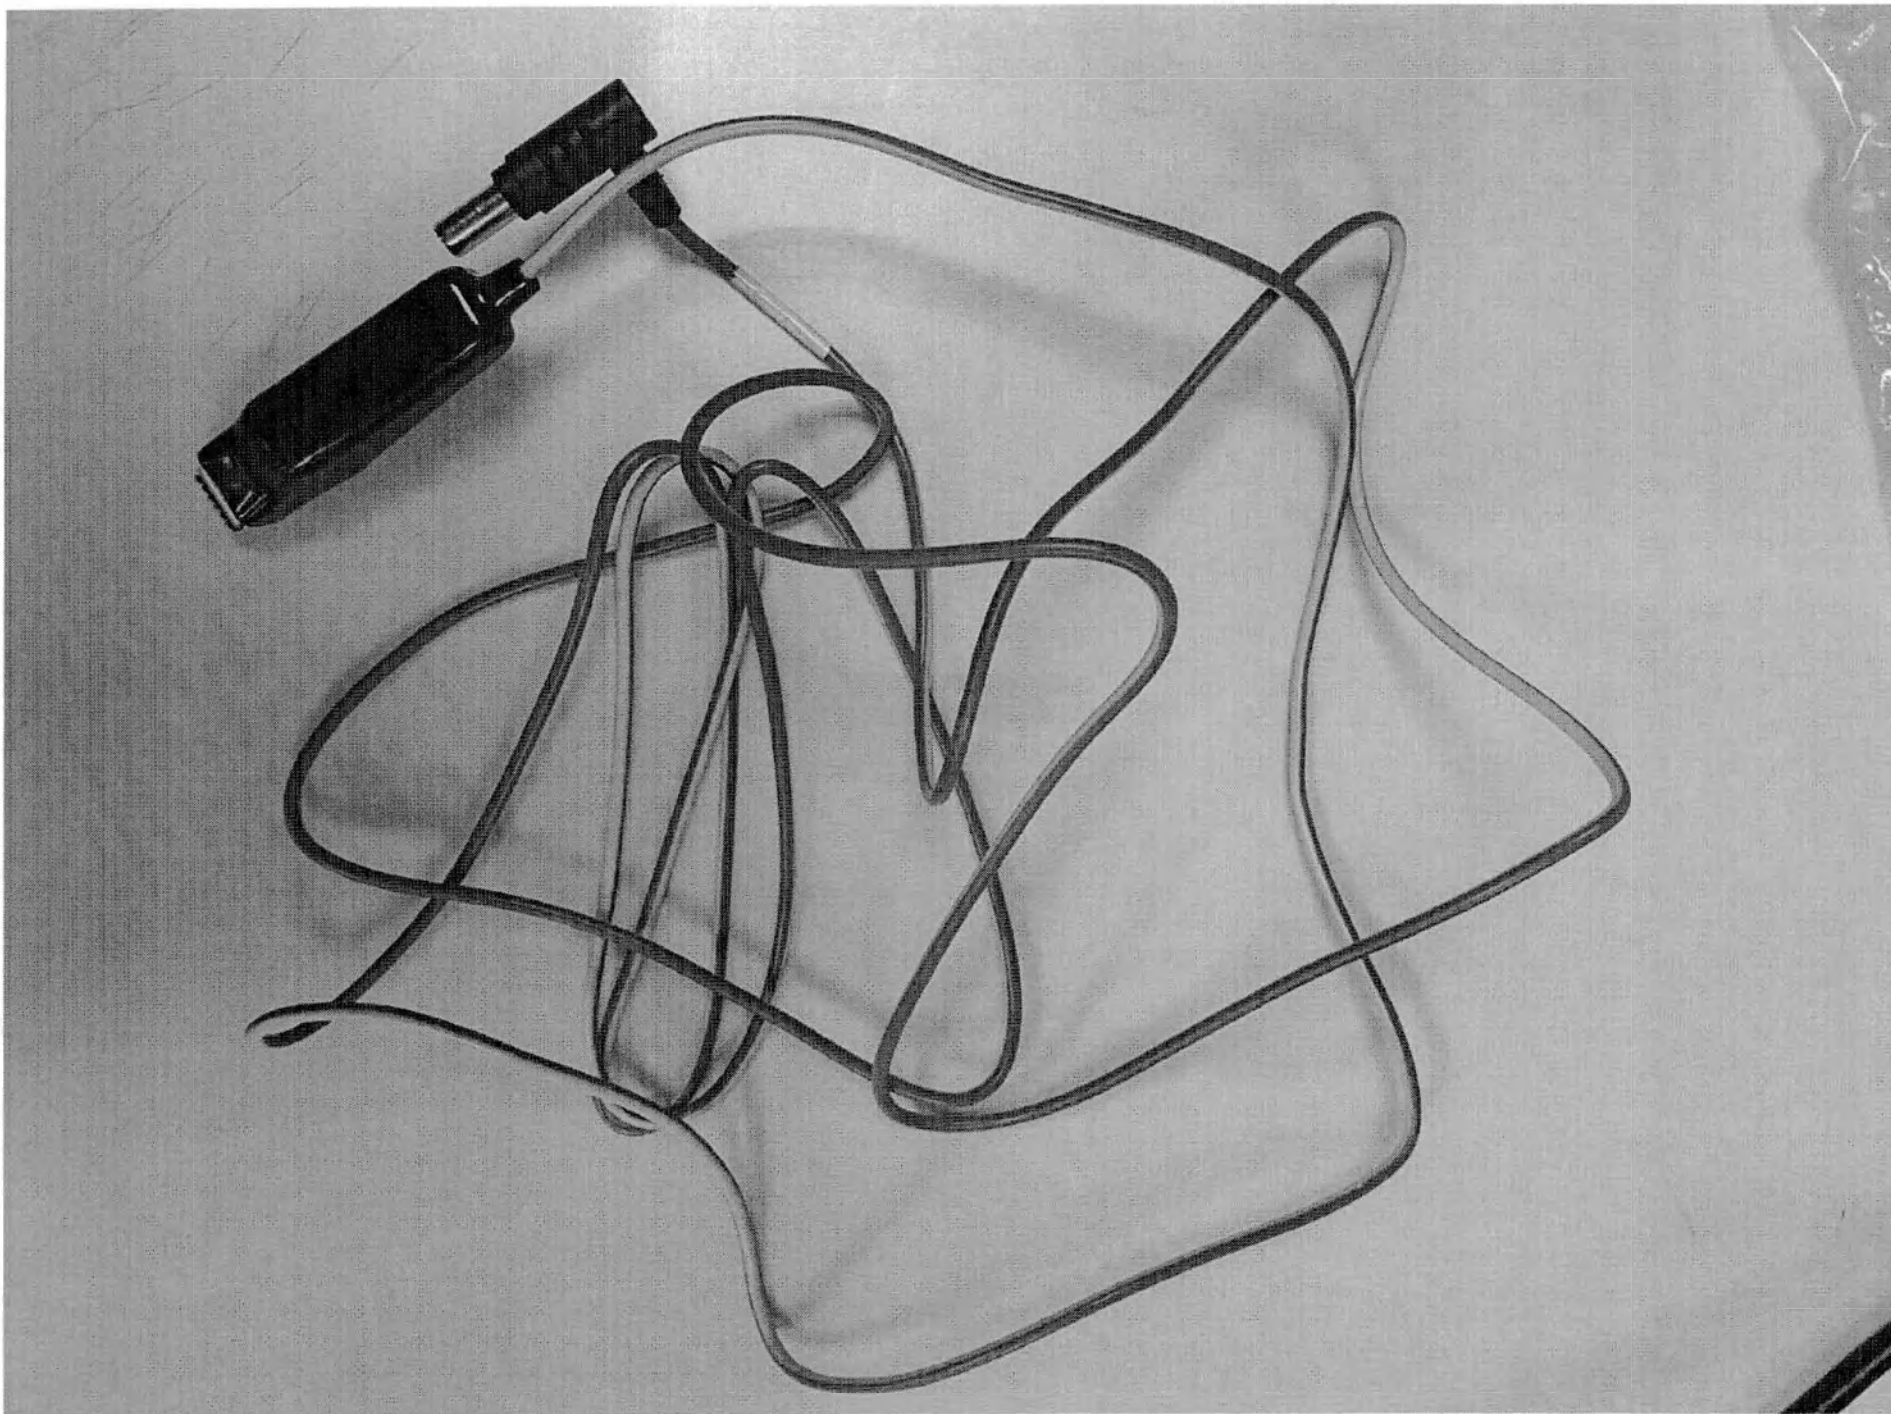



SonoScape


Монитор


Руководство пользователя


E-mail: sonoscape@sonoscape.net www.sonoscape.com

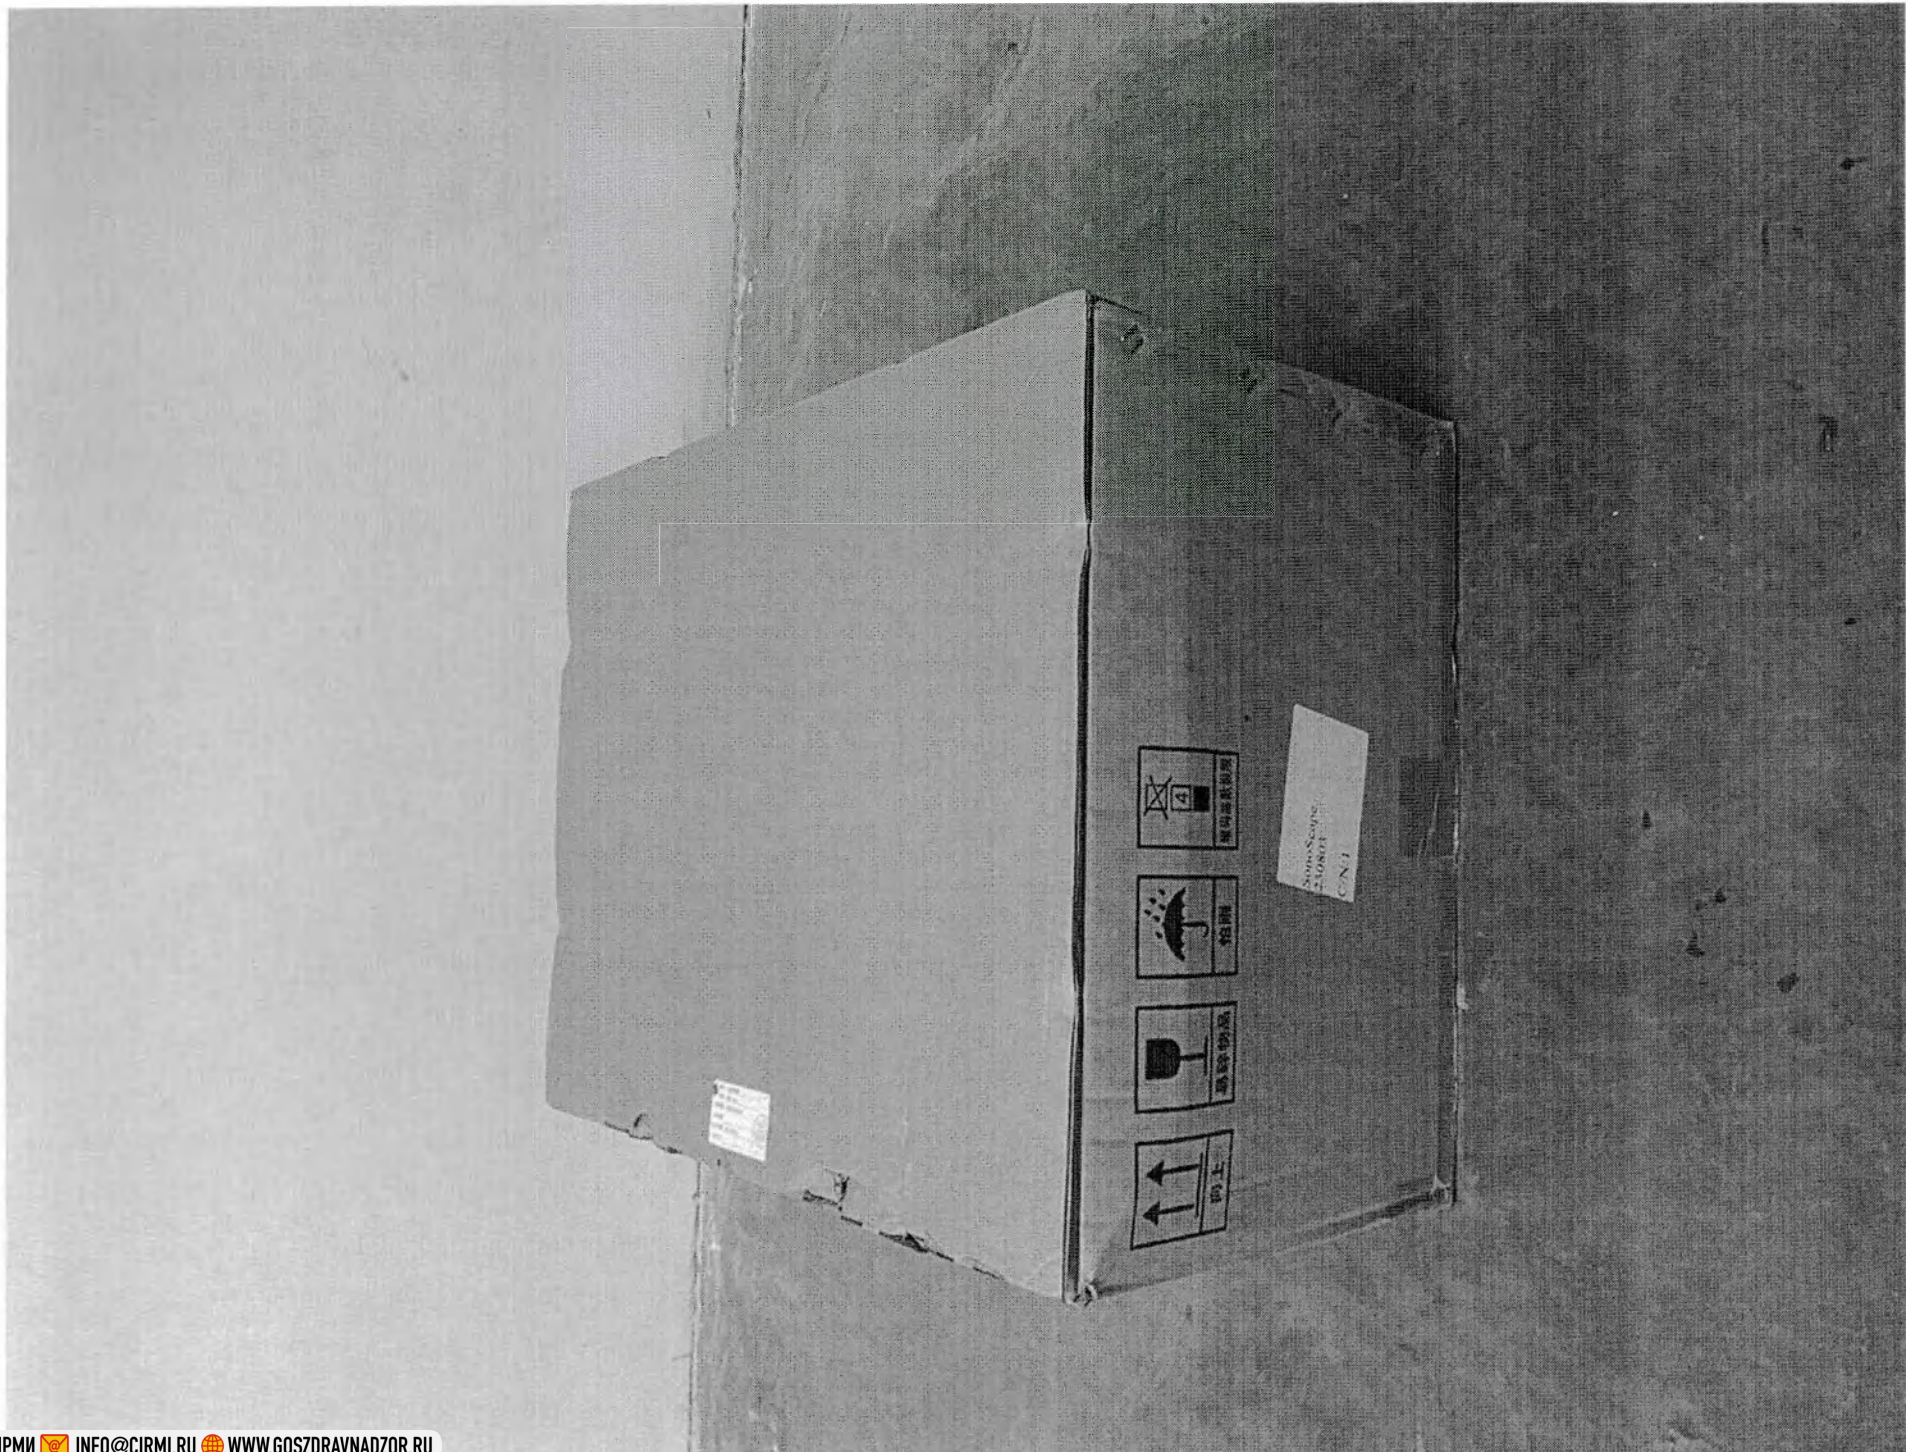

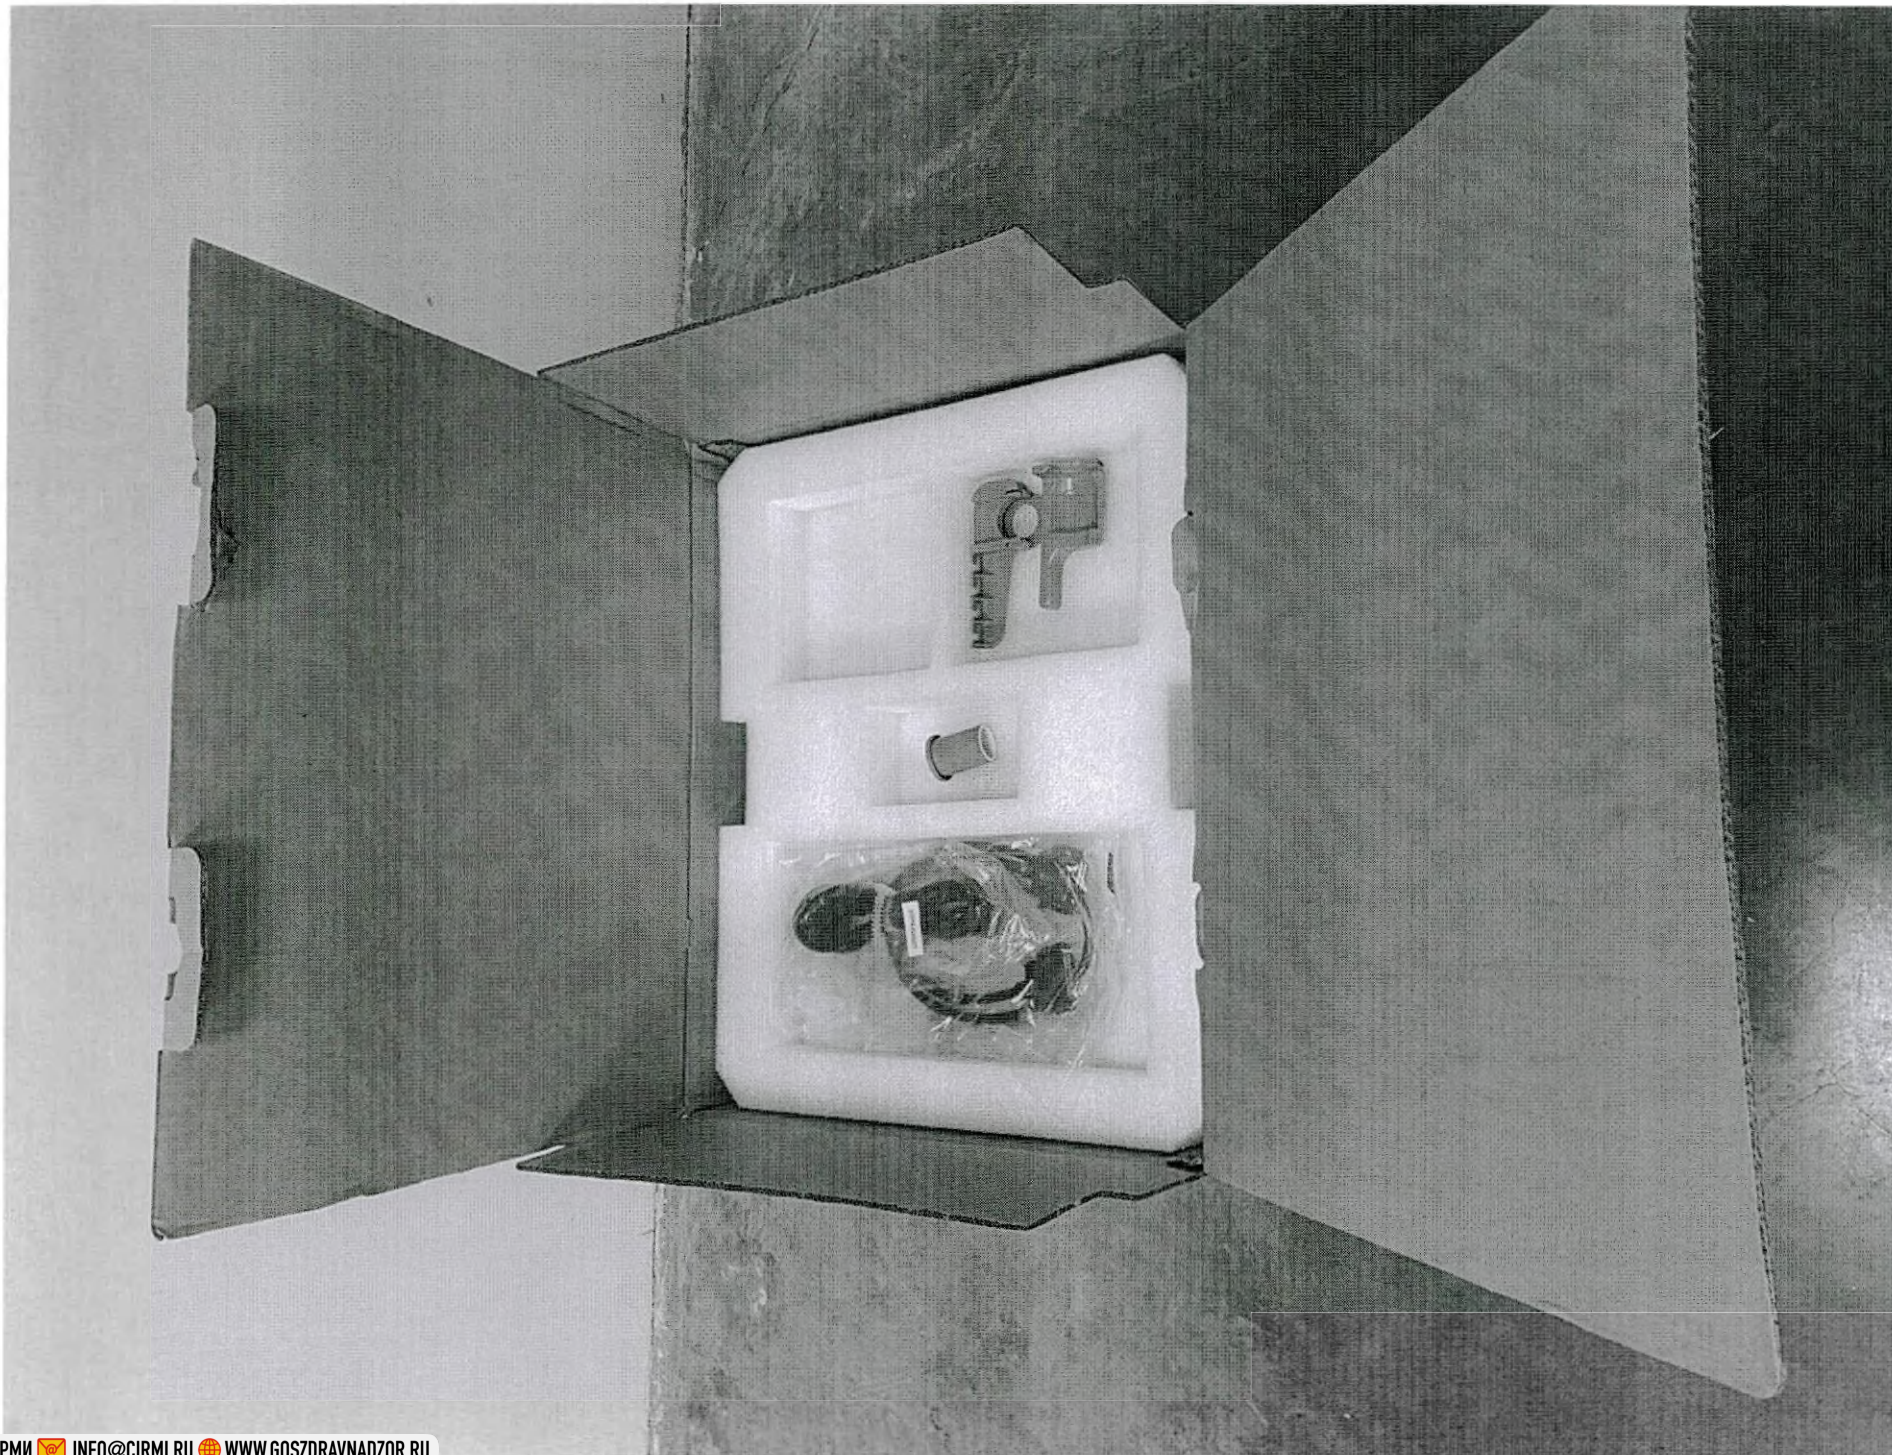


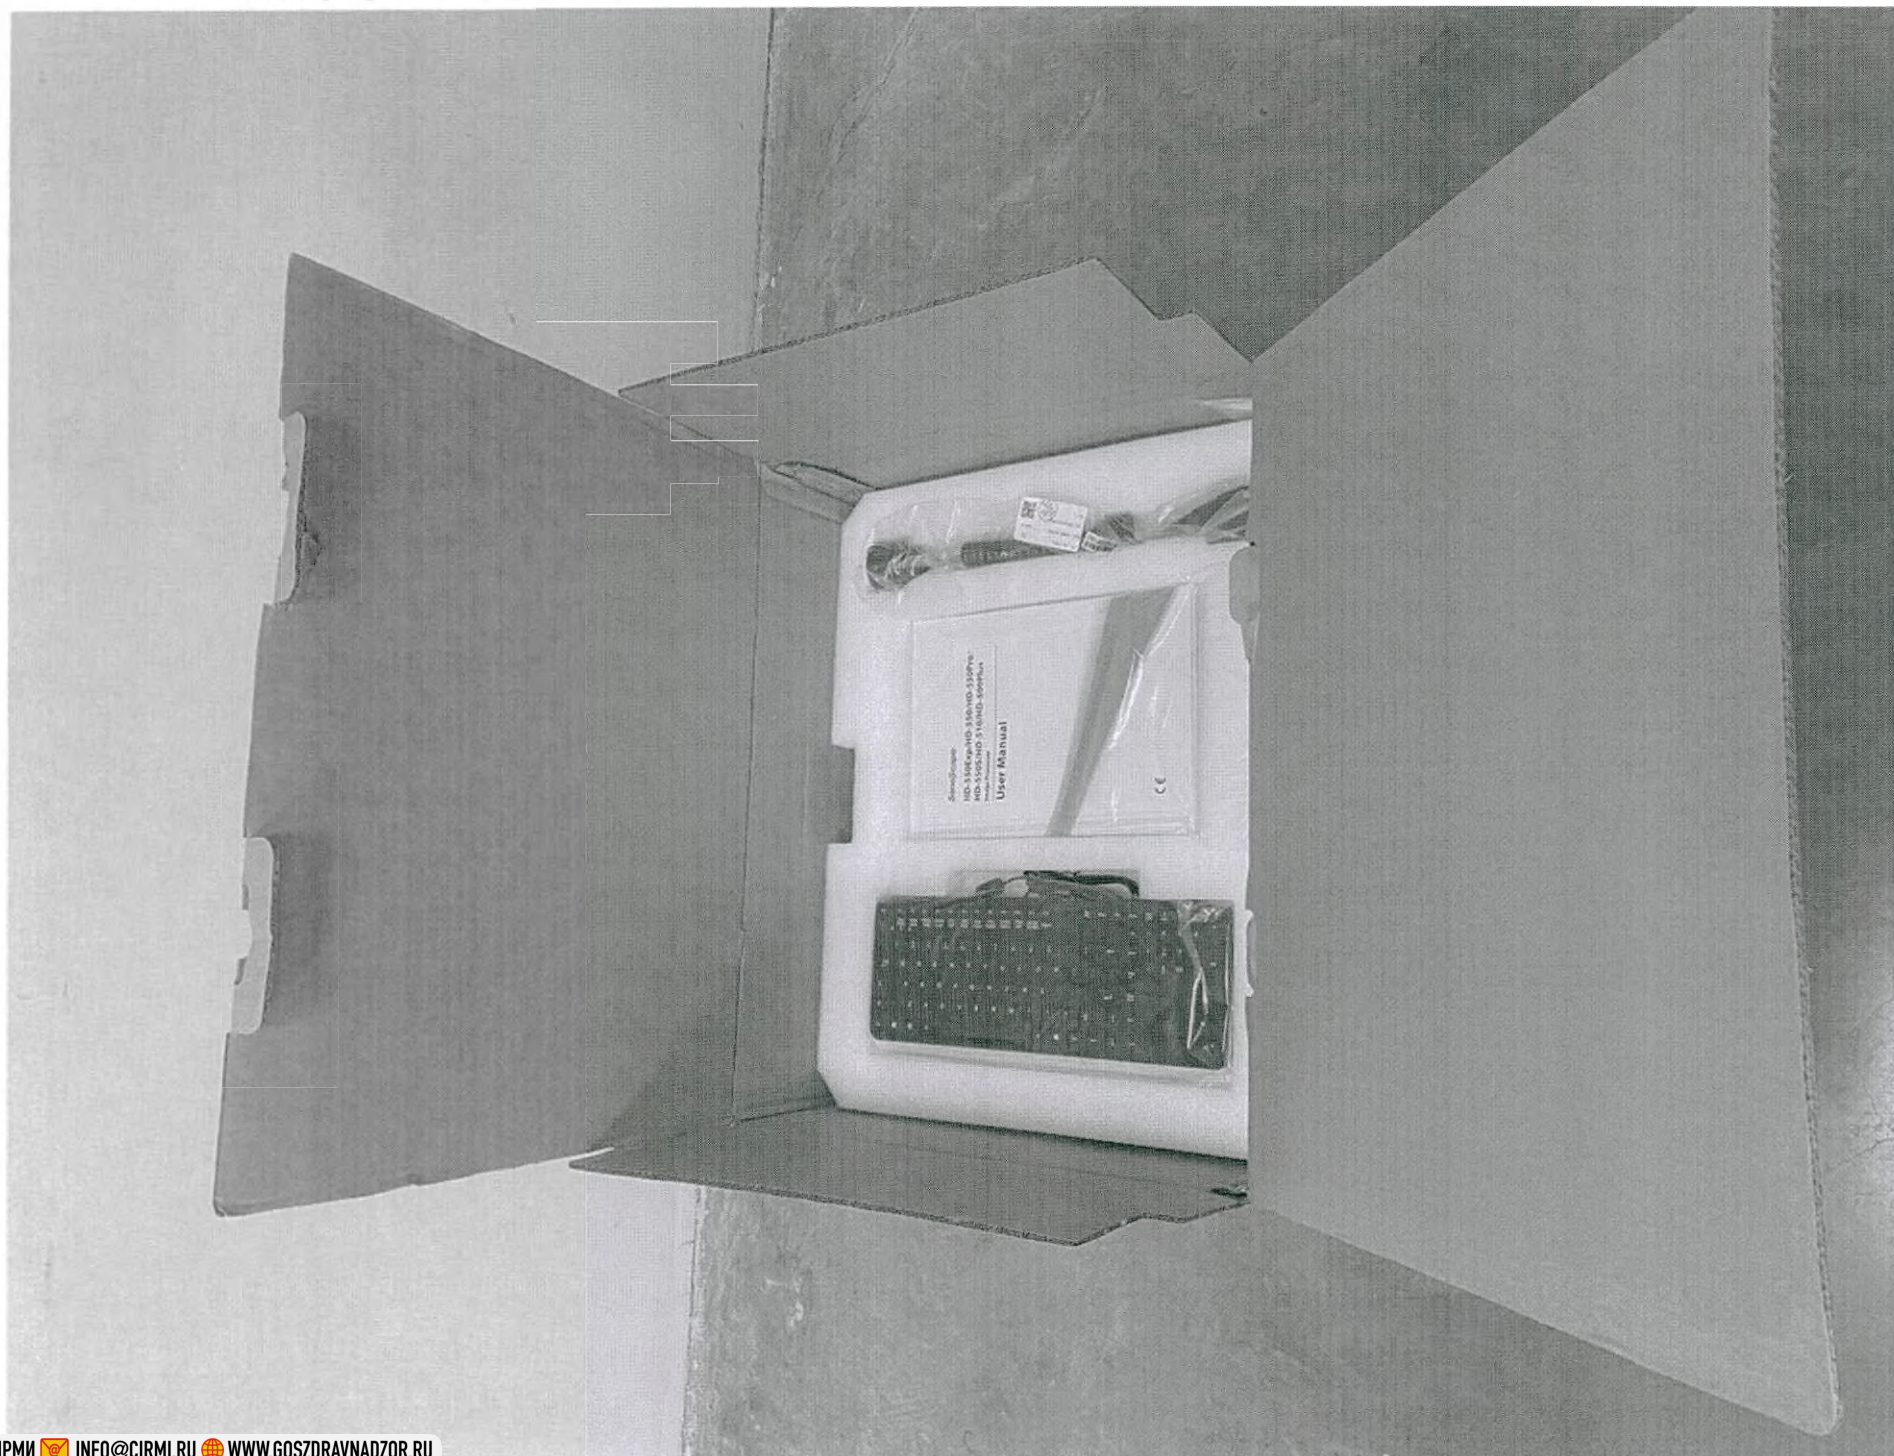

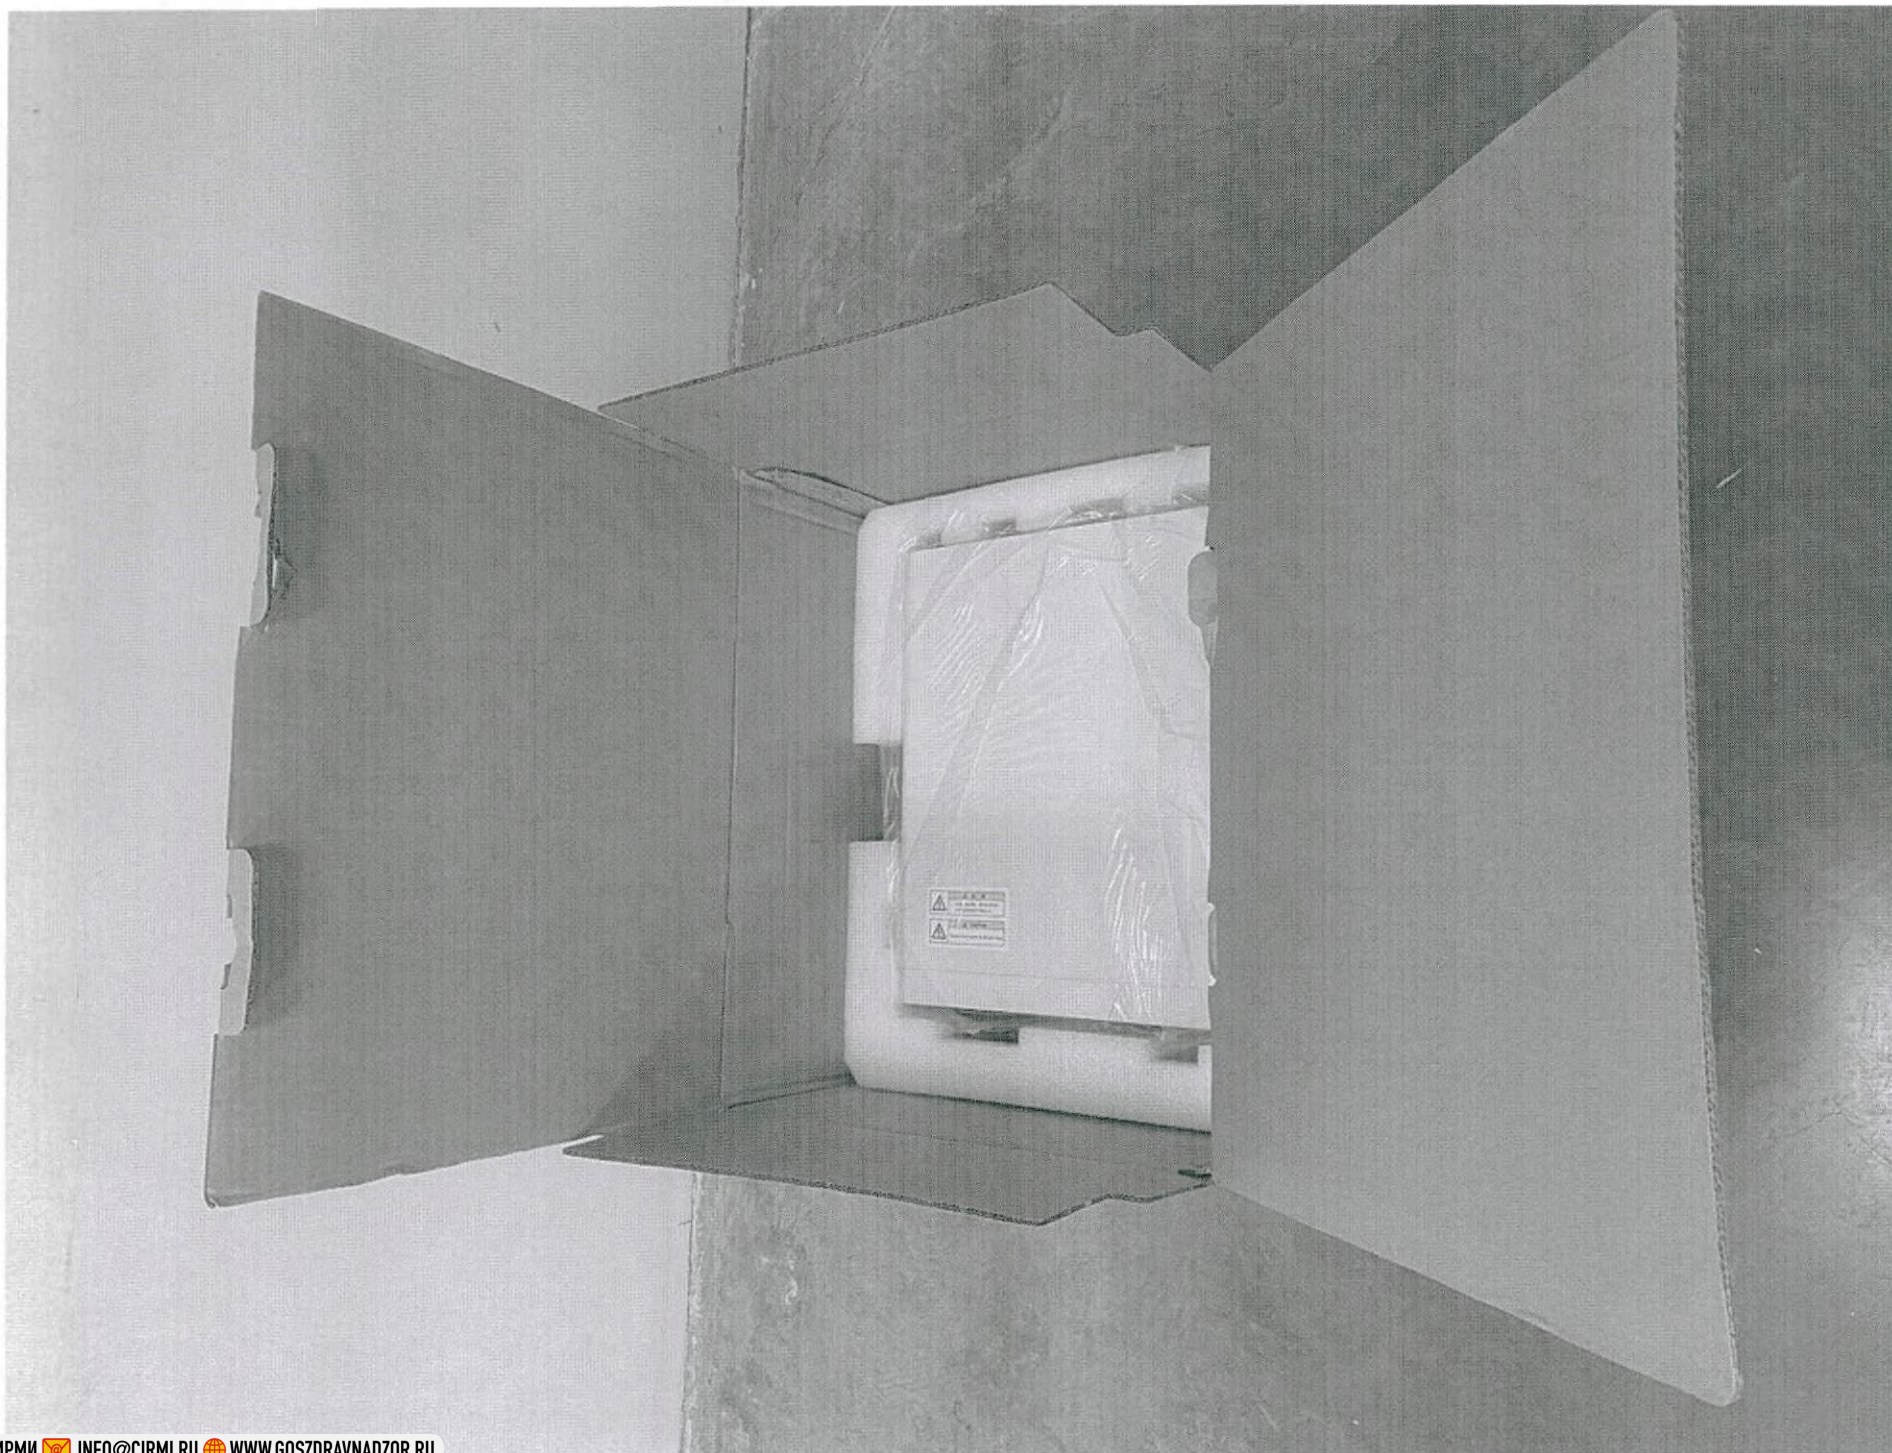


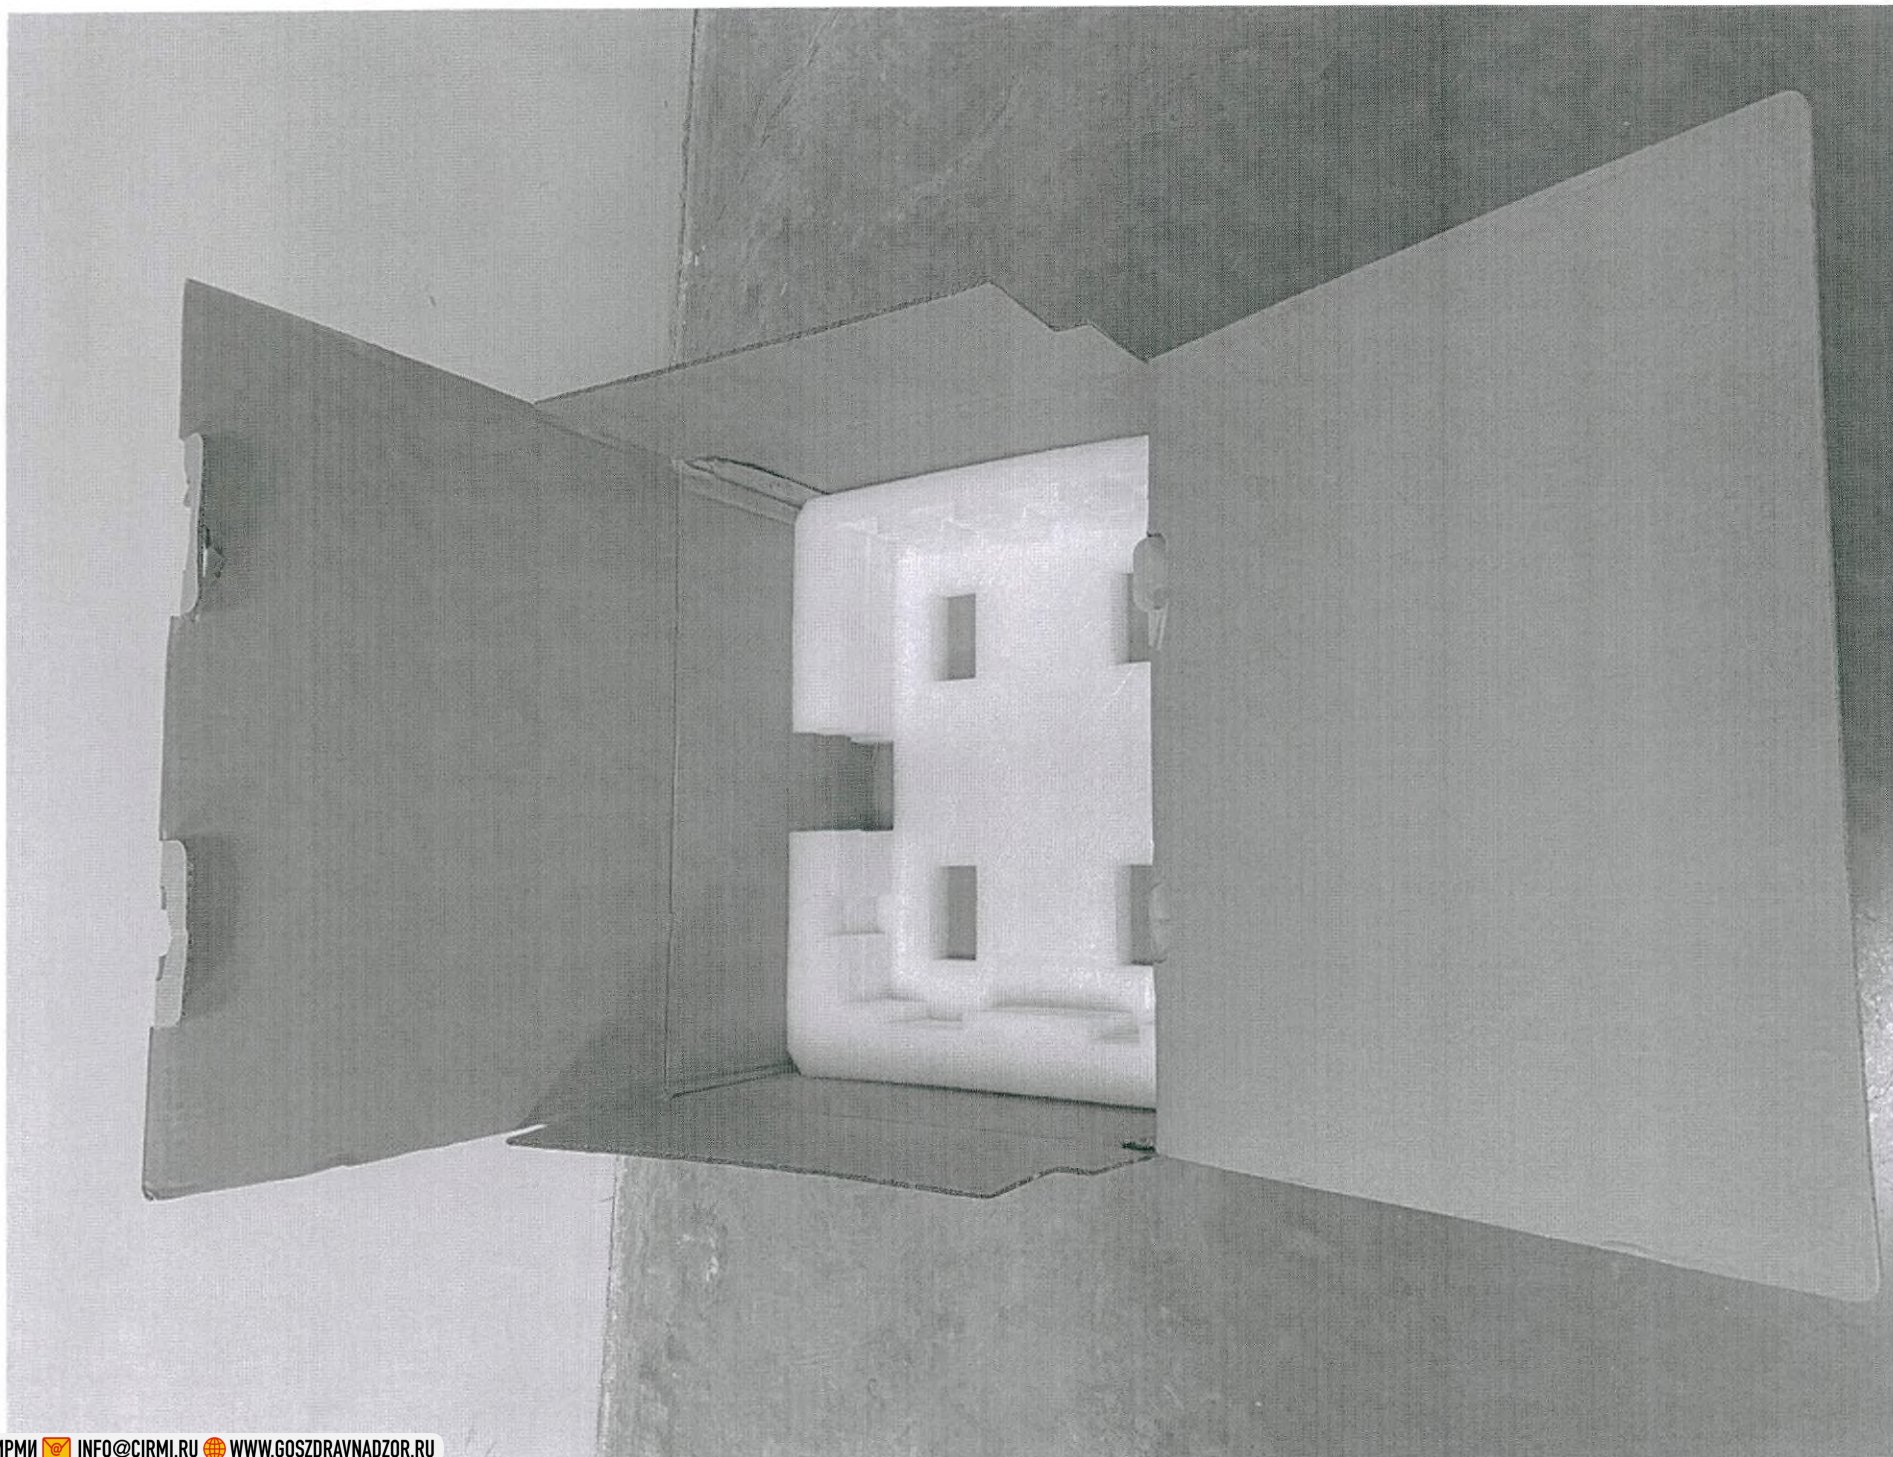





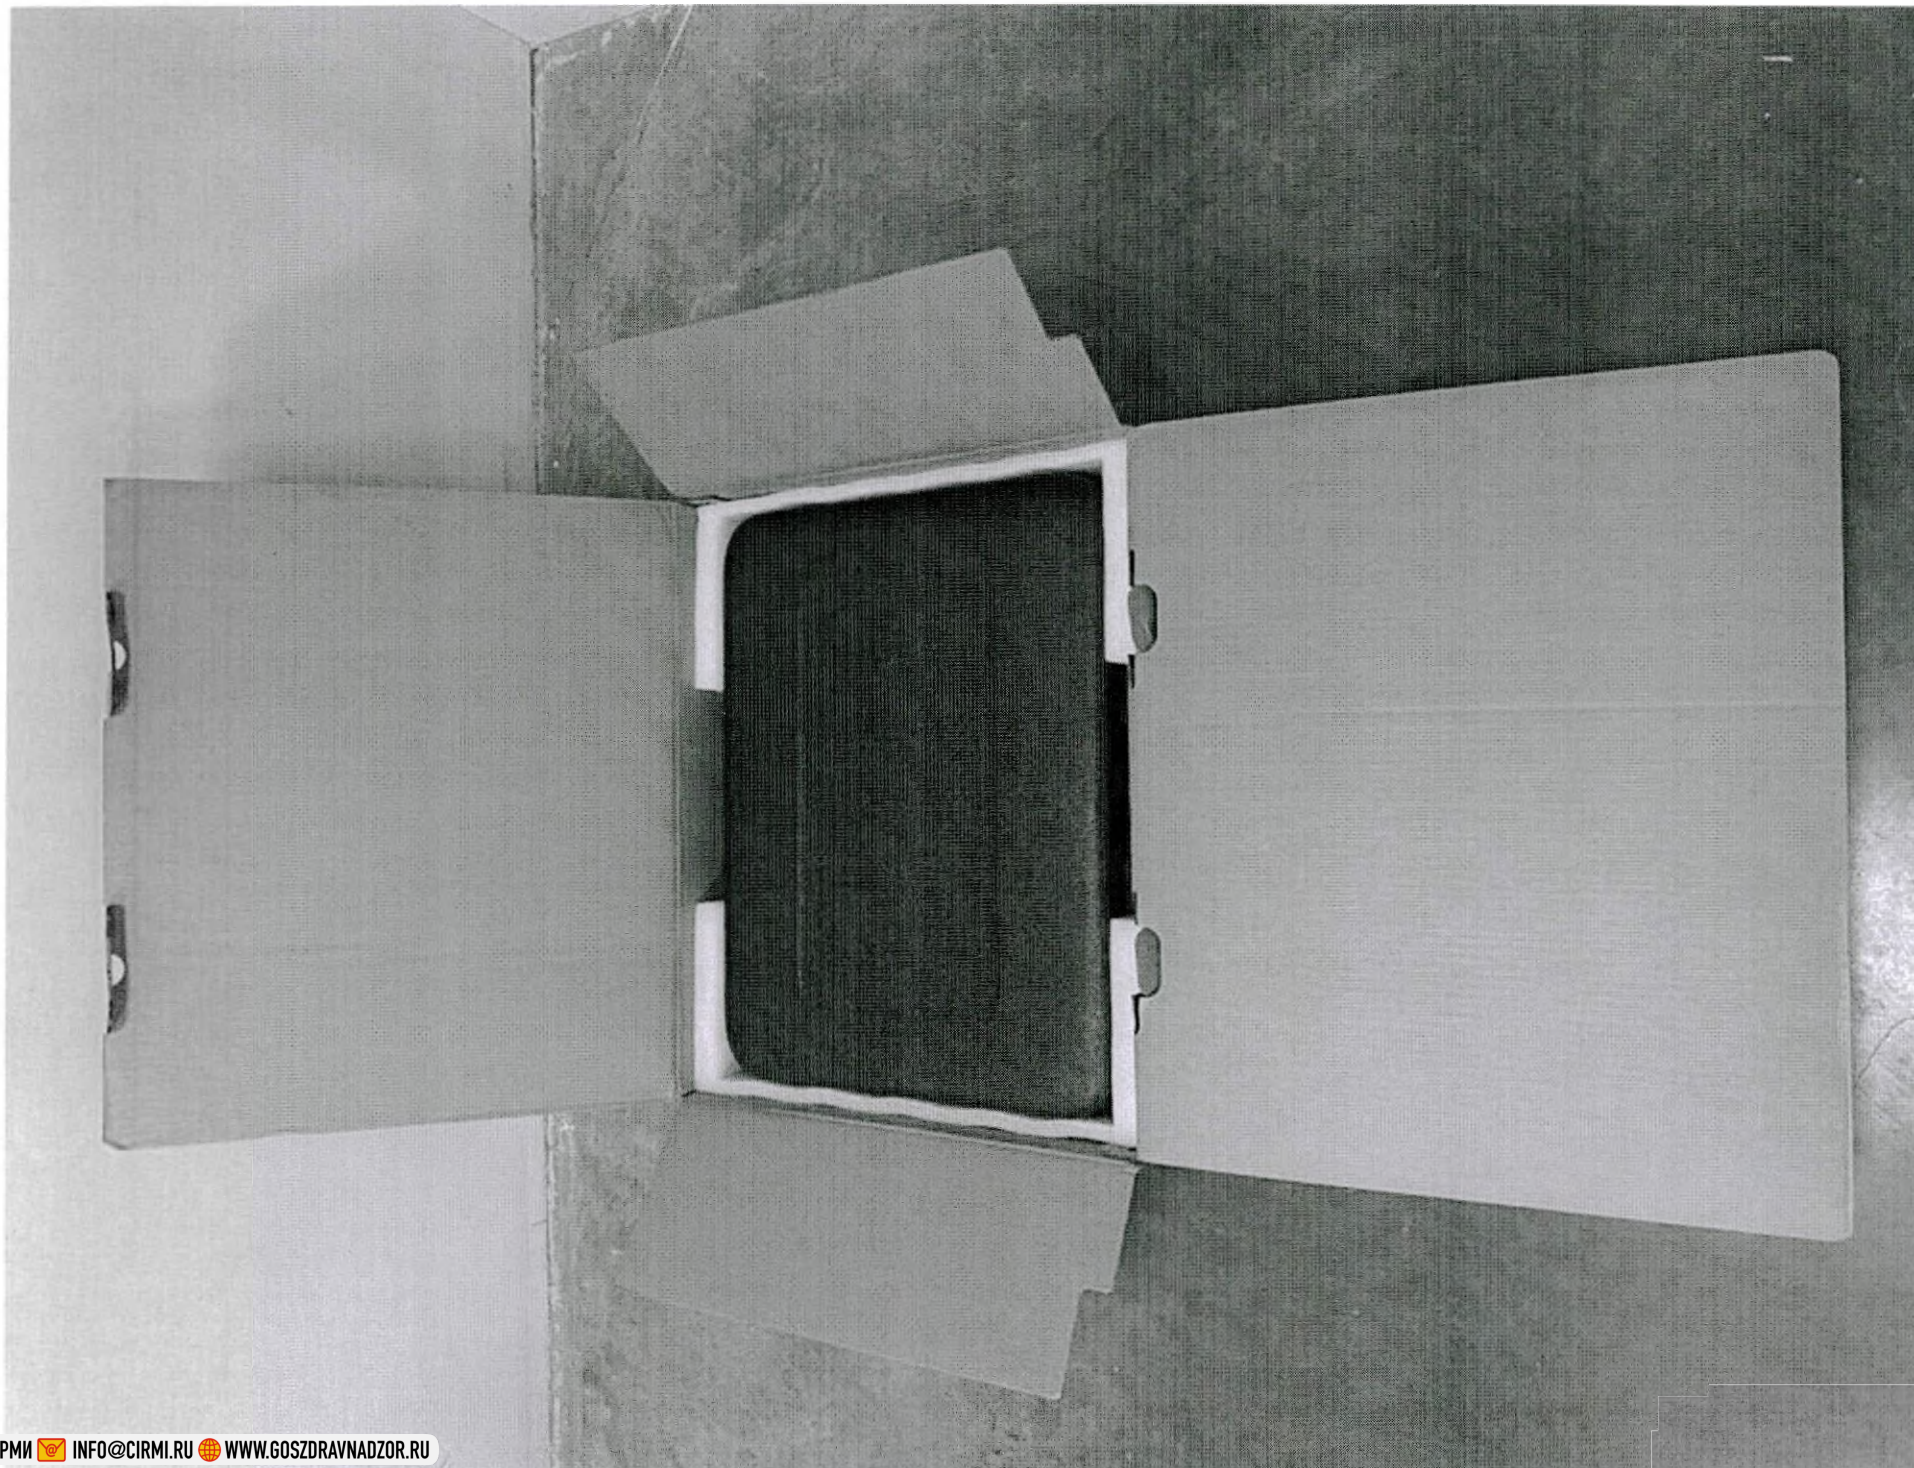




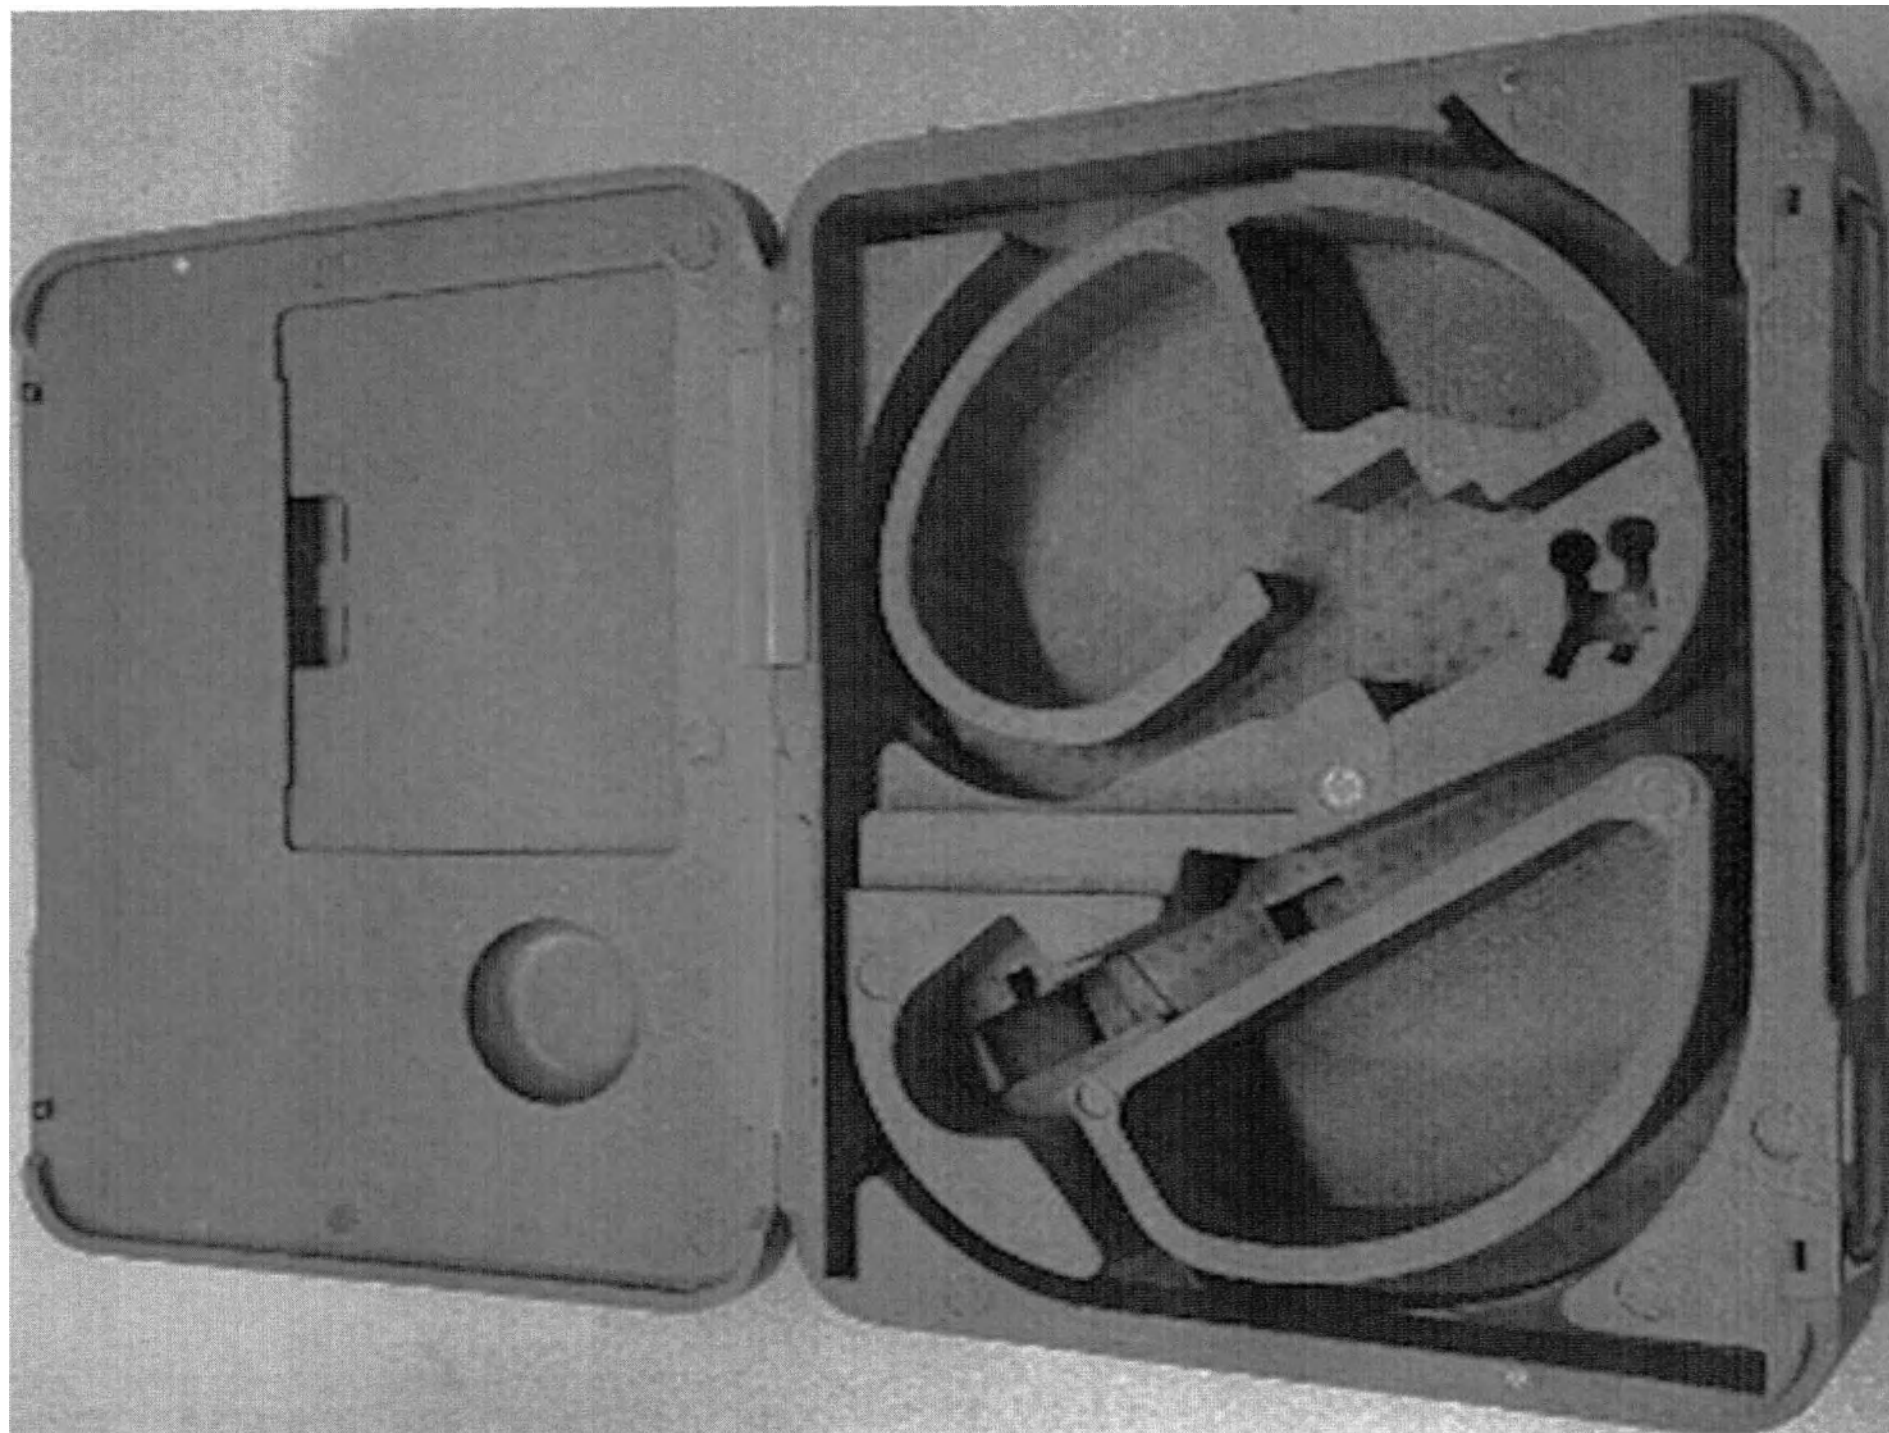


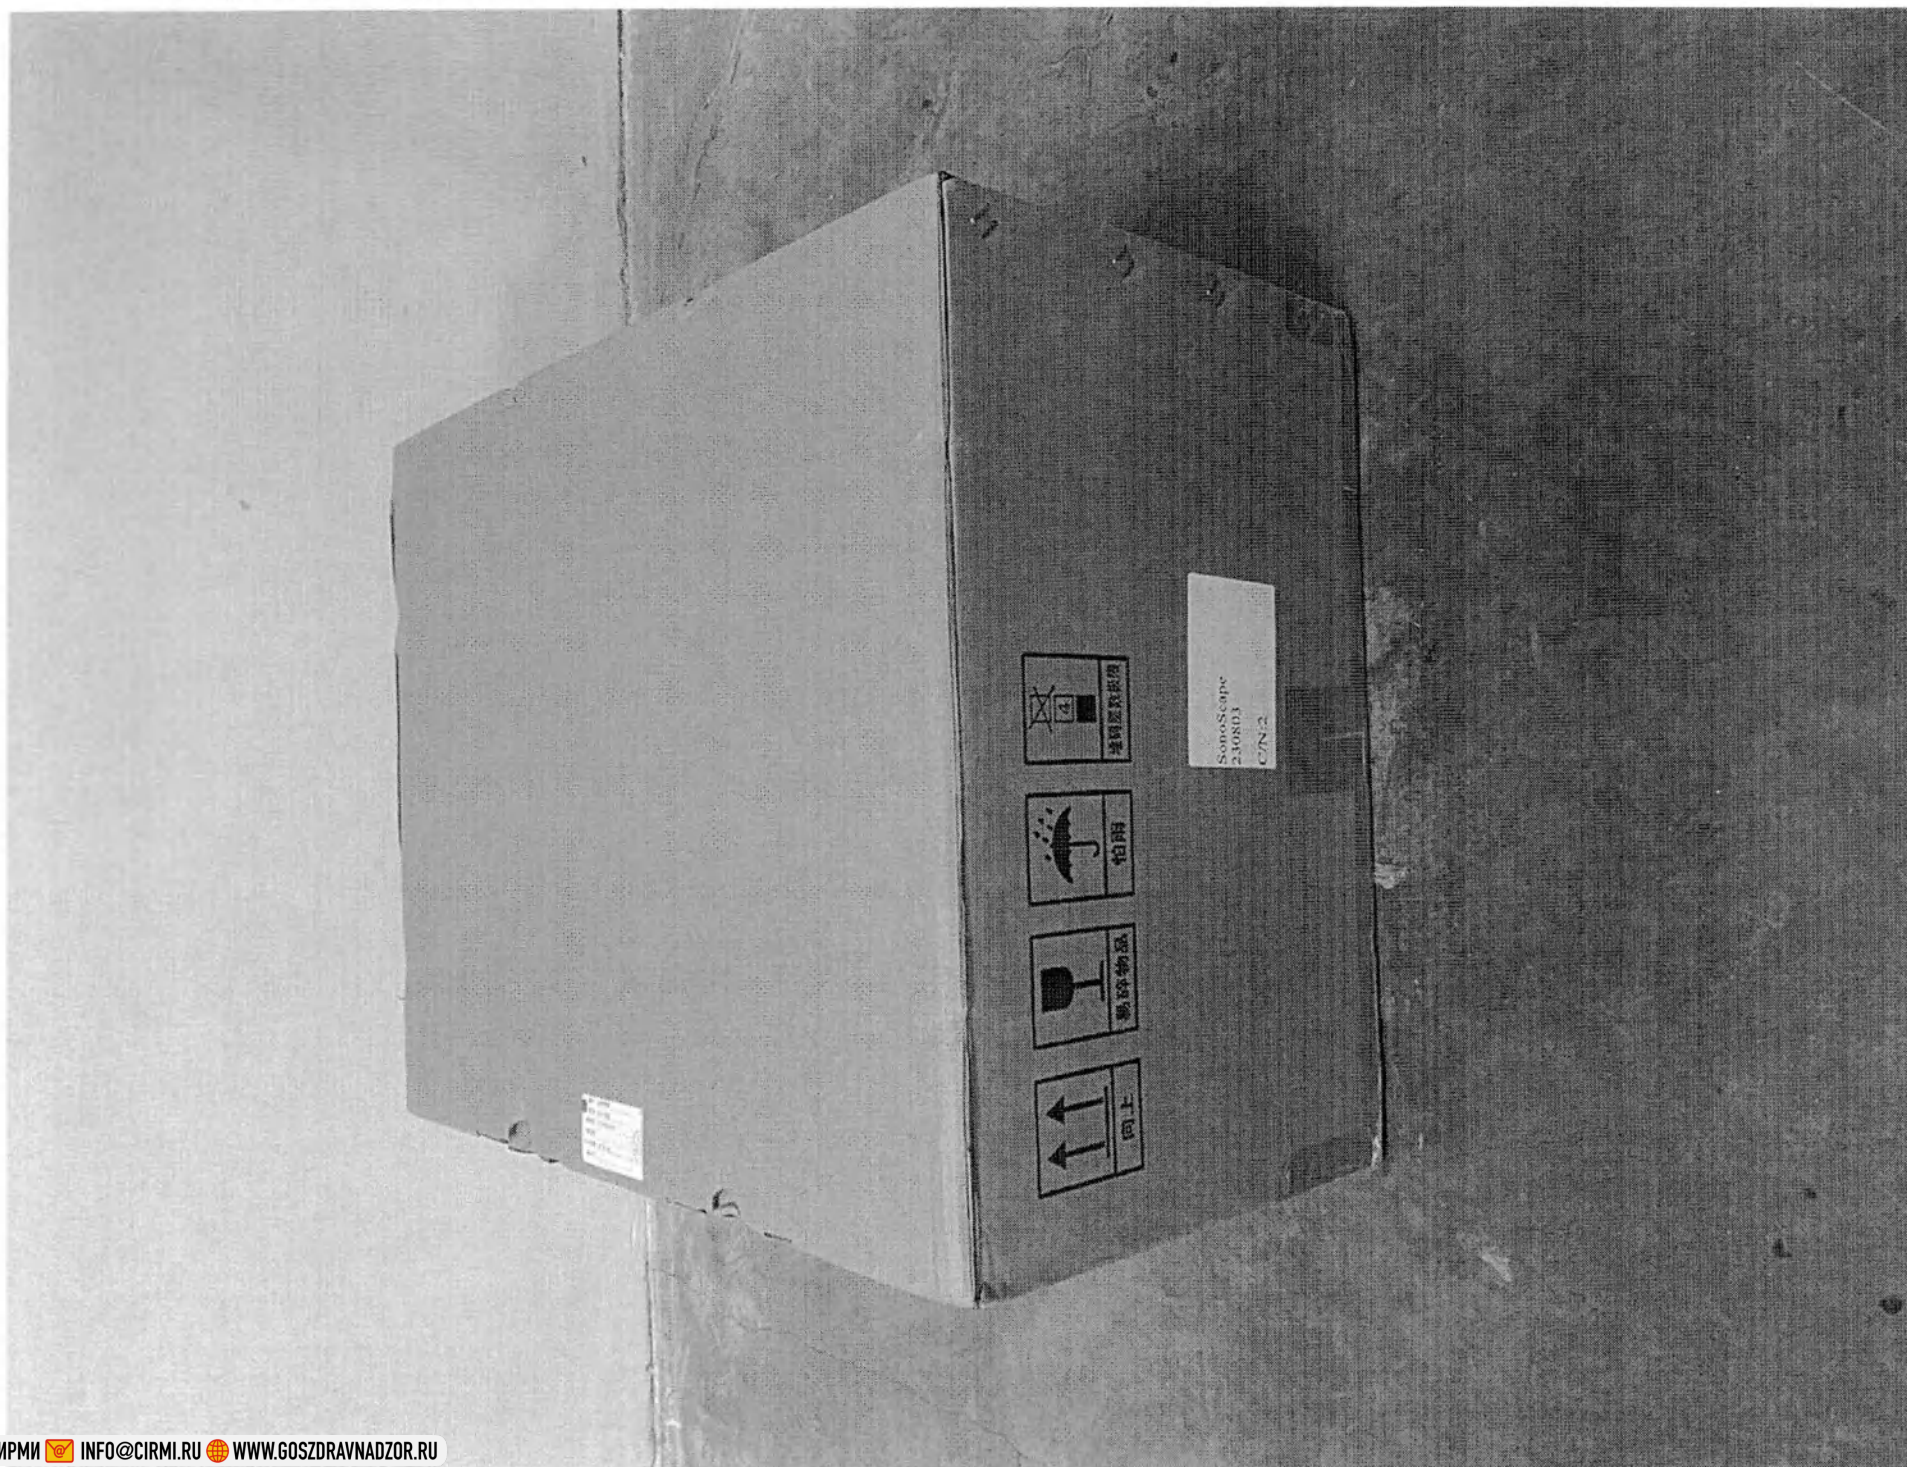

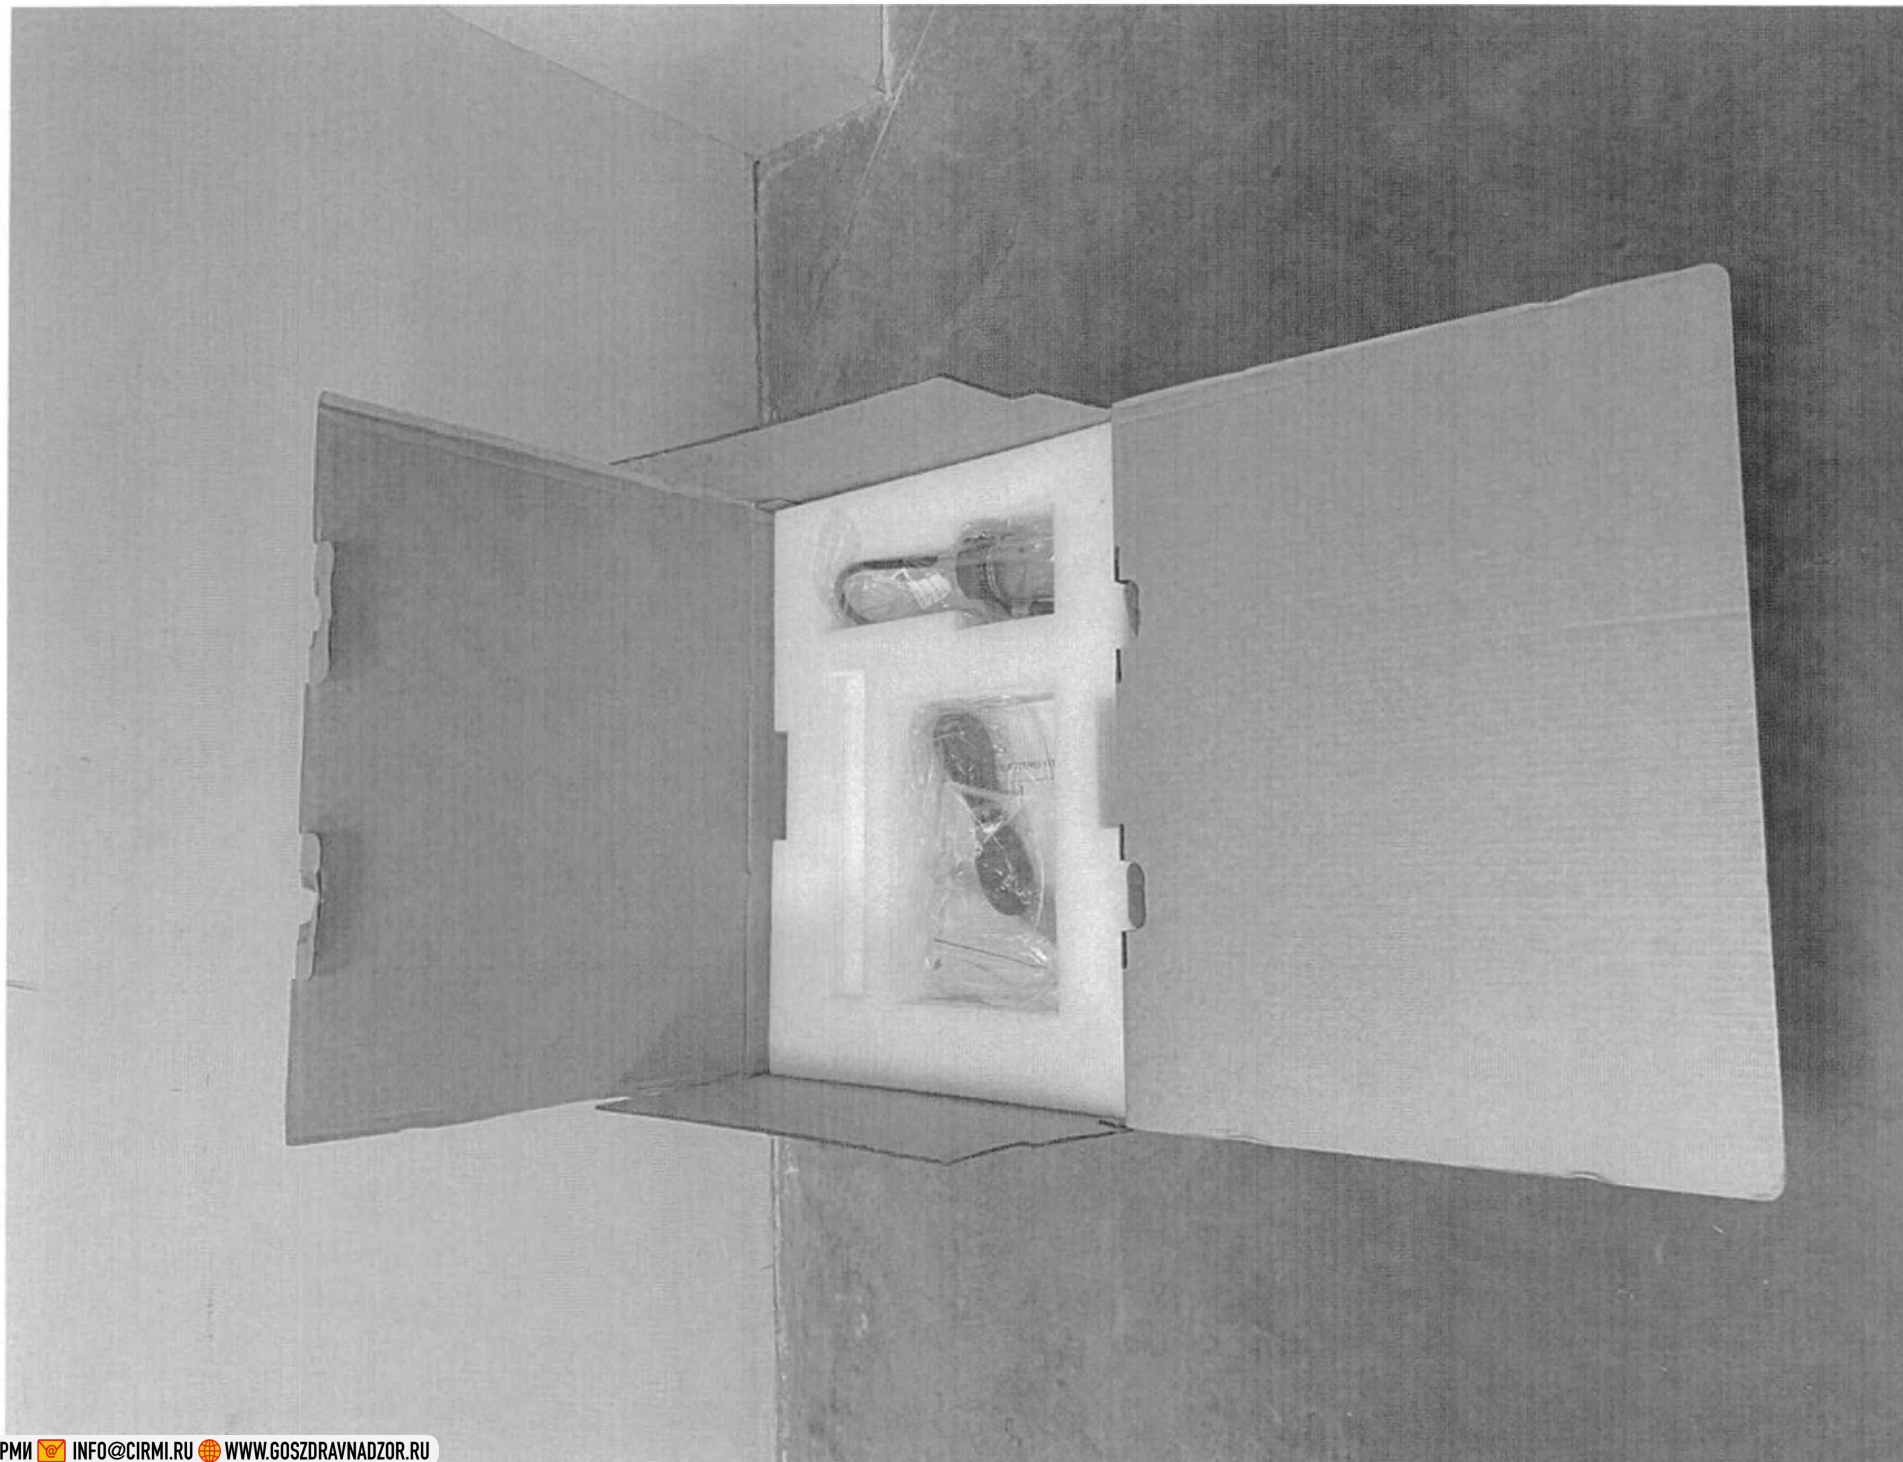


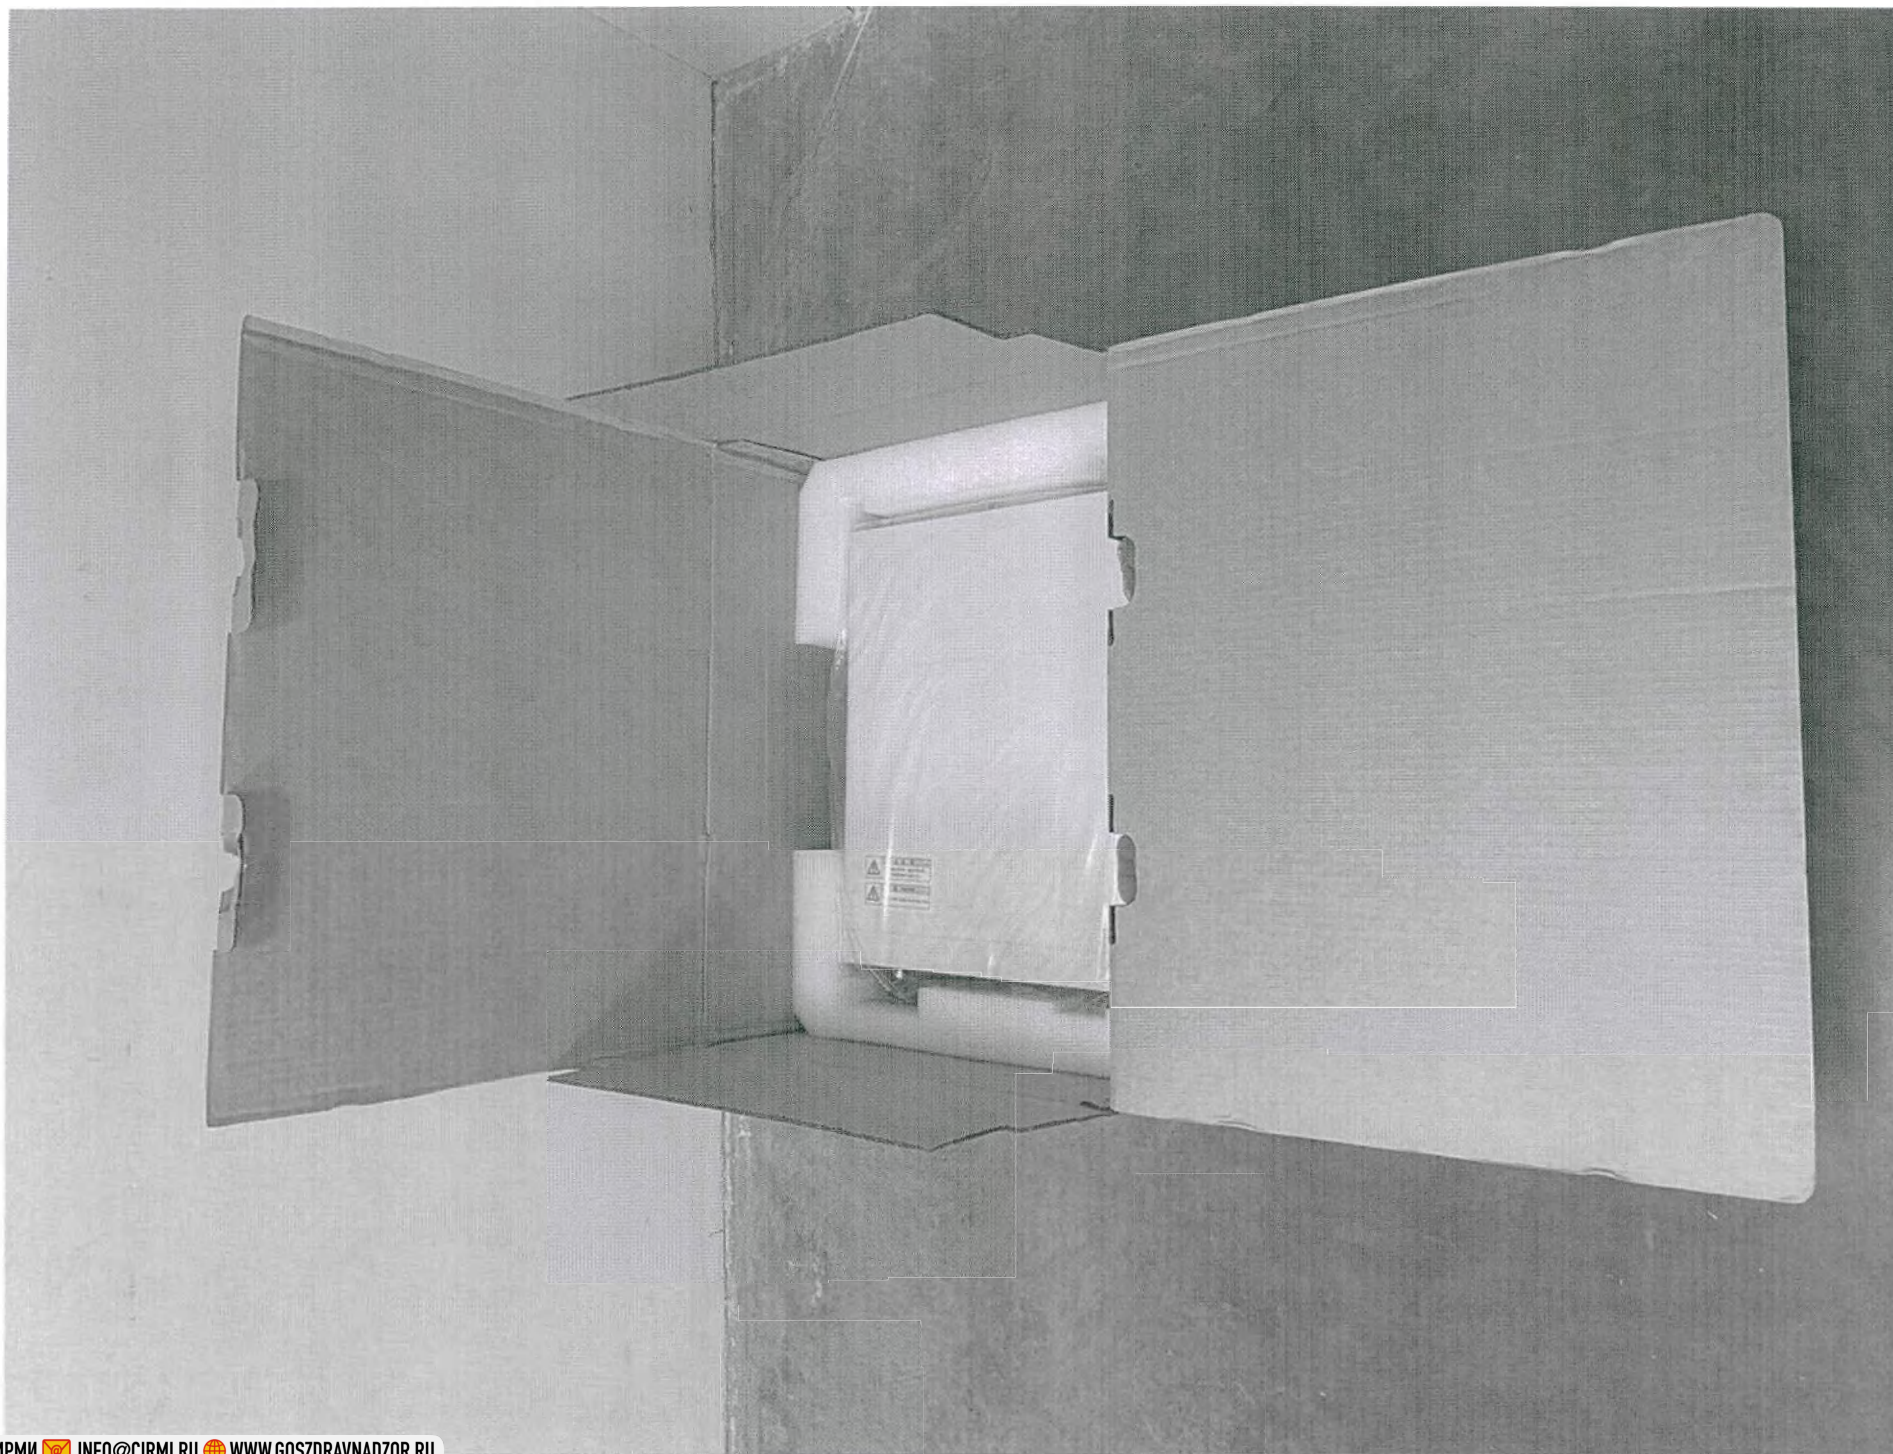



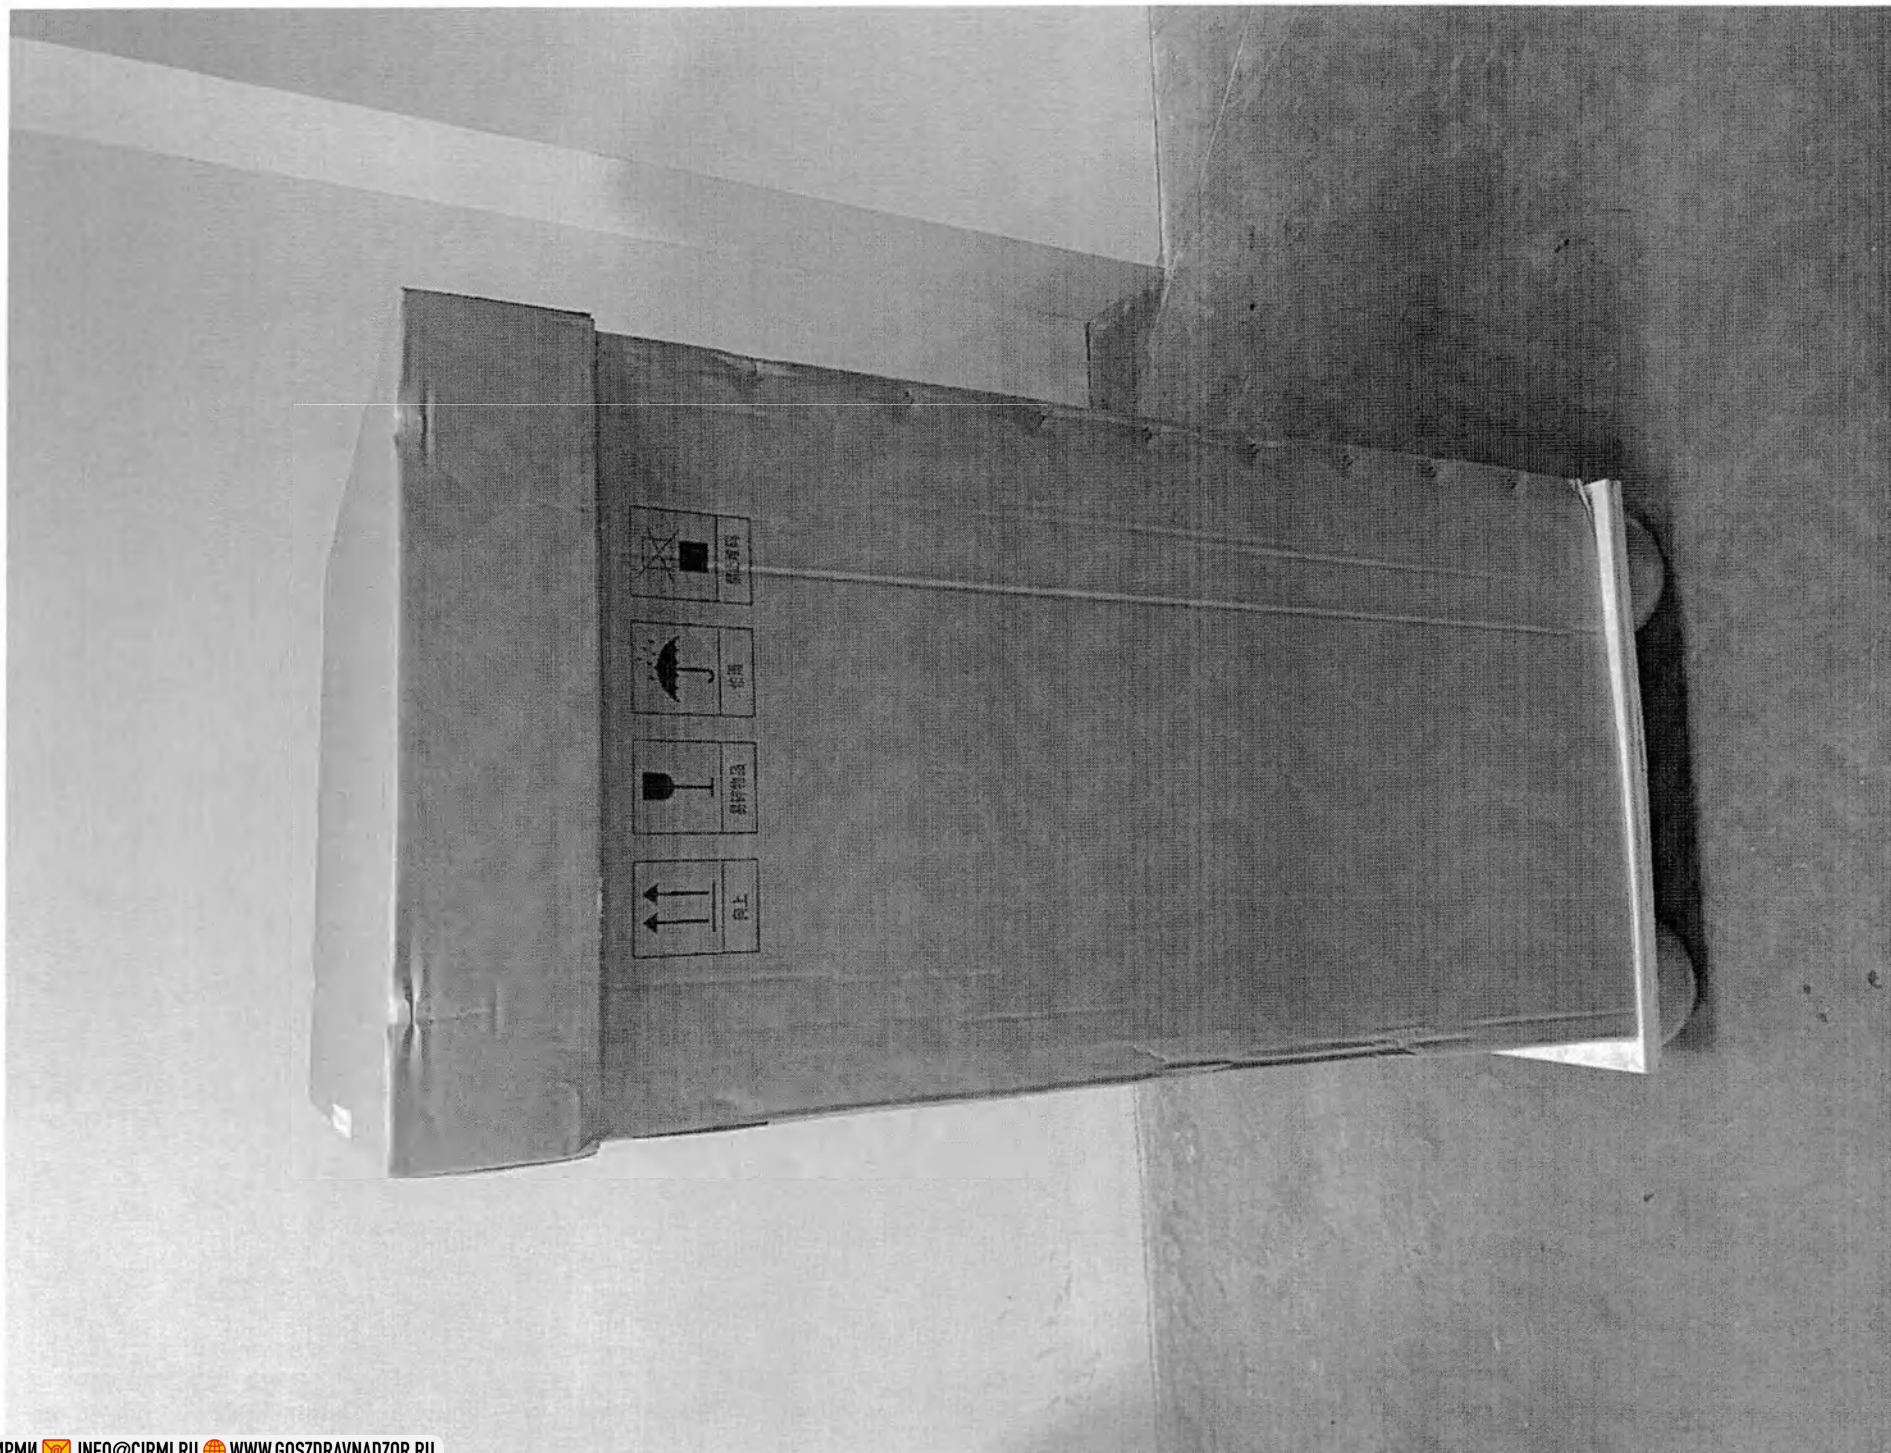



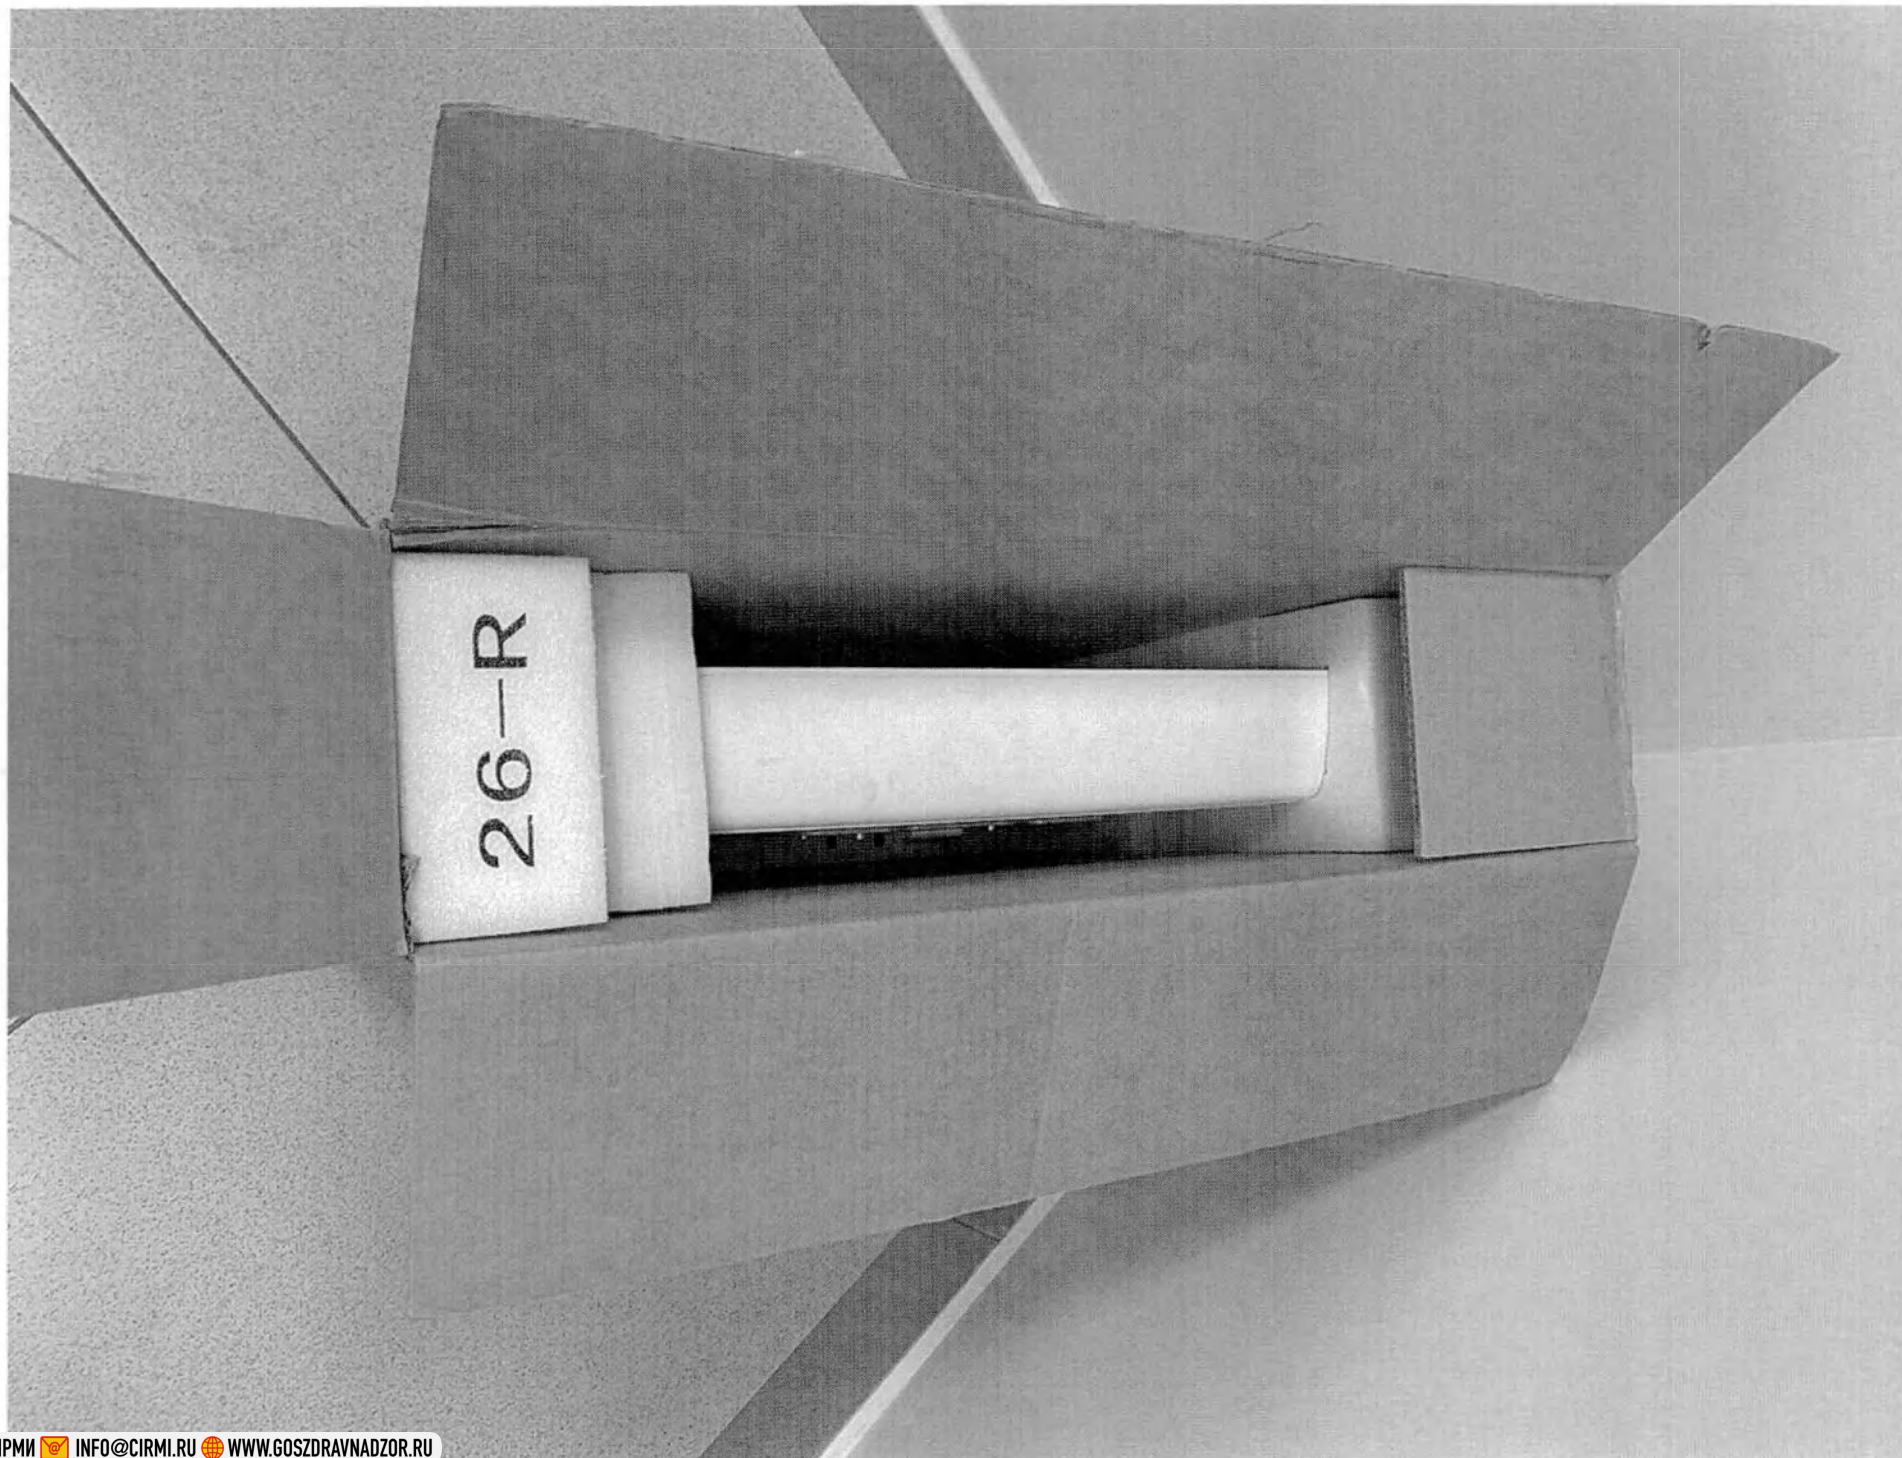

Устройство обработки изображений, вариант исполнения: _____
Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Комплектация:

1. Устройство обработки изображений, вариант исполнения: _____ – 1 шт.
2. Силовой шнур – 1 шт.
3. Держатель витого видеокабеля – 1 шт. (при необходимости)
4. Колпачок баланса белого – 1 шт.
5. Держатель колпачка баланса белого – 1 шт.
6. Клавиатура – 1 шт.
7. Плавкий предохранитель – 2 шт.
8. Витой видеокабель – 1 шт. (при необходимости)
9. Оптоволоконный кабель – 1 шт. (при необходимости)
10. Руководство пользователя – 1 шт.
11. Ножной переключатель – 1 шт. (при необходимости)
12. Видеокабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
13. Видеокабель Y/C – 1 шт. (при необходимости)
14. Видеокабель VGA – 1 шт. (при необходимости)
15. Аудио кабель – 1 шт. (при необходимости)
16. Подставка – 4 шт. (при необходимости)
17. Кабель управления светом – 1 шт.

Производитель:

«SonoScape Medical Corp.» («Соноскейп Медикал Корп.»), Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong P.R. China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории России:

ООО «Соноскейп Медицина Рус», Российская Федерация, Республика Татарстан, 420108 г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 50, этаж 1, помещение 38

Тел.: +7 (800) 511-94-32,

e-mail: sonoscaperu@yandex.ru

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Расшифровку символов см. в инструкции по применению.

Видеогастроскоп, вариант исполнения: _____

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Комплектация:

1. Видеогастроскоп, вариант исполнения: _____ – 1 шт.
2. Биопсийный клапан – 10 шт.
3. Щетка для очистки – 2 шт.
4. Щетка для очистки гнезда клапана: вода-воздух, аспирационного и биопсийного – 2 шт.
5. Течеискатель – 1 шт.
6. Шприц, 30 мл – 1 шт. (при необходимости)
7. Заглушка ирригационного канала – 1 шт.
8. Резиновый колпачок дистального конца – 1 шт.
9. Воздушный/водяной клапан – 2 шт.
10. Клапан аспирации – 2 шт.
11. Бутыль для воды – 1 шт.
12. Комплект для ручной обработки эндоскопа – 1 шт.:
 - комплект заглушек для промывки – 1 шт.
 - система для промывки каналов – 1 шт.
 - трубка-адаптер для ирригационного канала (длинная) – 1 шт.
 - трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) – 1 шт.
13. Коннектор для течеискателя – 1 шт. (при необходимости)
14. Бутыль для воды с адаптером CO₂ – 1 шт. (при необходимости)
15. Руководство пользователя – 1 шт.

Производитель:

«SonoScape Medical Corp.» («Соноскейп Медикал Корп.»), Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong P.R. China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории России:

ООО «Соноскейп Медицина Рус», Российская Федерация, Республика Татарстан, 420108 г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 50, этаж 1, помещение 38

Тел.: +7 (800) 511-94-32,

e-mail: sonoscaperu@yandex.ru

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Расшифровку символов см. в инструкции по применению.

Видеоколоноскоп, вариант исполнения: _____

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Комплектация:

1. Видеоколоноскоп, вариант исполнения: _____ – 1 шт.
2. Биопсийный клапан – 10 шт.
3. Щетка для очистки – 2 шт.
4. Щетка для очистки гнезда клапана: вода-воздух, аспирационного и биопсийного – 2 шт.
5. Течеискатель – 1 шт.
6. Шприц, 30 мл – 1 шт. (при необходимости)
7. Заглушка ирригационного канала – 1 шт.
8. Резиновый колпачок дистального конца – 1 шт.
9. Воздушный/водяной клапан – 2 шт.
10. Клапан аспирации – 2 шт.
11. Бутыль для воды – 1 шт.
12. Комплект для ручной обработки эндоскопа – 1 шт.:
 - комплект заглушек для промывки – 1 шт.
 - система для промывки каналов – 1 шт.
 - трубка-адаптер для ирригационного канала (длинная) – 1 шт.
 - трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) – 1 шт.
13. Коннектор для течеискателя – 1 шт. (при необходимости)
14. Бутыль для воды с адаптером CO₂ – 1 шт. (при необходимости)
15. Руководство пользователя – 1 шт.

Производитель:

«SonoScape Medical Corp.» («Соноскейп Медикал Корп.»), Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong P.R. China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории России:

ООО «Соноскейп Медицина Рус», Российская Федерация, Республика Татарстан, 420108 г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 50, этаж 1, помещение 38

Тел.: +7 (800) 511-94-32,

e-mail: sonoscaperu@yandex.ru

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Расшифровку символов см. в инструкции по применению.

Источник света, вариант исполнения: _____

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Комплектация:

1. Источник света, в вариантах исполнения: VLS-50T; VLS-50D; VLS-55Q; VLS-55T; VLS-51T; VLS-51D – 1 шт.
2. Плавкий предохранитель – 2 шт.
3. Кабель подключения к сети – 1 шт. (при необходимости)
4. Подставка – 4 шт. (при необходимости)
5. Руководство пользователя – 1 шт.

Производитель:

«SonoScape Medical Corp.» («Соноскейп Медикал Корп.»), Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong P.R. China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории России:

ООО «Соноскейп Медицина Рус», Российская Федерация, Республика Татарстан, 420108 г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 50, этаж 1, помещение 38

Тел.: +7 (800) 511-94-32,

e-mail: sonoscaperu@yandex.ru

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Расшифровку символов см. в инструкции по применению.

Тележка эндоскопическая HDT-500

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Комплектация:

1. Тележка эндоскопическая HDT-500, в вариантах исполнения: с трансформатором с одним кронштейном монитора, без трансформатора с одним кронштейном монитора с газовым амортизатором, с трансформатором с одним кронштейном монитора с газовым амортизатором, с трансформатором с двумя кронштейнами монитора – 1 шт.
2. Руководство пользователя – 1 шт.

Производитель:

«SonoScape Medical Corp.» («Соноскейп Медикал Корп.»), Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong P.R. China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории России:

ООО «Соноскейп Медицина Рус», Российская Федерация, Республика Татарстан, 420108 г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 50, этаж 1, помещение 38

Тел.: +7 (800) 511-94-32,

e-mail: sonoscaperu@yandex.ru

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Расшифровку символов см. в инструкции по применению.

Монитор медицинский высокой четкости

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Комплектация:

1. Монитор медицинский высокой четкости – 1 шт.
2. Шнур сетевой – 1 шт.
3. Сетевой адаптер – 1 шт.
4. Кабель DVI – 1 шт.
5. Кабель заземления – 1 шт.
6. Руководство пользователя – 1 шт.

Производитель:

«SonoScape Medical Corp.» («Соноскейп Медикал Корп.»), Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong P.R. China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории России:

ООО «Соноскейп Медицина Рус», Российская Федерация, Республика Татарстан, 420108 г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 50, этаж 1, помещение 38

Тел.: +7 (800) 511-94-32,

e-mail: sonoscaperu@yandex.ru

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Расшифровку символов см. в инструкции по применению.

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

99 (девяносто девять) листа(ов)

« 01 » 03 2024г.

Генеральный директор ГАО ЧЭН

