

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Компания Совтех»

О.Е. Кондрашова

О.Е. Кондрашова

«19» февраля 2024 г.

М.П.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ОДНОРАЗОВАЯ, НЕСТЕРИЛЬНАЯ
ПО ТУ 32.50.50-006-48072026-2022**


Версия 1 от «19» февраля 2024 г.

2024 г.


Диагностическая карта, 12 черных лунок с полем под записи

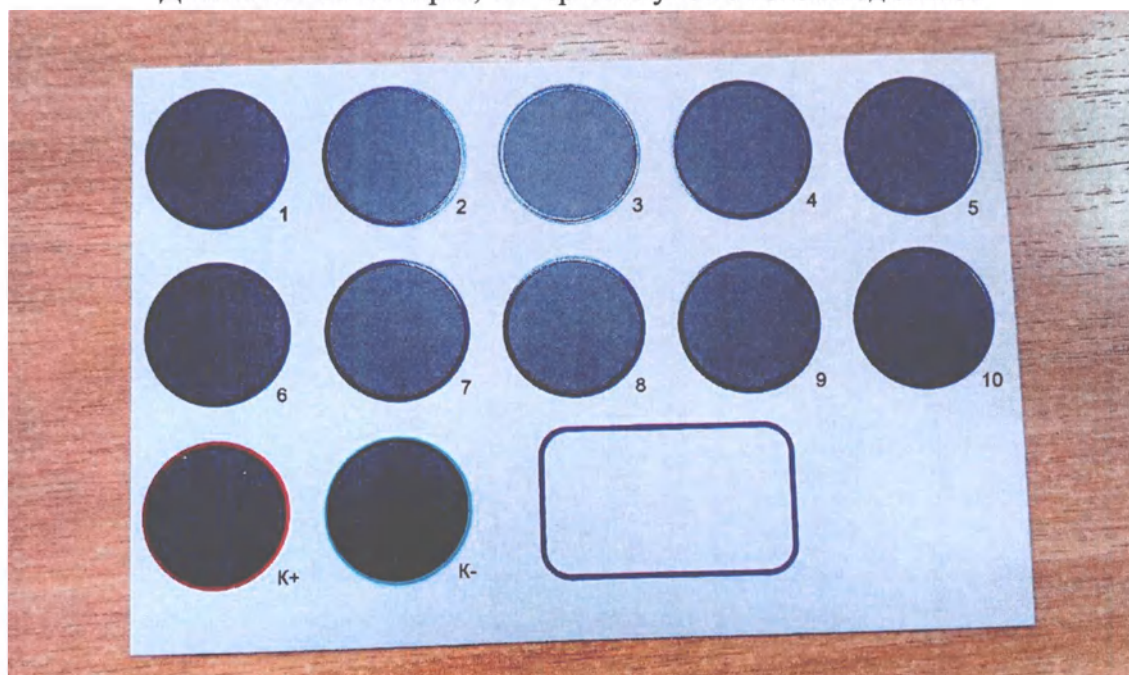


Маркировка потребительской упаковки

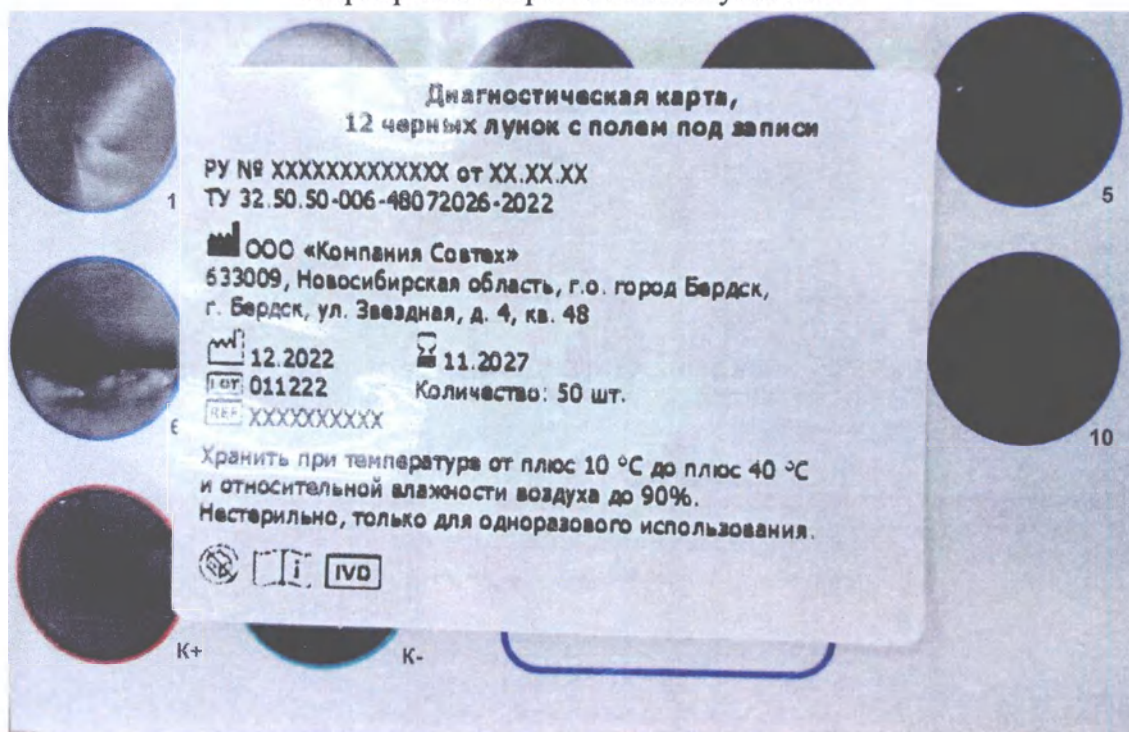


Диагностическая карта, 6 черных лунок

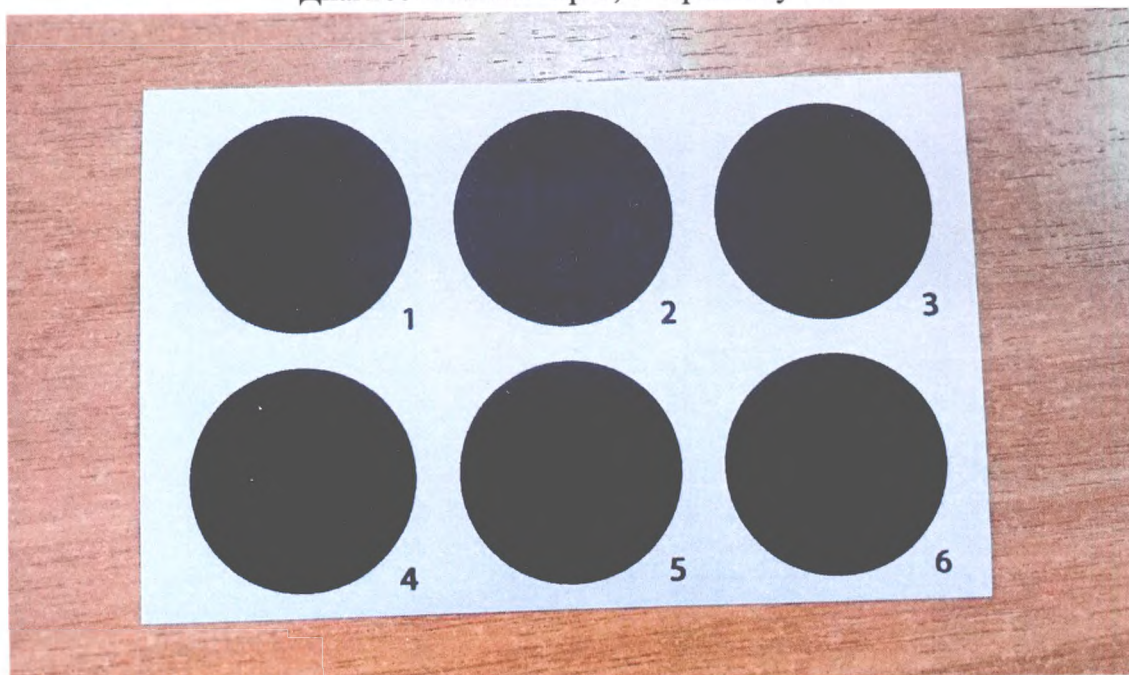


Маркировка потребительской упаковки

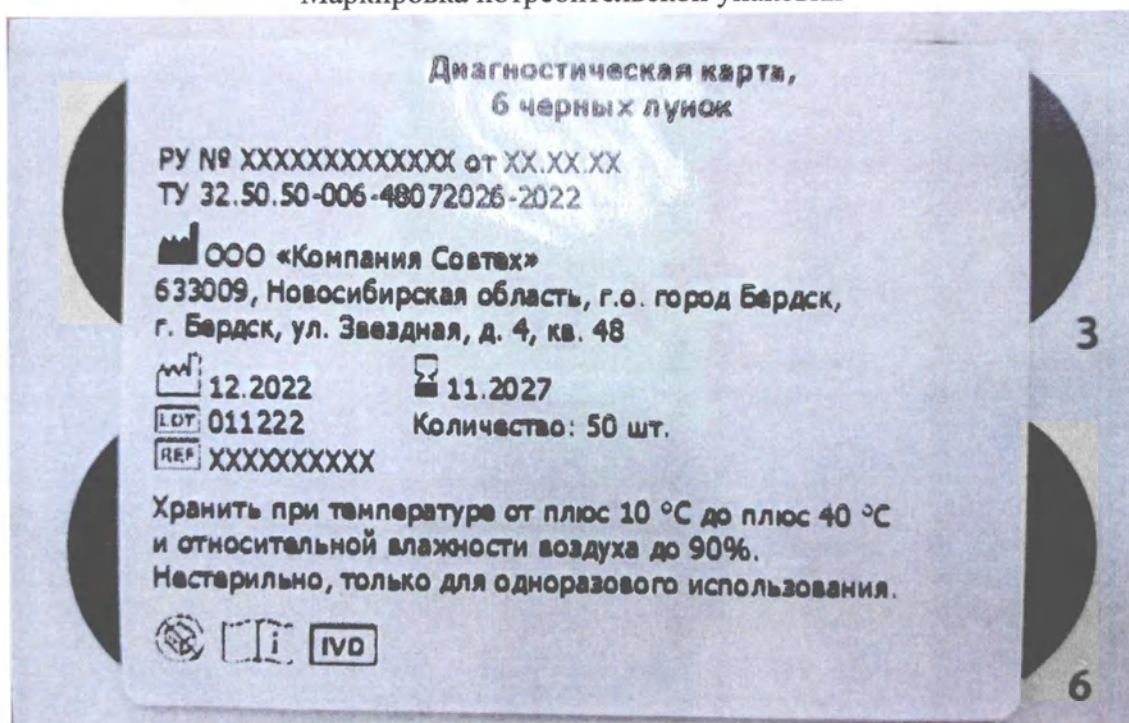

Диагностическая карта, 8 белых лунок

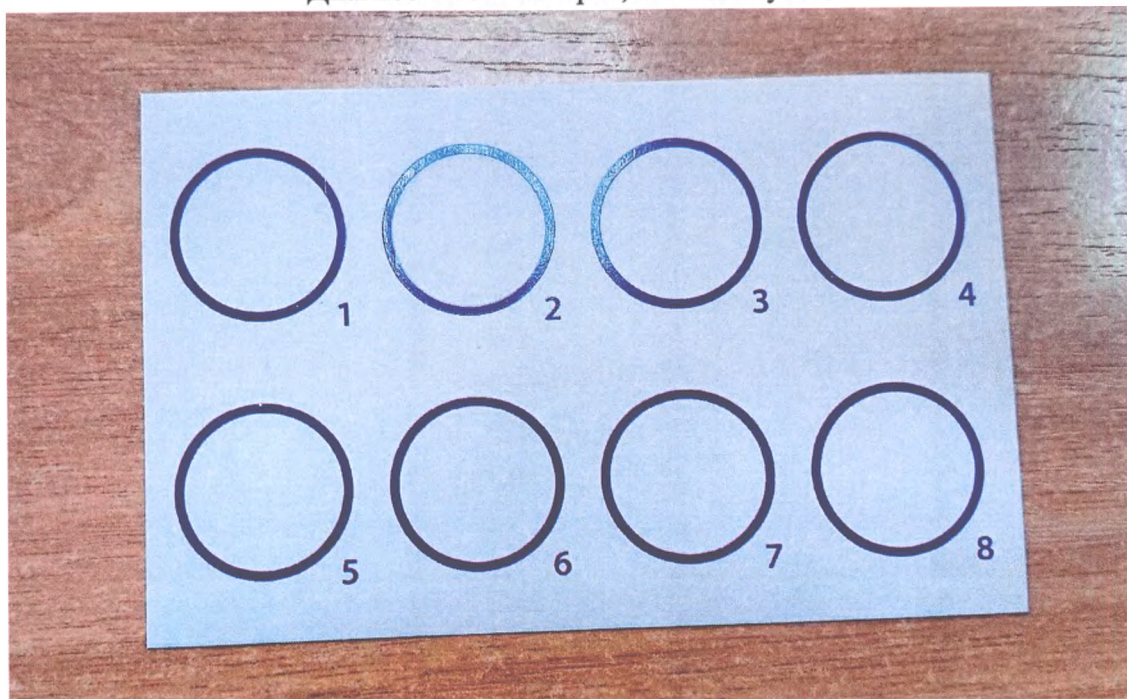

Маркировка потребительской упаковки

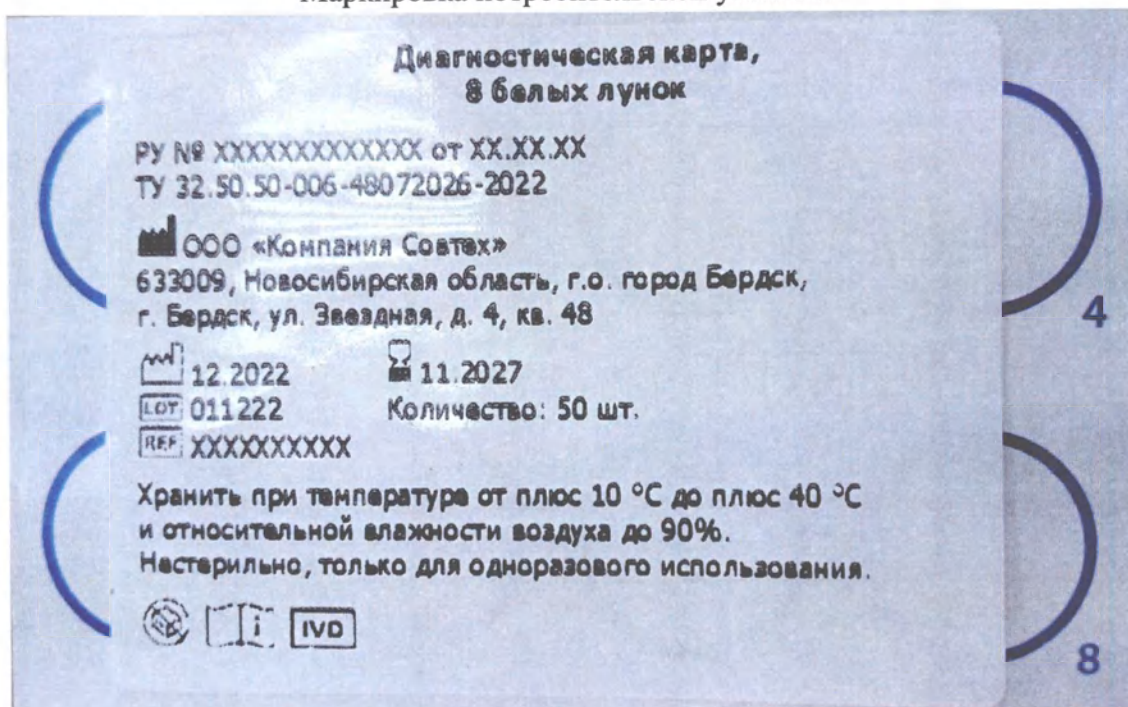

Диагностическая карта, 10 белых лунок со строками под записи

Diagram of a diagnostic card template. It features 10 white circular indentations arranged in two rows of five. Below each indentation is a horizontal line for writing. The indentations are numbered 1 through 10 in blue. The card is placed on a wooden surface.

Маркировка потребительской упаковки

Diagram of a consumer packaging label. The label is white and features a central text block with the following information:

Диагностическая карта,
10 белых лунок со строками под записи

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022


ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бардск,
г. Бардск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

12.2022 11.2027
011222 Количество: 50 шт.
XXXXXXXXXX


Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.

The label also features 10 white circular indentations arranged in two rows of five. Below each indentation is a horizontal line for writing. The indentations are numbered 1 through 10 in blue. The label is placed on a wooden surface.


Диагностическая карта, 10 белых лунок без строк под записи

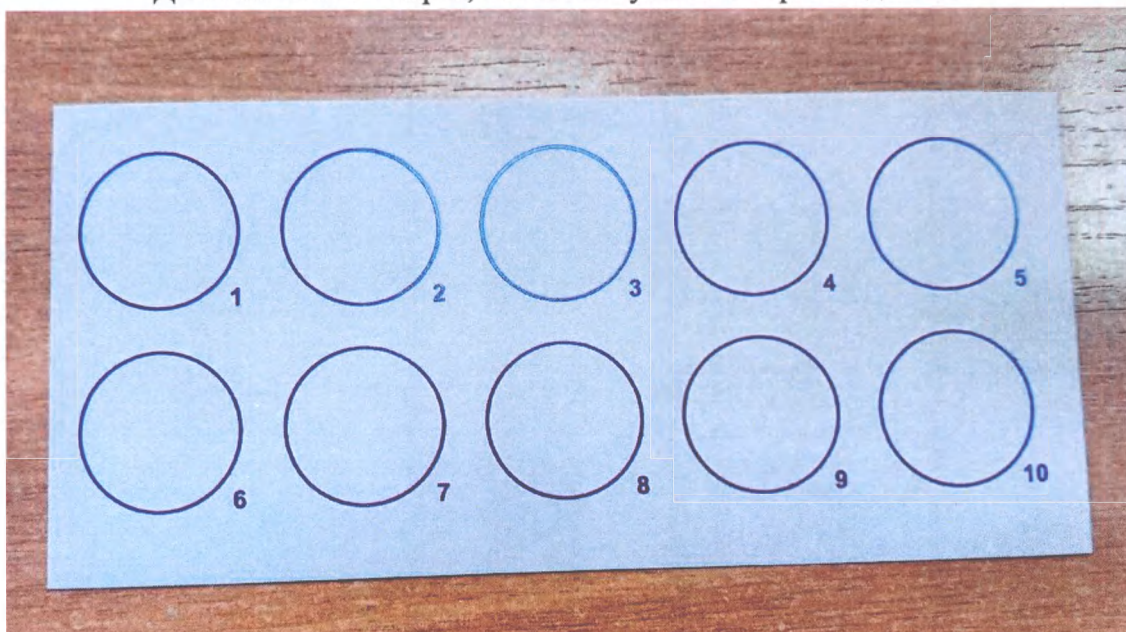


Маркировка потребительской упаковки

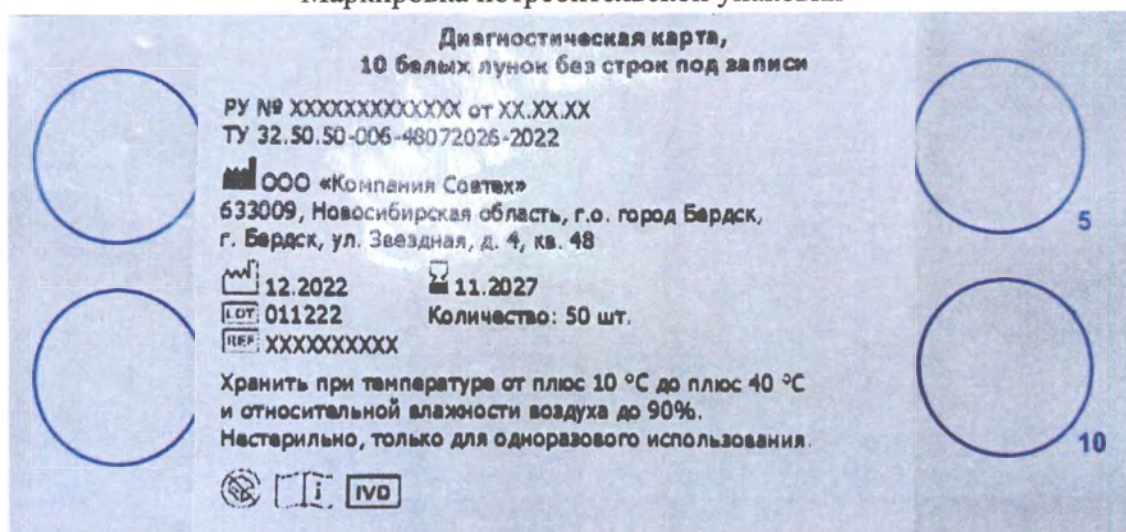

Диагностическая карта, 30 белых лунок с одной стороны
и 12 белых лунок с другой со строками под записи

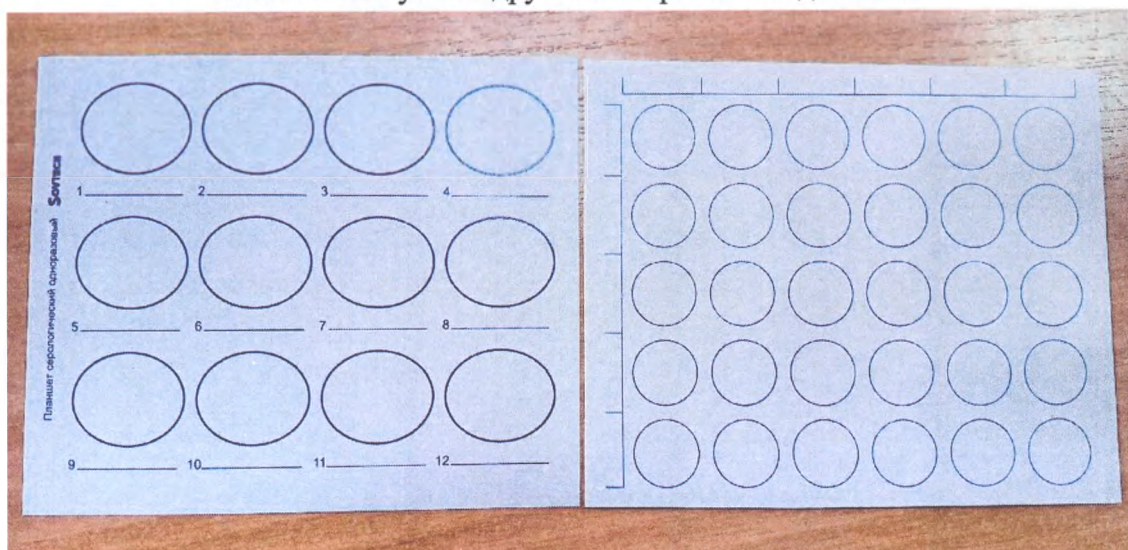

Маркировка потребительской упаковки

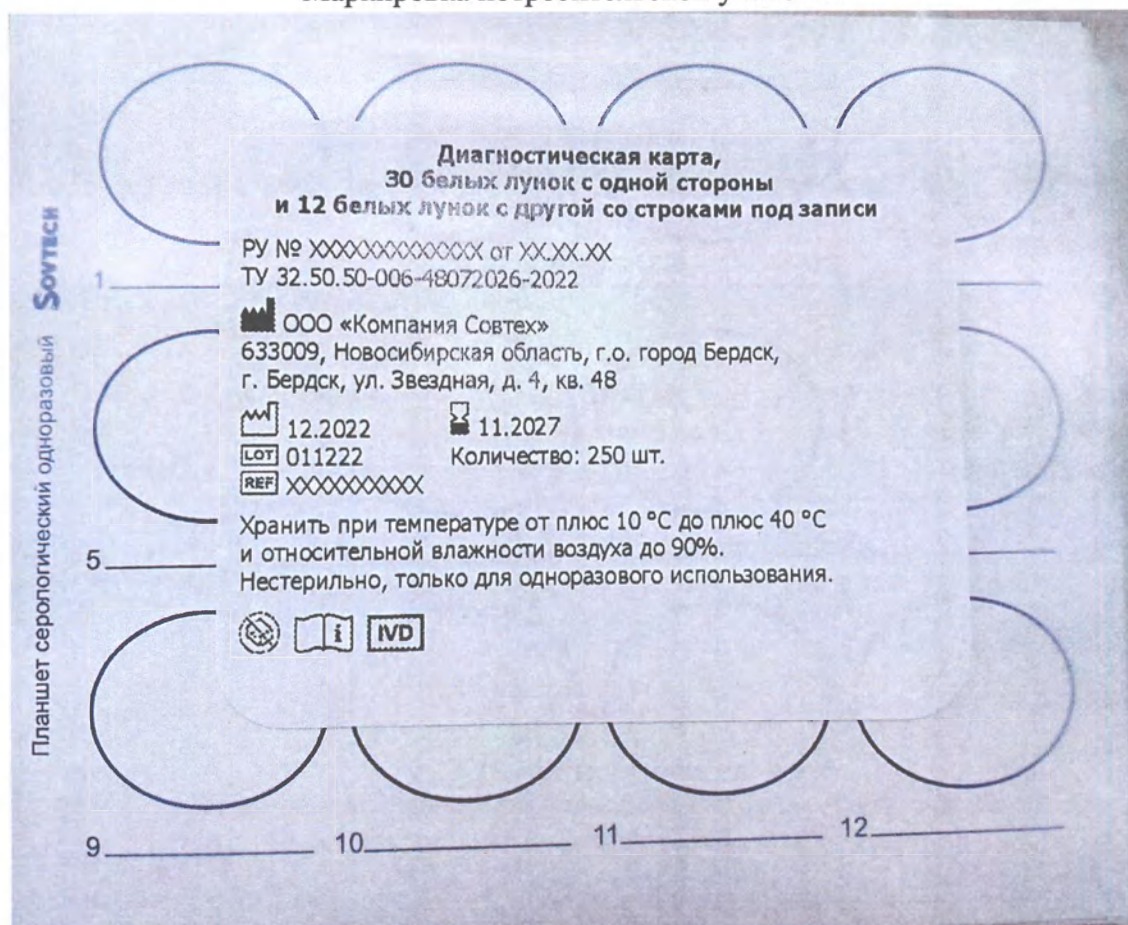

Диагностическая карта, 12 белых лунок со строками под записи

Sovtесh

Планшет серологический одноразовый

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Маркировка потребительской упаковки

Sovtесh

Планшет серологический одноразовый

**Диагностическая карта,
12 белых лунок со строками под записи**

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 12.2022  11.2027

 LOT 011222 Количество: 250 шт.

 REF XXXXXXXXXXXX


Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.

Нестерильно, только для одноразового использования.


  

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Диагностическая карта, 30 белых лунок

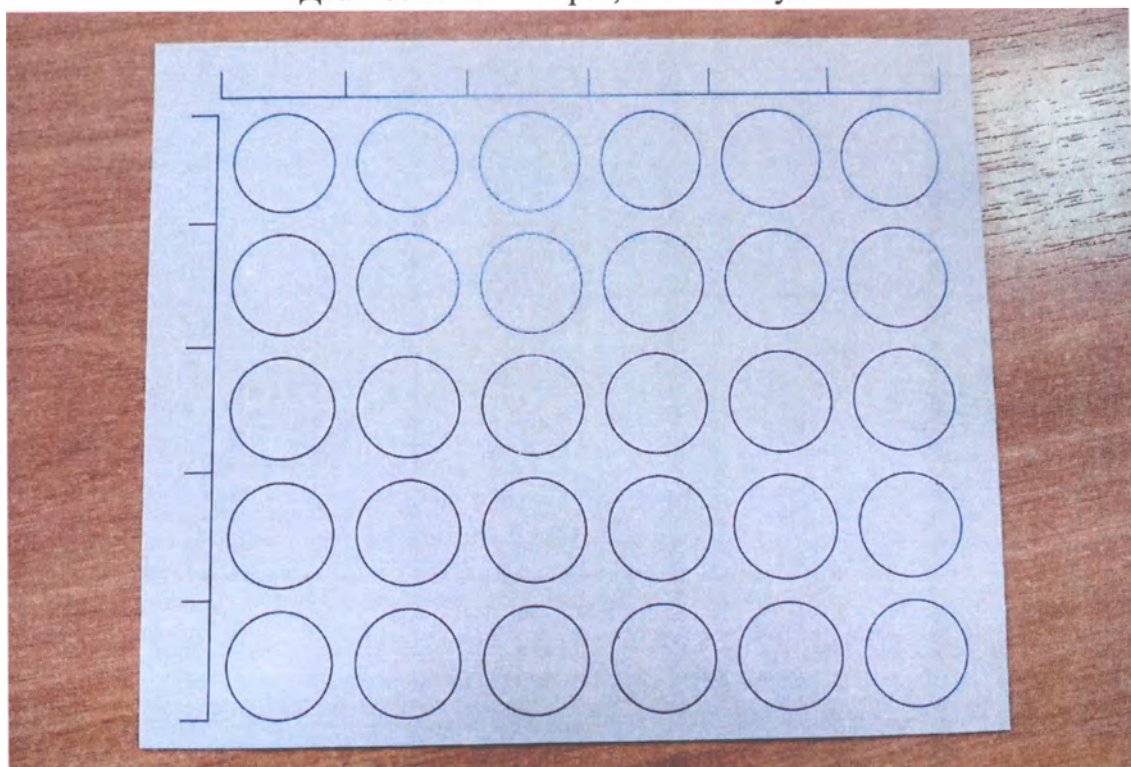


Маркировка потребительской упаковки

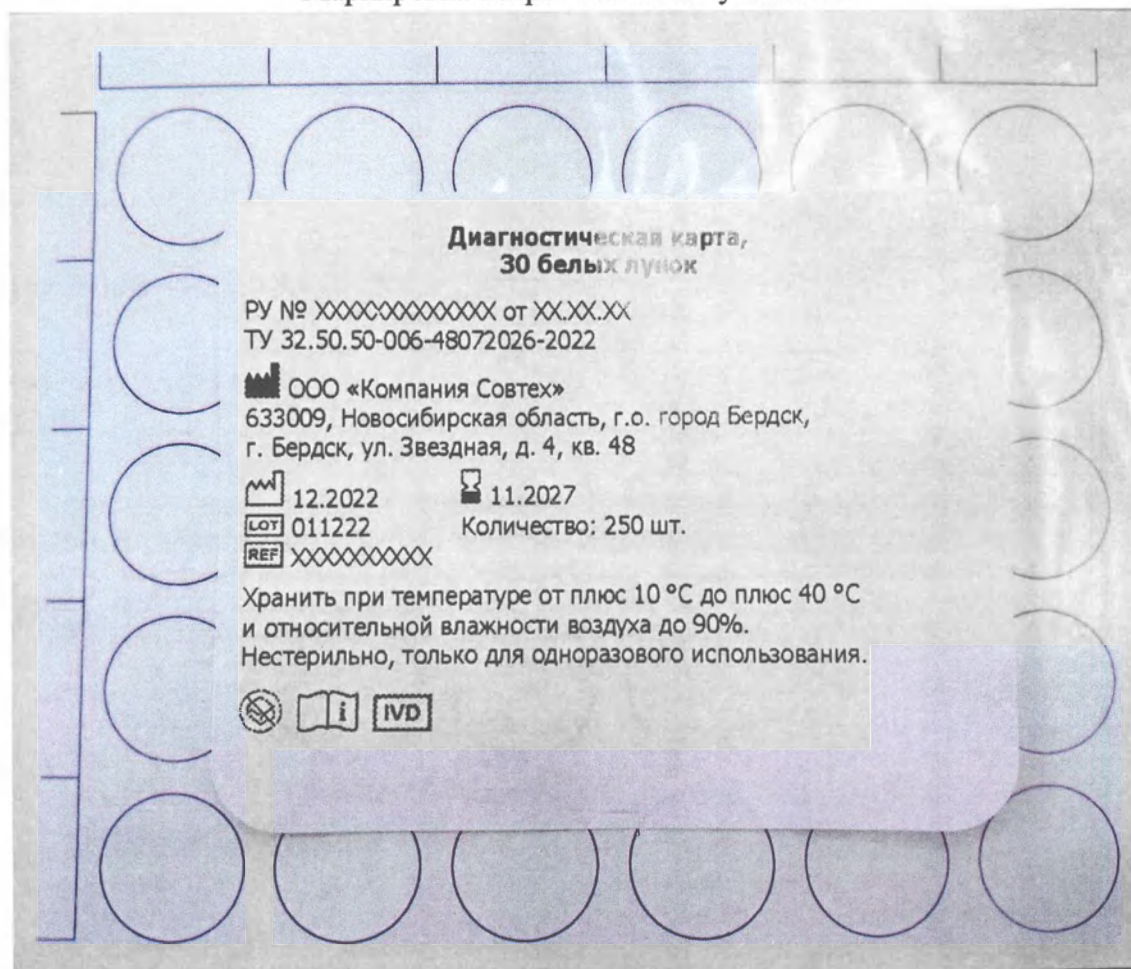


Диагностическая карта, 8 черных лунок со строками под записи

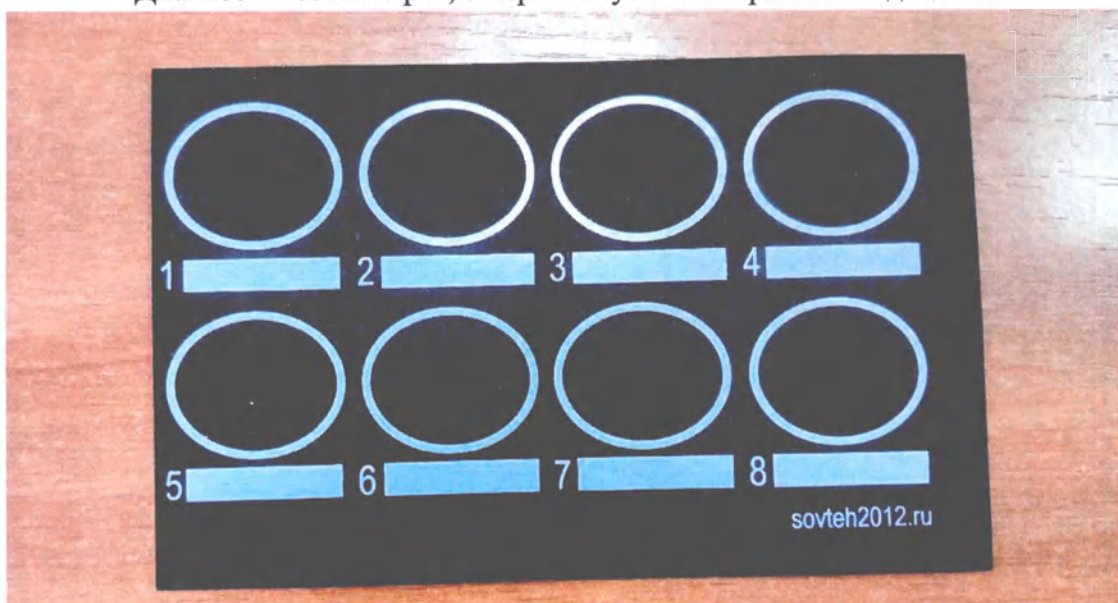


Маркировка потребительской упаковки

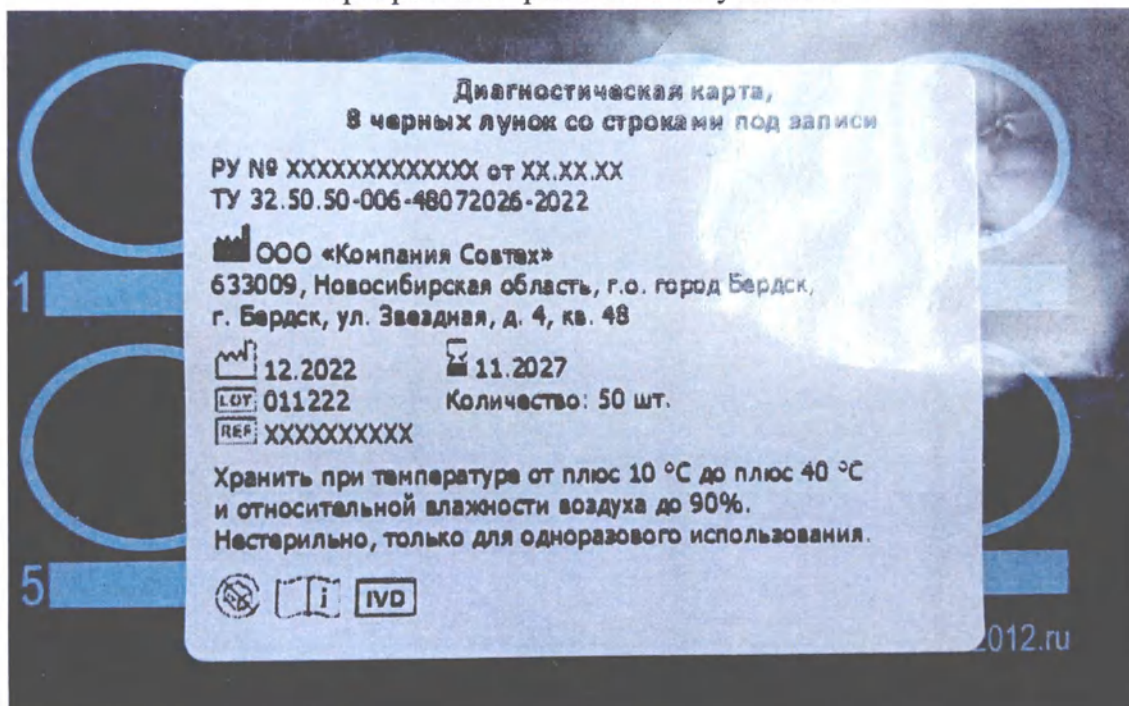

Диагностическая карта, 3 белые лунки

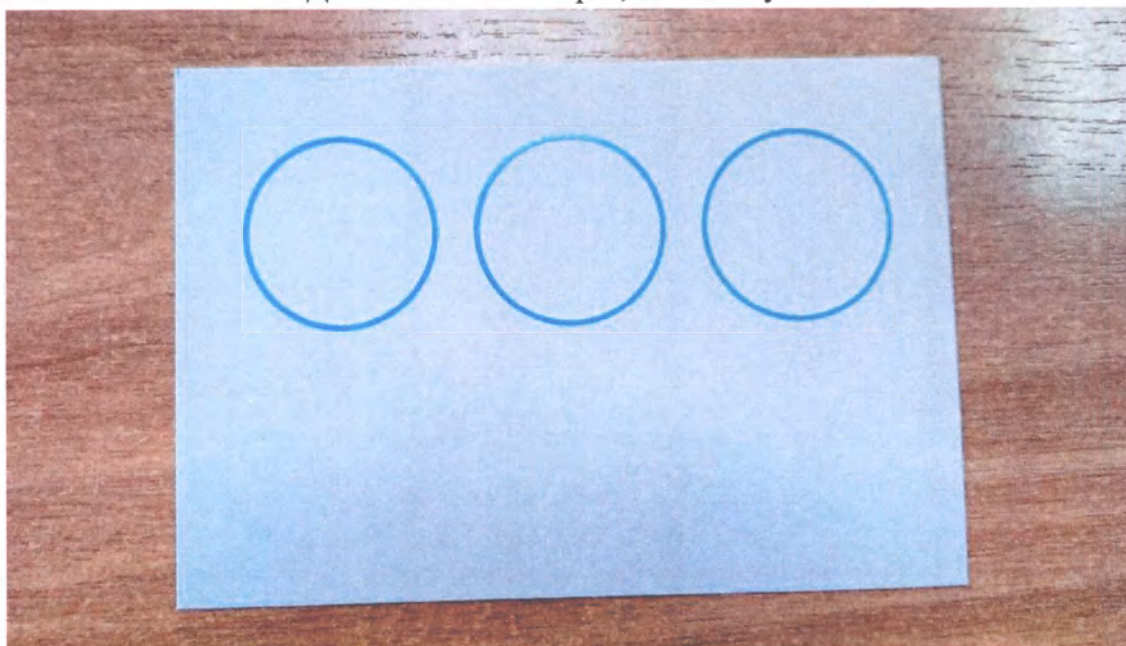

Маркировка потребительской упаковки

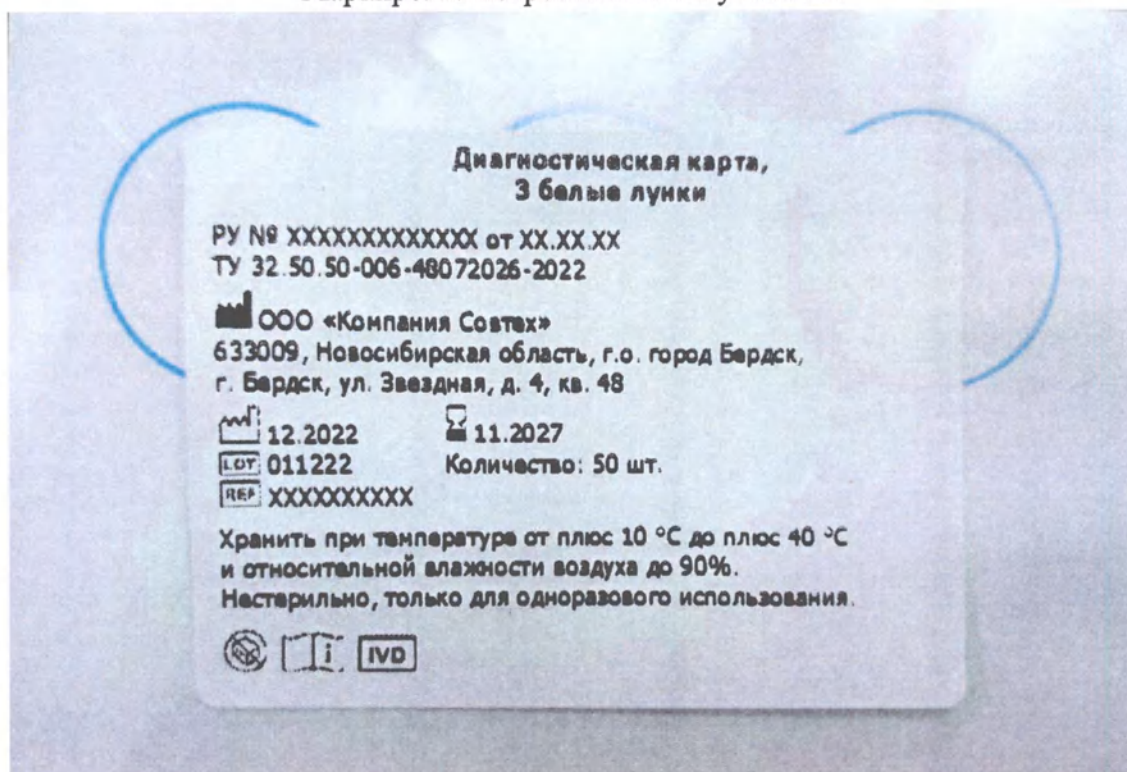

Образец потребительской упаковки на примере варианта исполнения Диагностическая карта, 30 белых лунок с одной стороны и 12 белых лунок с другой со строками под записи



Пример комплекта поставки, транспортная упаковка в открытом виде



Образец транспортной упаковки



Маркировка транспортной упаковки на примере Диагностическая карта, 30 белых лунок с одной стороны и 12 белых лунок с другой со строками под записи

Диагностическая карта для проведения иммунологических исследований, одноразовая, нестерильная по ТУ 32.50.50-006-48072026-2022, в комплекте:

I. Диагностическая карта, 30 белых лунок с одной стороны и 12 белых лунок с другой со строками под записи - 250 шт. в потребительской упаковке
II. Инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 12.2022  11.2027
 LOT 011222  REF XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +10 °С до +40 °С при относительной влажности до 90%.
Условия транспортирования: от -40 °С до +40 °С при относительной влажности до 90%.
Число единиц потребительской упаковки: 12 шт.
Масса брутто: 16,544 кг

  
sovteh2012.ru

 **SOVTECH**
расходные материалы для лабораторий



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 13 (тринадцать) листах
Директор ООО «Компания Совтех»

О.Е. Кондрашова

О.Е. Кондрашова

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Компания Совтех»

О.Е. Кондрашова
«19» февраля 2024 г.
М.П.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ОДНОРАЗОВАЯ, НЕСТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

Версия 1 от «19» февраля 2024 г.

1. МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диагностическая карта,
12 черных лунок с полем под записи

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ
LOT XXMMГГ Количество: 50 шт.
REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



Диагностическая карта,
6 черных лунок

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ
LOT XXMMГГ Количество: 50 шт.
REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.




Диагностическая карта,
8 белых лунок

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ
LOT XXMMГГ Количество: 50 шт.
REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



Диагностическая карта,
10 белых лунок со строками под записи

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ
LOT XXMMГГ Количество: 50 шт.
REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

**Диагностическая карта,
10 белых лунок без строк под записи**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 LOT XXMMГГ Количество: 50 шт.
 REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



**Диагностическая карта,
30 белых лунок с одной стороны
и 12 белых лунок с другой со строками под записи**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 LOT XXMMГГ Количество: 250 шт.
 REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



**Диагностическая карта,
12 белых лунок со строками под записи**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 LOT XXMMГГ Количество: 250 шт.
 REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



**Диагностическая карта,
30 белых лунок**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 LOT XXMMГГ Количество: 250 шт.
 REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



**Диагностическая карта,
8 черных лунок со строками под записи**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 LOT XXMMГГ Количество: 50 шт.
 REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



**Диагностическая карта,
3 белые лунки**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 LOT XXMMГГ Количество: 50 шт.
 REF XXXXXXXXXXXX

Хранить при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%.
Нестерильно, только для одноразового использования.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

2. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пример маркировки транспортной (групповой) упаковки:

Диагностическая карта для проведения иммунологических исследований, одноразовая, нестерильная по ТУ 32.50.50-006-48072026-2022, в комплекте:
I. Диагностическая карта, 30 белых лунок с одной стороны и 12 белых лунок с другой со строками под записи - 250 шт. в потребительской упаковке
II. Инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX
ТУ 32.50.50-006-48072026-2022

ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

ММ.ГГГГ
 XXMMГГ

ММ.ГГГГ
 XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +10 °С до +40 °С при относительной влажности до 90%.
Условия транспортирования: от -40 °С до +40 °С при относительной влажности до 90%.
Число единиц потребительской упаковки: XX шт.
Масса брутто: XXXX кг

Примечание: при необходимости вместо «Диагностическая карта, 30 белых лунок с одной стороны и 12 белых лунок с другой со строками под записи - 250 шт. в потребительской упаковке» указывается требуемое наименование варианта исполнения и количество соответственно, согласно приведенным на маркировке потребительской упаковки, а также ТУ 32.50.50-006-48072026-2022.

Значения в Число единиц потребительской упаковки и Масса брутто допускается указывать от руки или с помощью клише.

Расположение информации и символов не нормировано.

3. ЭТИКЕТКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пример этикетки с фоном под маркировку транспортной (групповой) упаковки:



Маркировка транспортной (групповой) упаковки медицинского изделия наносится на этикетку с фоном.

Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия наносится на этикетку без фона.

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ– год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 3 (*три*) листах
Директор ООО «Компания Совтех»

О.Е. Кондрашова

О.Е. Кондрашова