


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов и калибраторов для количественного определения
тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)),
набор на 200 тестов**

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan
Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**

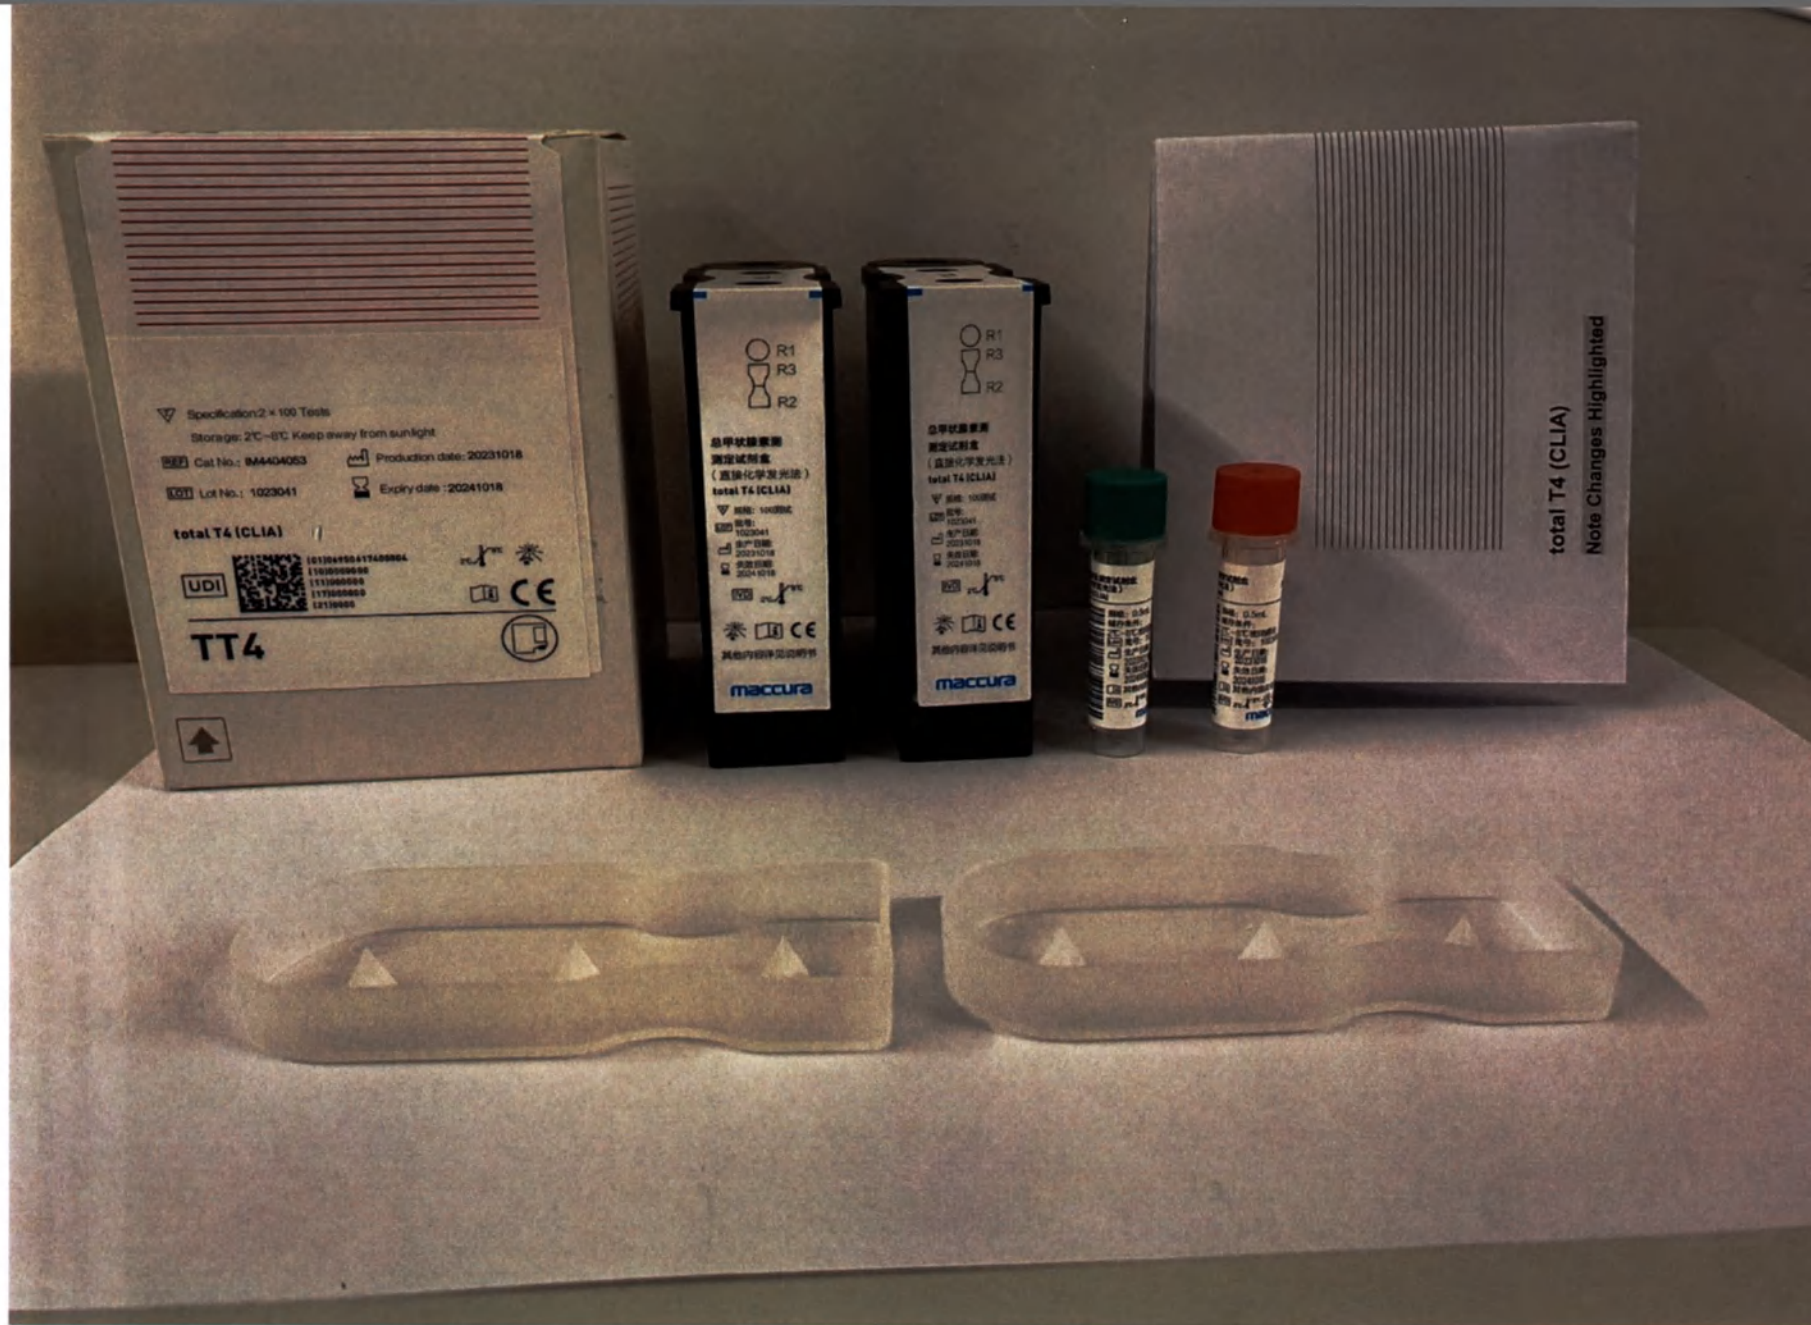

Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов»



maccura



IVD

6 950617 423409

生产许可证编号: 川食药监械生产许20150064号

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号:


川械注准20182400123

注意事项: 其他内容详见说明书

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537
Hamburg, Germany

TT4



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: + 86 28 8782 6777

传真: + 86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.

Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731


Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel : +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов»

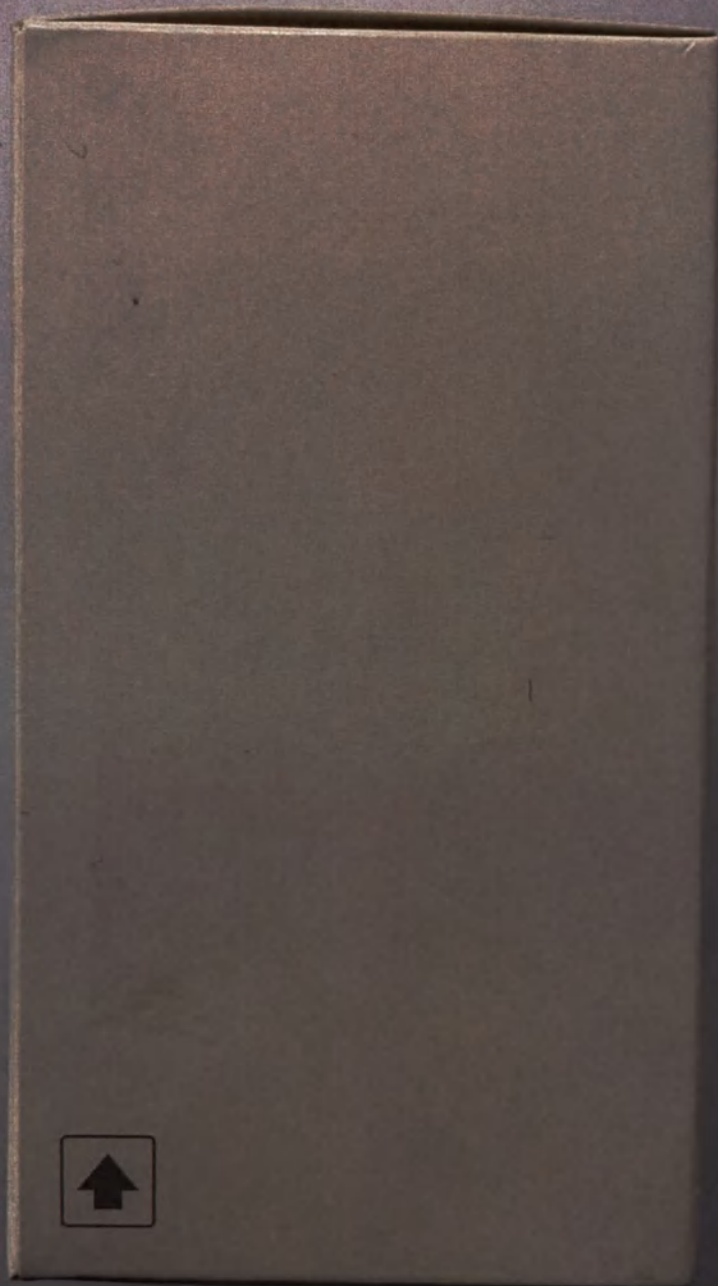


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов»

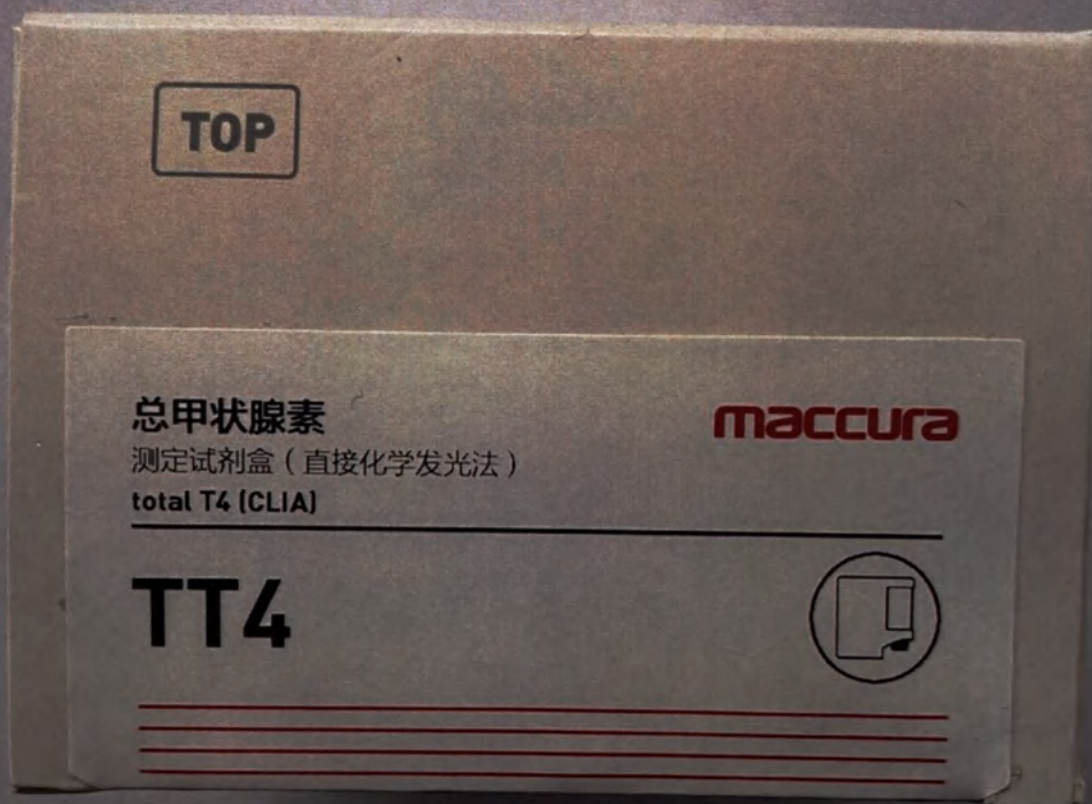


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов»



Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2, R3 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов»

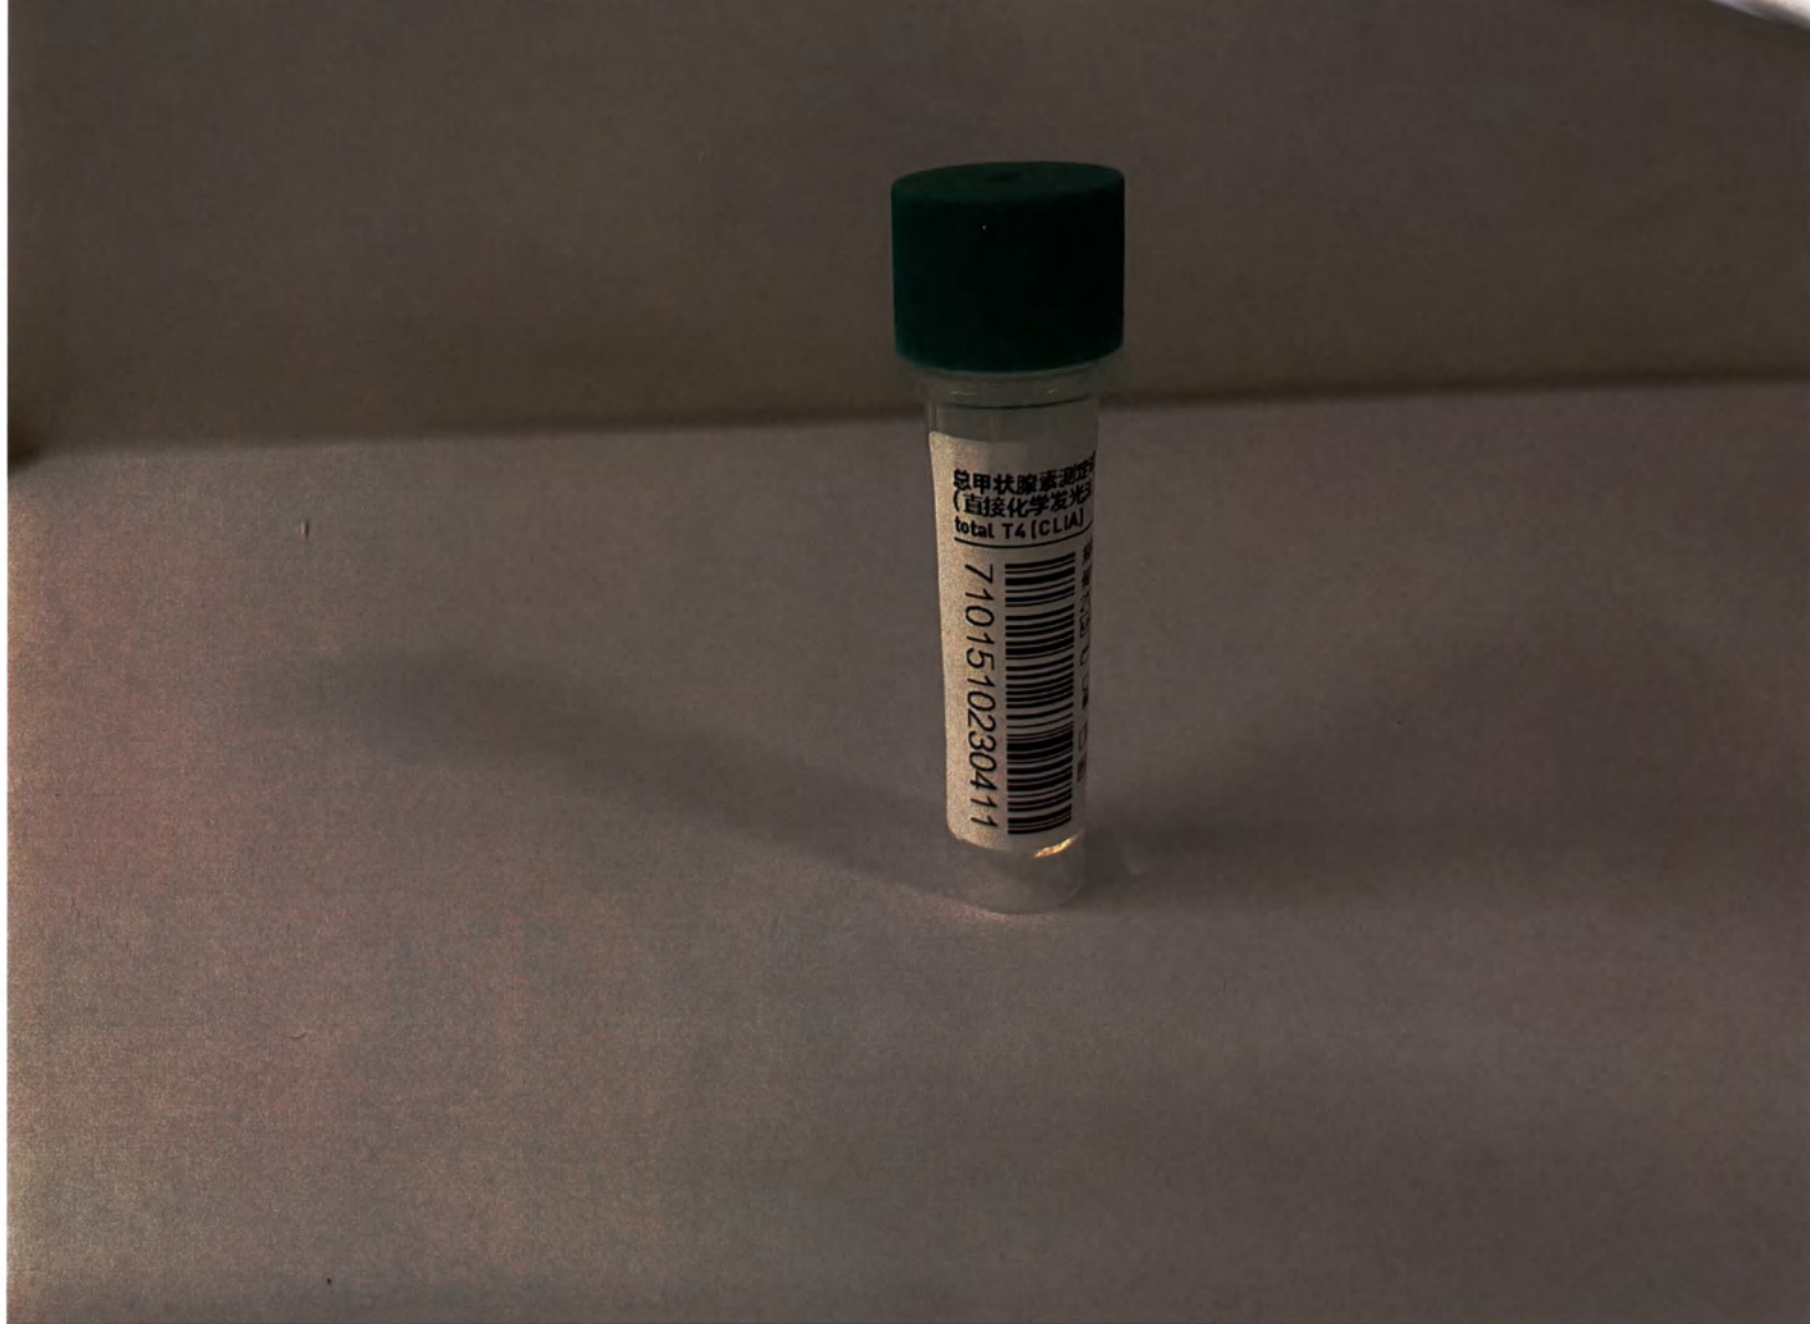


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Masscura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

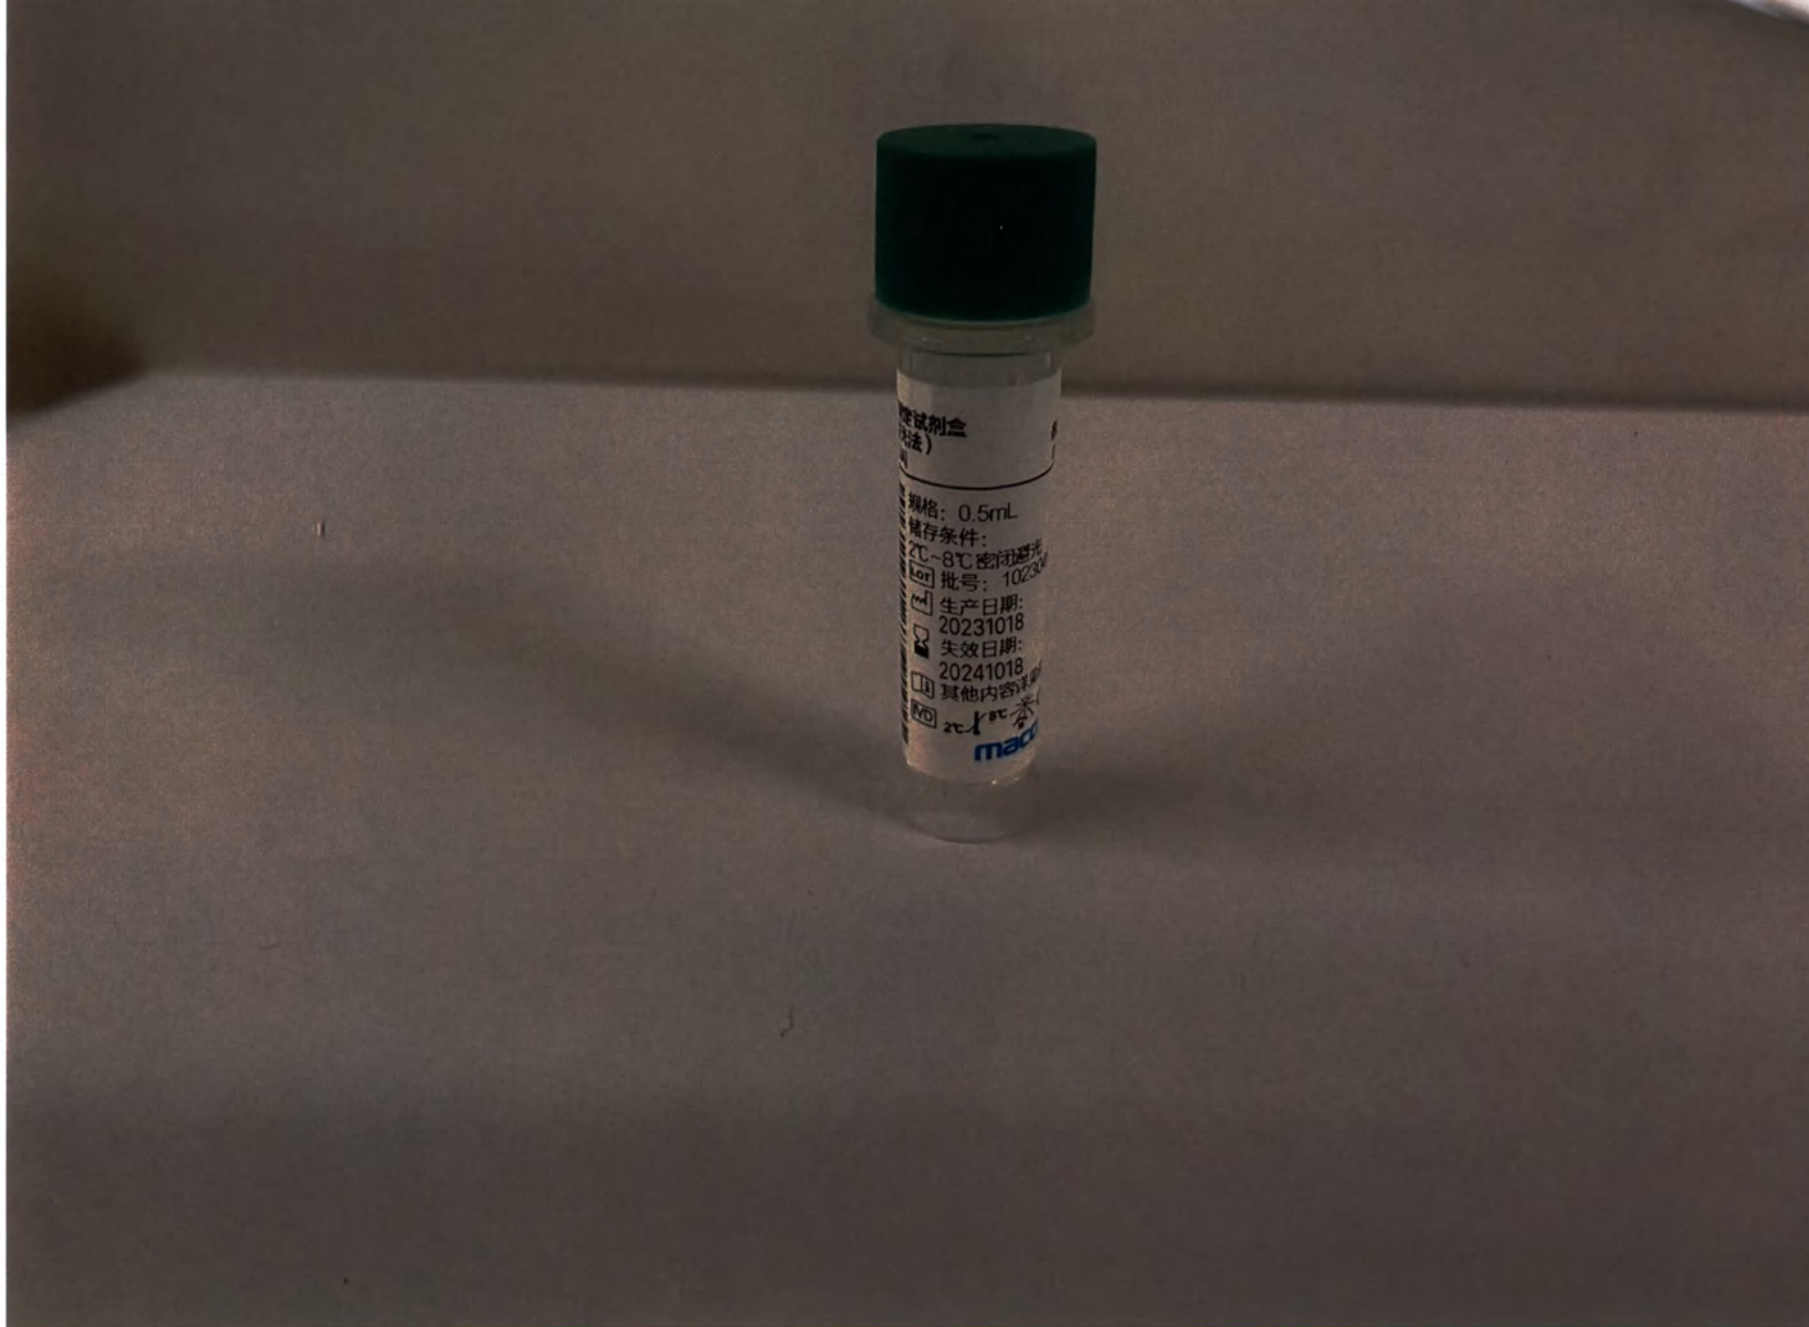


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий)


иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

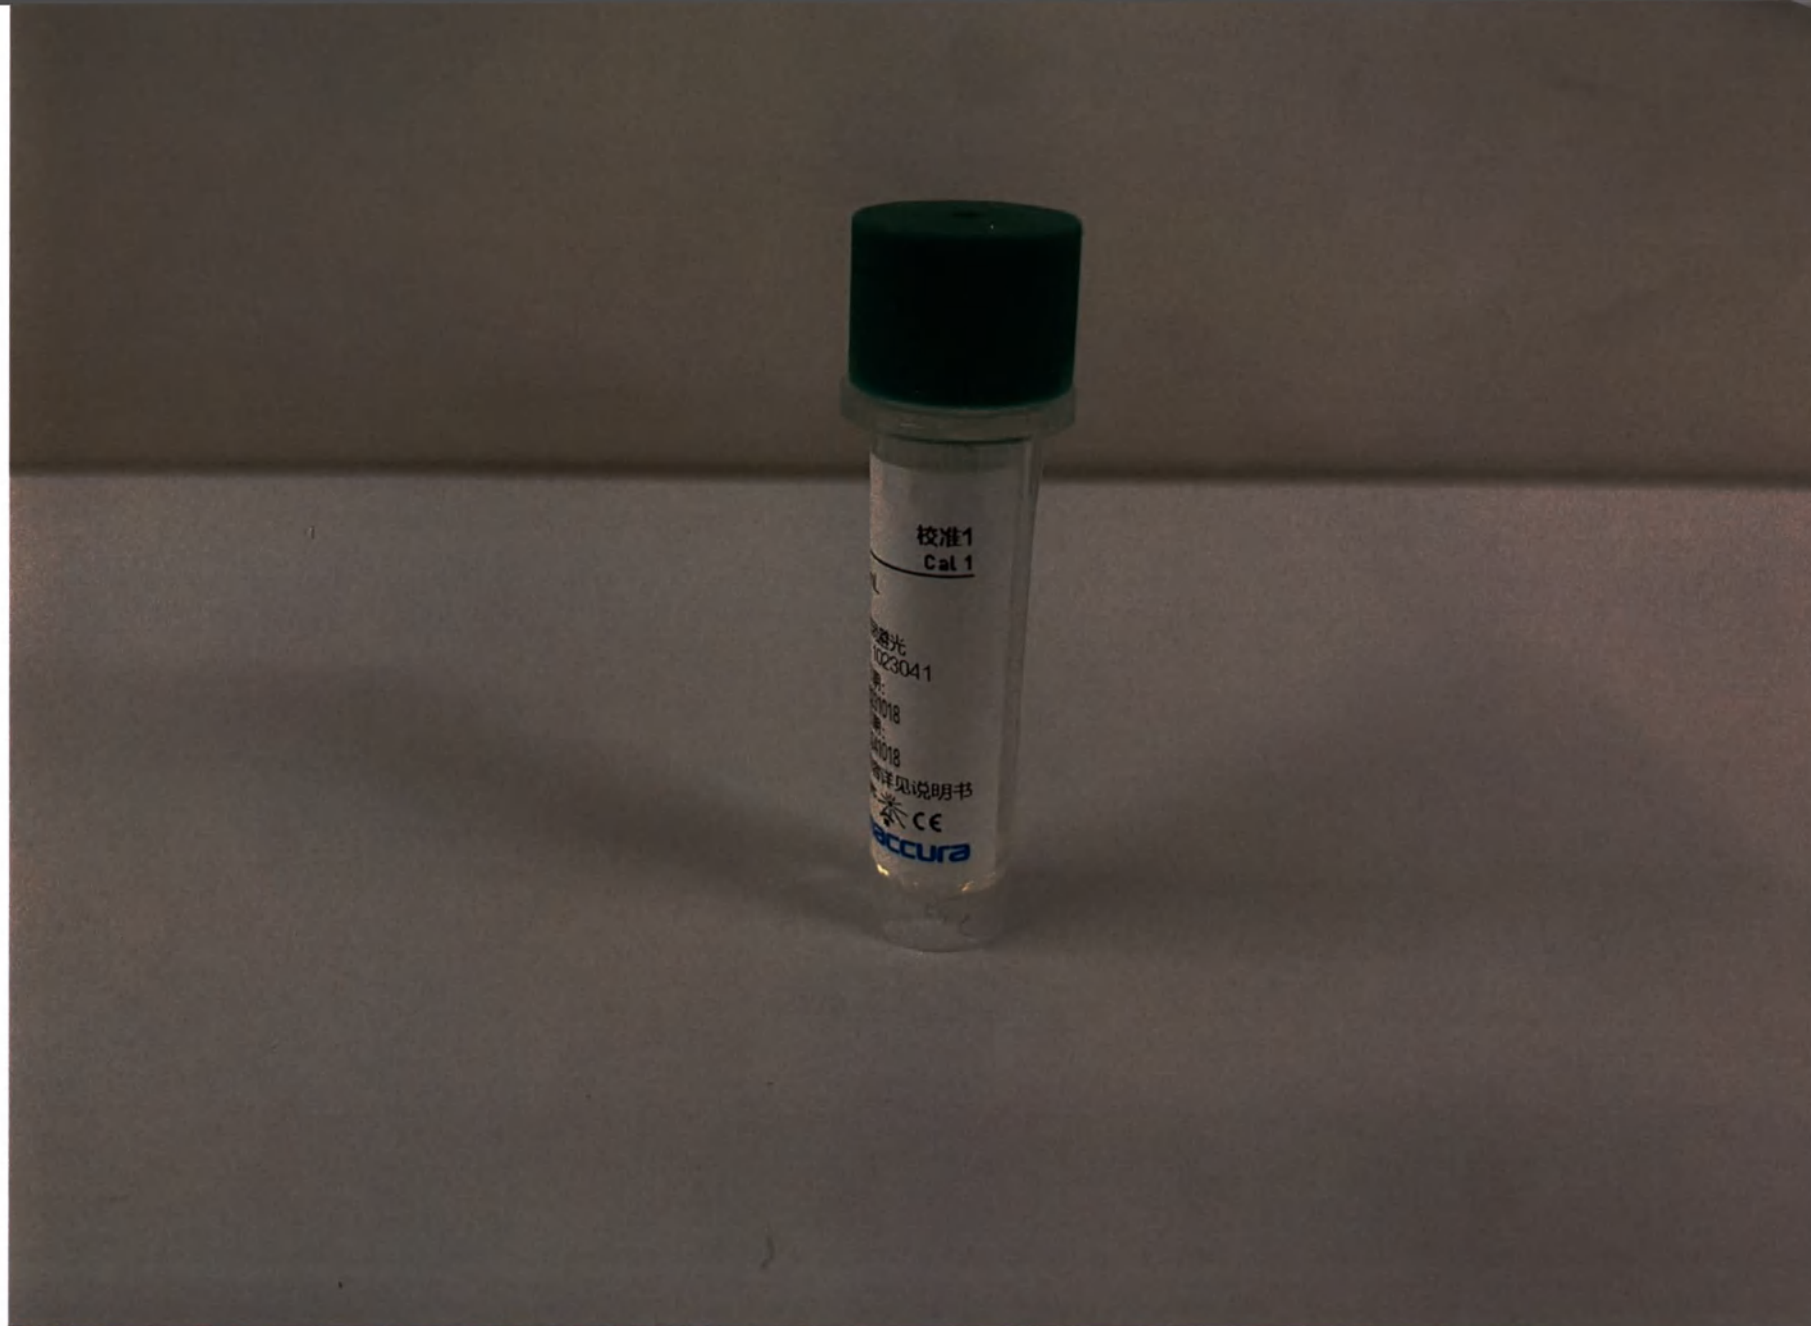


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

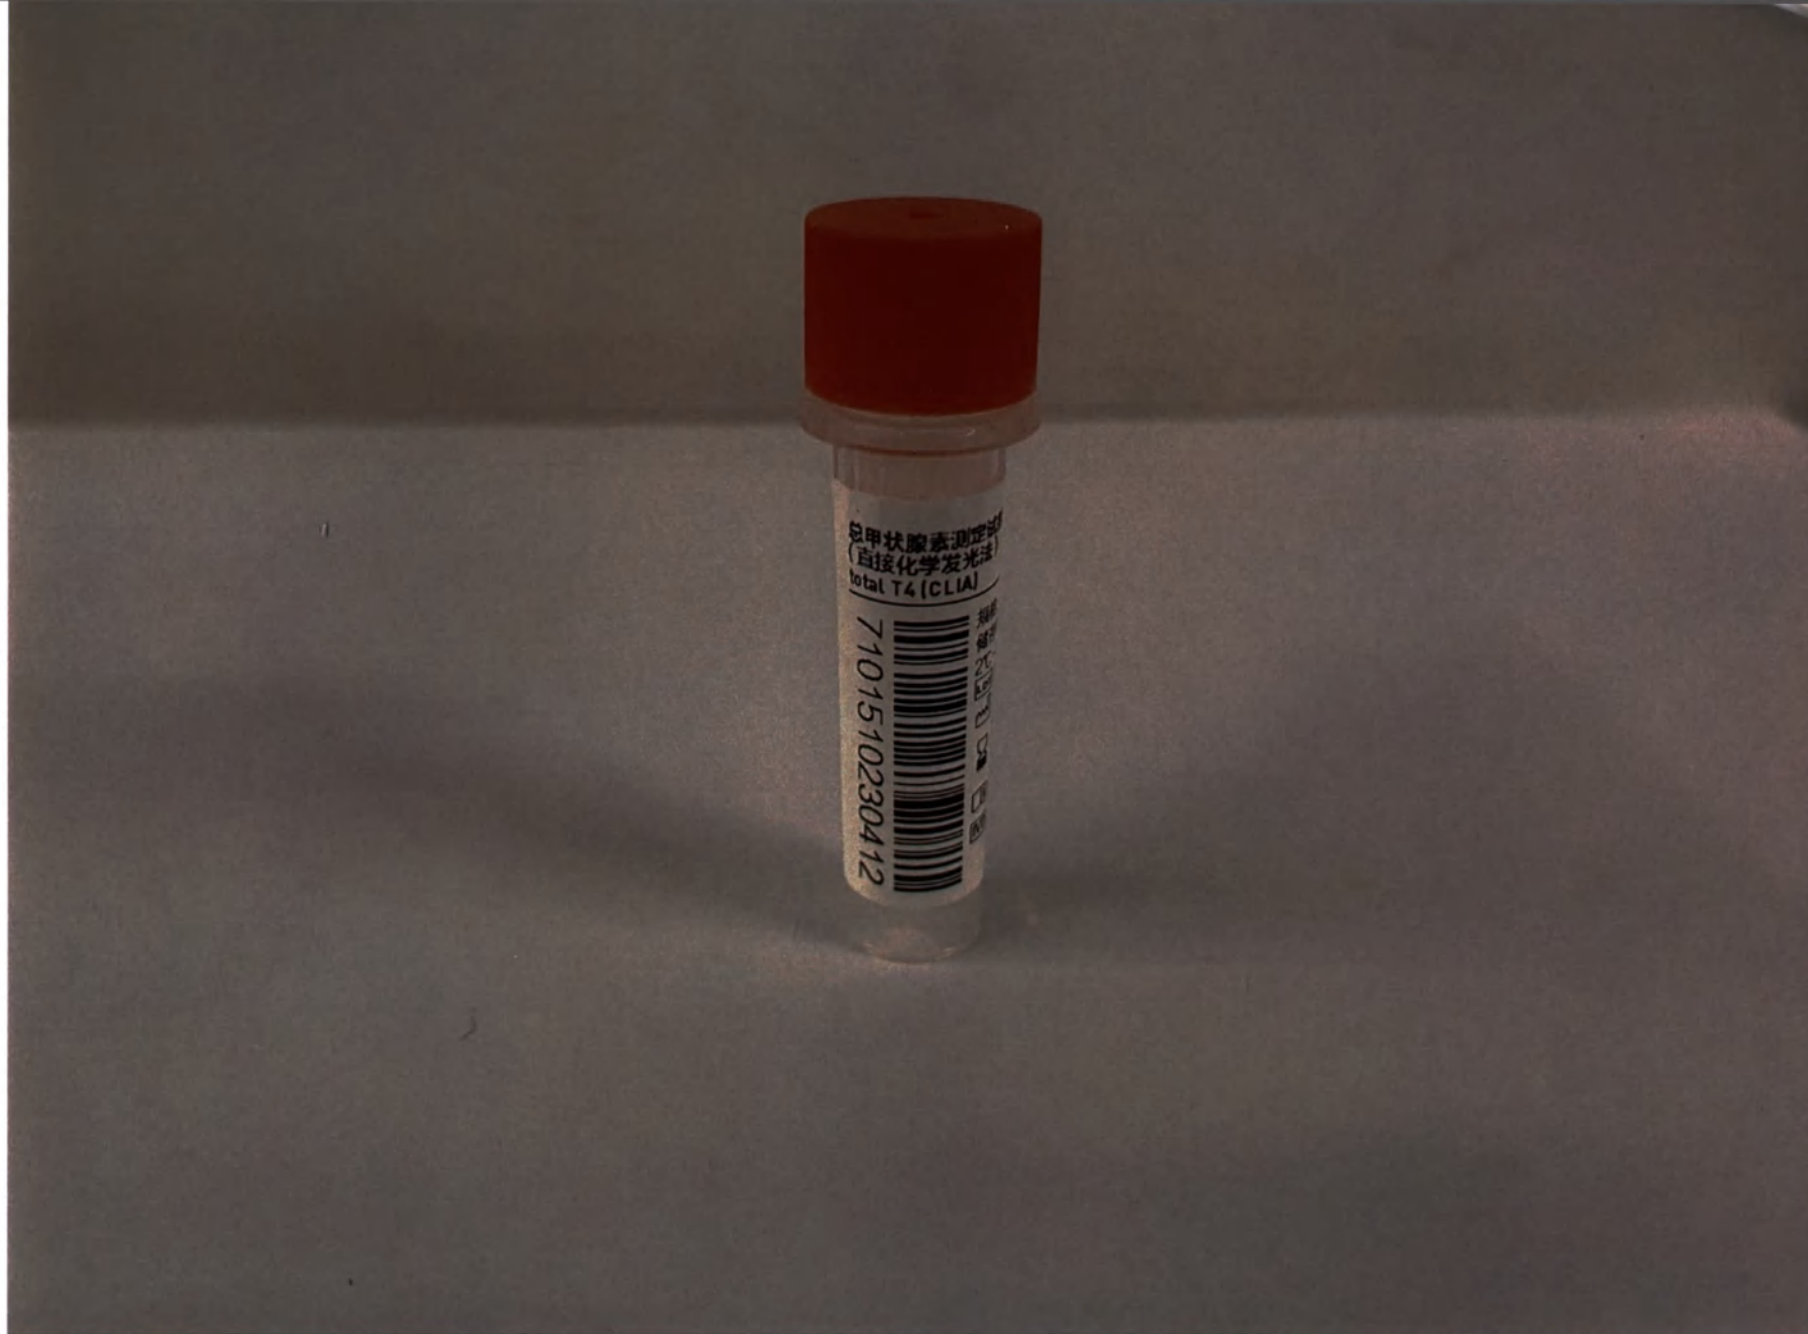

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

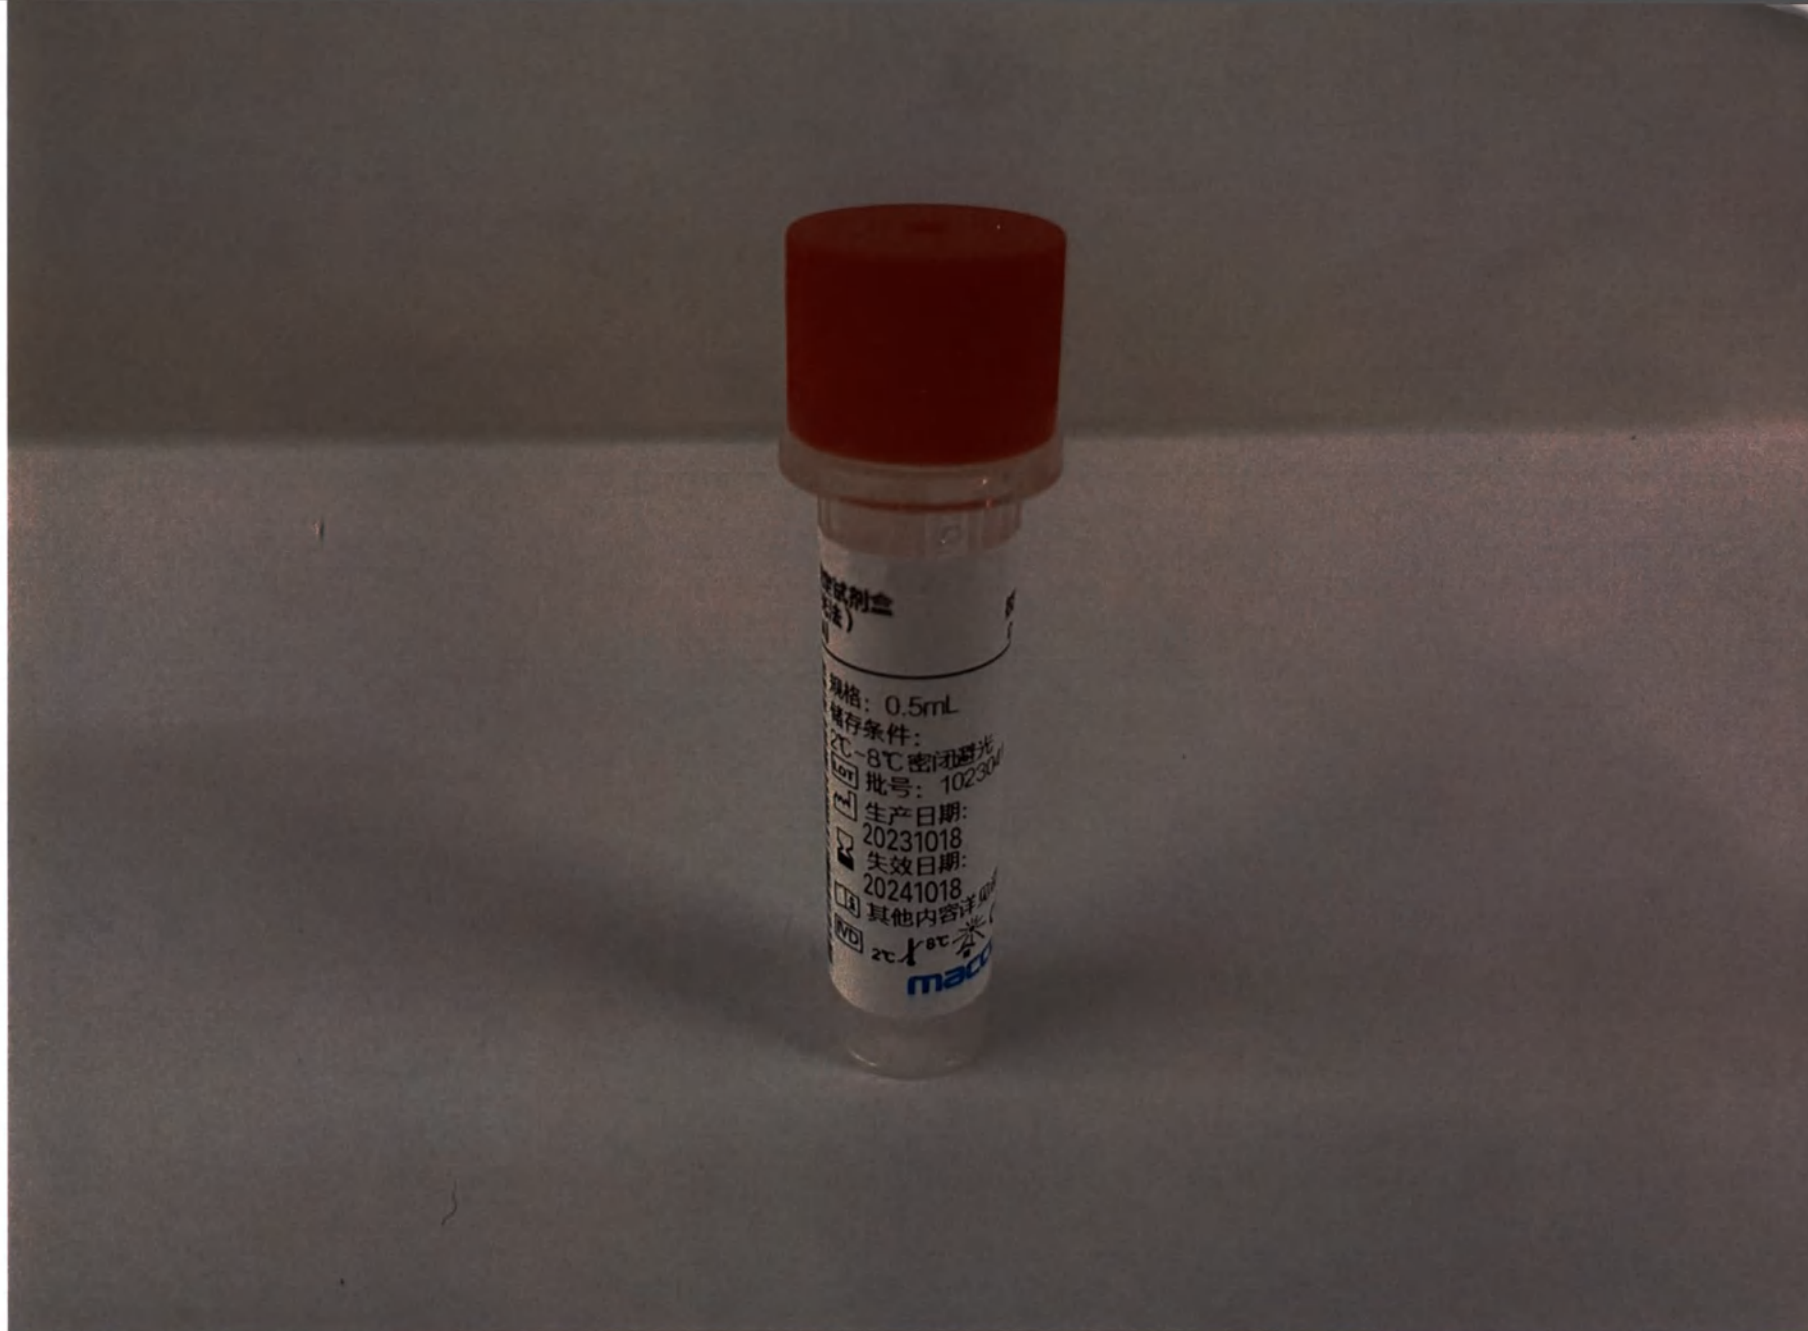


Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

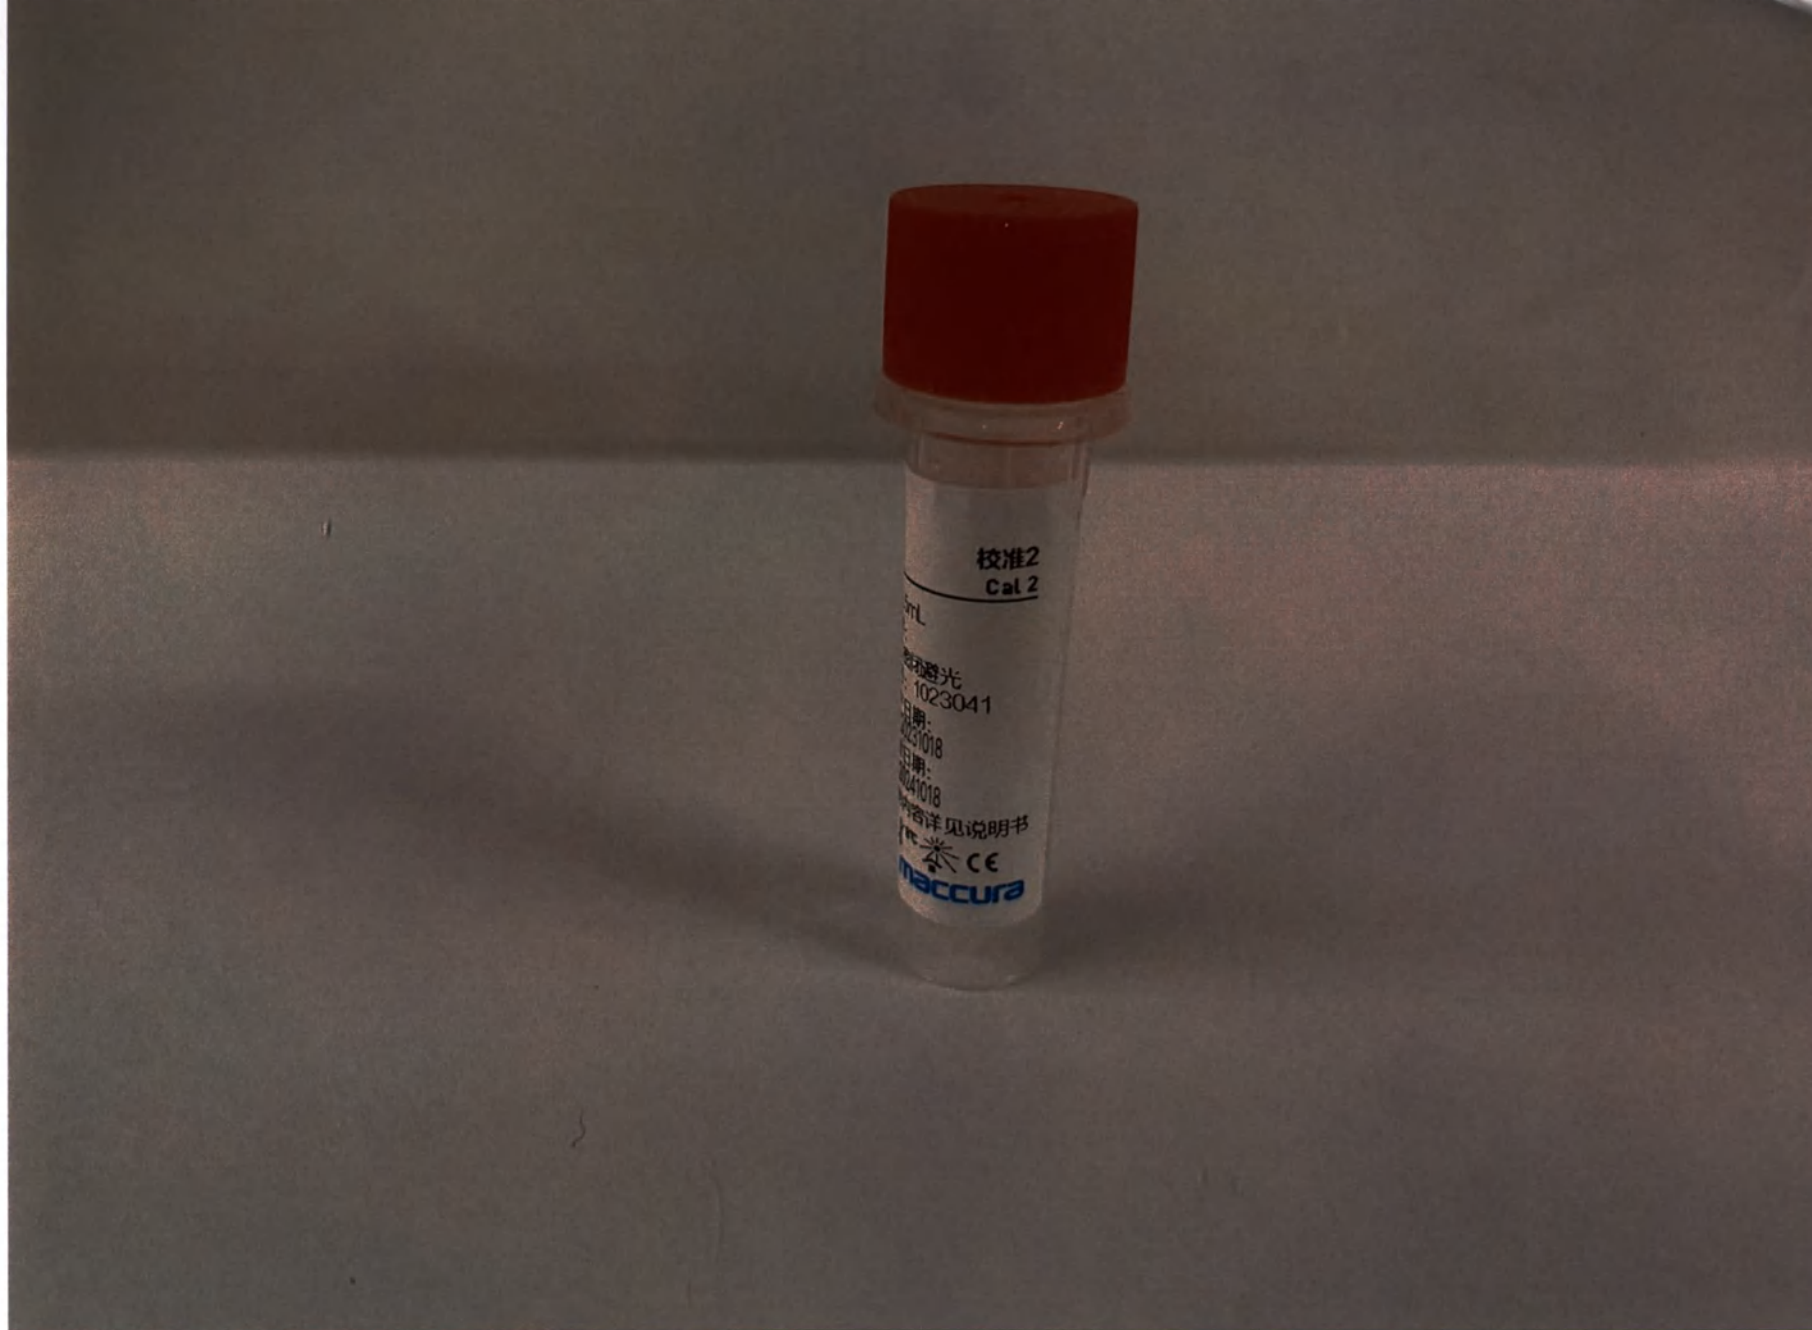

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий)

ИММУНОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (total T4 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

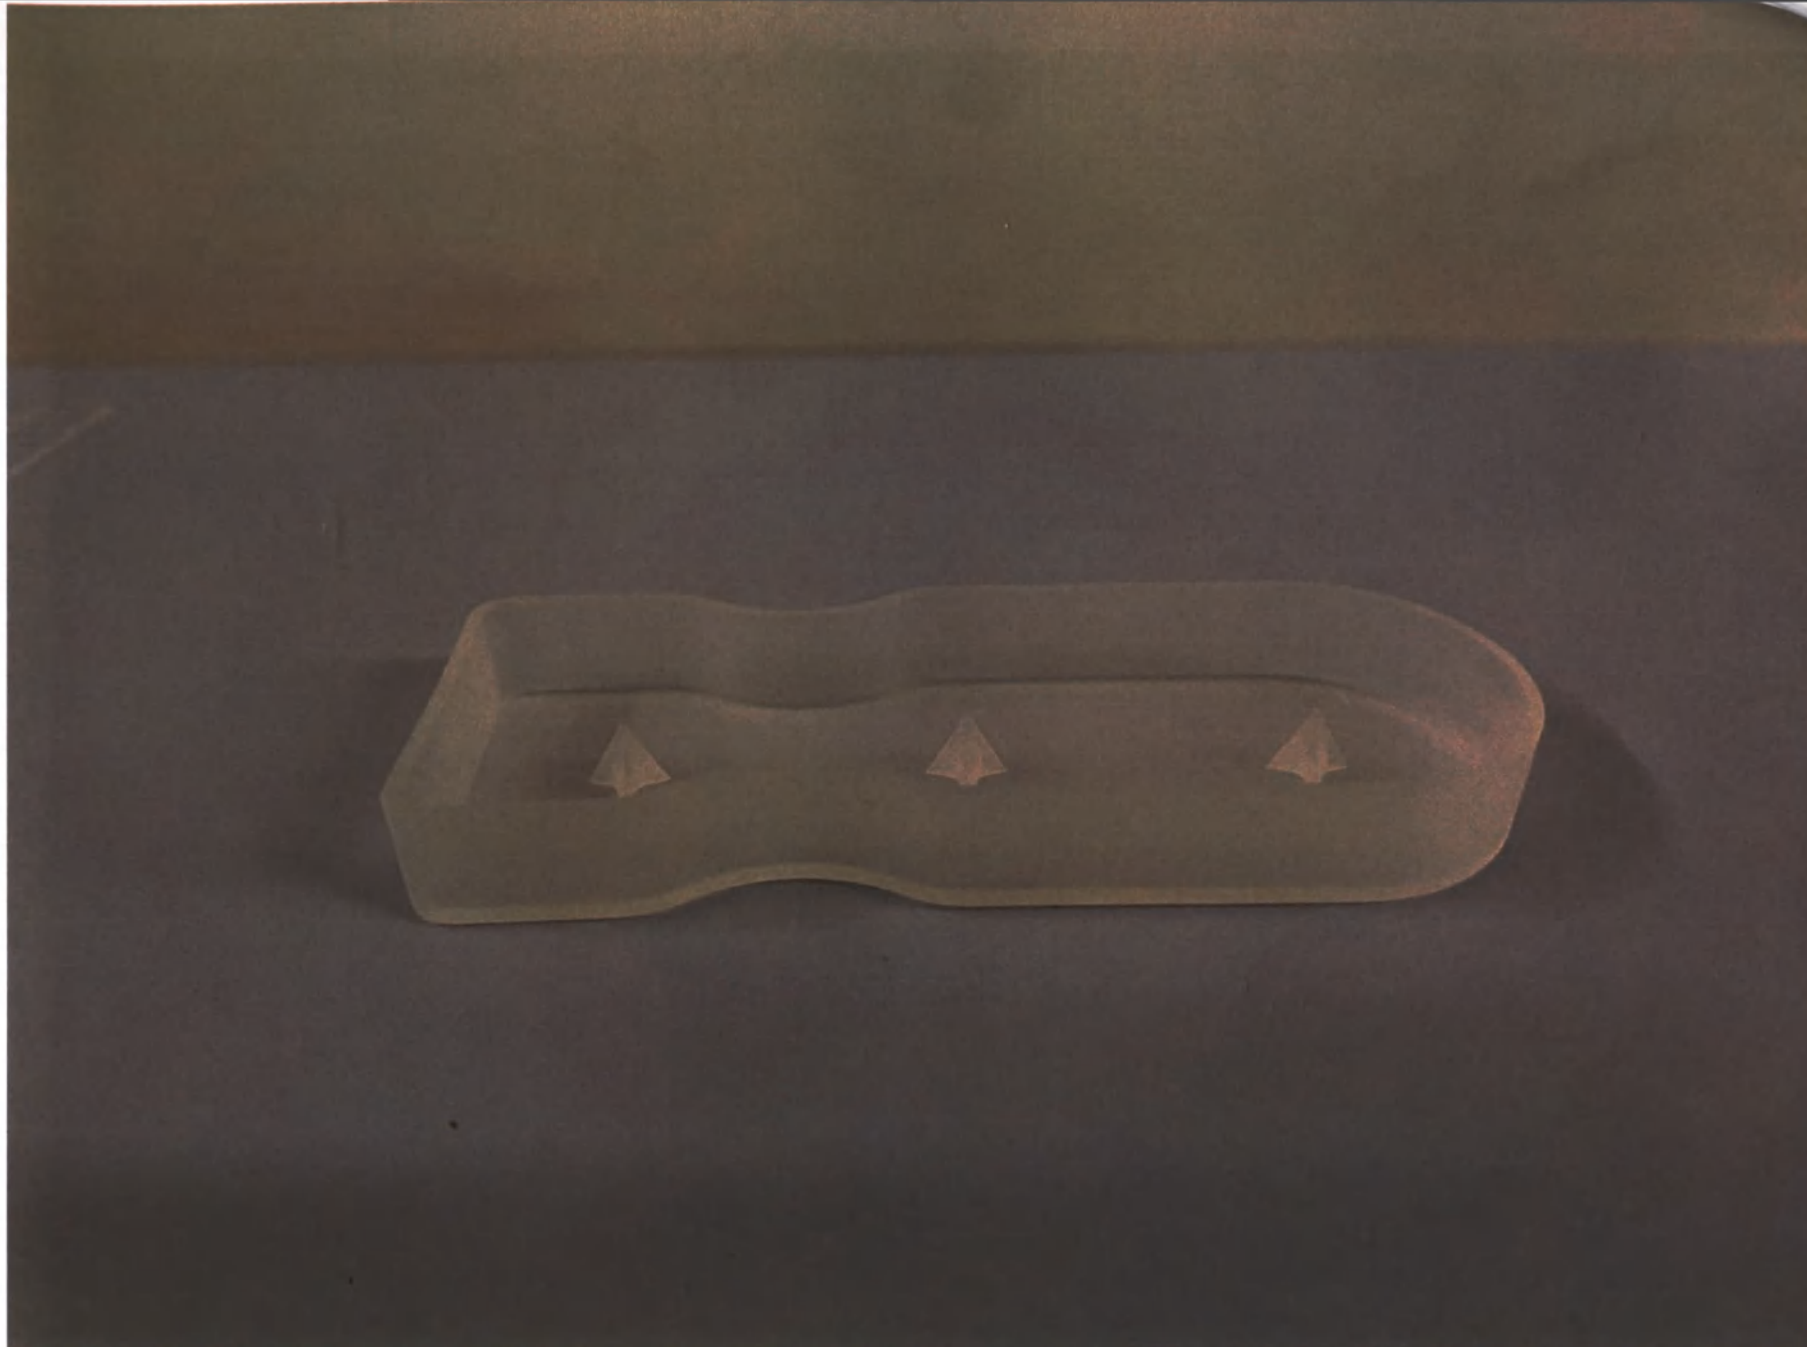

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения тироксина (Т4 общий)

Всего прошнуровано,
пронумеровано и укреплено
печатью 16 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»