

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«21» августа 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА М К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ИКСОДОВЫХ
КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА)
(ЛаймБест - IgM)
по ТУ 9398-267-23548172-2011

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011»



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 3



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,

Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211

тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 3



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 4



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 5



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 6



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 7




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов
(болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 8



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 9

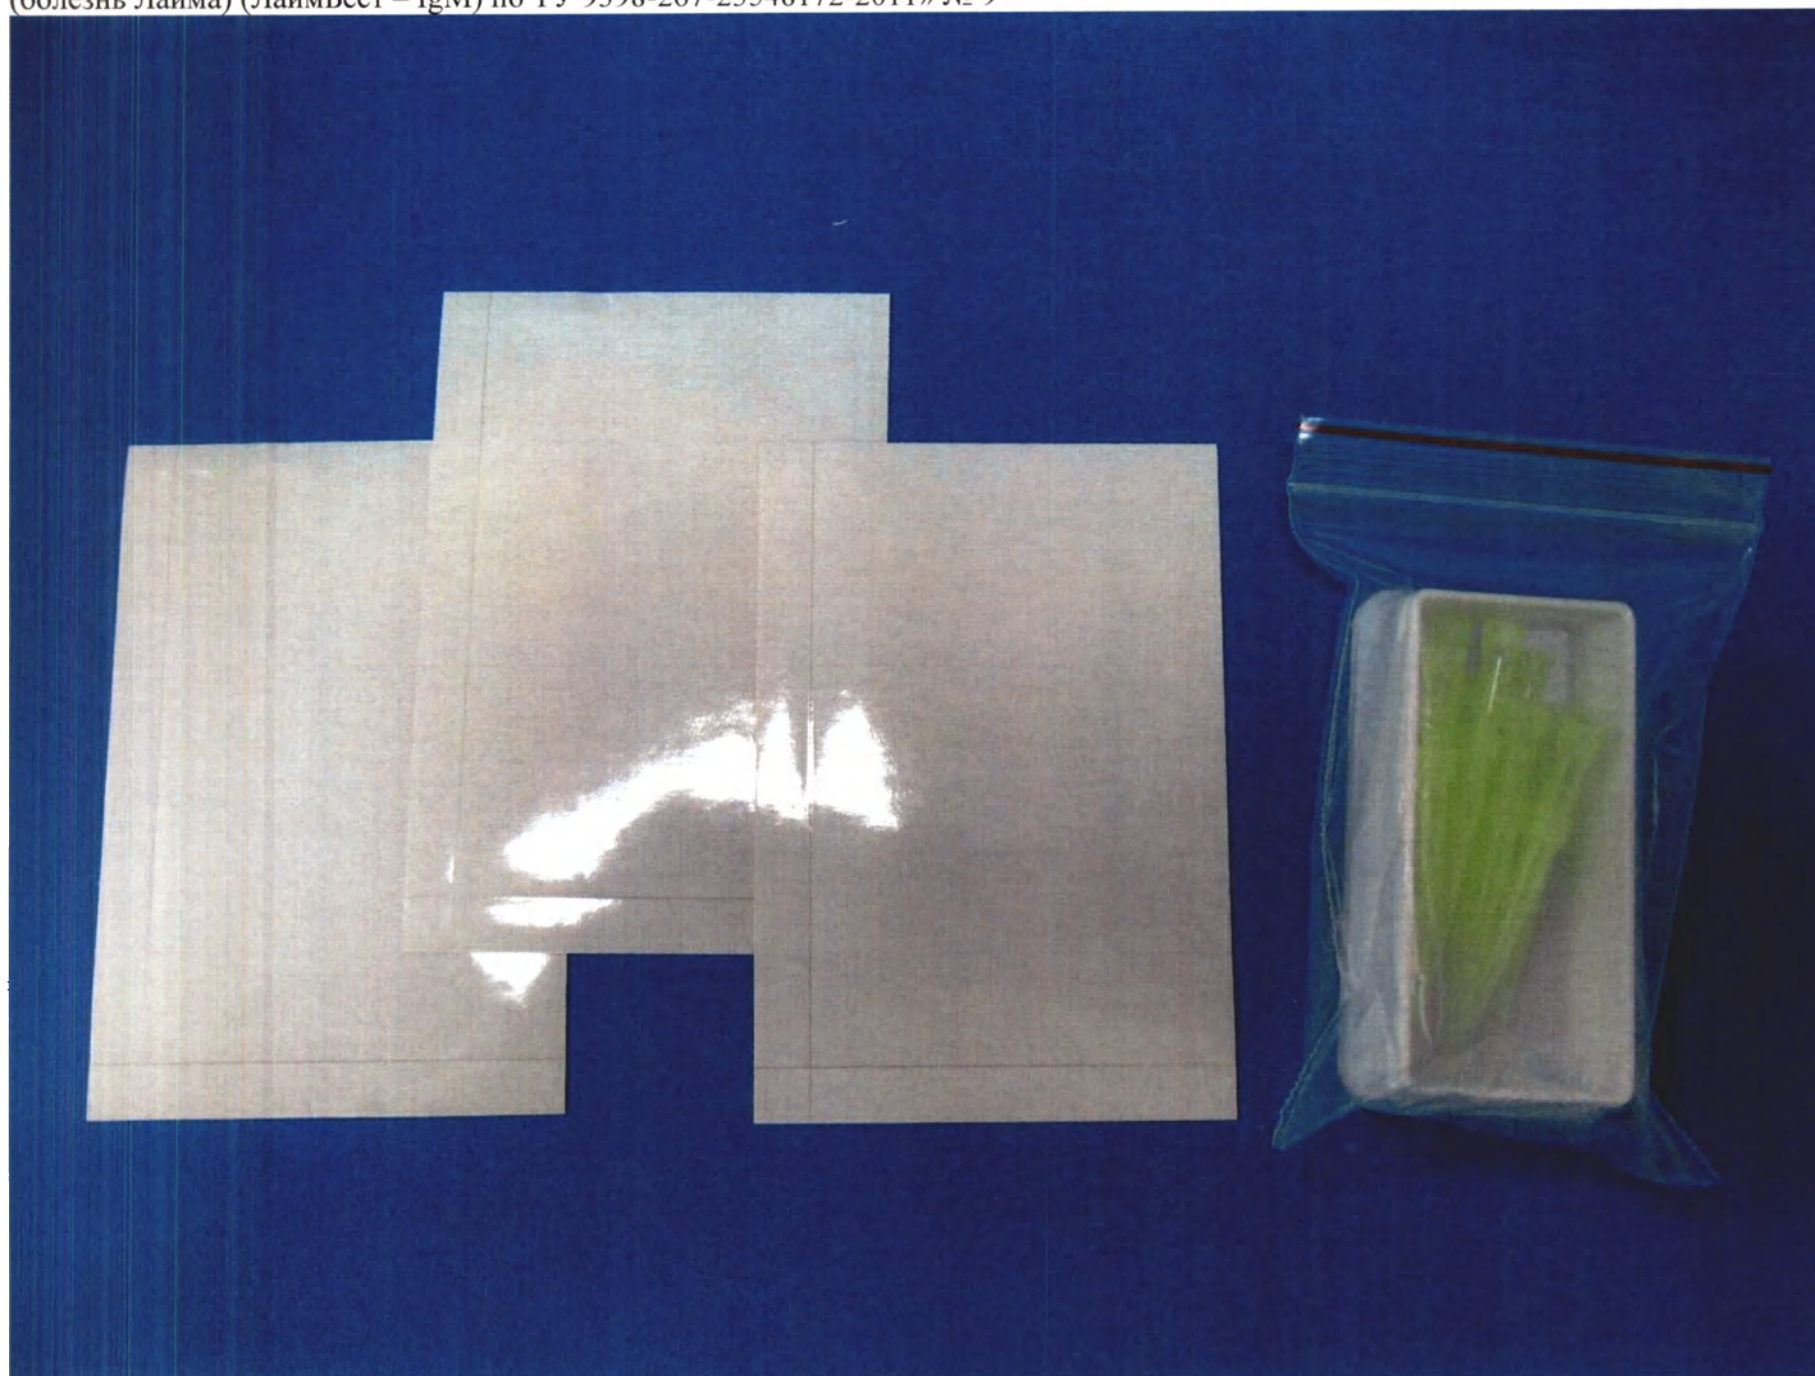

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011»




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 1

ВЕКТОР

БЕСТ

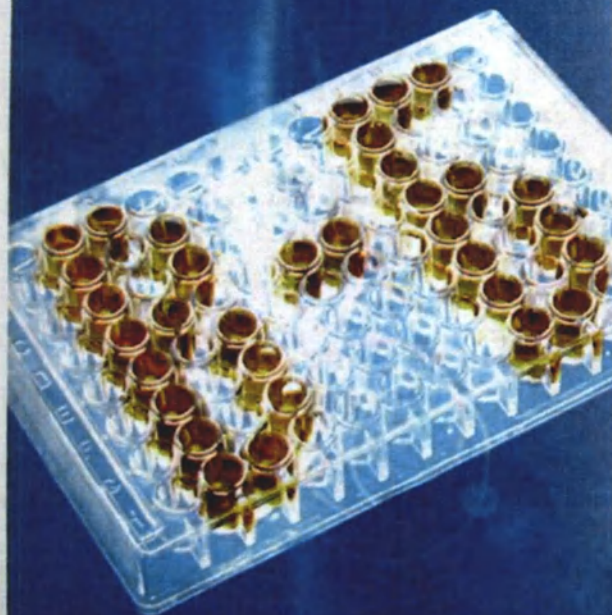

REF

D-1454

набор реагентов для иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов класса М
к возбудителям иксодовых клещевых
боррелиозов (болезнь Лайма)

ЛаймБест – IgM

КОД 447

СОСТАВ:

КОД

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.	1 шт.	523327
2. Положительный контрольный образец (К ⁺)	1 фл.	0,5 мл 4809
3. Отрицательный контрольный образец (К ⁻)	1 фл.	0,5 мл 3969
4. Конъюгат, концентрат	1 фл.	1,5 мл 12568
5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	1 фл.	13,0 мл 510011
6. Раствор для разведения сывороток (РС)	1 фл.	13,0 мл 753378
7. Раствор для разведения конъюгата (РК)	1 фл.	13,0 мл 5906
8. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх28)	1 фл.	28,0 мл 2979
9. Субстратный буферный раствор (СБР)	1 фл.	13,0 мл 665
10. Тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ (концентрат))	1 фл.	1,5 мл 40679
11. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл 1448
12. Плёнка для заклеивания планшета	3 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	
14. Наконечники для дозаторов	16 шт.	
15. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 3

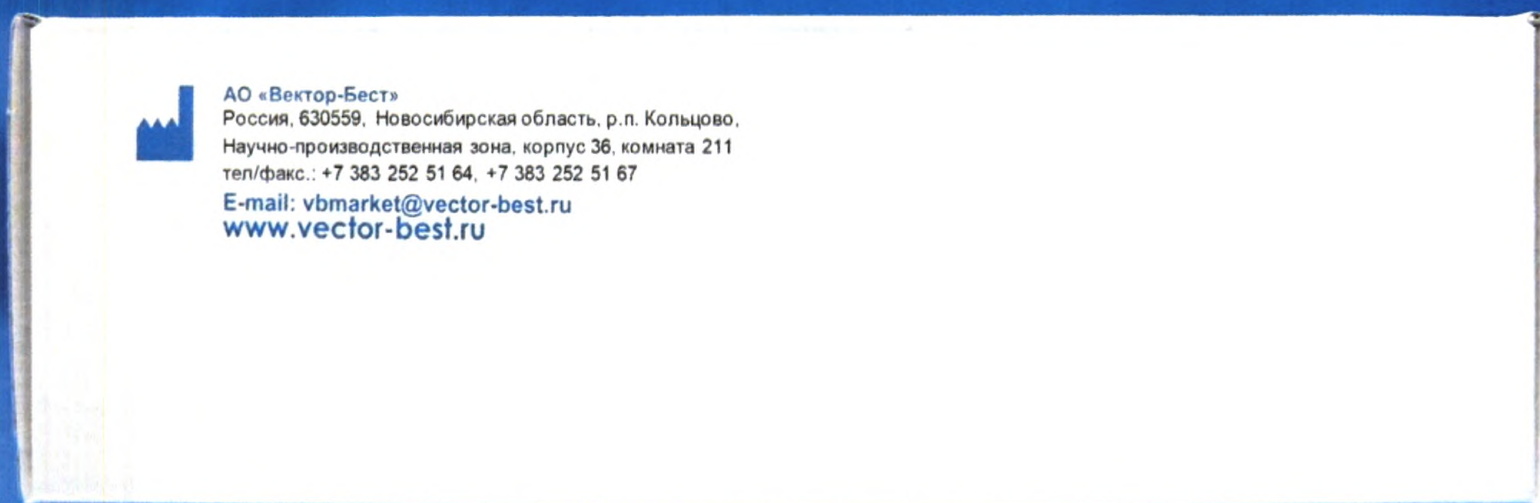

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов
(болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов
(болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 3



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 4



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 5



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 6




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 7



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 8

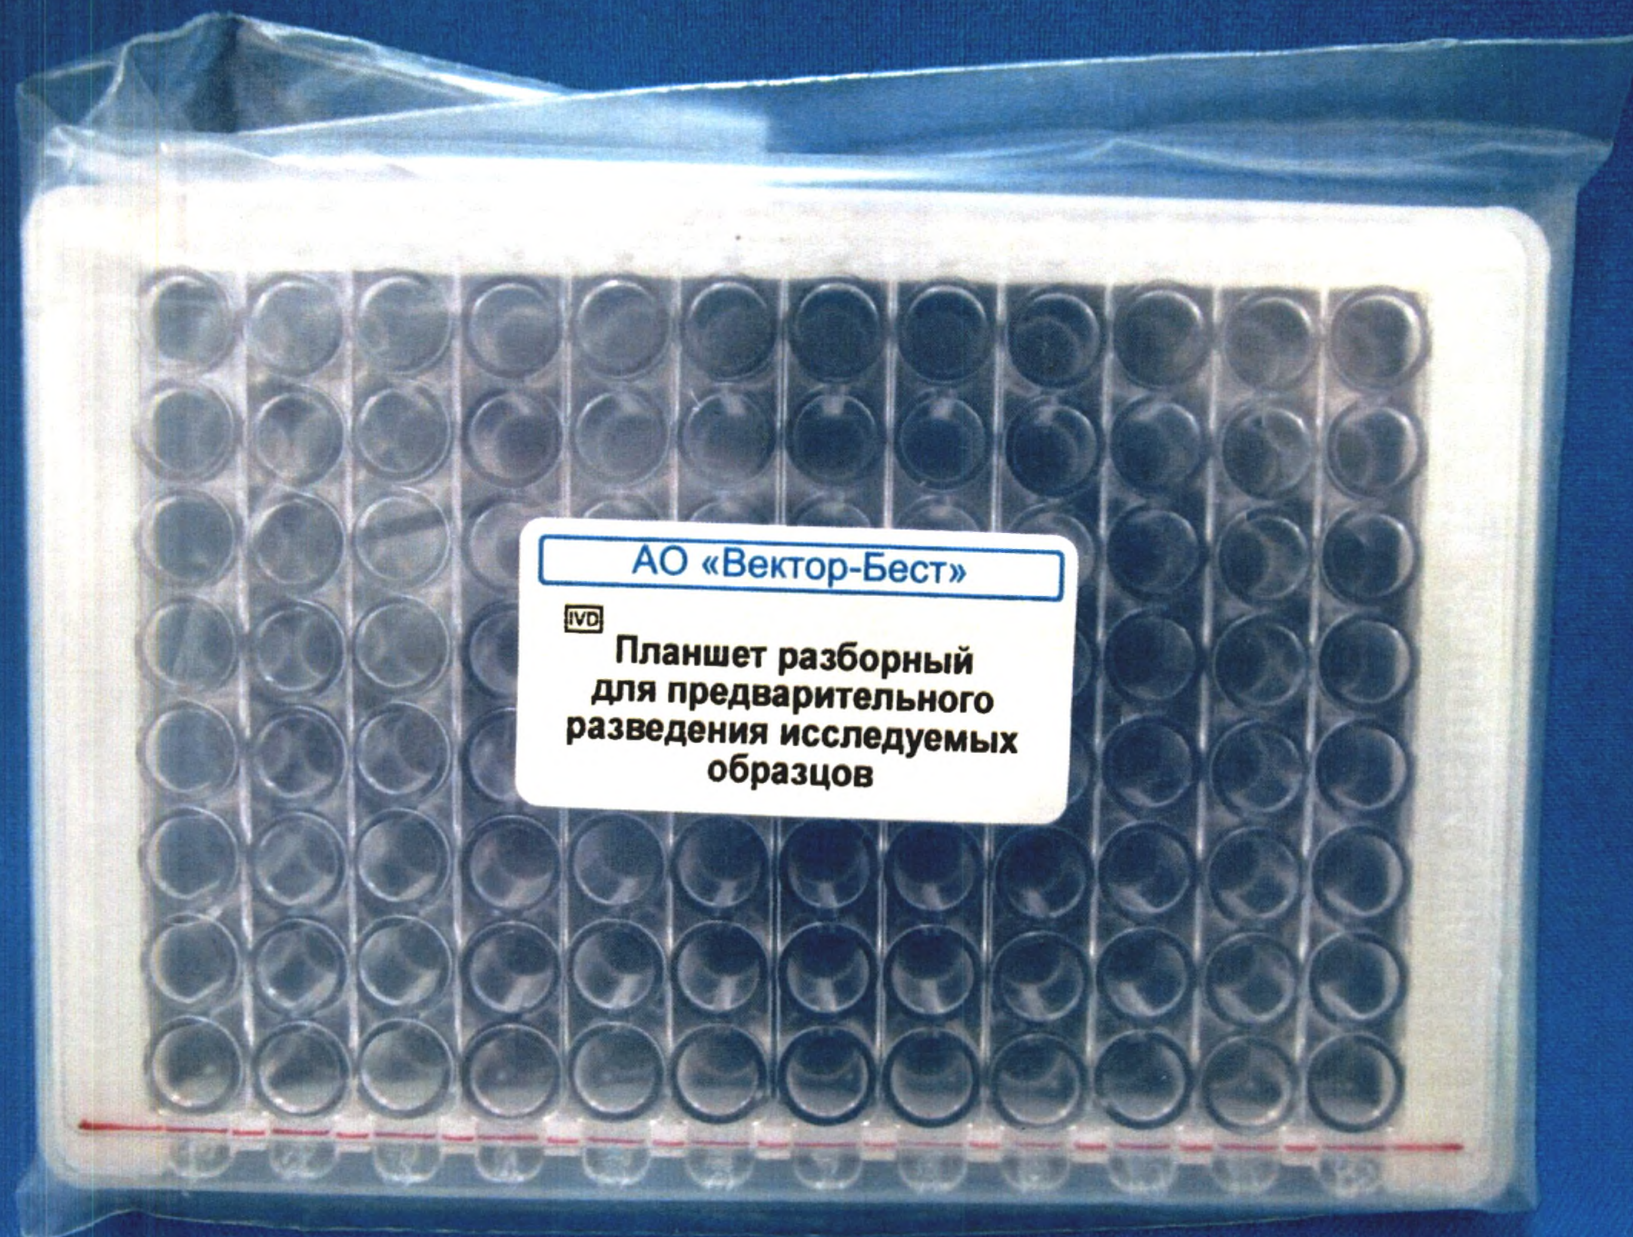

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест – IgM) по ТУ 9398-267-23548172-2011» № 9



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 27 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



04 12 Масяго А.В.
20 23 г.